



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	190315	190549	190842	190274	190636	190523	0.13
2	12.64	189938	190262				190100	0.13

单位质量响应值		RSD%	判断
14990.01	15039.56	0.24	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2022030401批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	170051	-	170051	79.290	82.52	8.20	79.29	82.52	8.20
	2	188895	-	188895	88.077			88.08		
	3	184145	-	184145	85.862			85.86		
	4	188207	-	188207	87.756			87.76		
	5	150954	-	150954	70.386			70.39		
	6	179578	-	179578	83.732			83.73		
10min	1	194873	-	194873	90.864	89.68	2.39	91.00	89.82	2.39
	2	197020	-	197020	91.865			92.01		
	3	190859	-	190859	88.993			89.14		
	4	196848	-	196848	91.785			91.93		
	5	186603	-	186603	87.008			87.13		
	6	187739	-	187739	87.538			87.68		
15min	1	194611	-	194611	90.742	90.51	1.55	91.03	90.80	1.55
	2	197629	-	197629	92.149			92.45		
	3	190665	-	190665	88.902			89.19		
	4	196502	-	196502	91.624			91.92		
	5	190370	-	190370	88.765			89.03		
	6	194940	-	194940	90.895			91.18		
20min	1	197719	-	197719	92.191	92.09	1.81	92.63	92.53	1.81
	2	197891	-	197891	92.271			92.72		
	3	192935	-	192935	89.961			90.40		
	4	202014	-	202014	94.194			94.65		
	5	193909	-	193909	90.415			90.82		
	6	200529	-	200529	93.501			93.94		
30min	1	201731	-	201731	94.062	93.40	1.12	94.65	93.99	1.13
	2	200748	-	200748	93.604			94.21		
	3	197013	-	197013	91.862			92.45		
	4	202142	-	202142	94.253			94.86		
	5	198054	-	198054	92.347			92.91		
	6	202216	-	202216	94.288			94.88		
45min	1	204653	-	204653	95.424	94.78	1.20	96.17	95.52	1.20
	2	203130	-	203130	94.714			95.48		
	3	200031	-	200031	93.269			94.01		
	4	204628	-	204628	95.413			96.18		
	5	200846	-	200846	93.649			94.36		
	6	206298	-	206298	96.191			96.94		
极限	1	206085	-	206085	96.092	95.64	1.14	97.00	96.54	1.14
	2	205433	-	205433	95.788			96.71		
	3	201331	-	201331	93.875			94.77		
	4	205565	-	205565	95.850			96.77		
	5	203929	-	203929	95.087			95.96		
	6	208301	-	208301	97.125			98.04		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	190174	190283	190170	190145	190048	190164	0.05
2	12.64	189785	190274				190030	0.19
单位质量响应值			RSD%	判断				
14961.76			0.35	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2022030501批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	160813	-	160813	75.068	80.88	7.77	75.07	80.88	7.77
	2	185941	-	185941	86.797			86.80		
	3	183586	-	183586	85.698			85.70		
	4	180787	-	180787	84.391			84.39		
	5	152746	-	152746	71.302			71.30		
	6	175685	-	175685	82.010			82.01		
10min	1	182742	-	182742	85.304	87.92	2.55	85.43	88.06	2.56
	2	194283	-	194283	90.691			90.84		
	3	190941	-	190941	89.131			89.27		
	4	192399	-	192399	89.812			89.95		
	5	184120	-	184120	85.947			86.07		
	6	185638	-	185638	86.656			86.79		
15min	1	193135	-	193135	90.155	90.69	1.40	90.42	90.97	1.41
	2	198343	-	198343	92.587			92.88		
	3	194249	-	194249	90.675			90.97		
	4	196054	-	196054	91.518			91.81		
	5	193483	-	193483	90.318			90.58		
	6	190359	-	190359	88.860			89.14		
20min	1	197494	-	197494	92.190	91.96	1.31	92.61	92.39	1.31
	2	200200	-	200200	93.453			93.90		
	3	196211	-	196211	91.591			92.03		
	4	198518	-	198518	92.668			93.11		
	5	196990	-	196990	91.955			92.37		
	6	192562	-	192562	89.888			90.32		
30min	1	202164	-	202164	94.370	93.93	1.45	94.94	94.51	1.45
	2	204622	-	204622	95.518			96.12		
	3	199408	-	199408	93.084			93.68		
	4	202630	-	202630	94.588			95.19		
	5	202119	-	202119	94.349			94.92		
	6	196333	-	196333	91.648			92.23		
45min	1	206452	-	206452	96.372	95.30	1.56	97.10	96.04	1.55
	2	206614	-	206614	96.447			97.21		
	3	201876	-	201876	94.236			94.99		
	4	205506	-	205506	95.930			96.69		
	5	205744	-	205744	96.041			96.76		
	6	198738	-	198738	92.771			93.50		
极限	1	209499	-	209499	97.794	96.06	1.88	98.68	96.96	1.87
	2	208175	-	208175	97.176			98.10		
	3	203213	-	203213	94.860			95.77		
	4	205623	-	205623	95.985			96.90		
	5	208724	-	208724	97.432			98.32		
	6	199476	-	199476	93.115			94.00		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	190851	190392	190555	190723	190329	190570	0.12
2	12.64	189955	190103				190029	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
14993.71		15033.94		0.19	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2022030601批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	174370	-	174370	81.309	78.81	9.97	81.31	78.81	9.97
	2	173538	-	173538	80.921			80.92		
	3	187116	-	187116	87.253			87.25		
	4	150047	-	150047	69.967			69.97		
	5	146604	-	146604	68.362			68.36		
	6	182363	-	182363	85.036			85.04		
10min	1	189421	-	189421	88.328	87.18	4.42	88.46	87.31	4.42
	2	190994	-	190994	89.061			89.20		
	3	196109	-	196109	91.446			91.59		
	4	176180	-	176180	82.153			82.27		
	5	177257	-	177257	82.655			82.77		
	6	191814	-	191814	89.443			89.59		
15min	1	192863	-	192863	89.933	90.07	2.63	90.22	90.34	2.64
	2	195035	-	195035	90.945			91.23		
	3	200542	-	200542	93.513			93.81		
	4	186481	-	186481	86.957			87.21		
	5	188590	-	188590	87.940			88.19		
	6	195410	-	195410	91.120			91.41		
20min	1	195104	-	195104	90.978	91.57	2.24	91.41	92.00	2.25
	2	198046	-	198046	92.349			92.78		
	3	203506	-	203506	94.895			95.35		
	4	191349	-	191349	89.227			89.63		
	5	192597	-	192597	89.809			90.21		
	6	197625	-	197625	92.153			92.60		
30min	1	198653	-	198653	92.632	93.14	1.91	93.22	93.72	1.92
	2	200818	-	200818	93.642			94.23		
	3	206018	-	206018	96.067			96.68		
	4	194592	-	194592	90.739			91.29		
	5	197883	-	197883	92.273			92.82		
	6	200490	-	200490	93.489			94.09		
45min	1	201778	-	201778	94.090	94.55	1.56	94.83	95.28	1.58
	2	204738	-	204738	95.470			96.21		
	3	207941	-	207941	96.964			97.74		
	4	198884	-	198884	92.740			93.44		
	5	201078	-	201078	93.763			94.47		
	6	202167	-	202167	94.271			95.02		
极限	1	204631	-	204631	95.420	96.02	1.38	96.32	96.92	1.39
	2	207419	-	207419	96.720			97.62		
	3	210645	-	210645	98.224			99.16		
	4	202480	-	202480	94.417			95.27		
	5	205788	-	205788	95.960			96.82		
	6	204565	-	204565	95.389			96.30		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	190408	190614	190394	190592	190438	190489	0.06
2	12.64	190661	190770				190716	0.05
单位质量响应值			RSD%	判断				
14987.33			0.48	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-U028516批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	133008	-	133008	61.924	68.80	11.32	61.92	68.80	11.32
	2	142916	-	142916	66.536			66.54		
	3	137158	-	137158	63.856			63.86		
	4	148195	-	148195	68.994			68.99		
	5	179976	-	179976	83.790			83.79		
	6	145377	-	145377	67.682			67.68		
10min	1	165965	-	165965	77.267	81.41	5.82	77.37	81.52	5.83
	2	170057	-	170057	79.172			79.28		
	3	168153	-	168153	78.286			78.39		
	4	180678	-	180678	84.117			84.23		
	5	192867	-	192867	89.792			89.93		
	6	171439	-	171439	79.816			79.93		
15min	1	179756	-	179756	83.688	87.29	3.43	83.92	87.55	3.44
	2	185522	-	185522	86.372			86.62		
	3	184111	-	184111	85.715			85.95		
	4	193336	-	193336	90.010			90.27		
	5	197074	-	197074	91.750			92.04		
	6	185216	-	185216	86.230			86.48		
20min	1	187499	-	187499	87.293	90.27	2.38	87.66	90.66	2.39
	2	193687	-	193687	90.174			90.56		
	3	191962	-	191962	89.371			89.75		
	4	198208	-	198208	92.278			92.68		
	5	200087	-	200087	93.153			93.60		
	6	191857	-	191857	89.322			89.71		
30min	1	195079	-	195079	90.822	93.20	1.89	91.34	93.75	1.91
	2	199598	-	199598	92.926			93.46		
	3	199755	-	199755	92.999			93.53		
	4	205001	-	205001	95.441			96.00		
	5	204059	-	204059	95.002			95.60		
	6	197632	-	197632	92.010			92.55		
45min	1	200796	-	200796	93.483	94.92	1.45	94.15	95.62	1.46
	2	203605	-	203605	94.791			95.48		
	3	203698	-	203698	94.834			95.52		
	4	208904	-	208904	97.258			97.98		
	5	205089	-	205089	95.482			96.24		
	6	201200	-	201200	93.671			94.36		
极限	1	206107	-	206107	95.956	96.52	1.09	96.78	97.38	1.10
	2	207583	-	207583	96.643			97.49		
	3	207324	-	207324	96.523			97.36		
	4	211169	-	211169	98.313			99.19		
	5	207419	-	207419	96.567			97.48		
	6	204324	-	204324	95.126			95.97		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:


未审阅版本

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1517-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:21:54 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:11 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

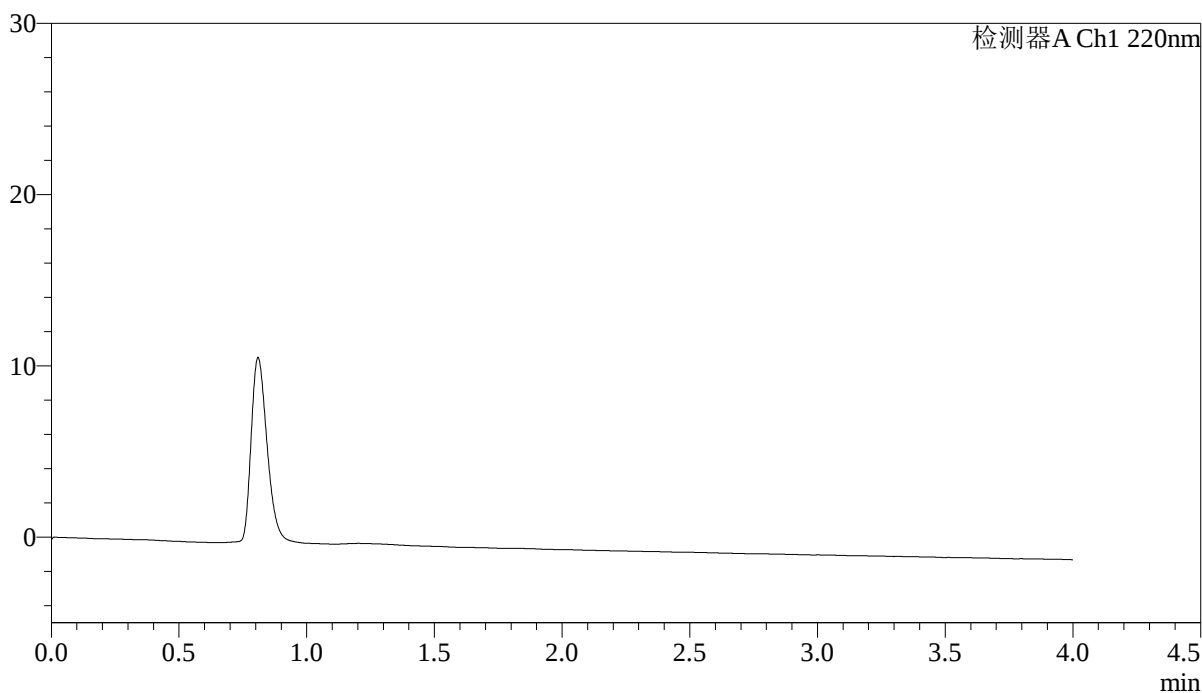

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1518-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:26:17 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:19 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

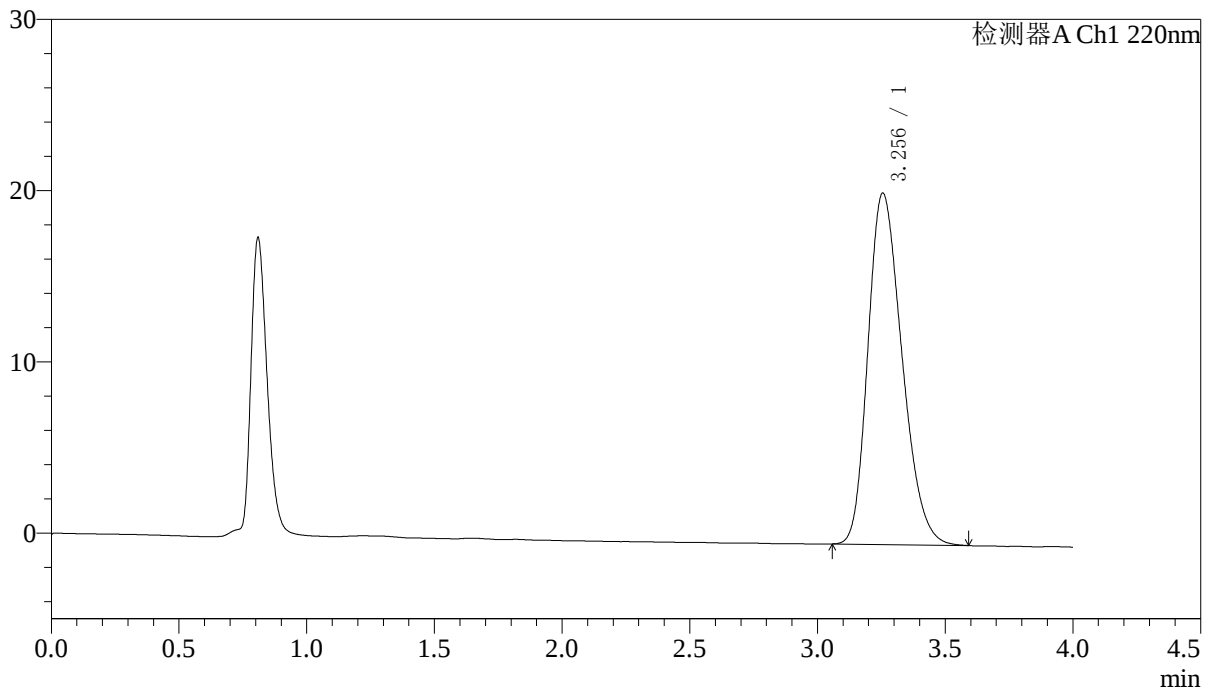

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.256	190315	100.000	20531	2830	1.257	--
总计		190315	100.000	20531			


图2 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1519-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:30:40 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:26 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

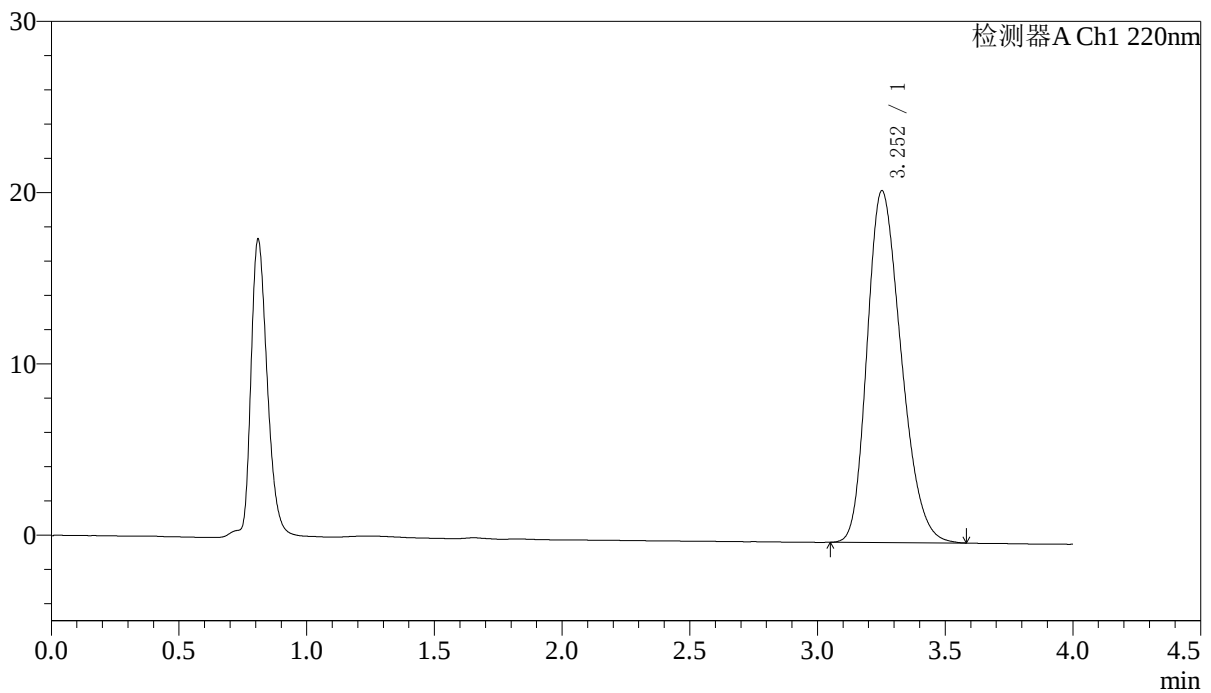

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.252	190549	100.000	20529	2832	1.256	--
总计		190549	100.000	20529			


图3 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1520-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:35:03 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:33 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

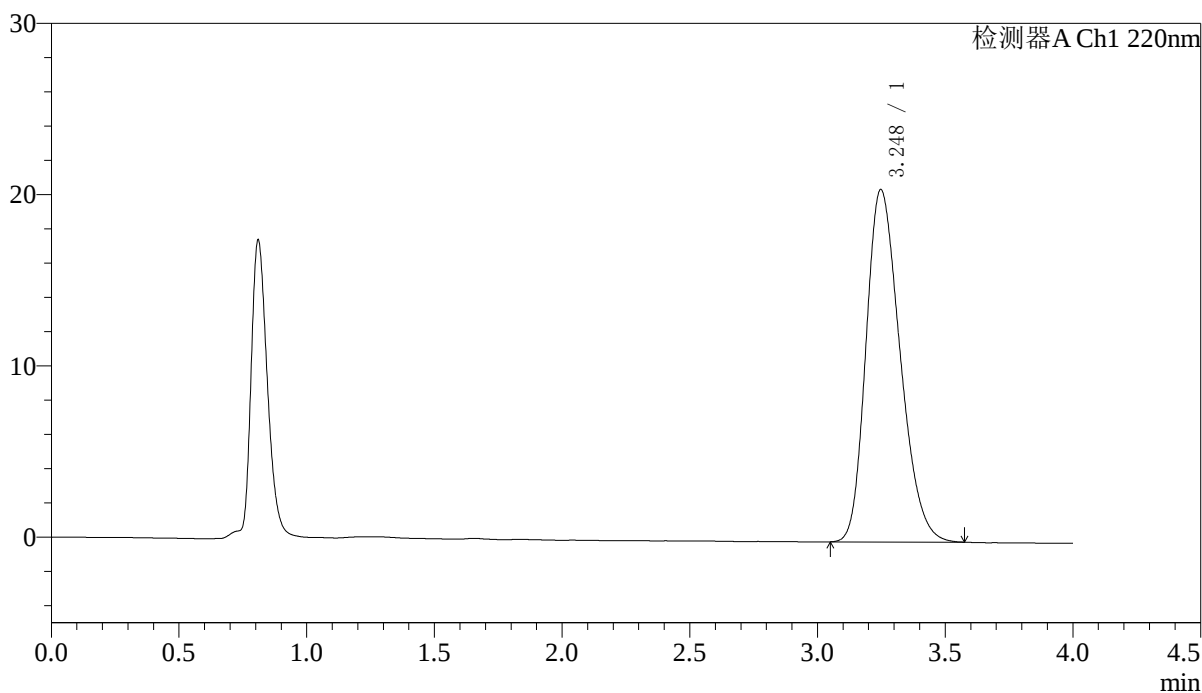

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.248	190842	100.000	20582	2820	1.258	--
总计		190842	100.000	20582			

图4 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3



J465

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)

波长 : 220nm

数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1521-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd

方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/28 11:39:26

处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:40

仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.0ml/min


柱温:30°C

版本号:6.115

分析者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

＜色谱图＞

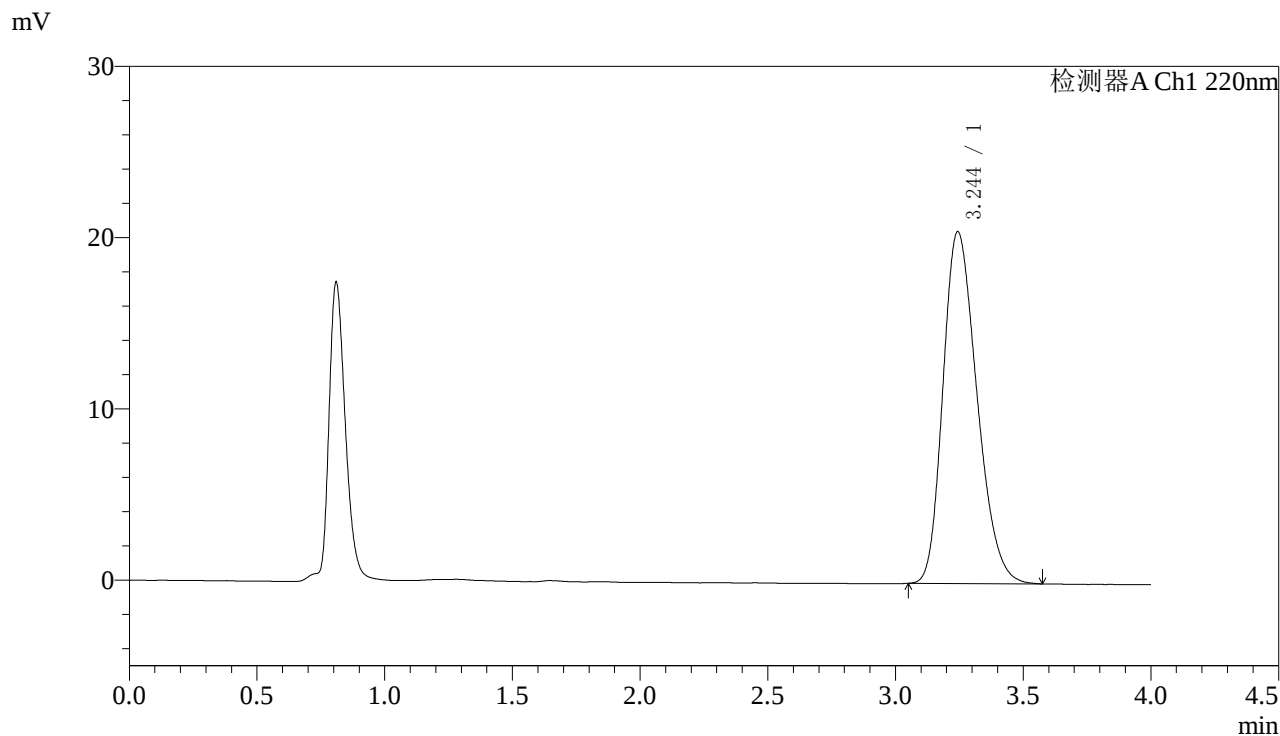

＜峰表＞

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.244	190274	100.000	20528	2820	1.256	--
总计		190274	100.000	20528			

图5 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4



J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)

波长 : 220nm

数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1522-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd

方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/28 11:43:49

处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:47

仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流速:1.0ml/min


柱温:30°C

版本号:6.115

分析者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

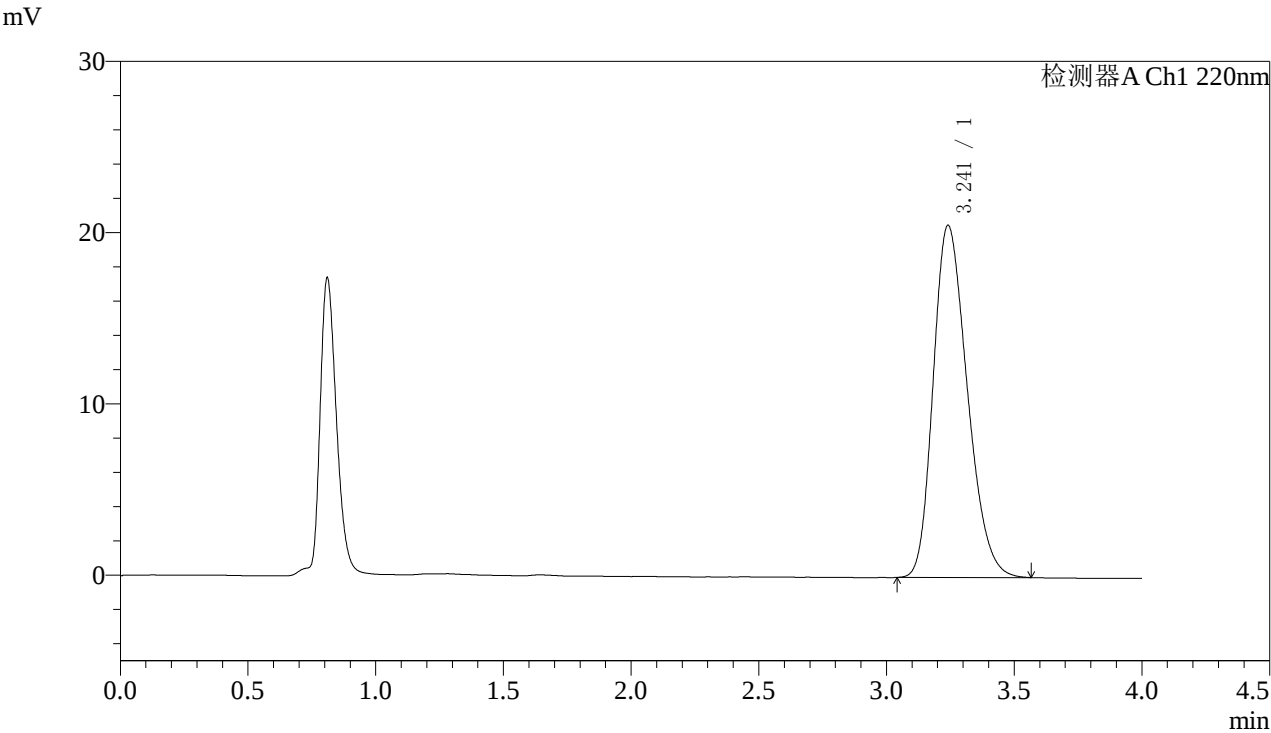

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.241	190636	100.000	20554	2812	1.254	--
总计		190636	100.000	20554			


图6 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1523-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:48:12 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:52:54 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

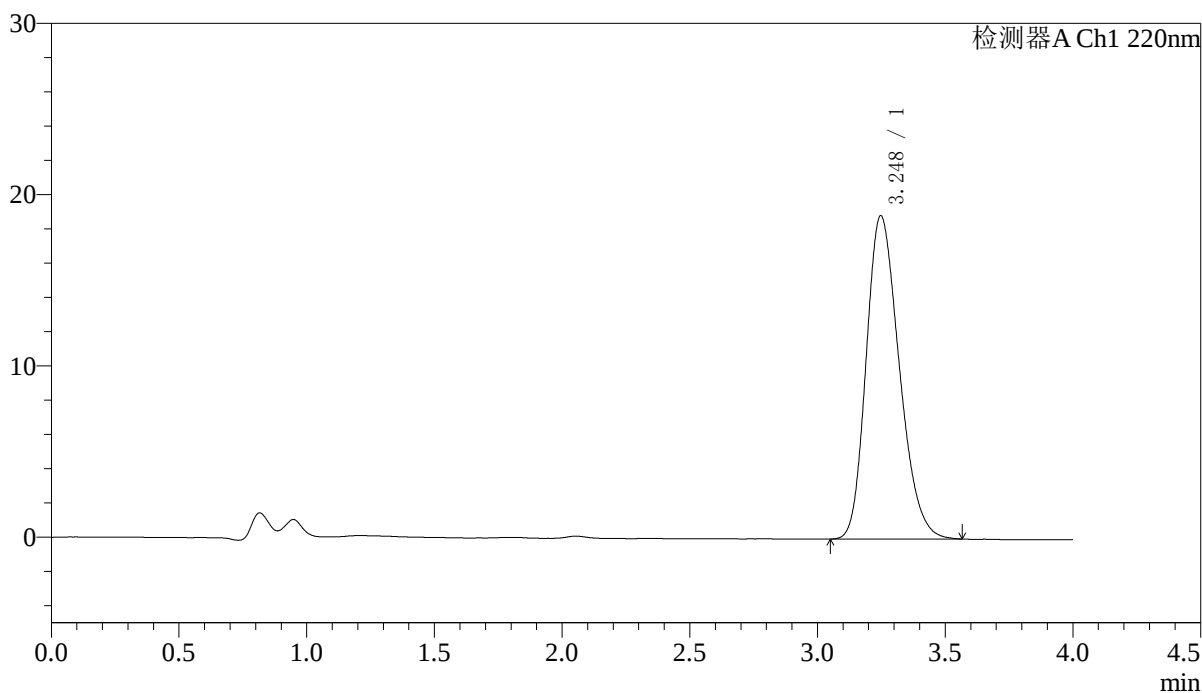

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.248	170051	100.000	18888	2994	1.239	--
总计		170051	100.000	18888			


图7 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1524-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:52:34 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:01 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

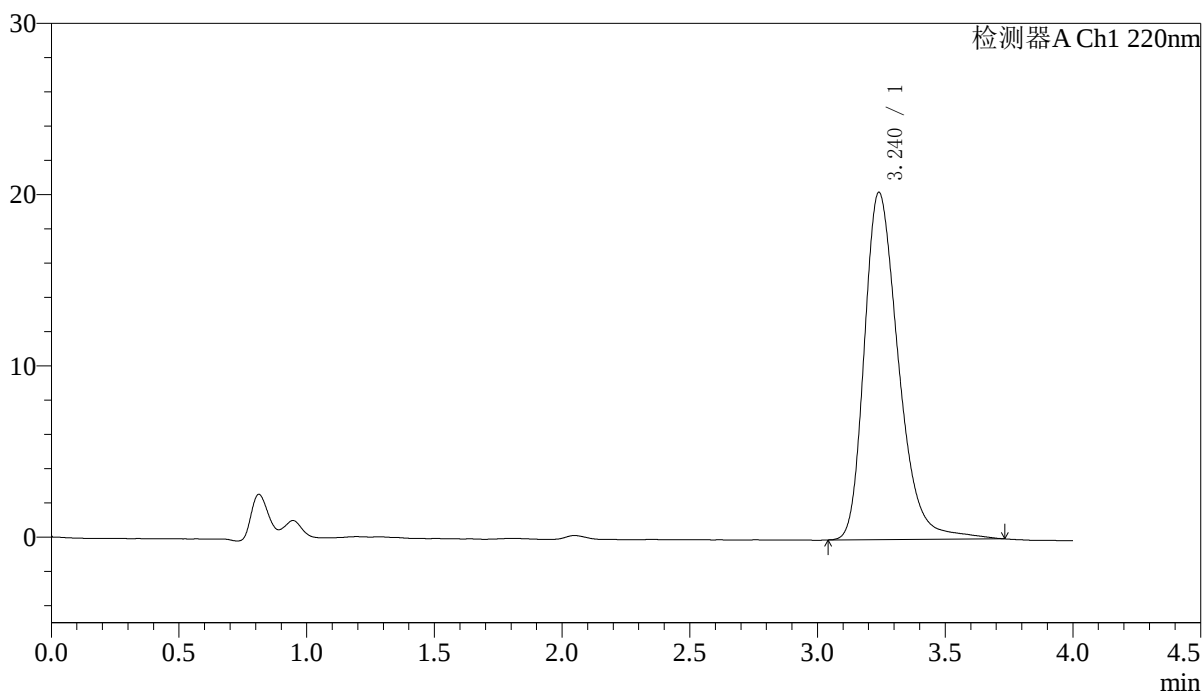

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.240	188895	100.000	20277	2938	1.307	--
总计		188895	100.000	20277			


图8 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1525-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 11:56:56 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:08 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

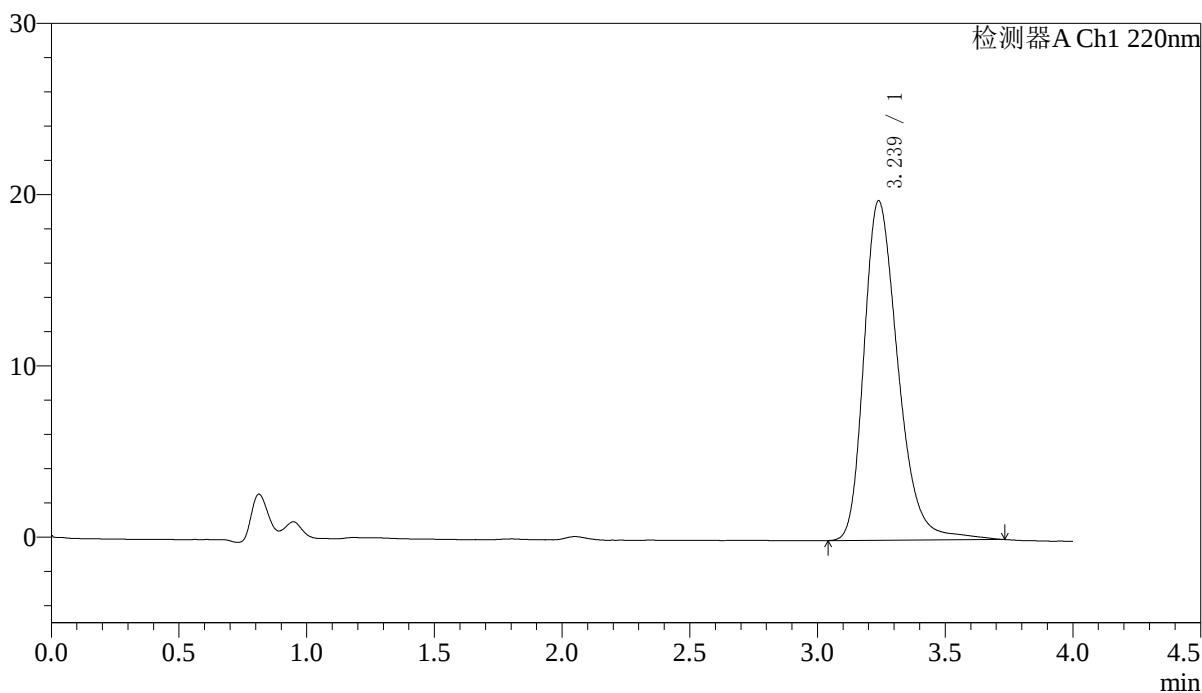

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.239	184145	100.000	19832	2948	1.292	--
总计		184145	100.000	19832			


图9 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1526-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:01:18 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:15 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

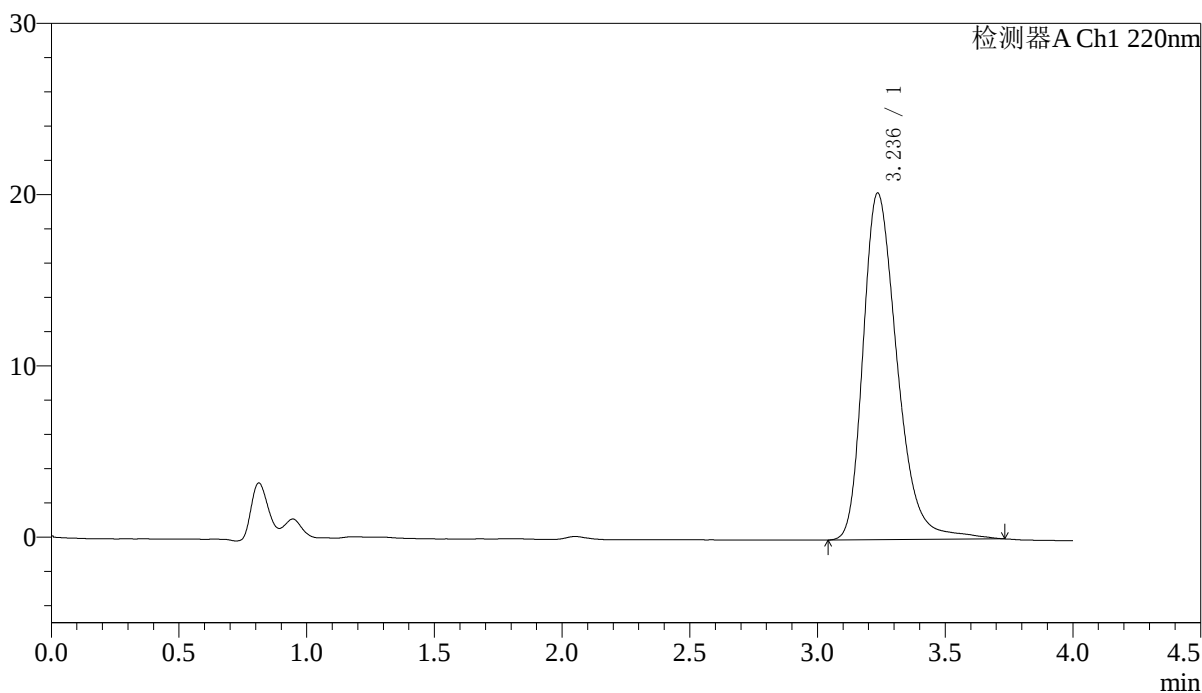

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.236	188207	100.000	20228	2945	1.305	--
总计		188207	100.000	20228			


图10 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1527-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:05:39 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:22 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

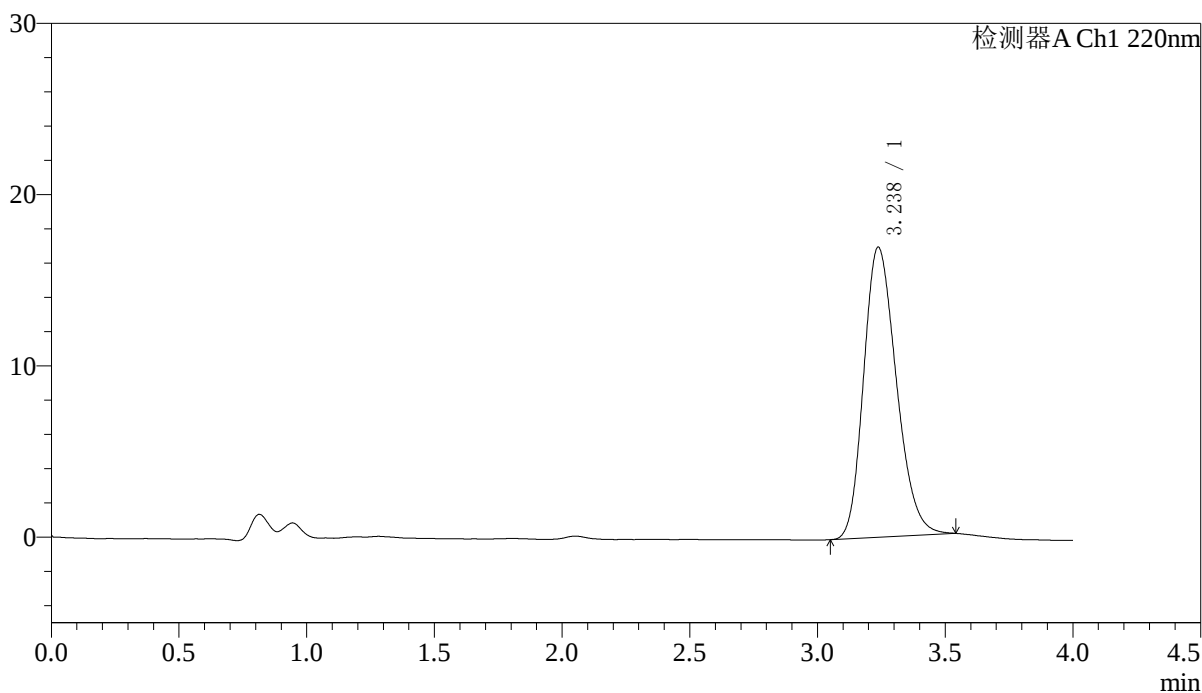

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.238	150954	100.000	16945	3042	1.224	--
总计		150954	100.000	16945			


图11 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1528-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:10:00 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:29 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

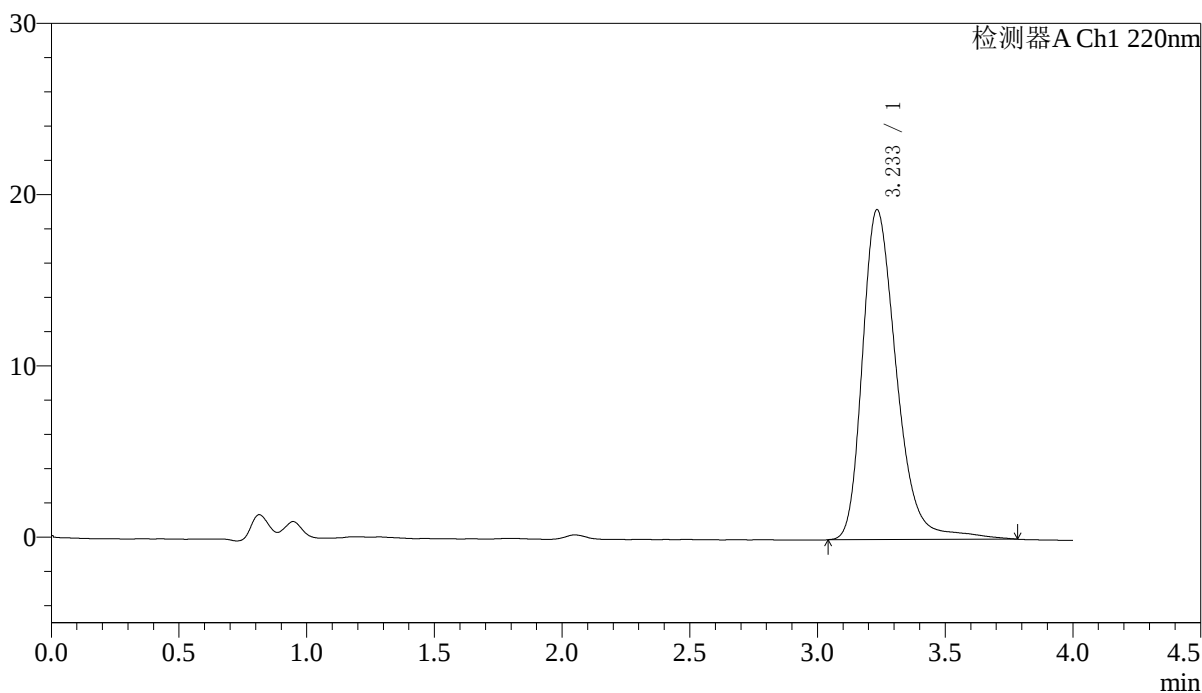

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.233	179578	100.000	19246	2969	1.295	--
总计		179578	100.000	19246			


图12 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1529-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:14:22 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:36 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

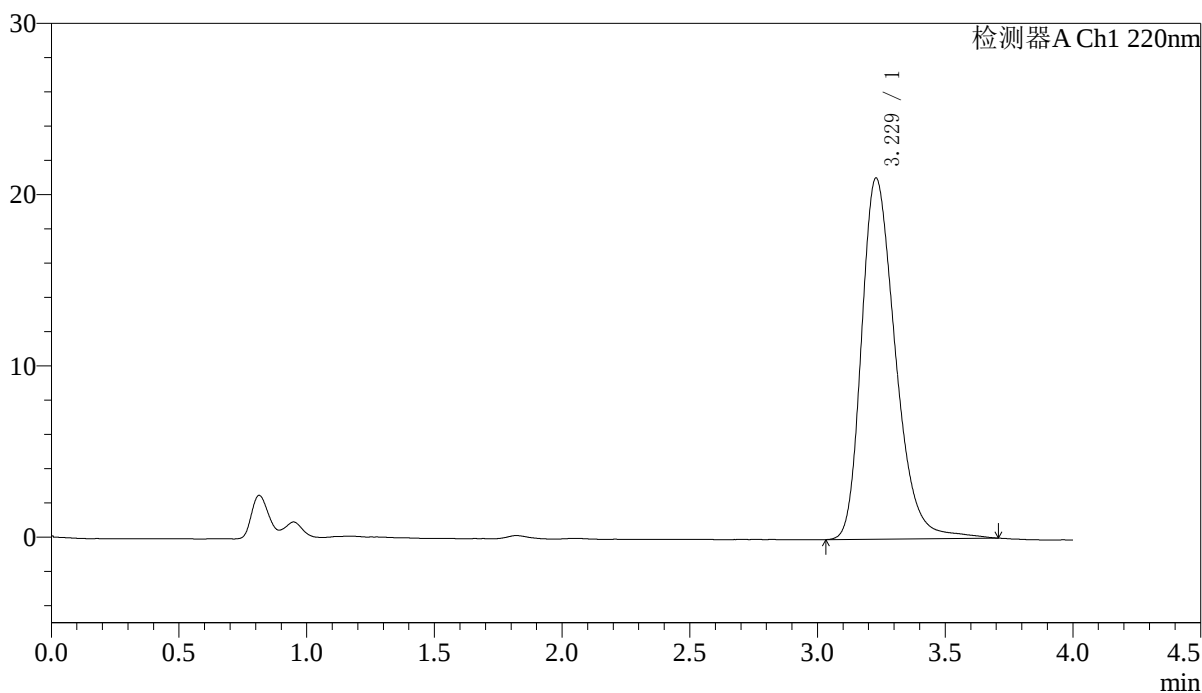

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.229	194873	100.000	21094	2930	1.294	--
总计		194873	100.000	21094			


图13 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1530-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:18:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:43 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

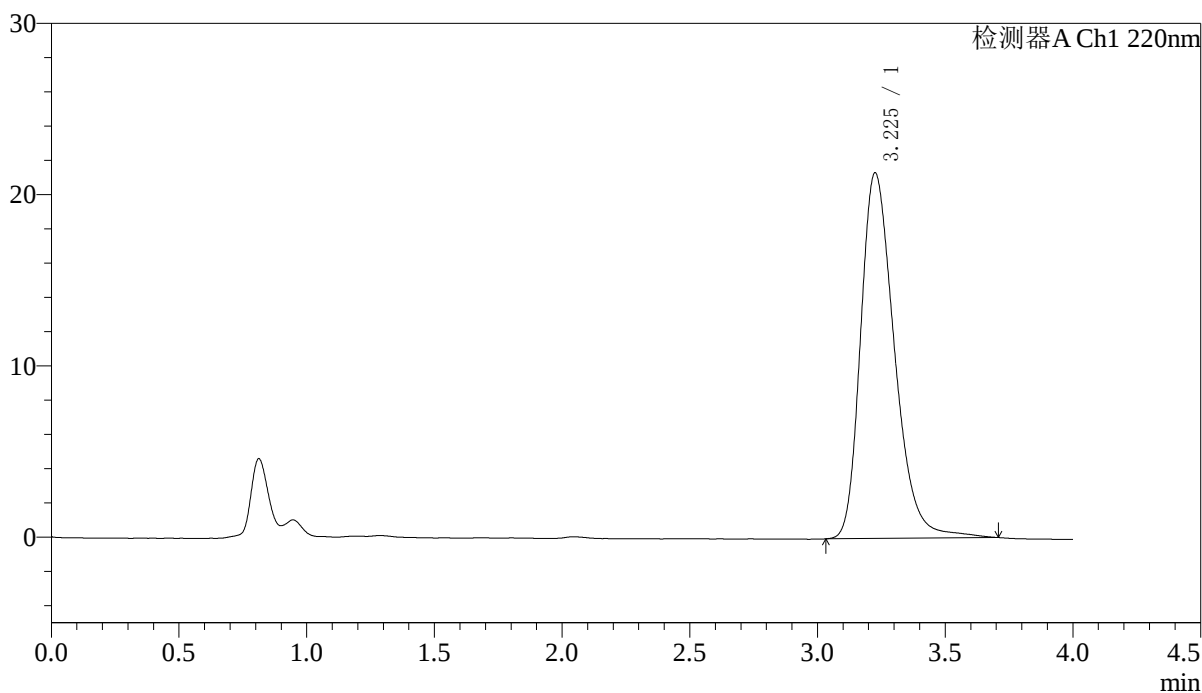

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.225	197020	100.000	21314	2934	1.298	--
总计		197020	100.000	21314			


图14 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1531-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:23:07 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:50 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

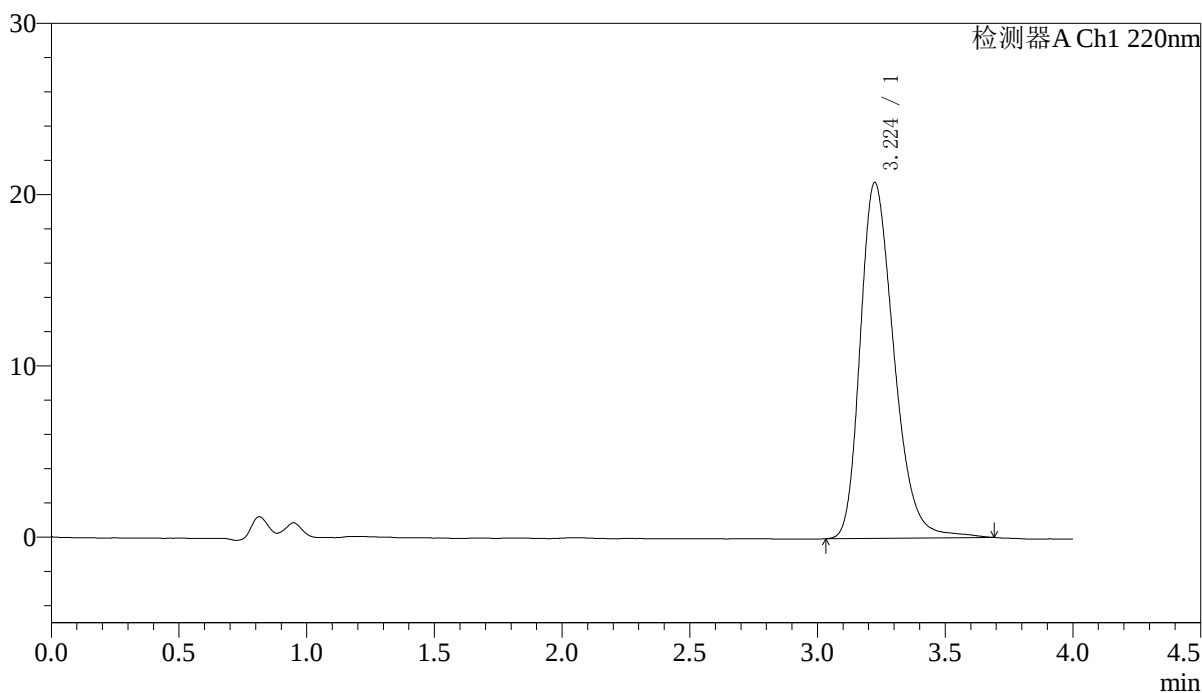

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.224	190859	100.000	20769	2944	1.281	--
总计		190859	100.000	20769			


图15 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1532-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:27:29 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:53:57 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

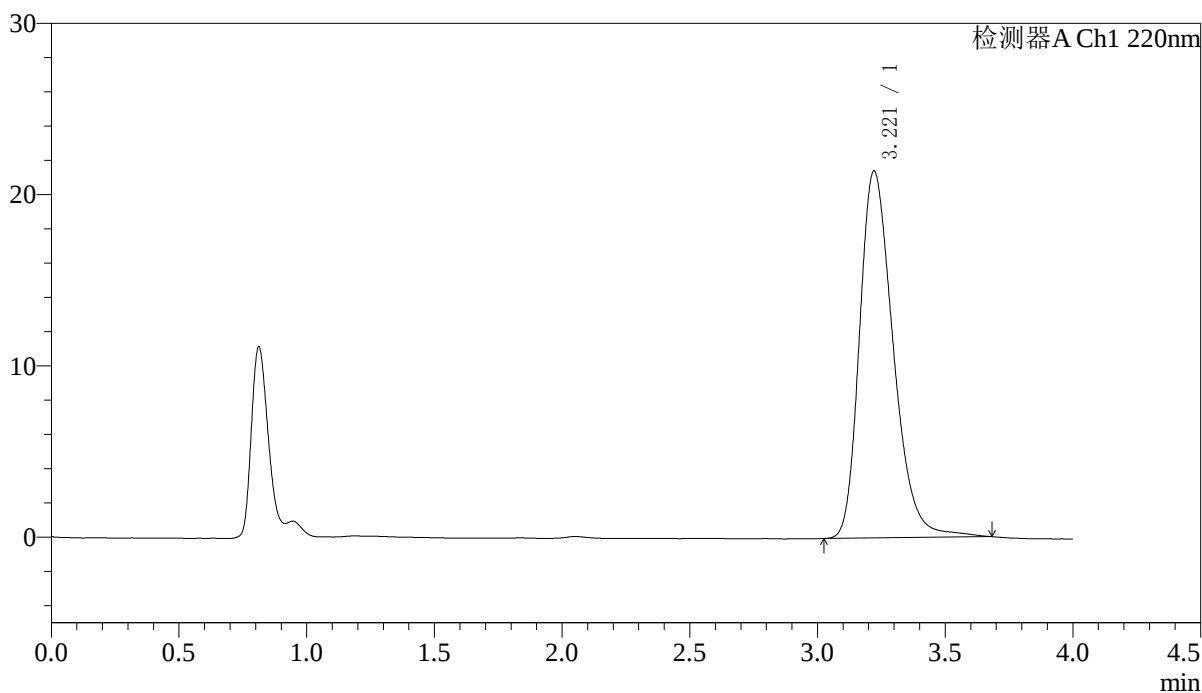

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.221	196848	100.000	21432	2937	1.289	--
总计		196848	100.000	21432			


图16 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1533-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:31:51 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:04 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

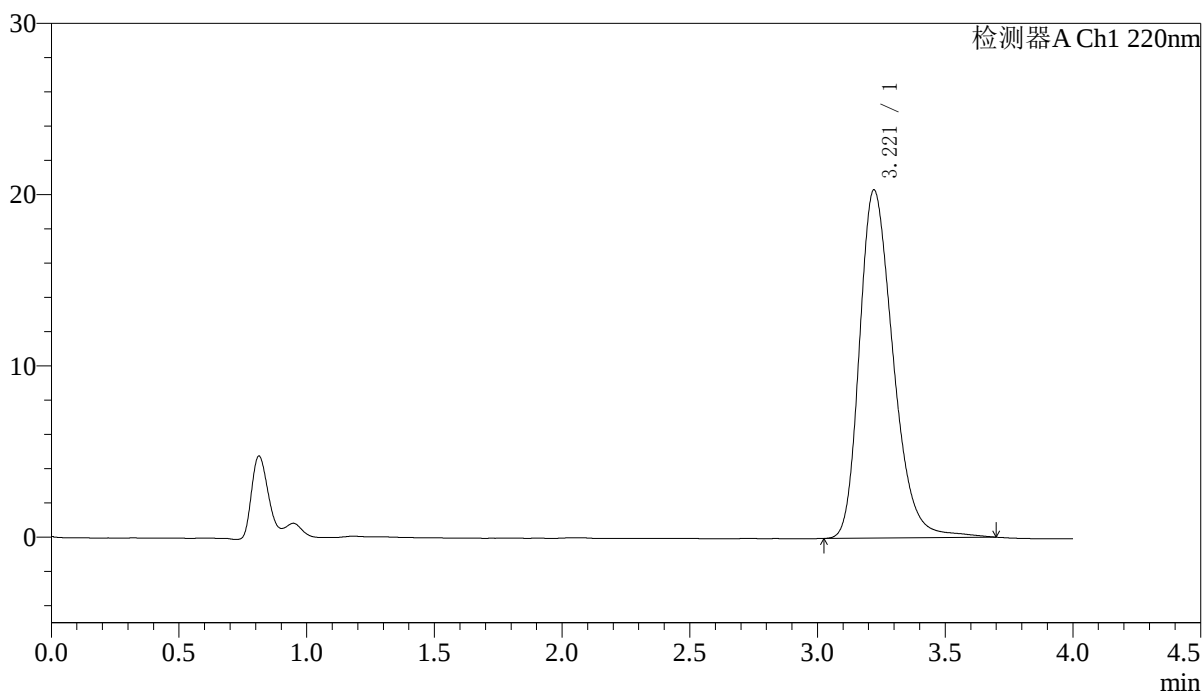

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.221	186603	100.000	20342	2953	1.282	--
总计		186603	100.000	20342			


图17 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1534-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:36:12 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:11 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

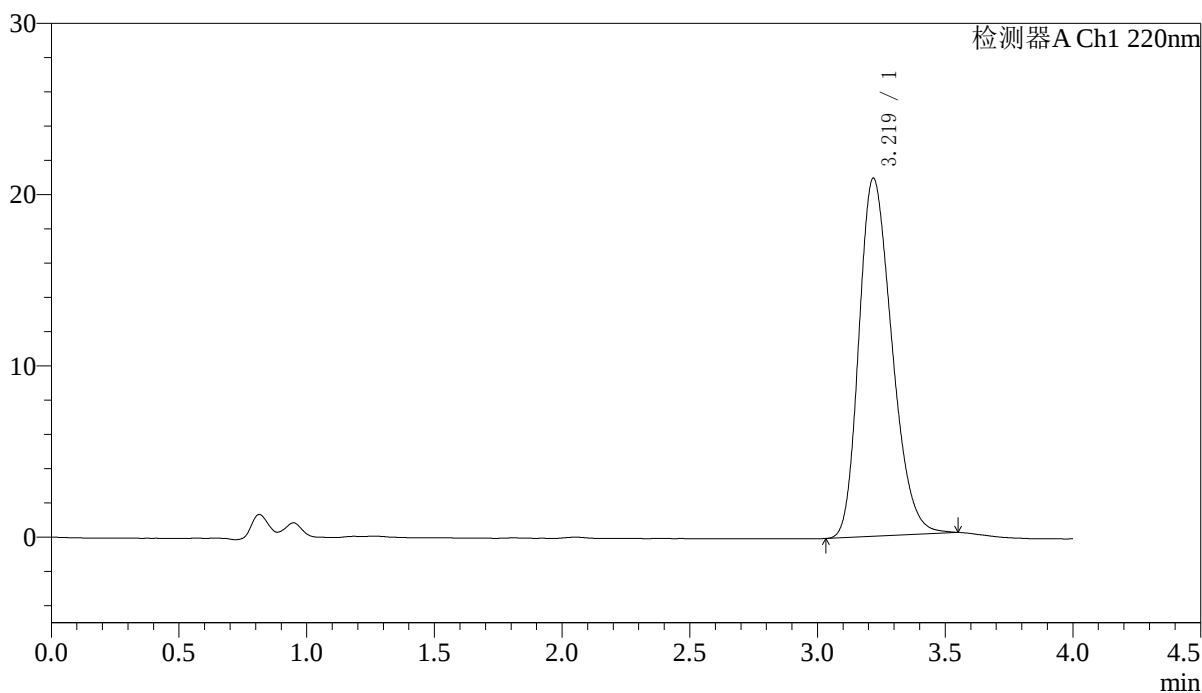

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.219	187739	100.000	20892	2968	1.256	--
总计		187739	100.000	20892			


图18 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1535-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:40:34 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:18 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

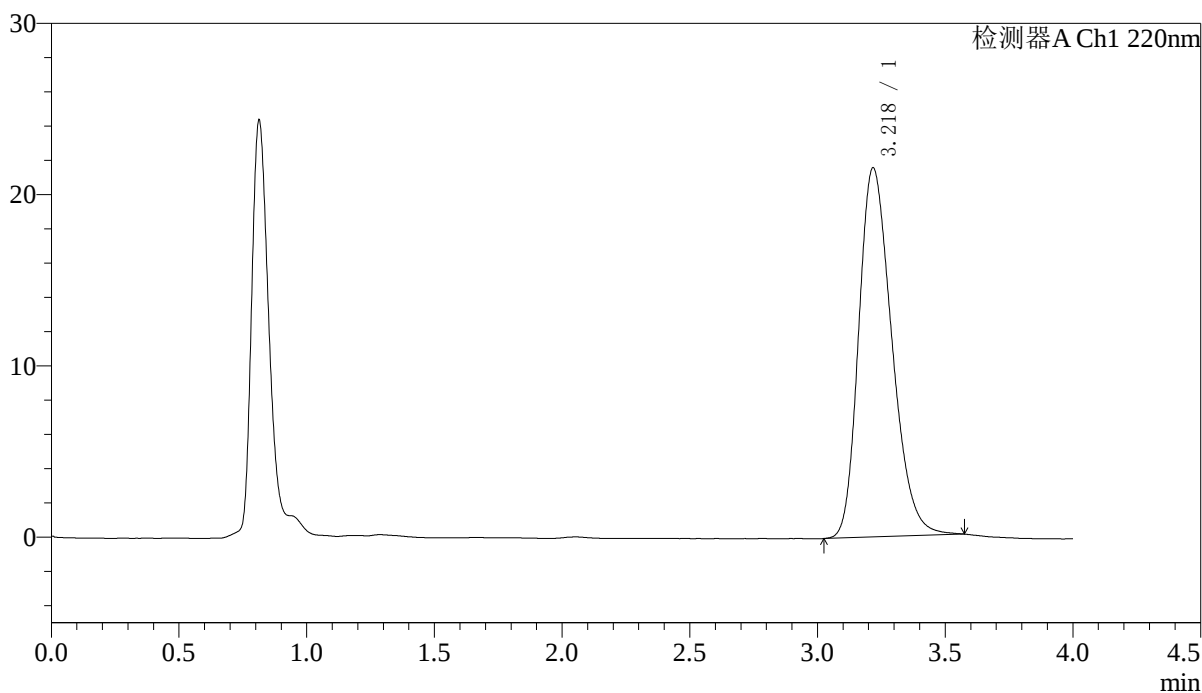

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.218	194611	100.000	21512	2956	1.269	--
总计		194611	100.000	21512			


图19 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1536-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:44:57 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:25 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

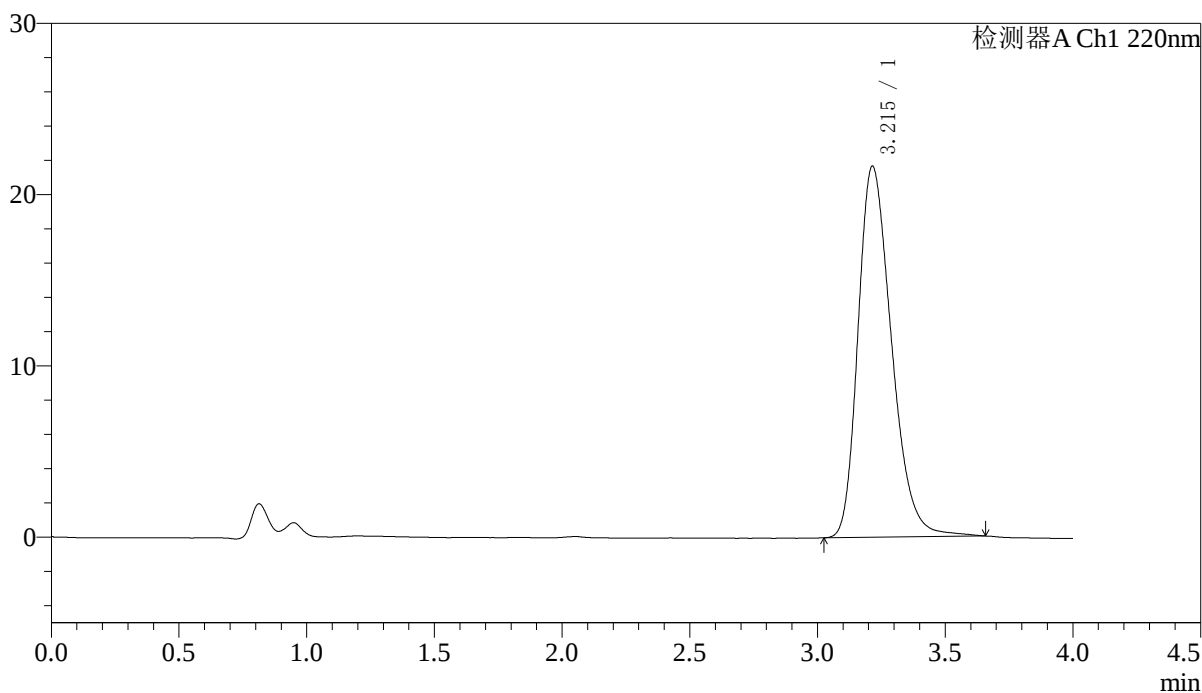

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.215	197629	100.000	21669	2934	1.286	--
总计		197629	100.000	21669			


图20 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1537-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:49:19 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:32 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

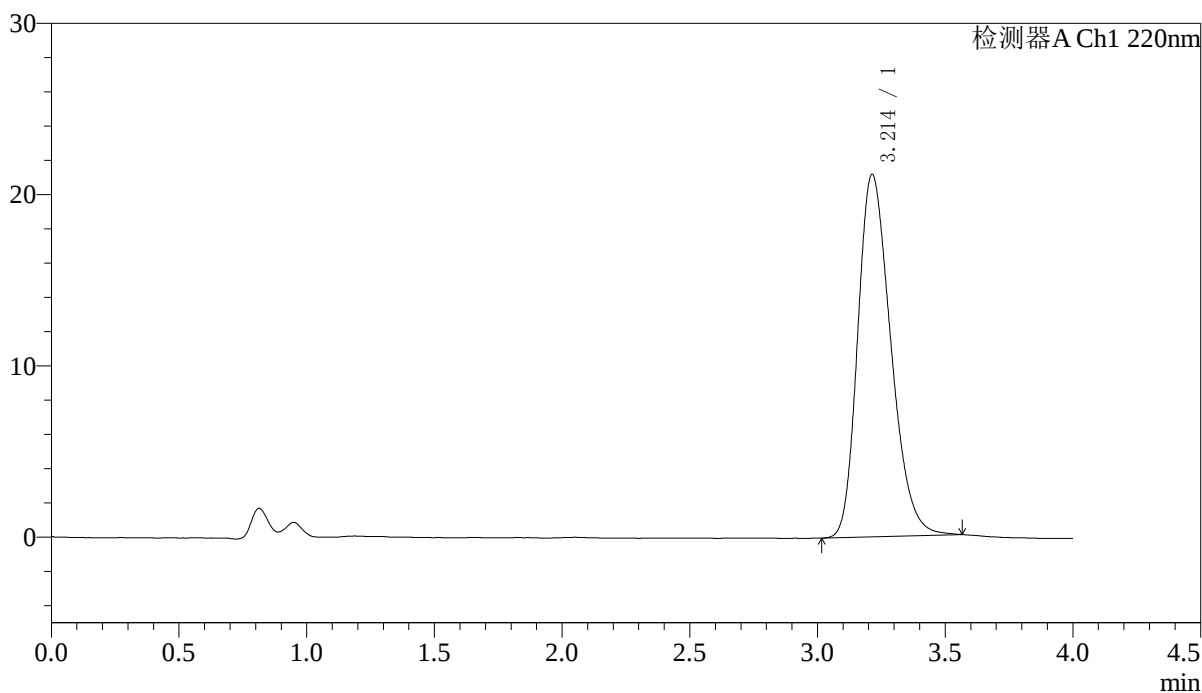

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.214	190665	100.000	21171	2959	1.265	--
总计		190665	100.000	21171			


图21 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1538-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:53:41 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:39 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

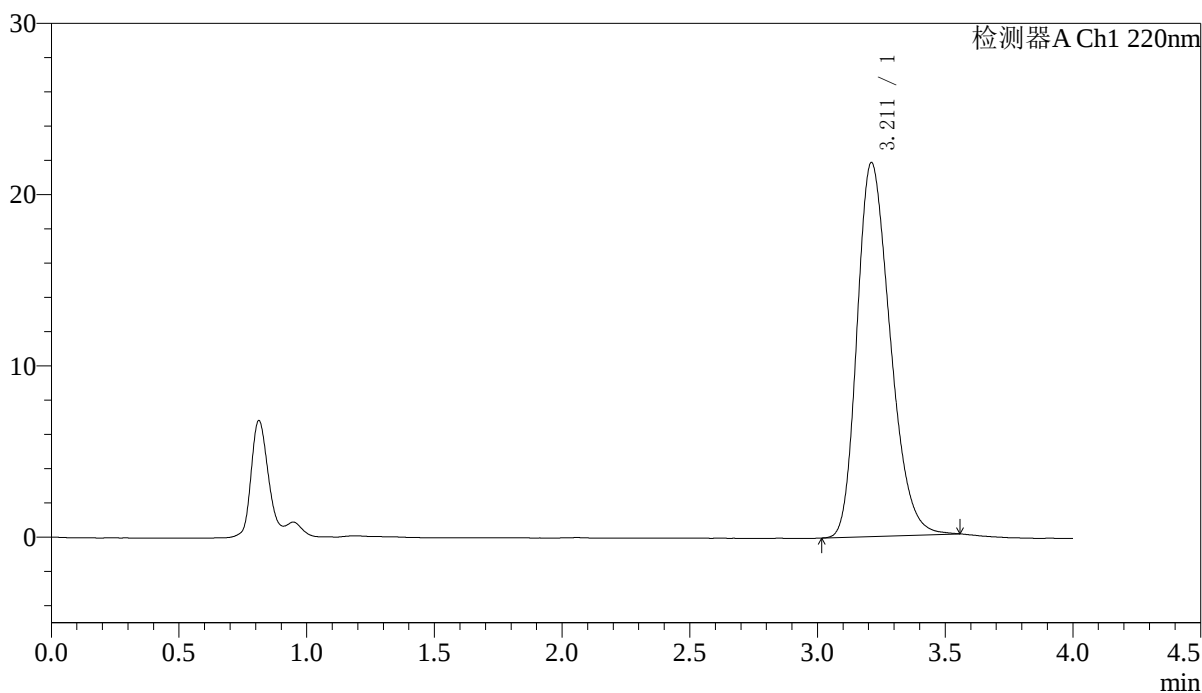

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.211	196502	100.000	21831	2952	1.267	--
总计		196502	100.000	21831			


图22 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1539-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 12:58:03 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:46 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

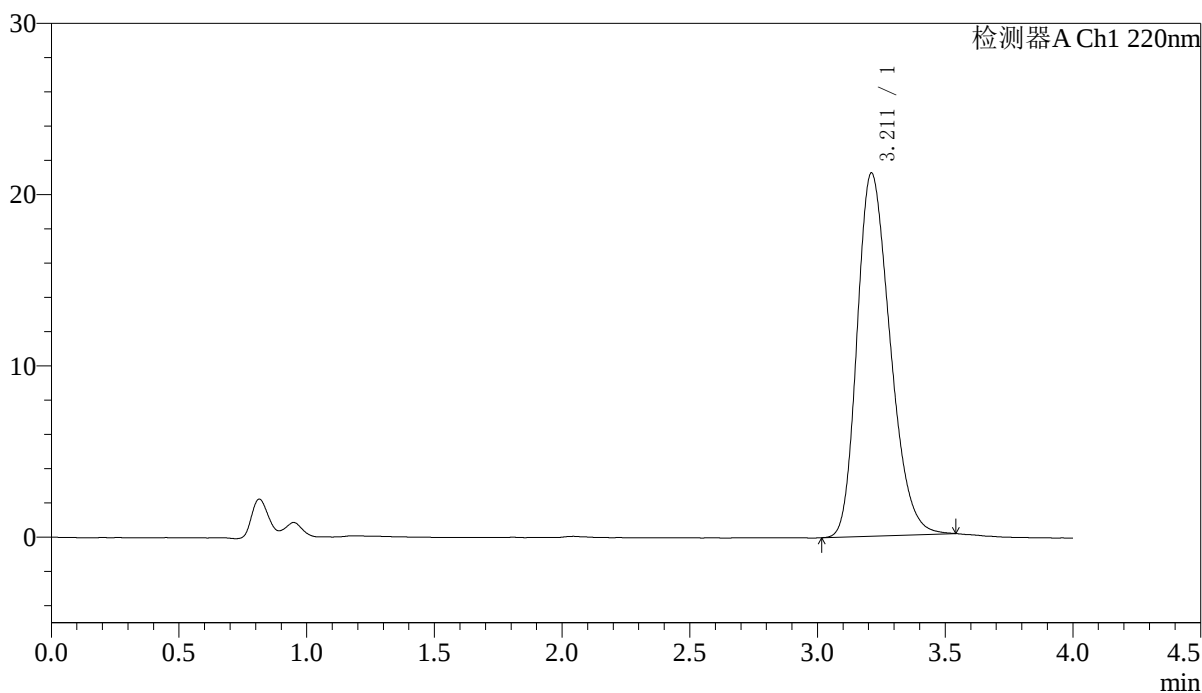

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.211	190370	100.000	21205	2957	1.261	--
总计		190370	100.000	21205			


图23 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1540-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:02:25 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:54:53 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

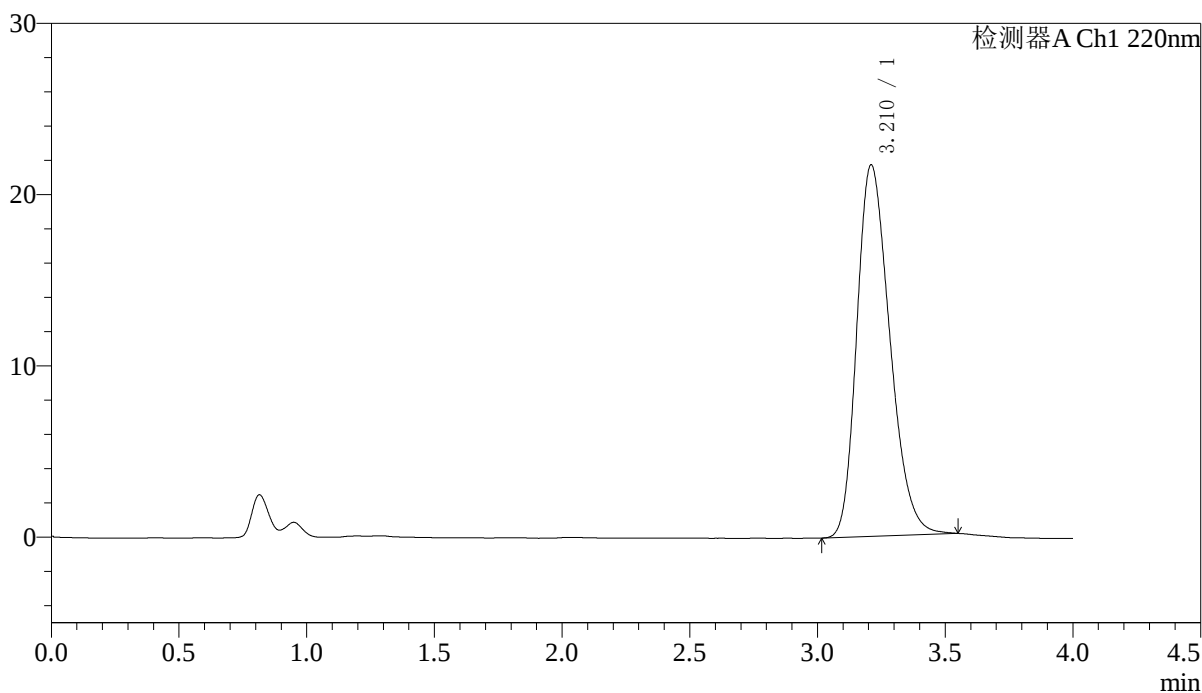

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.210	194940	100.000	21669	2952	1.264	--
总计		194940	100.000	21669			


图24 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1541-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:06:47 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:00 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

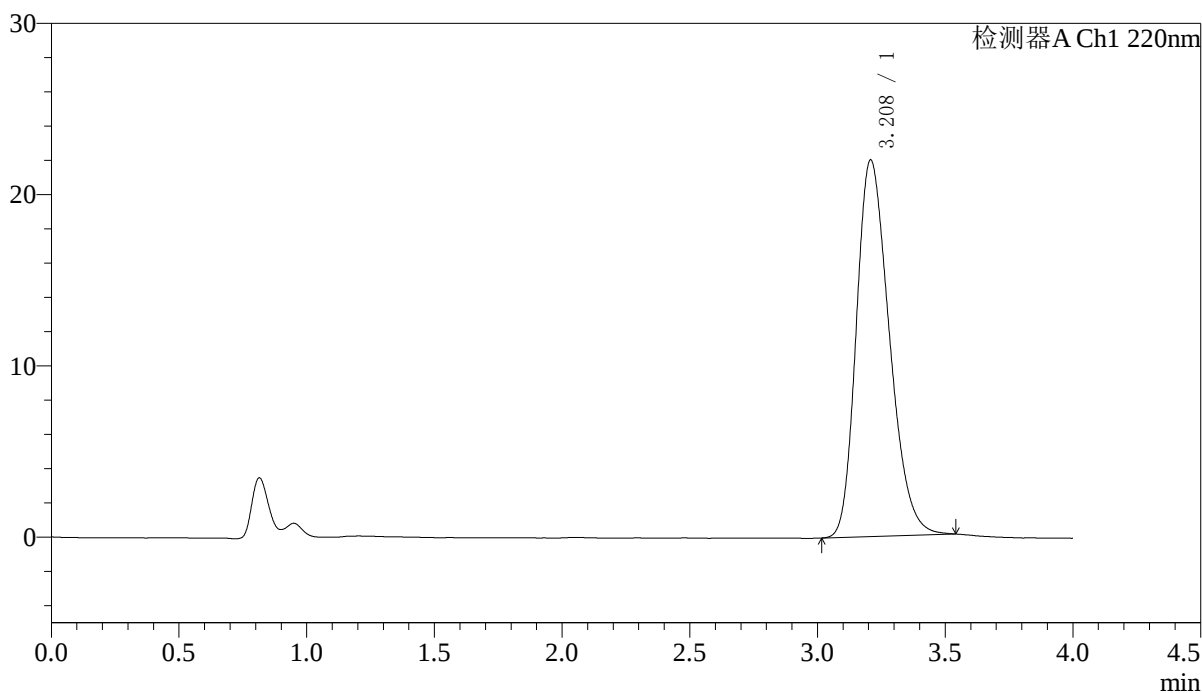

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.208	197719	100.000	21973	2946	1.266	--
总计		197719	100.000	21973			


图25 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1542-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:11:09 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:07 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

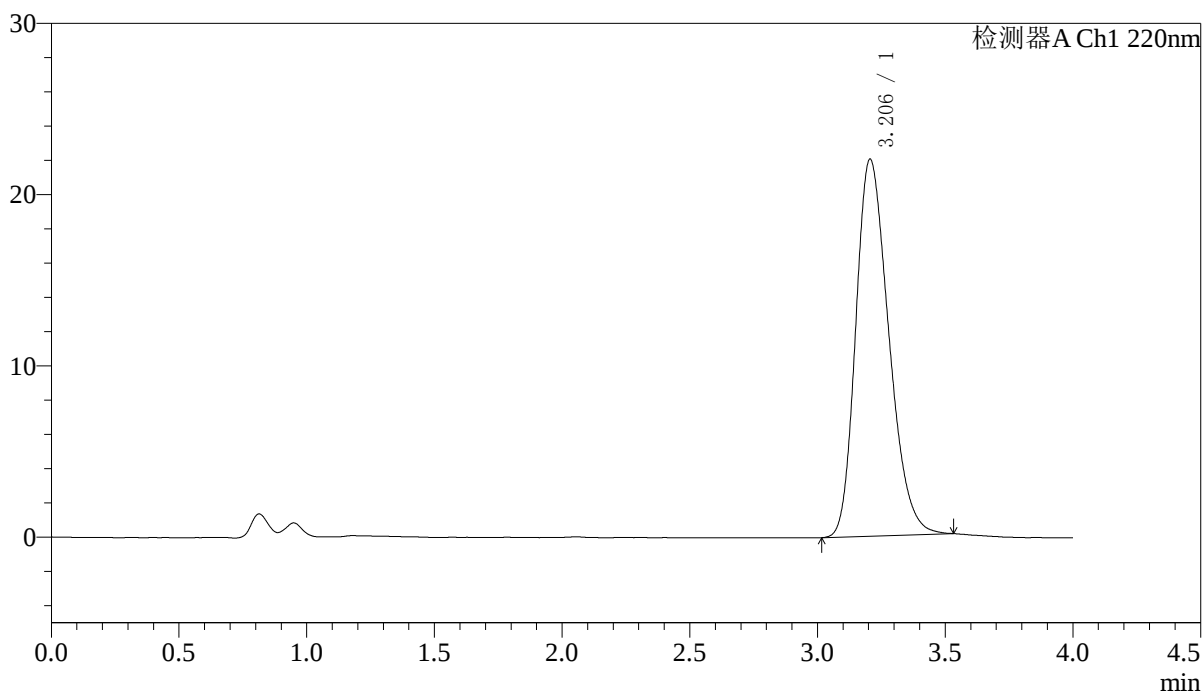

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.206	197891	100.000	22021	2938	1.265	--
总计		197891	100.000	22021			


图26 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1543-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:15:31 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:14 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

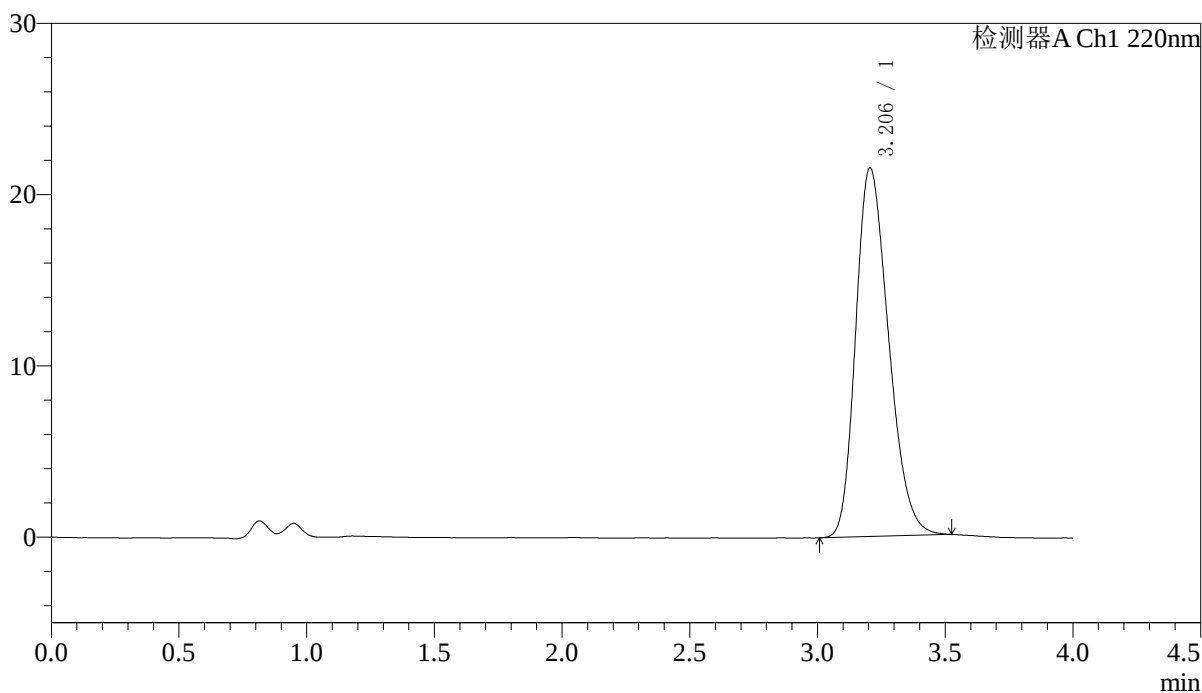

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.206	192935	100.000	21550	2947	1.255	--
总计		192935	100.000	21550			


图27 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1544-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:19:54 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:22 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

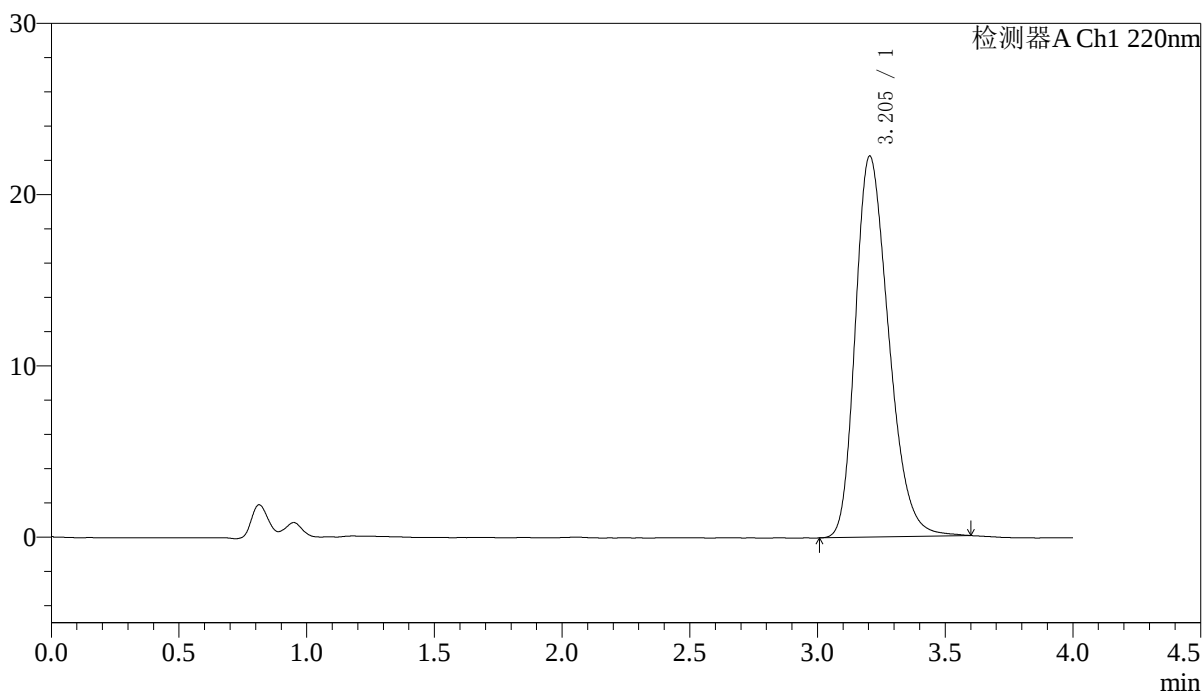

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.205	202014	100.000	22259	2912	1.277	--
总计		202014	100.000	22259			


图28 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1545-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:24:16 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:28 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

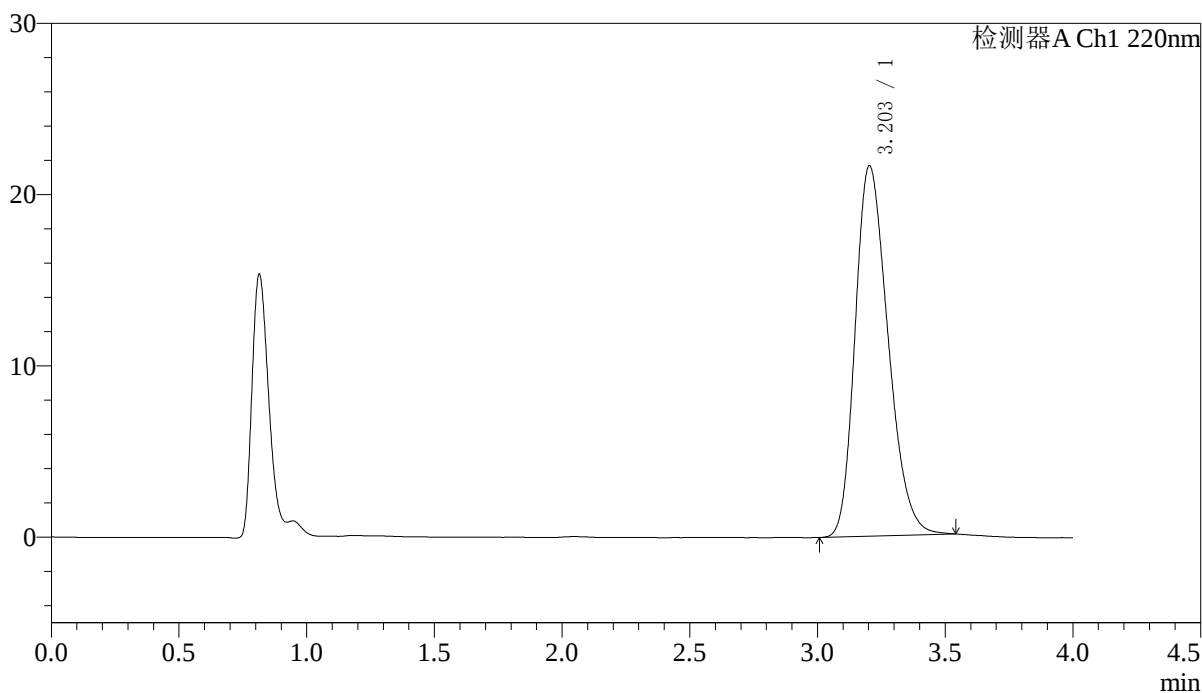

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.203	193909	100.000	21631	2949	1.261	--
总计		193909	100.000	21631			


图29 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1546-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:28:39 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:35 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

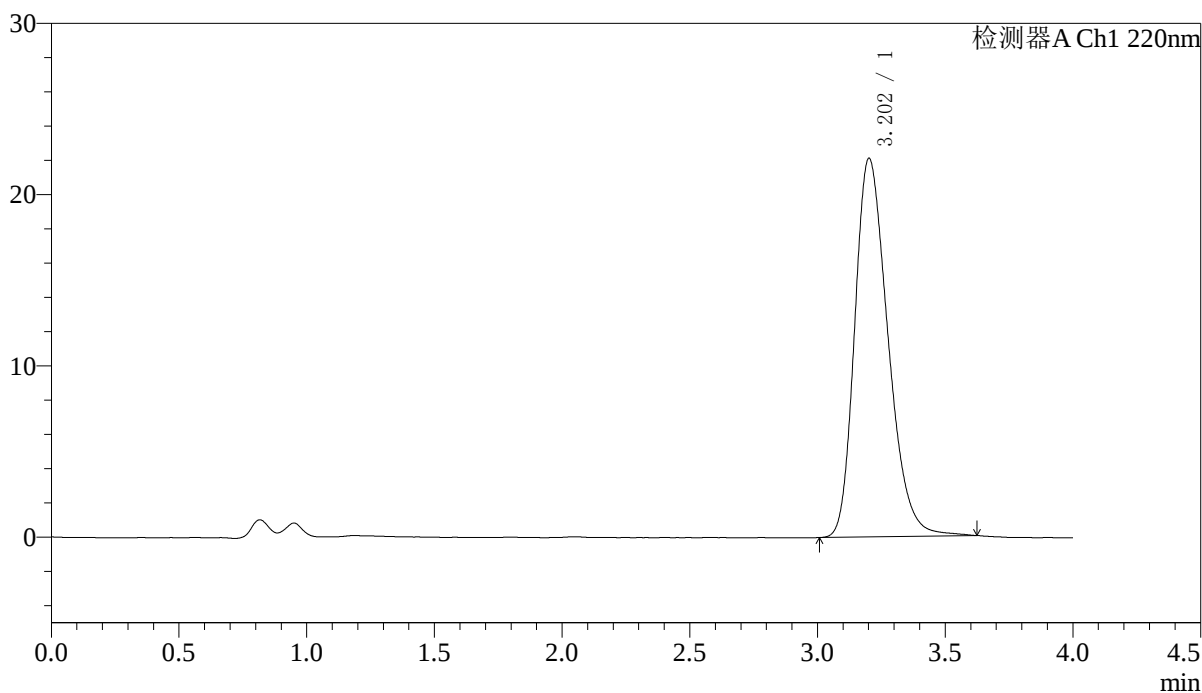

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.202	200529	100.000	22083	2925	1.281	--
总计		200529	100.000	22083			


图30 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1547-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:33:01 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:42 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

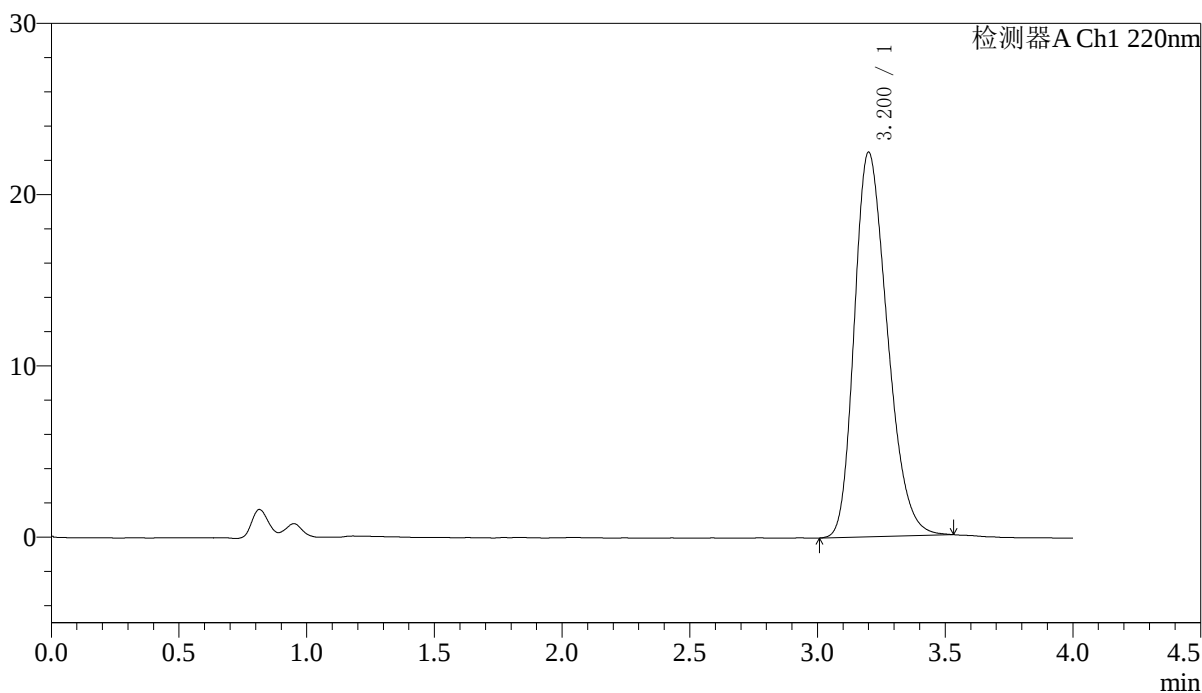

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.200	201731	100.000	22428	2929	1.269	--
总计		201731	100.000	22428			


图31 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1548-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:37:23 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:49 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

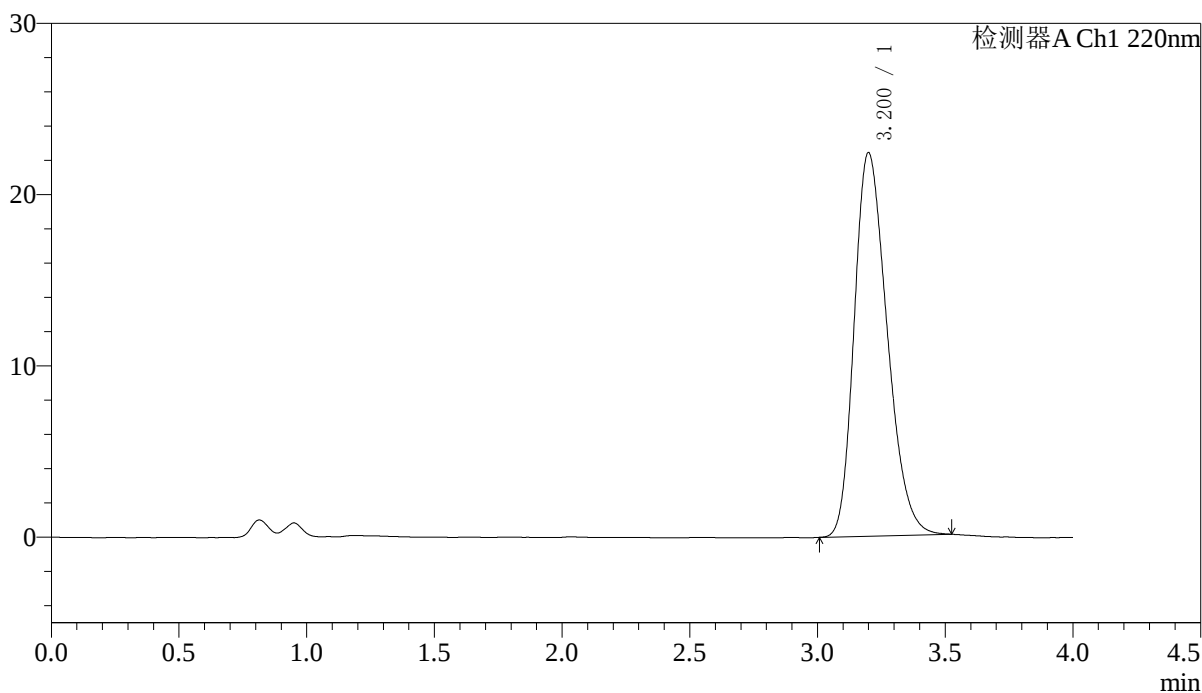

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.200	200748	100.000	22379	2934	1.265	--
总计		200748	100.000	22379			


图32 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1549-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:41:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:55:56 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

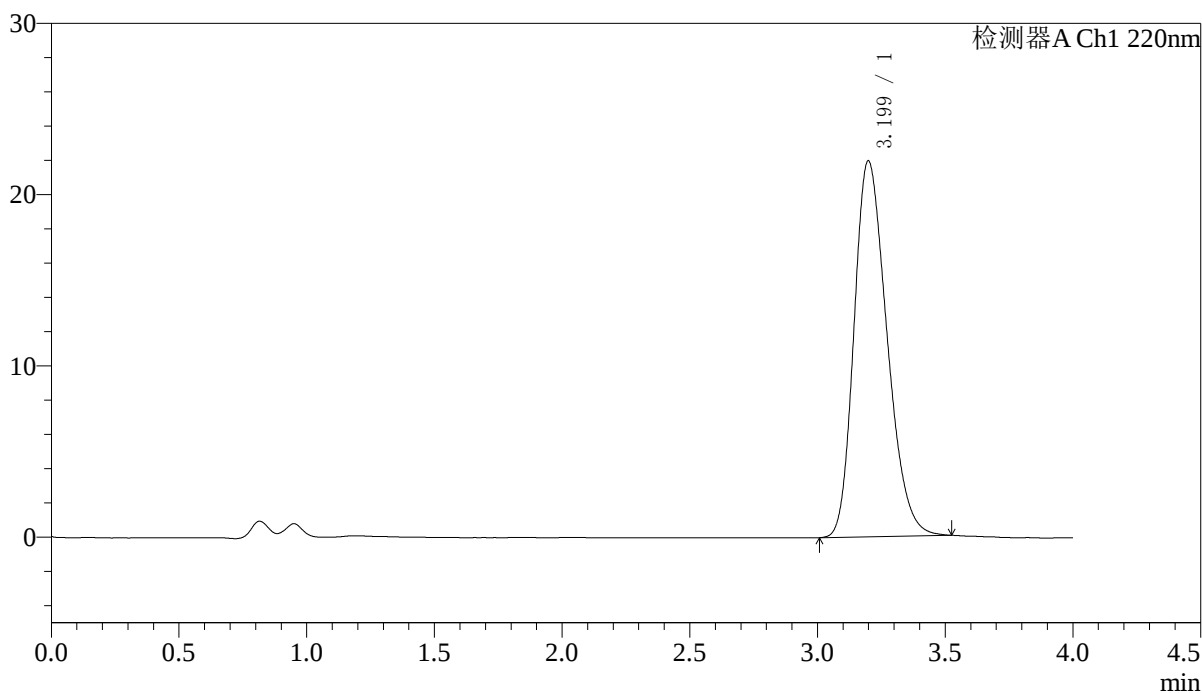

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.199	197013	100.000	21944	2929	1.260	--
总计		197013	100.000	21944			


图33 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1550-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:46:07 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:04 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

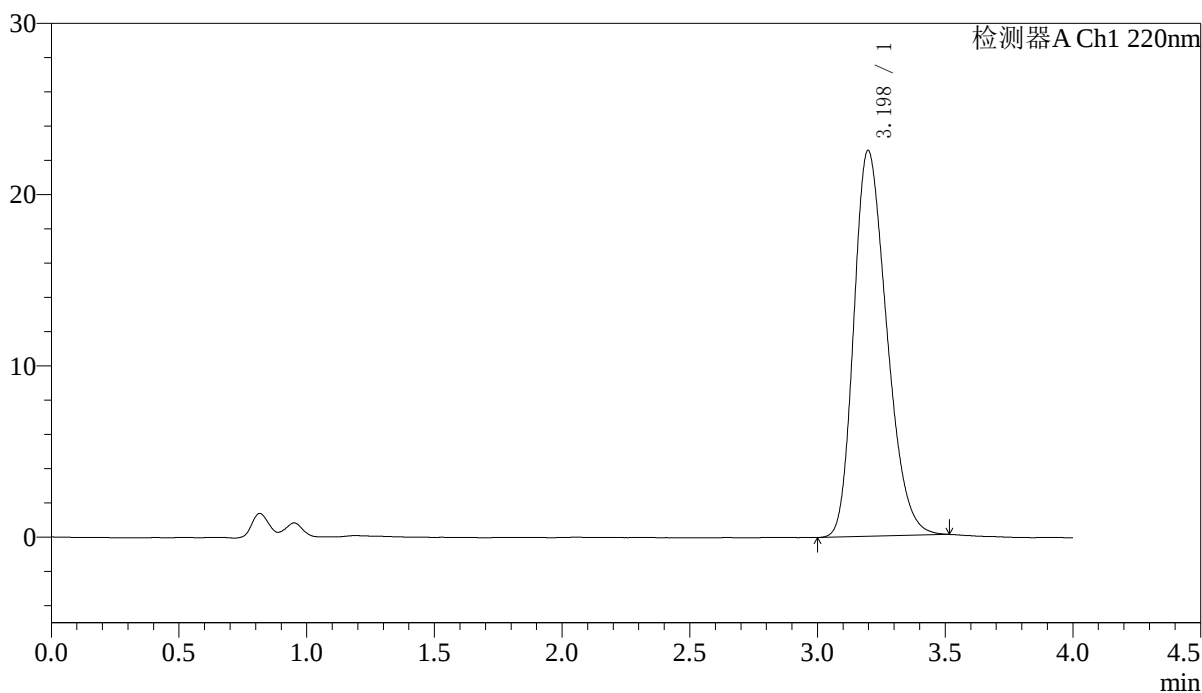

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.198	202142	100.000	22542	2929	1.264	--
总计		202142	100.000	22542			


图34 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1551-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:50:29 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:11 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

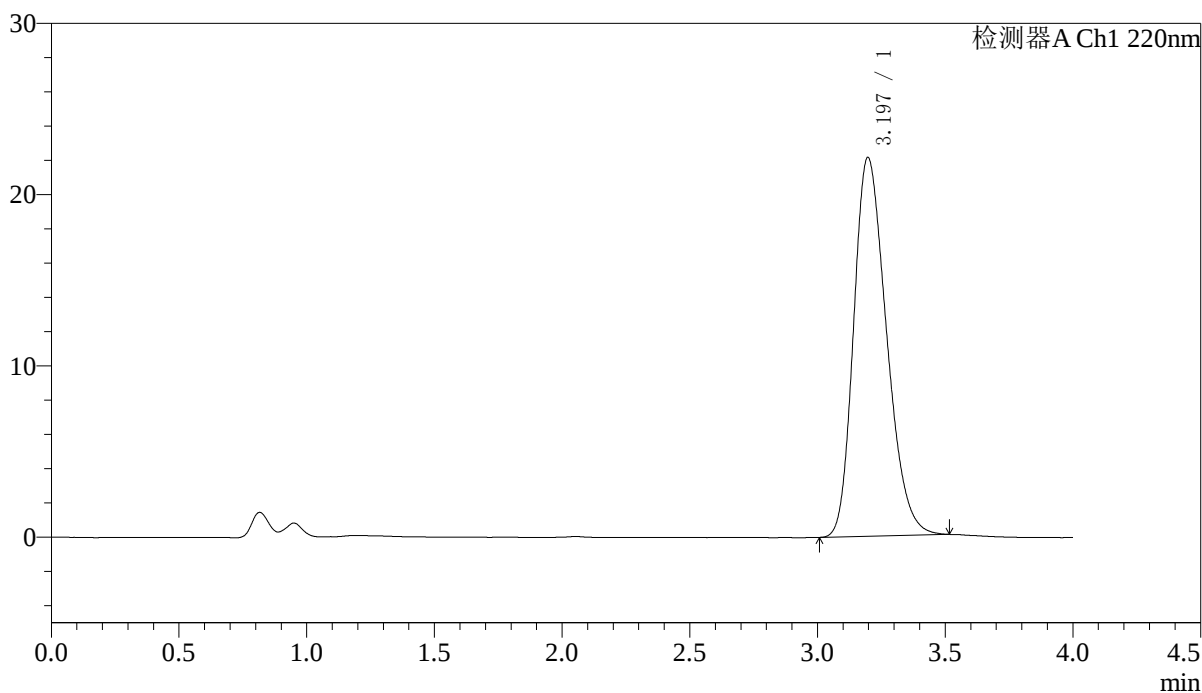

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.197	198054	100.000	22129	2936	1.261	--
总计		198054	100.000	22129			


图35 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1552-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:54:51 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:18 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

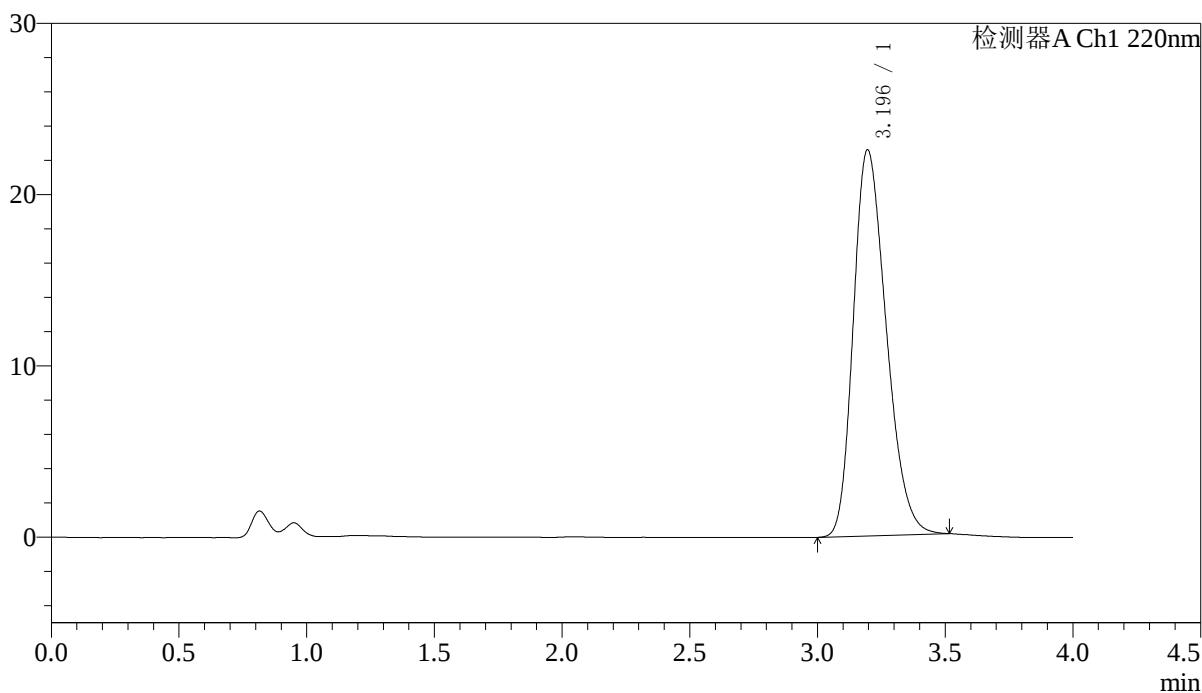

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.196	202216	100.000	22556	2924	1.265	--
总计		202216	100.000	22556			


图36 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1553-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 13:59:14 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:25 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

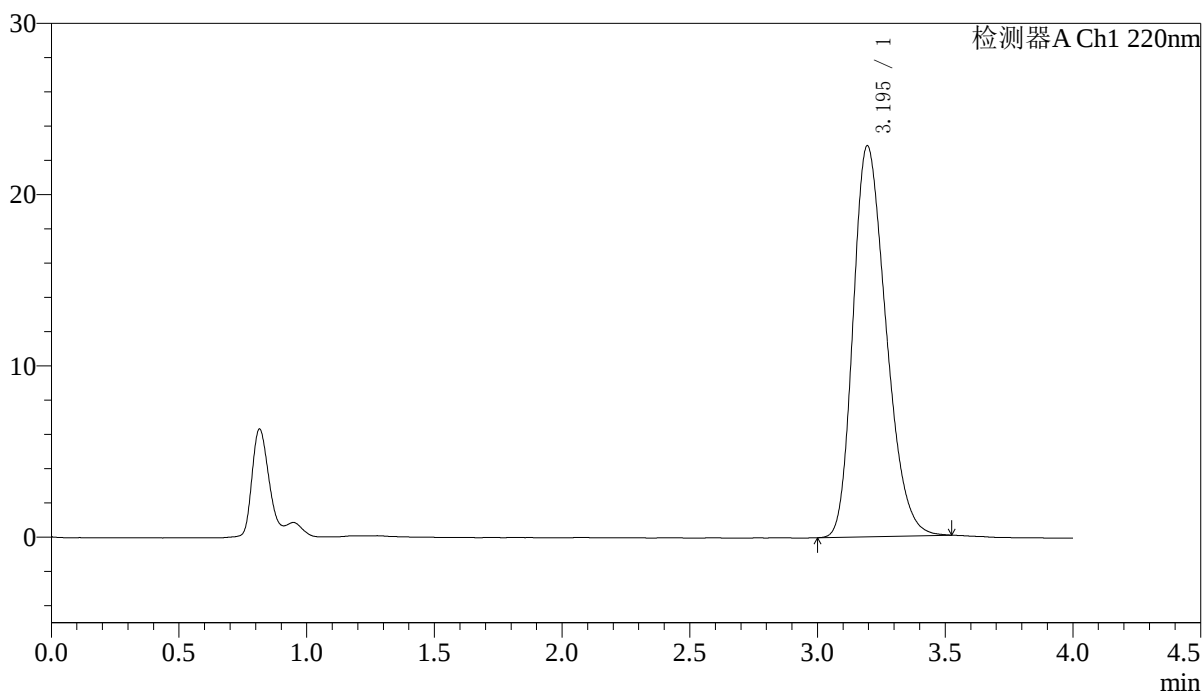

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.195	204653	100.000	22834	2928	1.268	--
总计		204653	100.000	22834			


图37 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1554-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:03:36 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:32 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

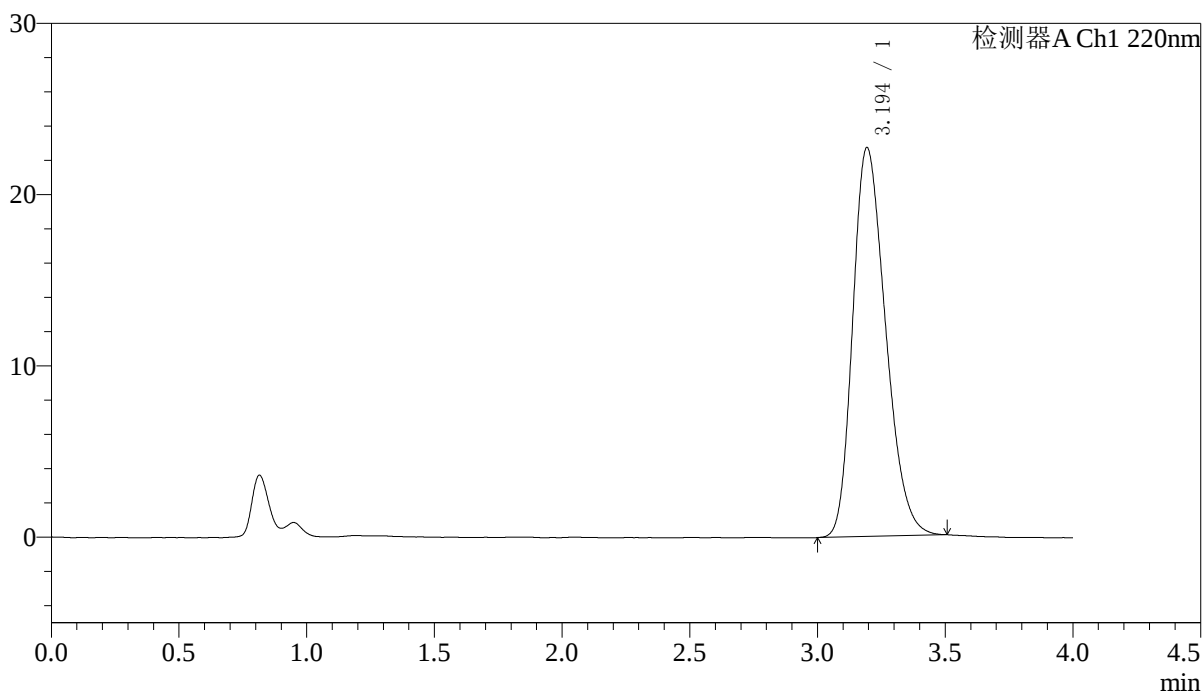

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.194	203130	100.000	22692	2931	1.265	--
总计		203130	100.000	22692			


图38 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1555-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:07:58 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:39 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

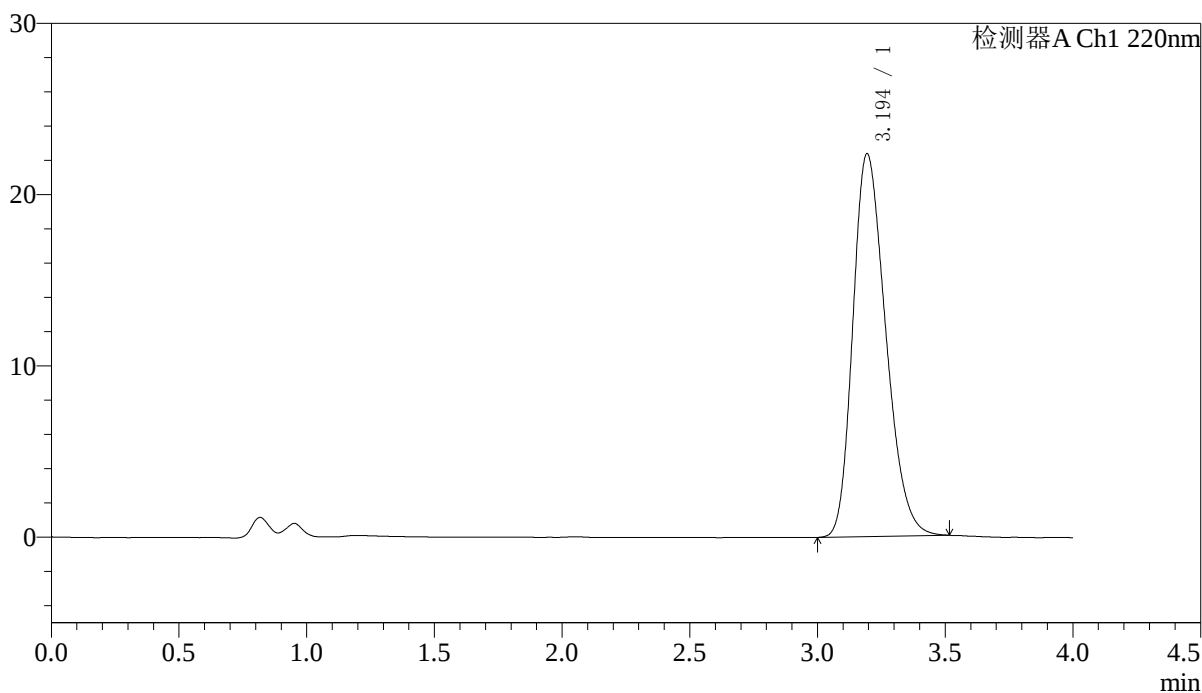

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.194	200031	100.000	22346	2932	1.264	--
总计		200031	100.000	22346			


图39 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1556-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:12:20 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:46 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

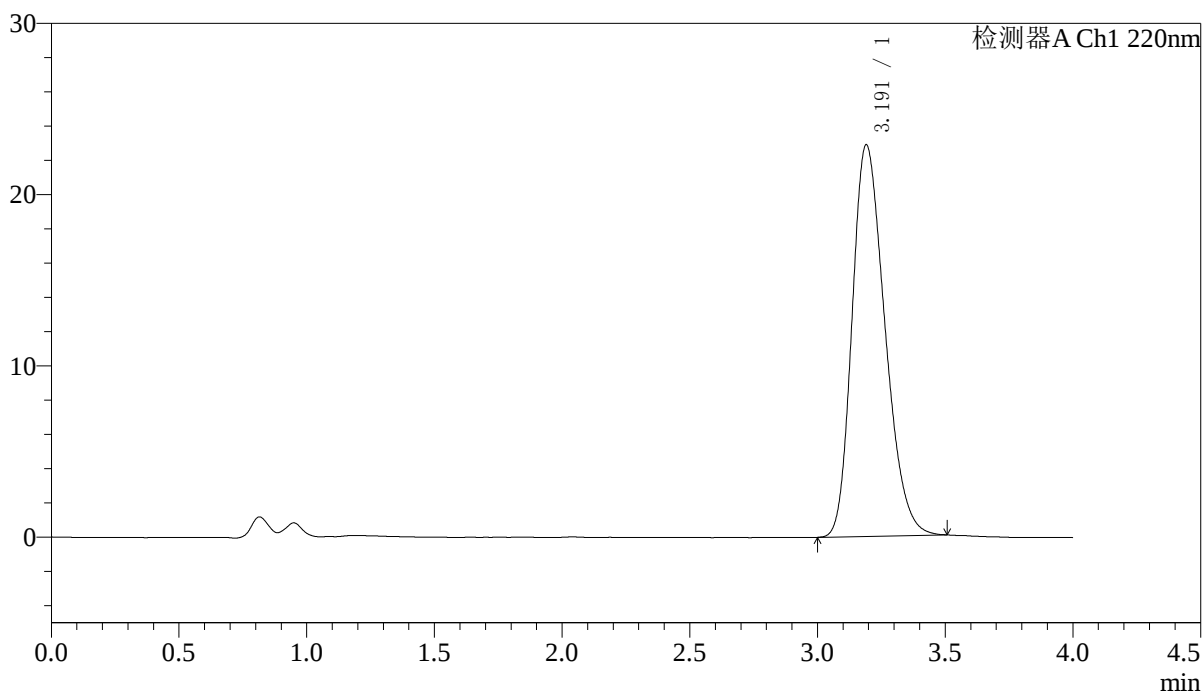

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.191	204628	100.000	22855	2928	1.264	--
总计		204628	100.000	22855			


图40 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1557-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:16:42 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:56:53 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

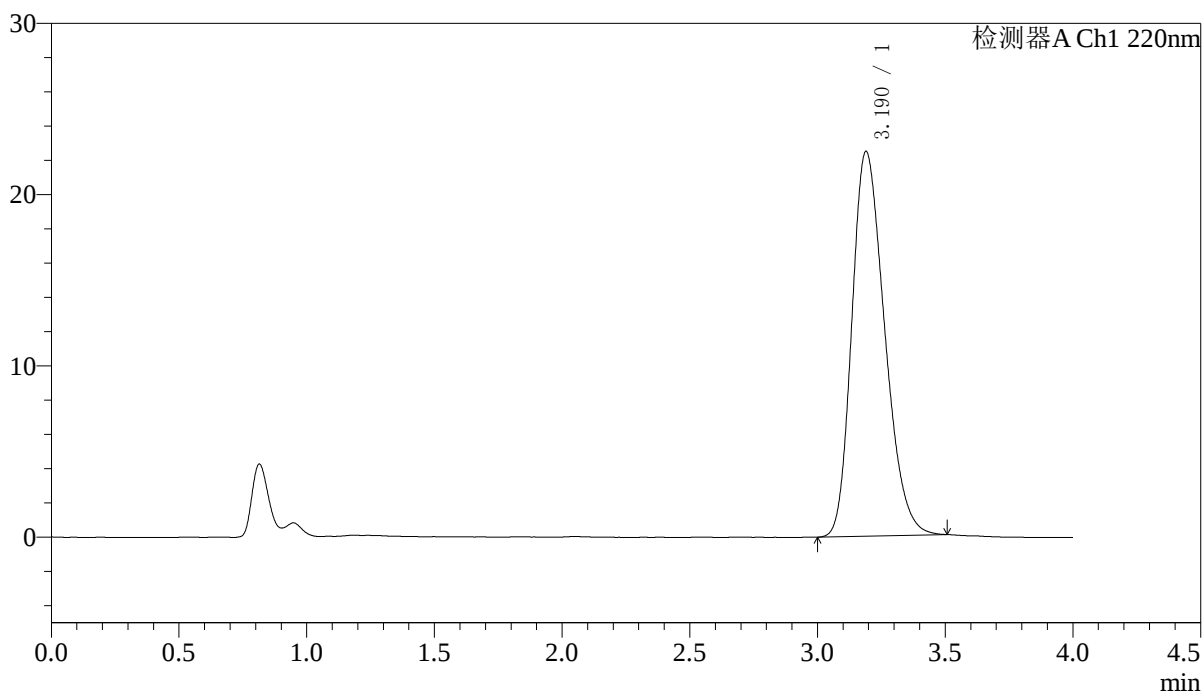

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.190	200846	100.000	22468	2927	1.263	--
总计		200846	100.000	22468			


图41 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1558-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:21:04 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:00 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

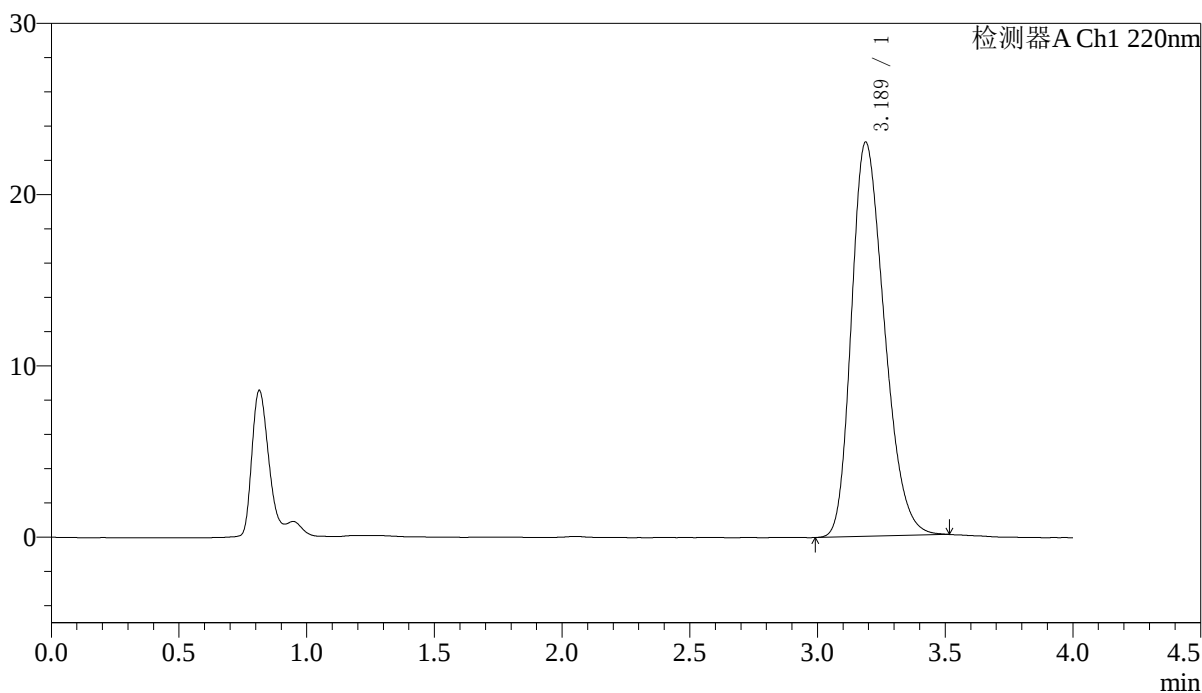

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.189	206298	100.000	23033	2917	1.268	--
总计		206298	100.000	23033			


图42 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1559-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:25:27 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:07 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

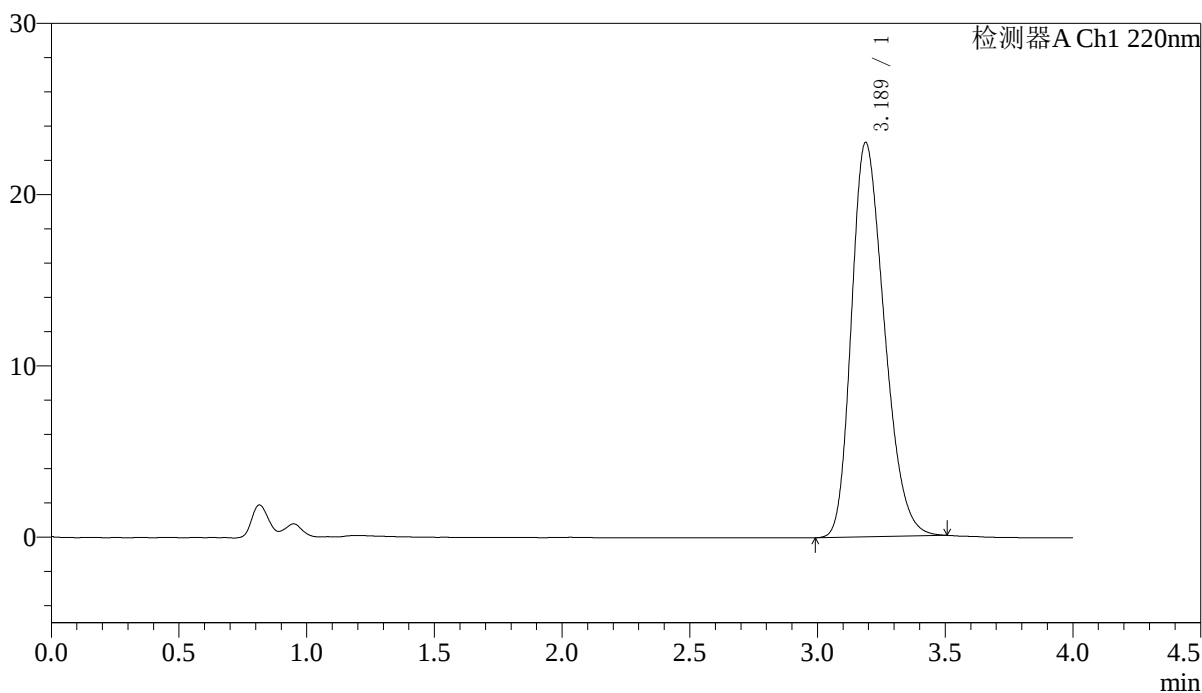

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.189	206085	100.000	23041	2916	1.267	--
总计		206085	100.000	23041			


图43 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1560-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:29:49 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:14 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

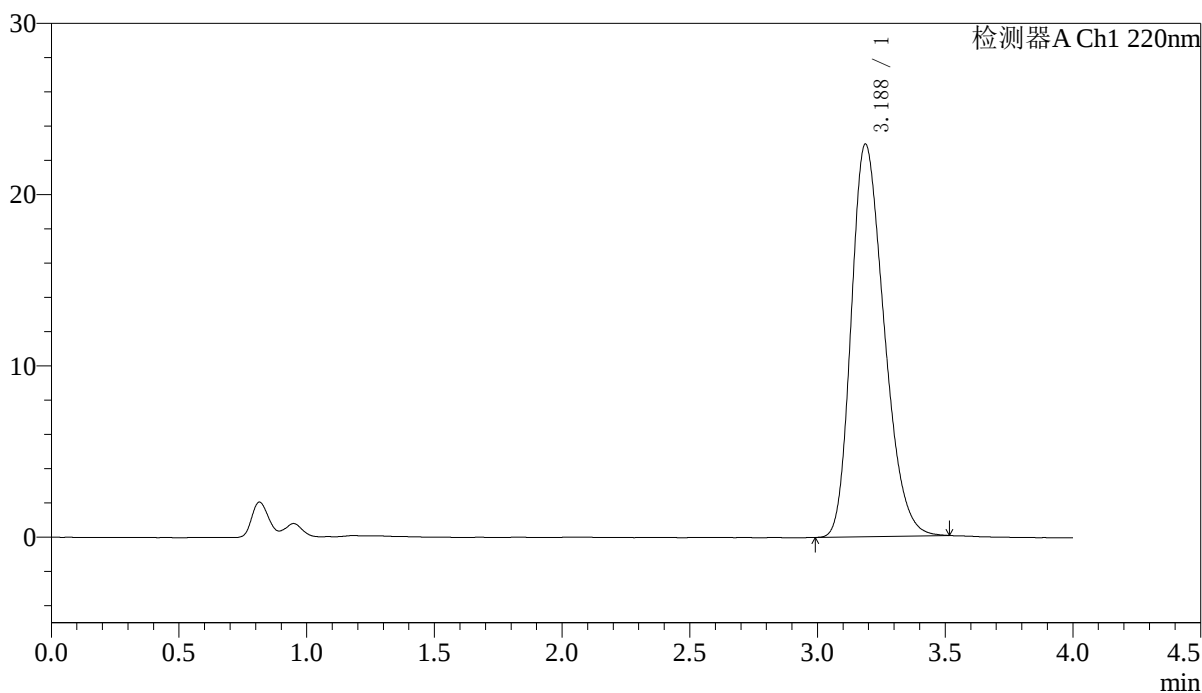

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.188	205433	100.000	22939	2915	1.268	--
总计		205433	100.000	22939			


图44 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1561-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:34:11 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:21 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

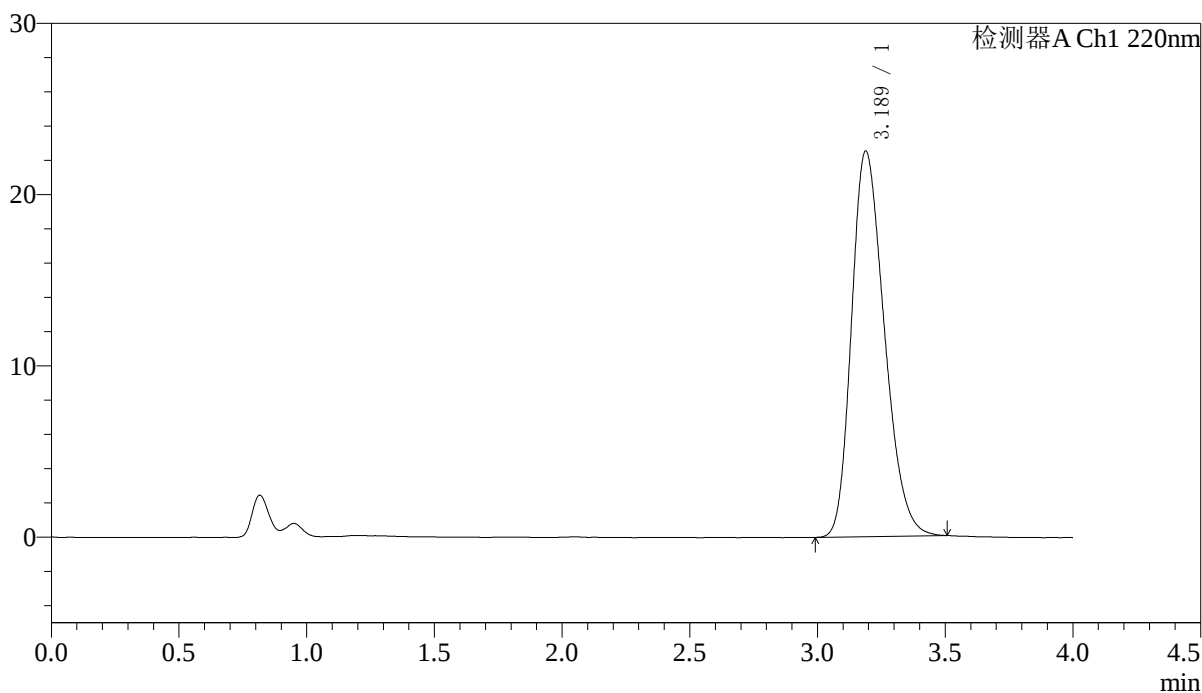

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.189	201331	100.000	22527	2931	1.261	--
总计		201331	100.000	22527			


图45 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1562-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:38:33 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:28 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

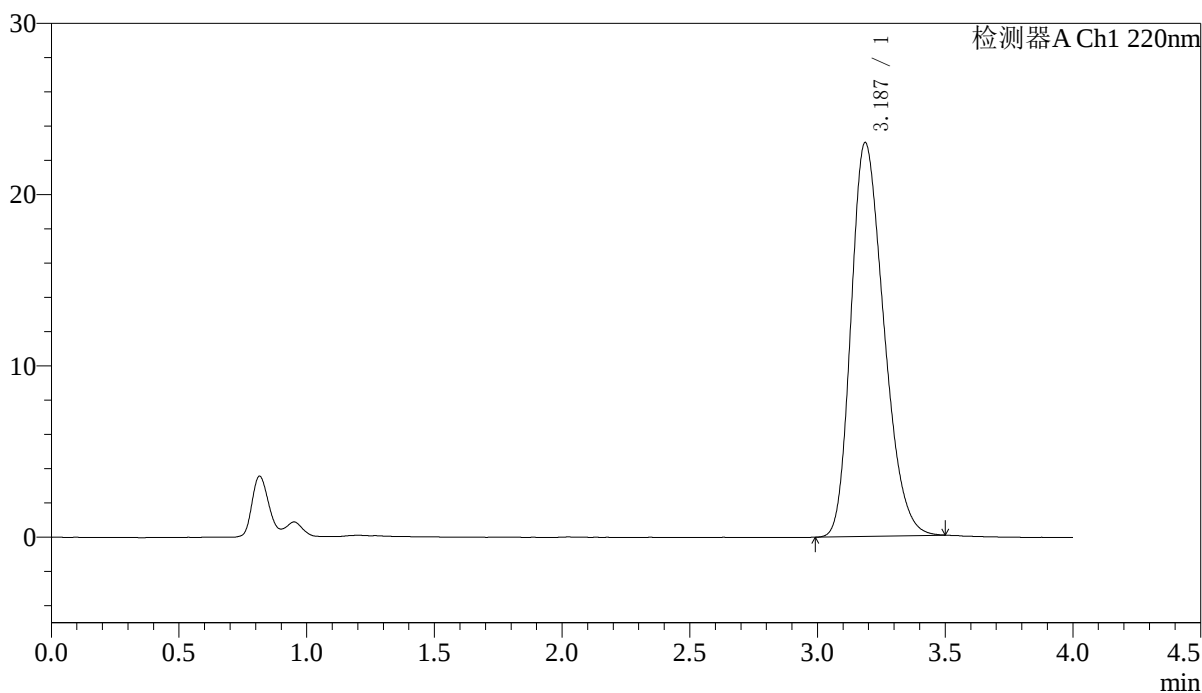

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.187	205565	100.000	23003	2916	1.265	--
总计		205565	100.000	23003			


图46 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1563-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:42:55 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:35 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

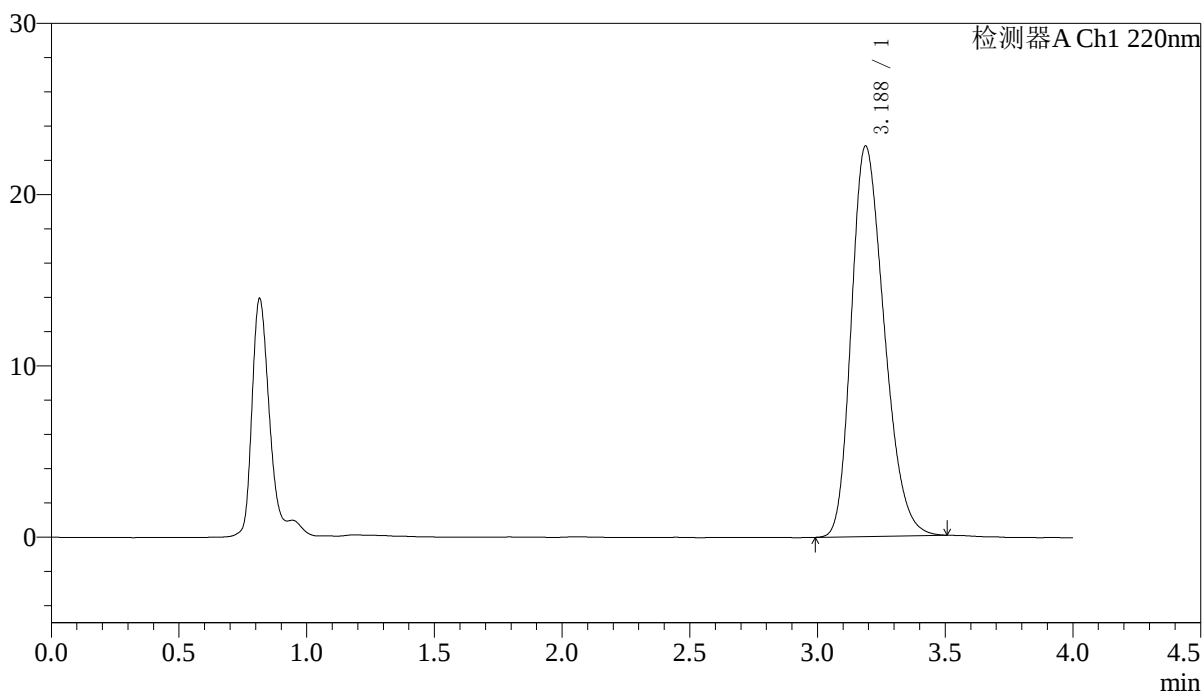

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.188	203929	100.000	22813	2933	1.264	--
总计		203929	100.000	22813			


图47 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1564-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:47:17 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:42 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

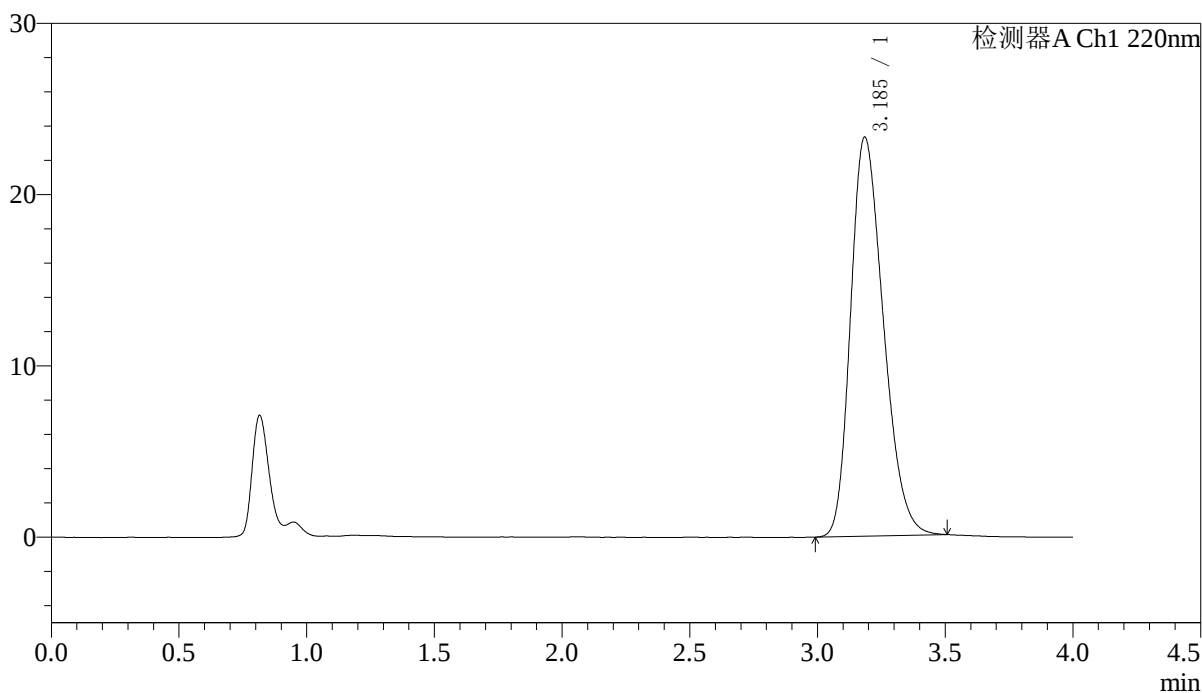

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.185	208301	100.000	23276	2924	1.268	--
总计		208301	100.000	23276			


图48 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1565-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:51:40 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:49 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

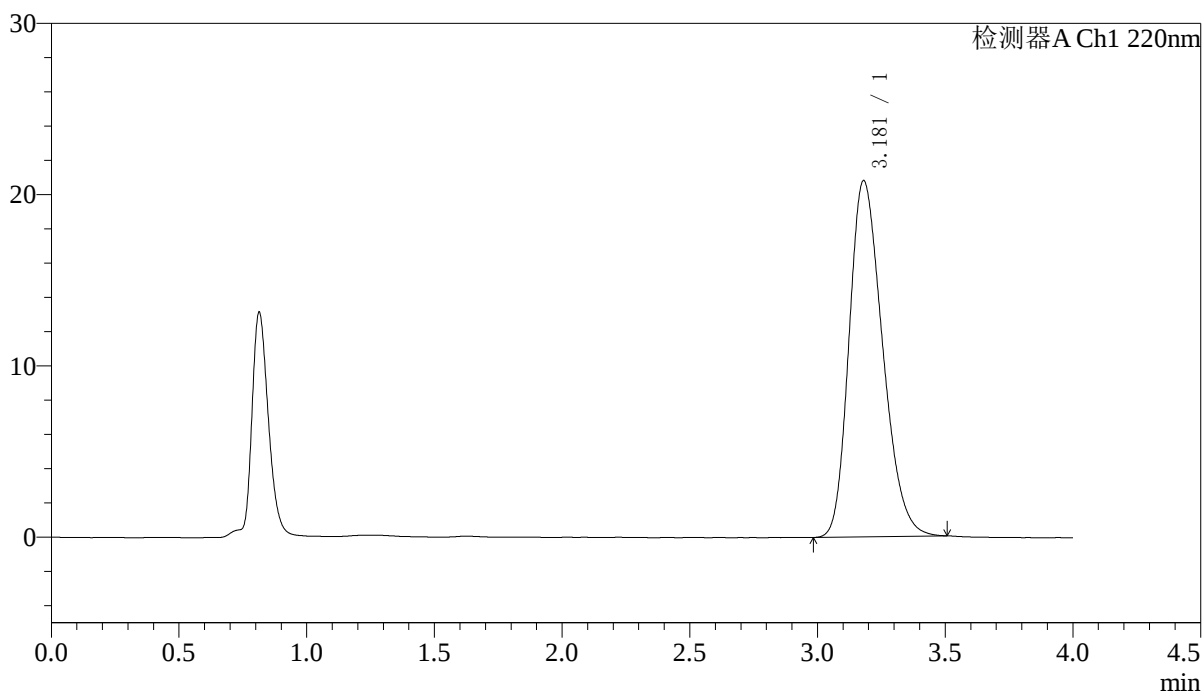

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.181	189938	100.000	20813	2797	1.257	--
总计		189938	100.000	20813			


图49 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1566-2 - zzp-2022030401p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 14:56:02 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:57:56 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

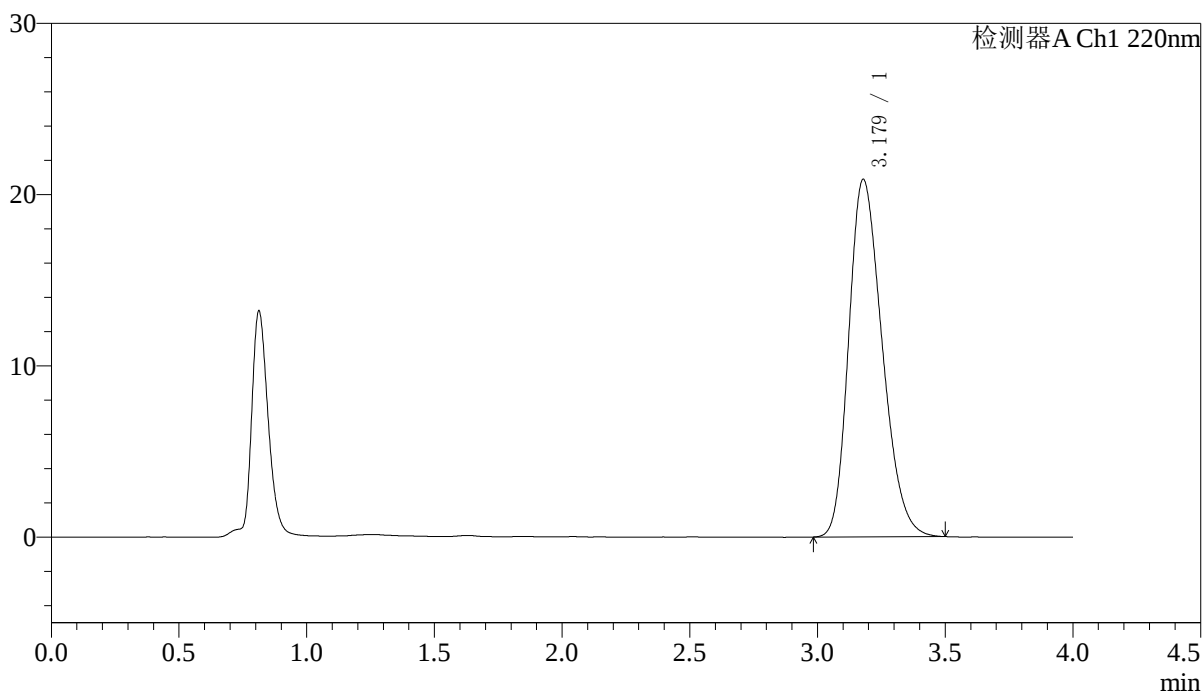

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.179	190262	100.000	20881	2798	1.254	--
总计		190262	100.000	20881			


图50 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1567-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:00:26 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:03 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

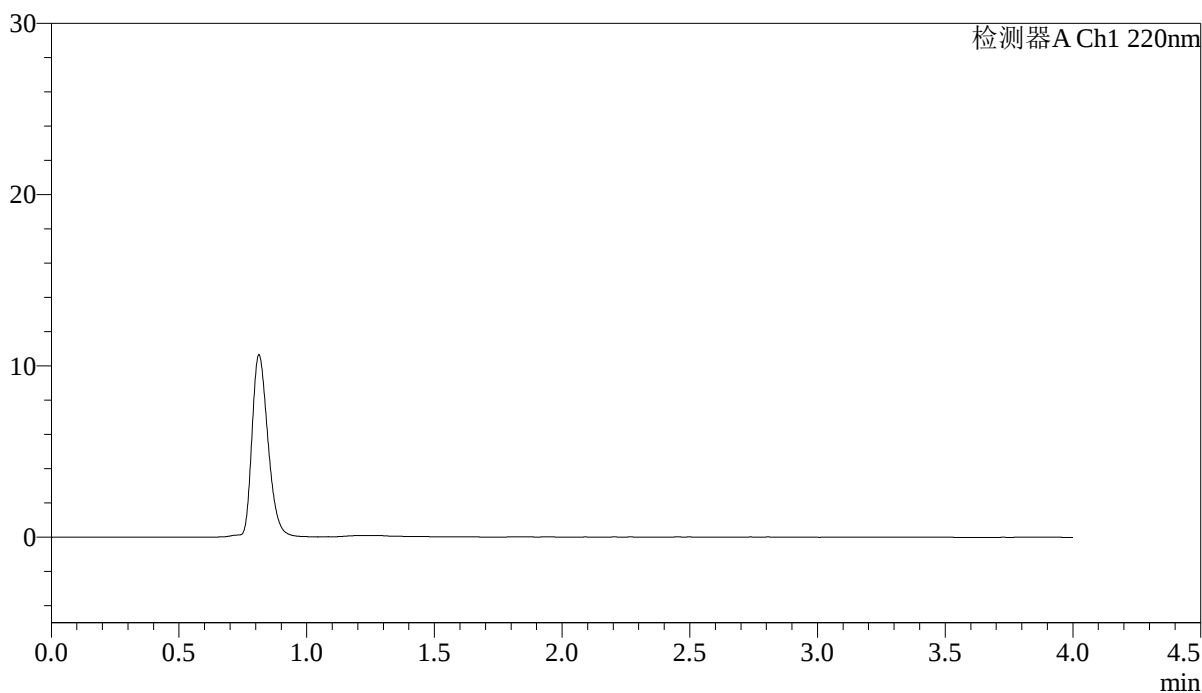

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1568-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:04:49 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:10 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

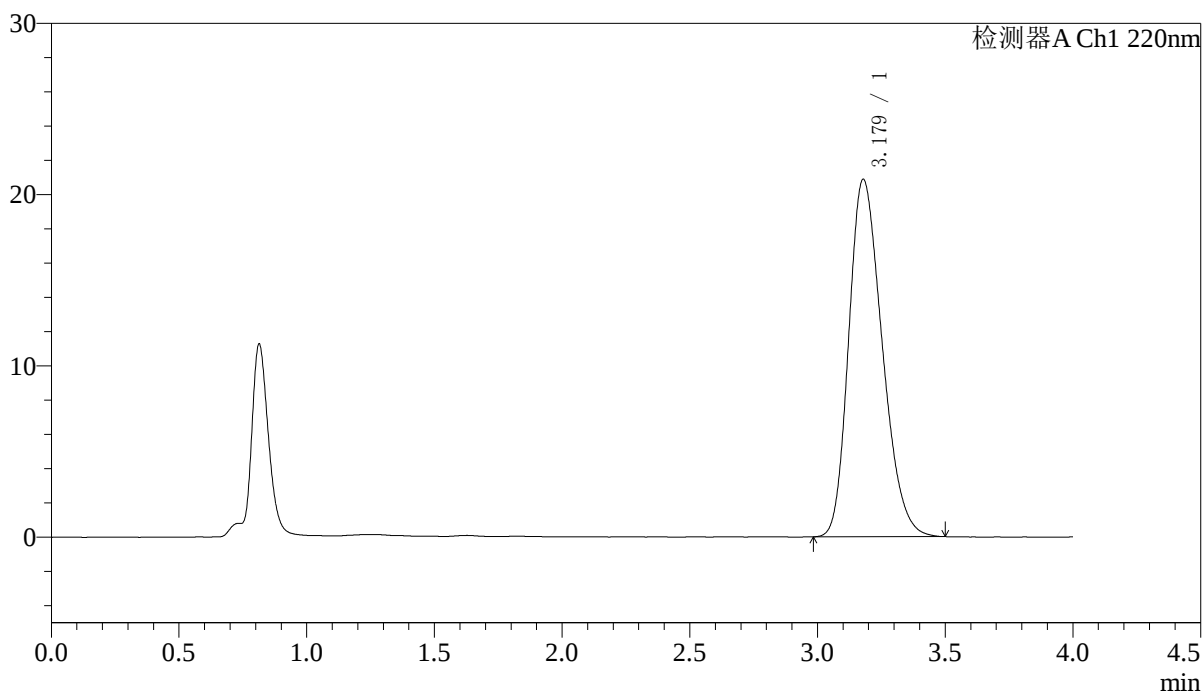

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.179	190174	100.000	20877	2792	1.254	--
总计		190174	100.000	20877			


图52 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1569-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:09:13 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:17 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

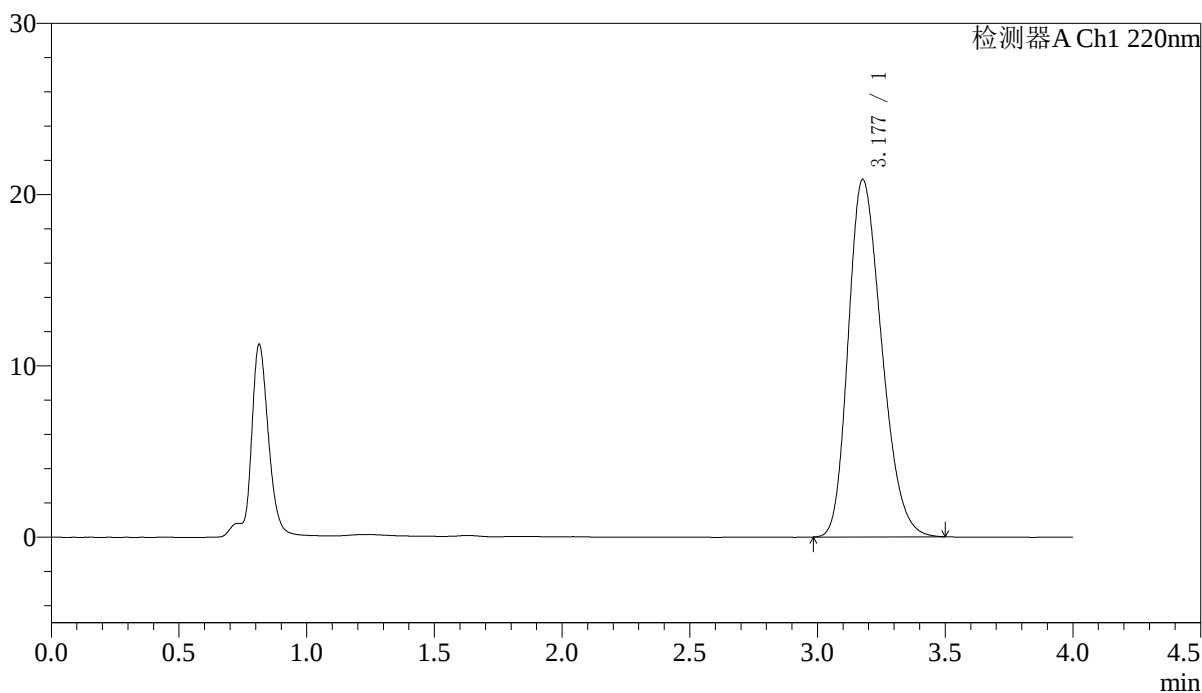

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.177	190283	100.000	20863	2800	1.256	--
总计		190283	100.000	20863			


图53 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1570-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:13:38 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:24 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

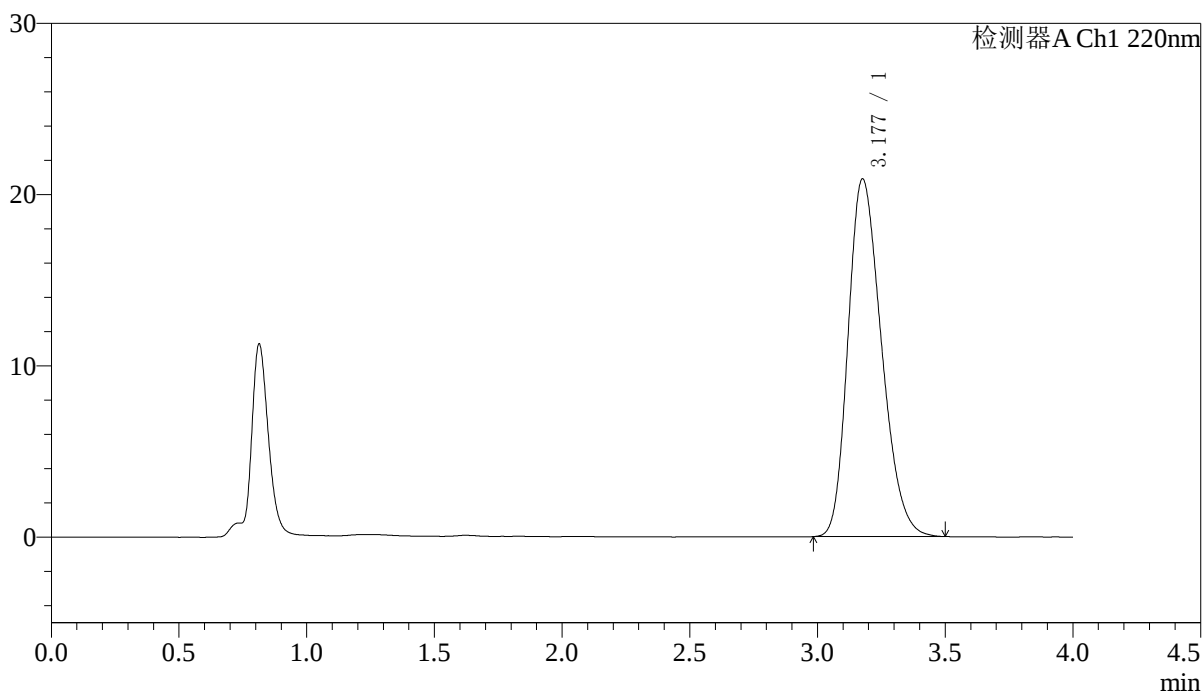

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.177	190170	100.000	20860	2801	1.255	--
总计		190170	100.000	20860			


图54 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1571-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:18:01 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:31 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

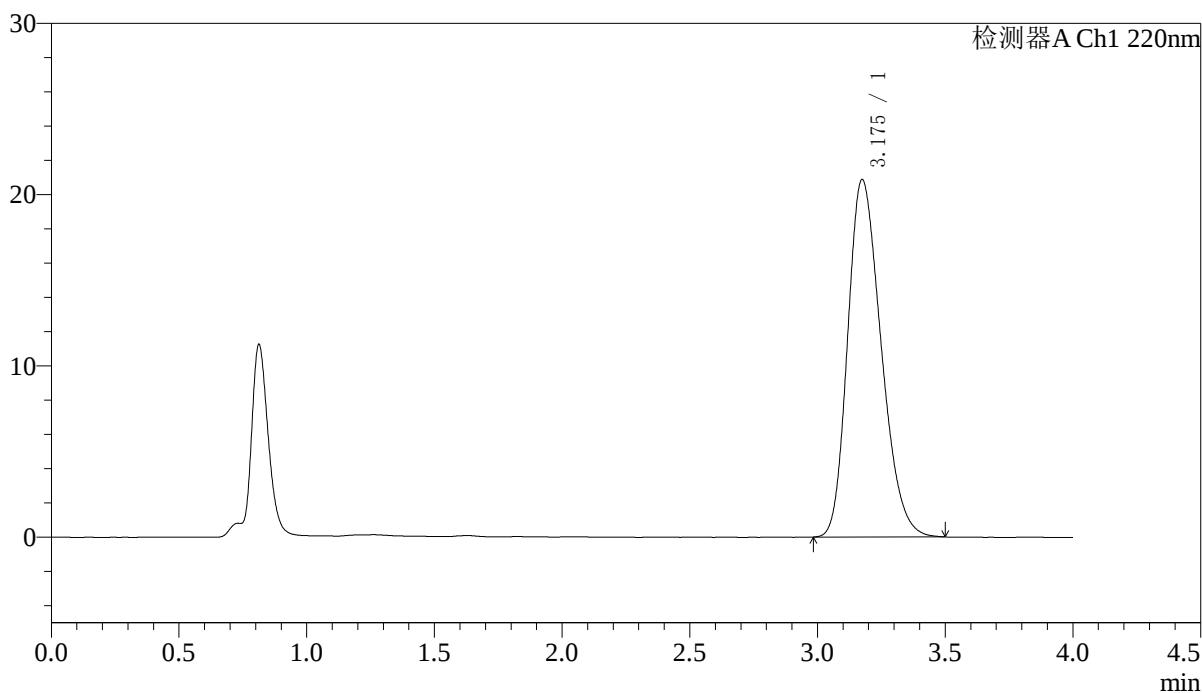

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.175	190145	100.000	20850	2797	1.255	--
总计		190145	100.000	20850			


图55 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1572-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:22:25 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:38 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

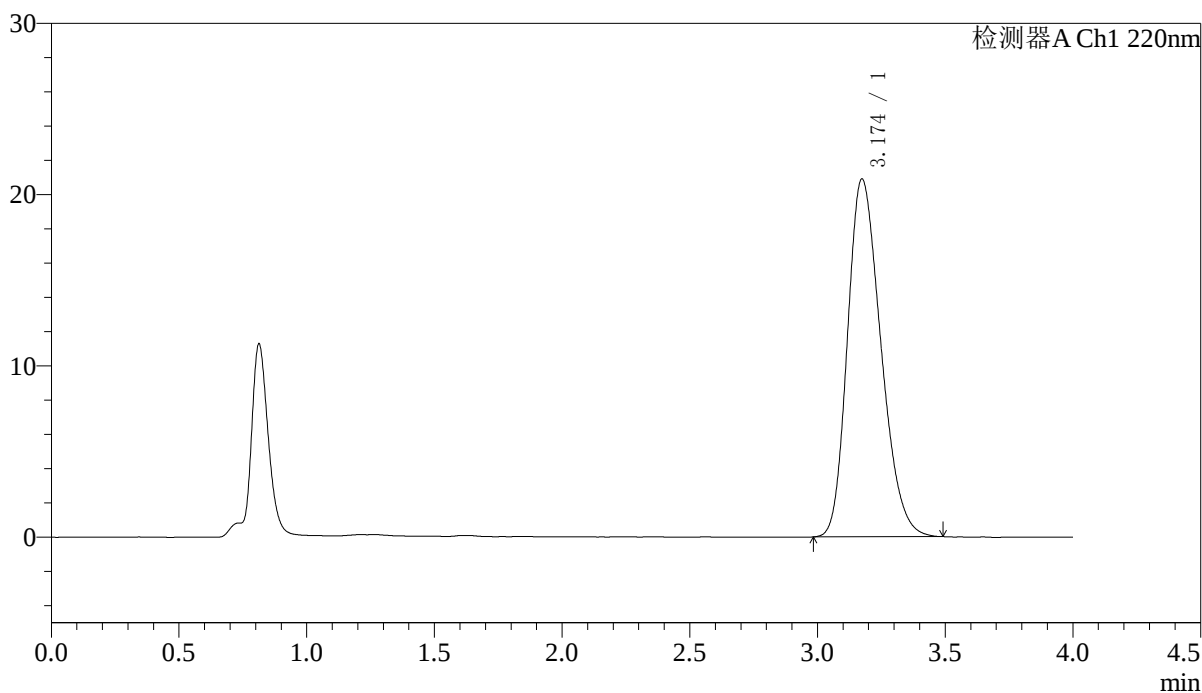

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.174	190048	100.000	20885	2794	1.252	--
总计		190048	100.000	20885			


图56 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1573-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:26:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:45 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

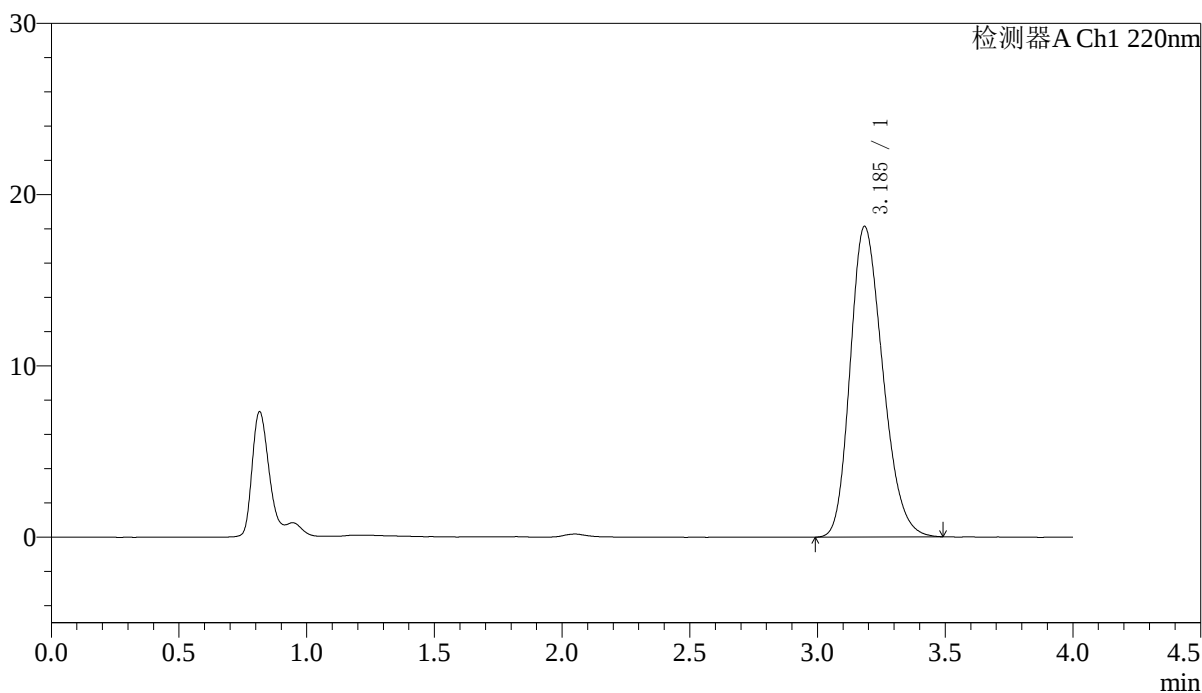

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.185	160813	100.000	18105	2978	1.231	--
总计		160813	100.000	18105			


图57 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1574-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:31:11 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:52 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

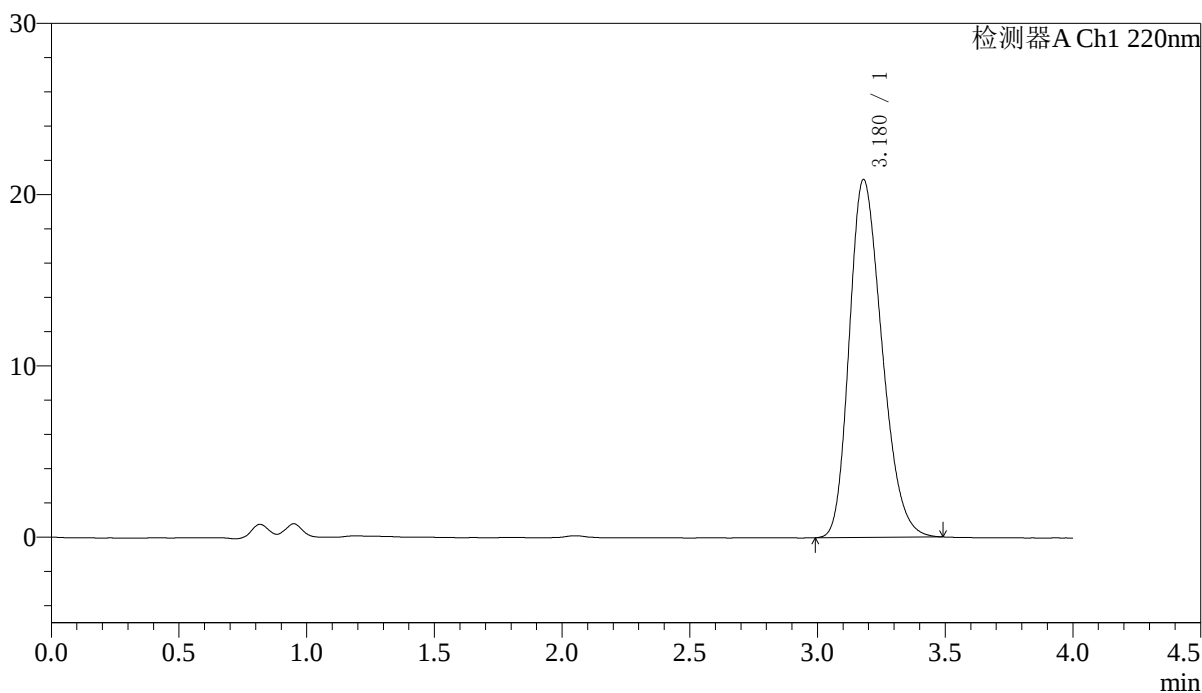

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.180	185941	100.000	20910	2948	1.250	--
总计		185941	100.000	20910			


图58 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1575-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:35:34 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:58:59 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

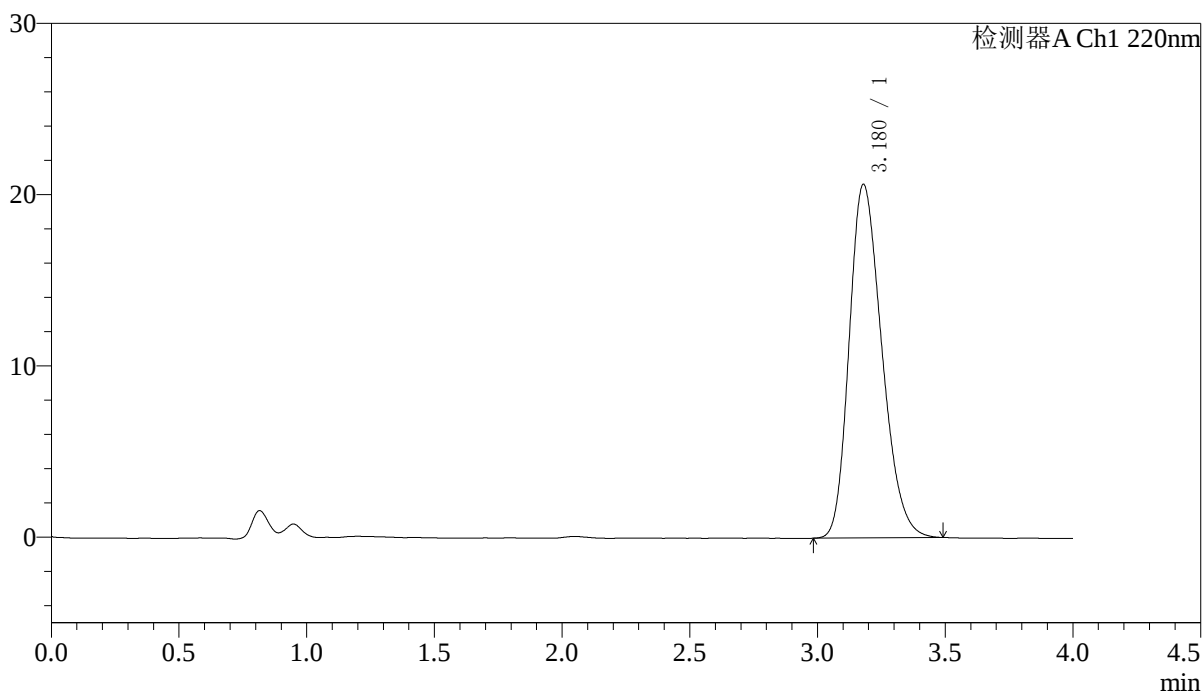

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.180	183586	100.000	20657	2949	1.249	--
总计		183586	100.000	20657			


图59 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1576-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:39:57 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:06 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

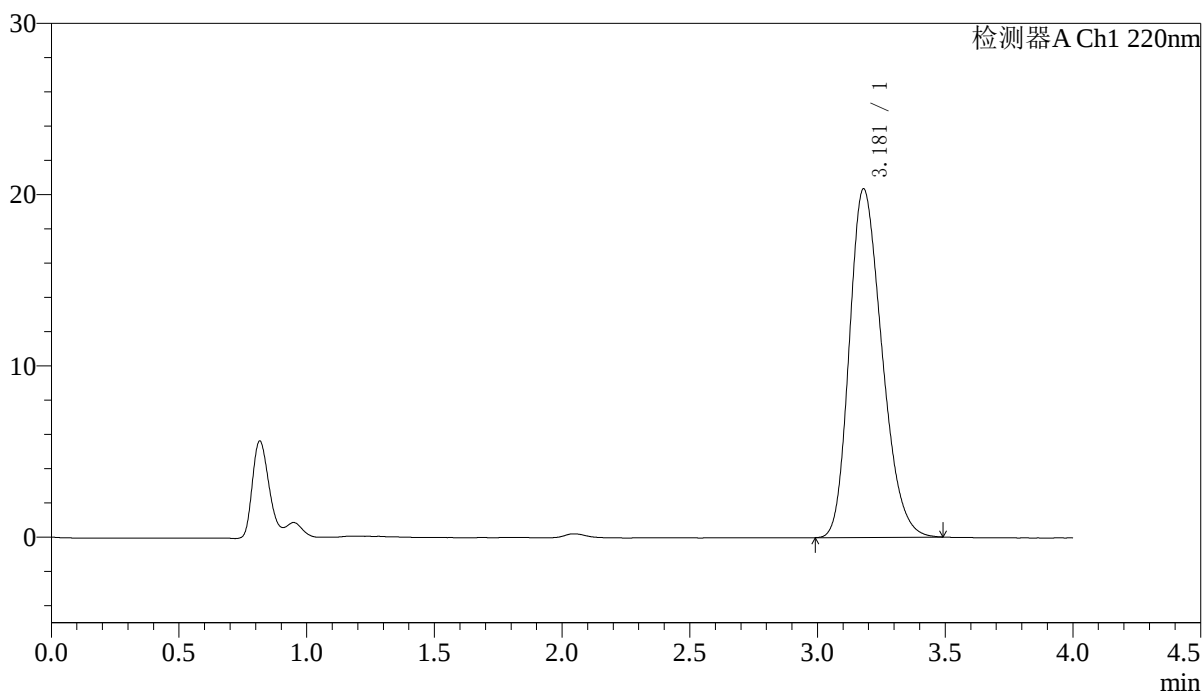

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.181	180787	100.000	20364	2953	1.249	--
总计		180787	100.000	20364			


图60 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1577-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:44:20 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:13 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

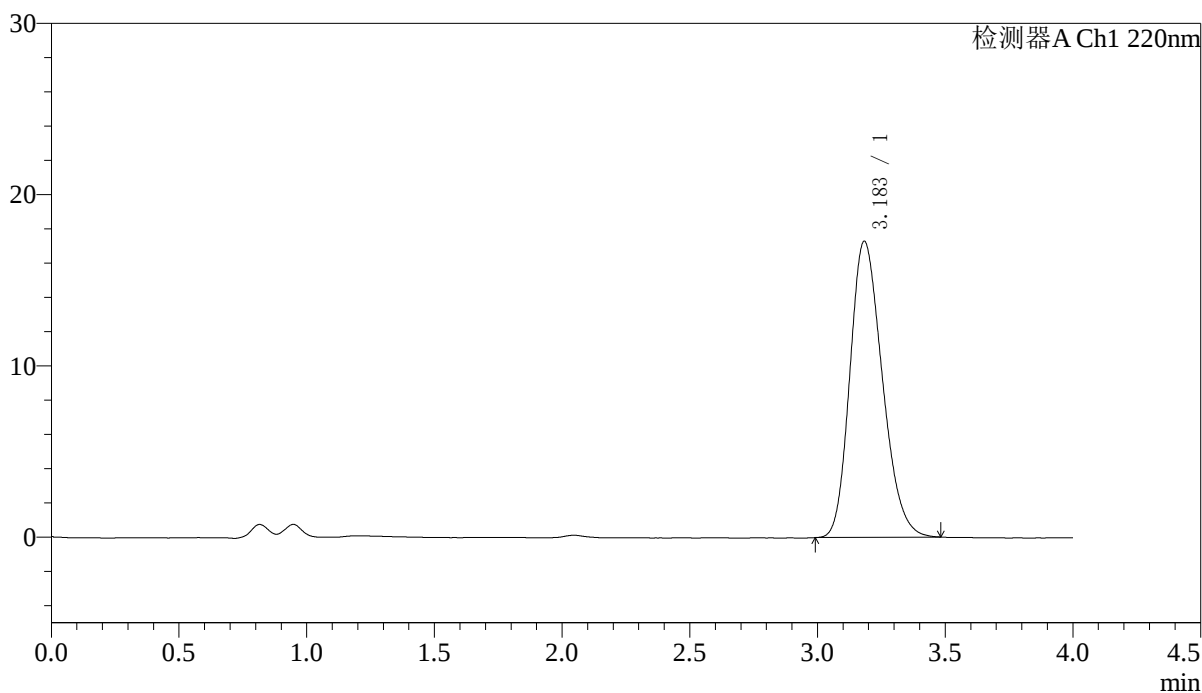

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.183	152746	100.000	17272	2992	1.224	--
总计		152746	100.000	17272			


图61 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1578-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:48:43 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:20 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

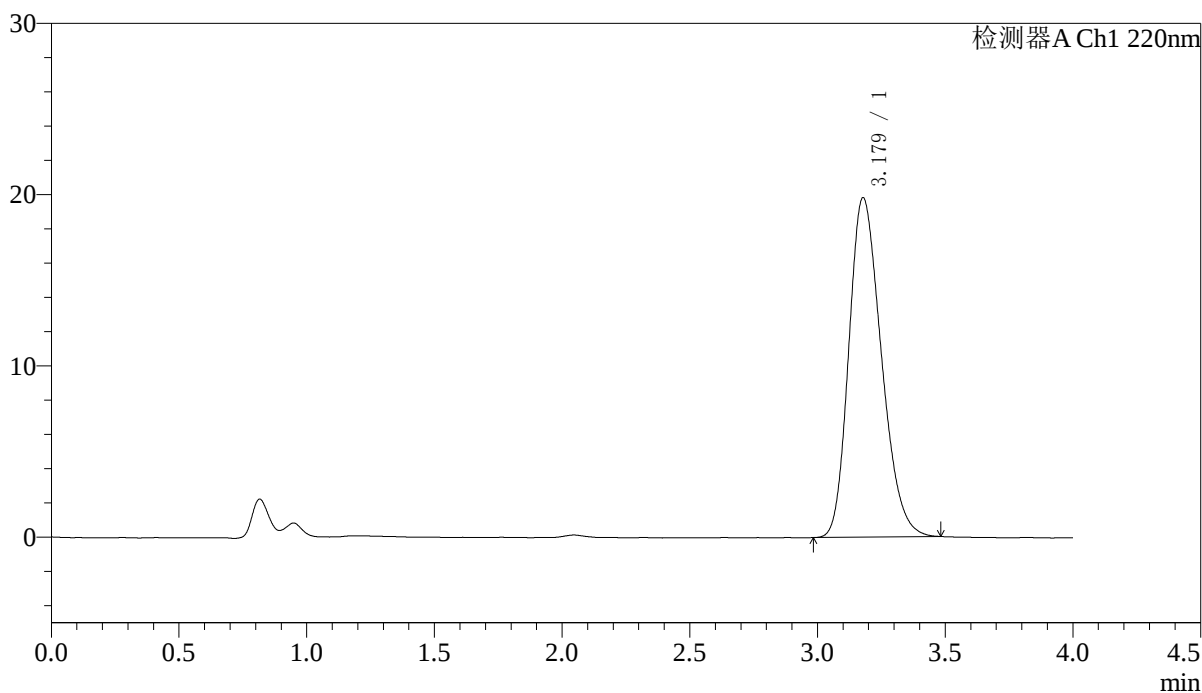

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.179	175685	100.000	19822	2966	1.243	--
总计		175685	100.000	19822			


图62 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1579-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:53:06 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:27 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

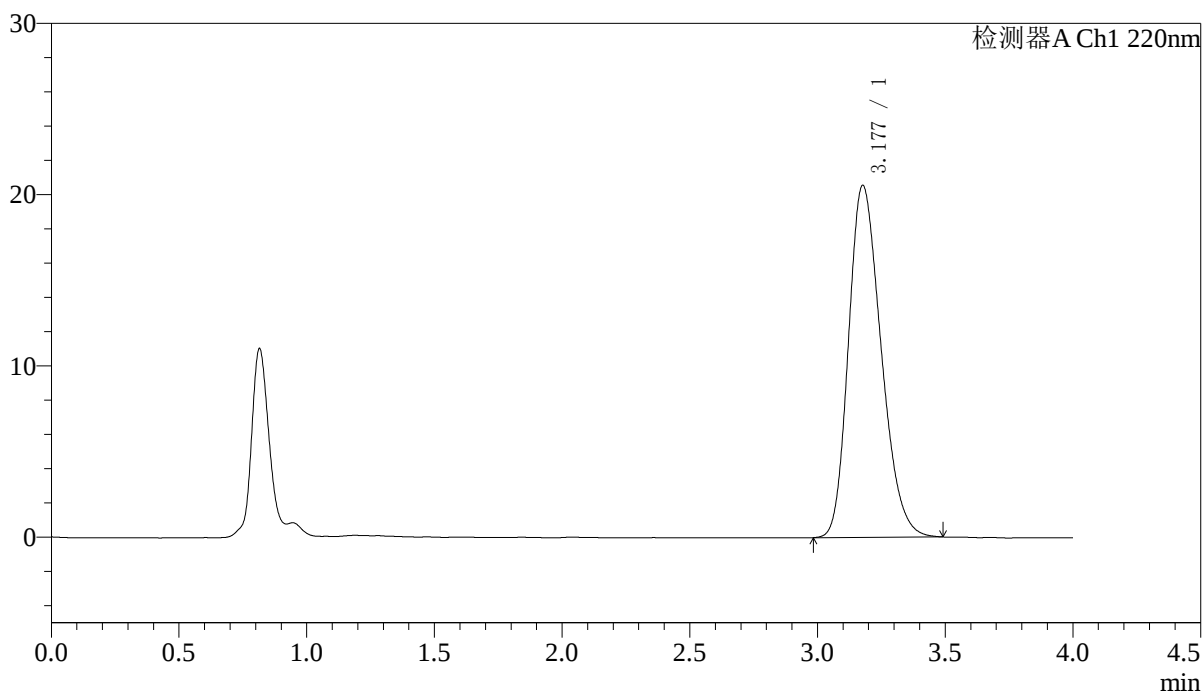

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.177	182742	100.000	20540	2944	1.247	--
总计		182742	100.000	20540			


图63 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1580-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 15:57:29 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:34 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

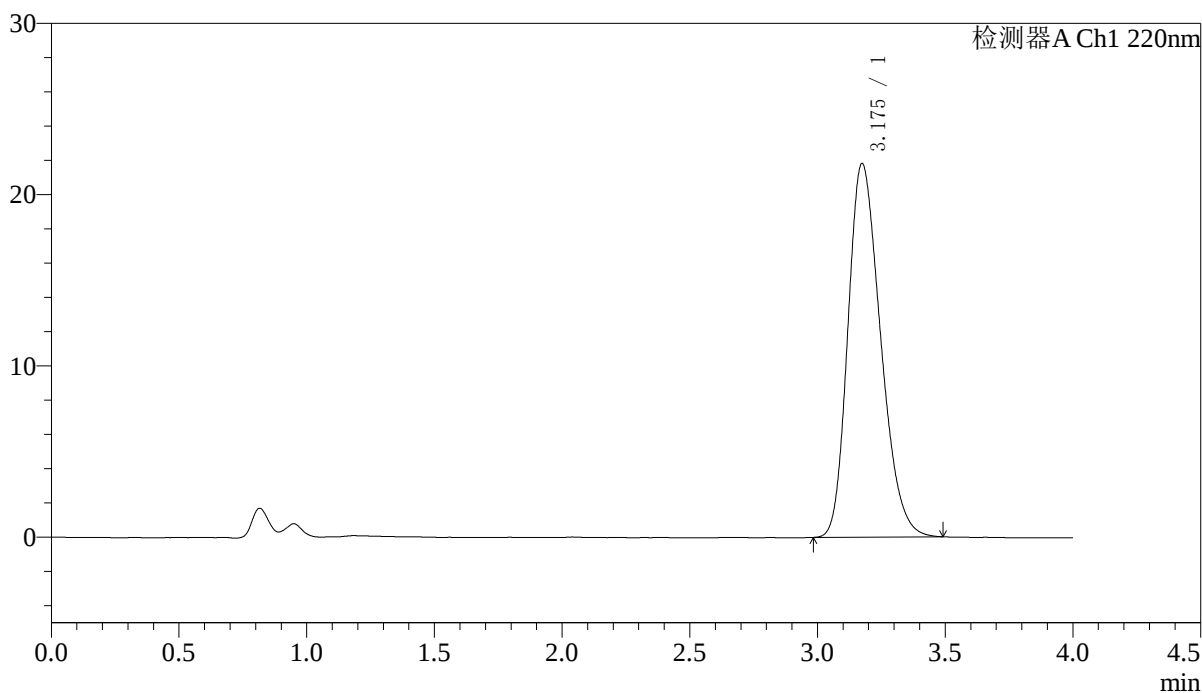

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.175	194283	100.000	21801	2927	1.259	--
总计		194283	100.000	21801			


图64 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1581-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:01:52 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:41 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

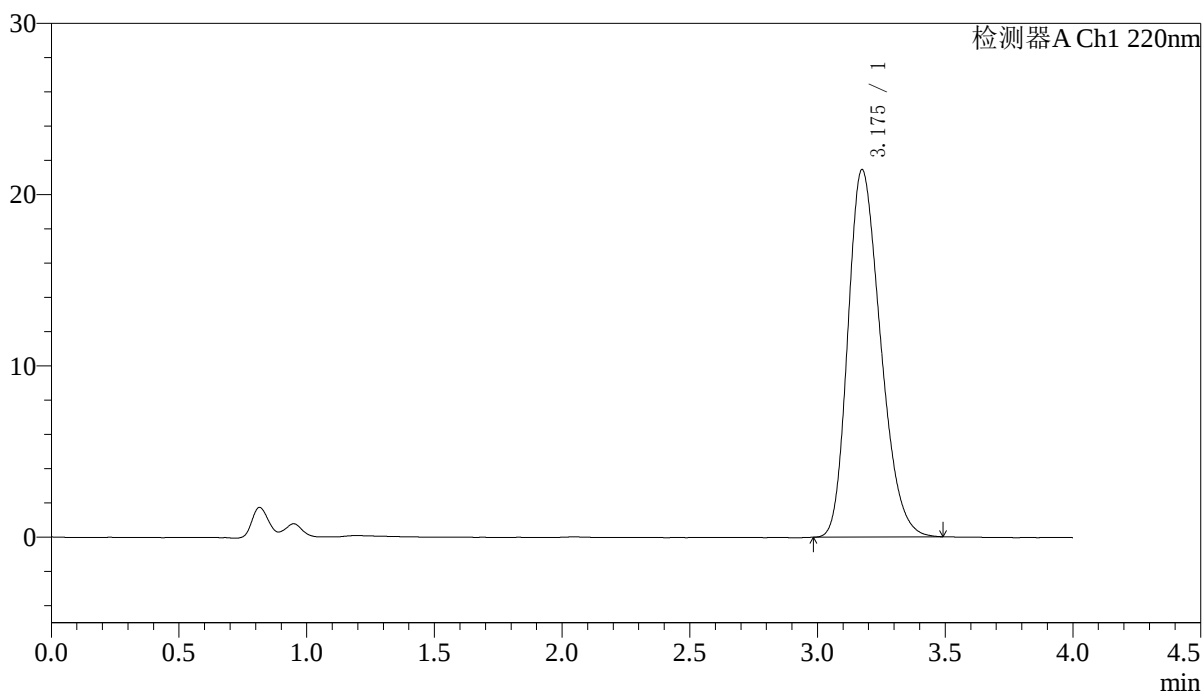

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.175	190941	100.000	21440	2929	1.257	--
总计		190941	100.000	21440			


图65 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1582-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:06:15 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:48 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

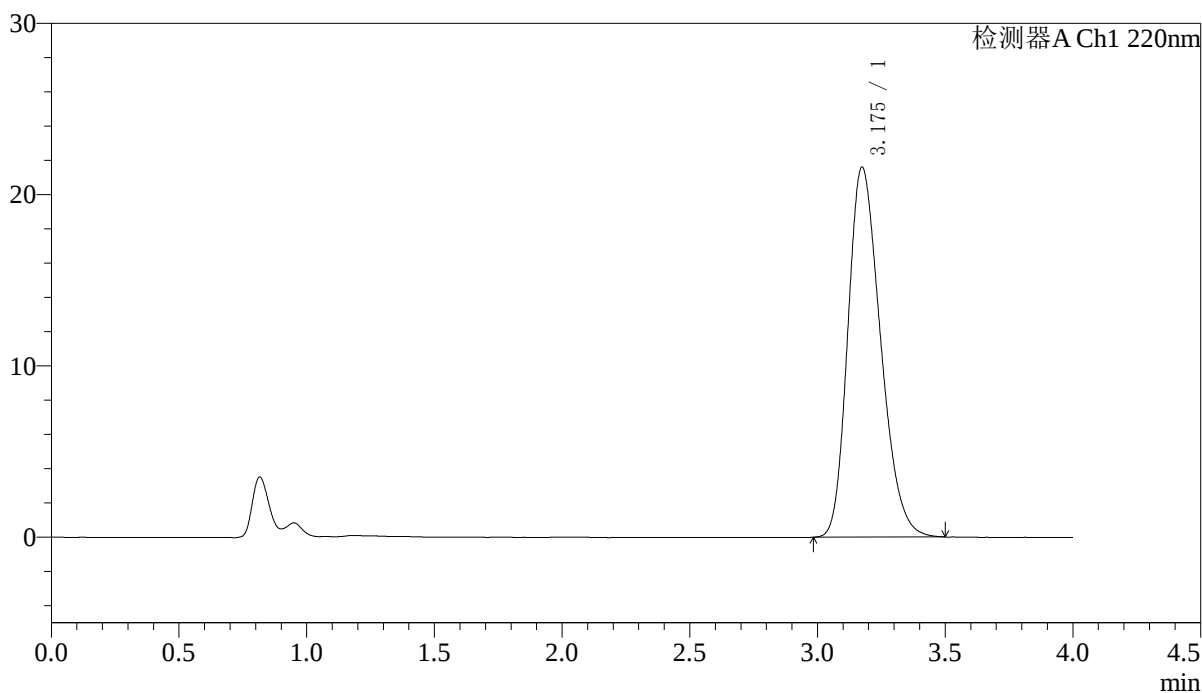

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.175	192399	100.000	21592	2929	1.258	--
总计		192399	100.000	21592			


图66 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1583-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:10:38 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:59:55 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

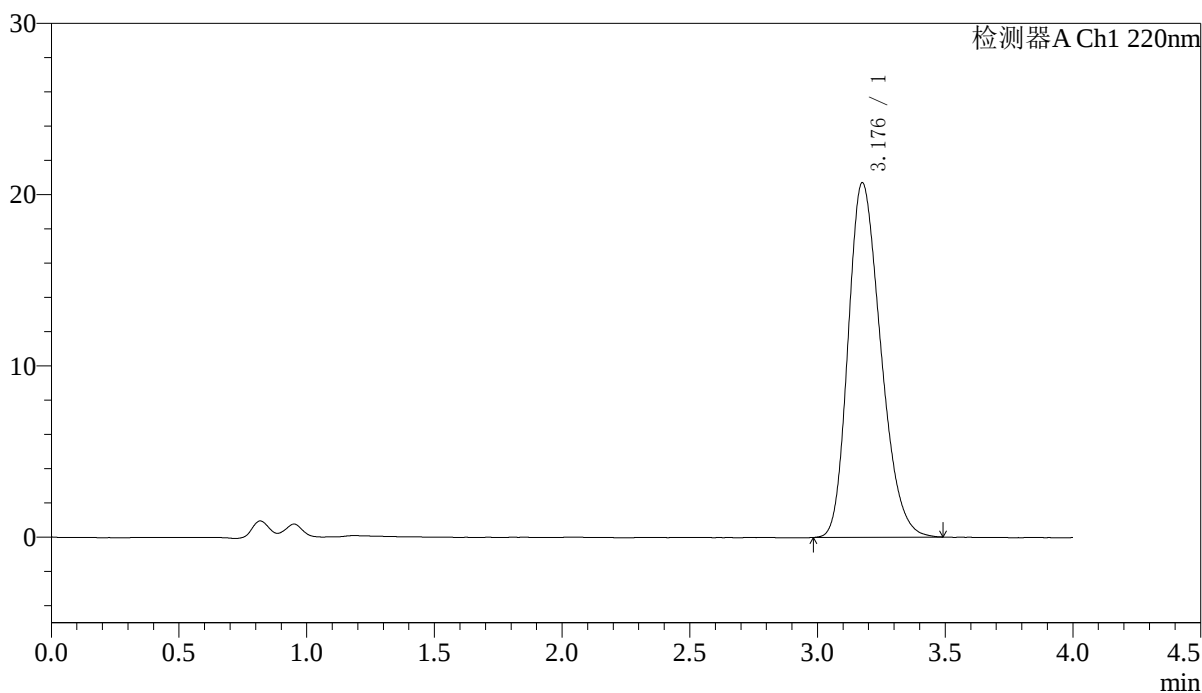

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.176	184120	100.000	20670	2947	1.251	--
总计		184120	100.000	20670			


图67 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1584-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:15:01 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:02 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

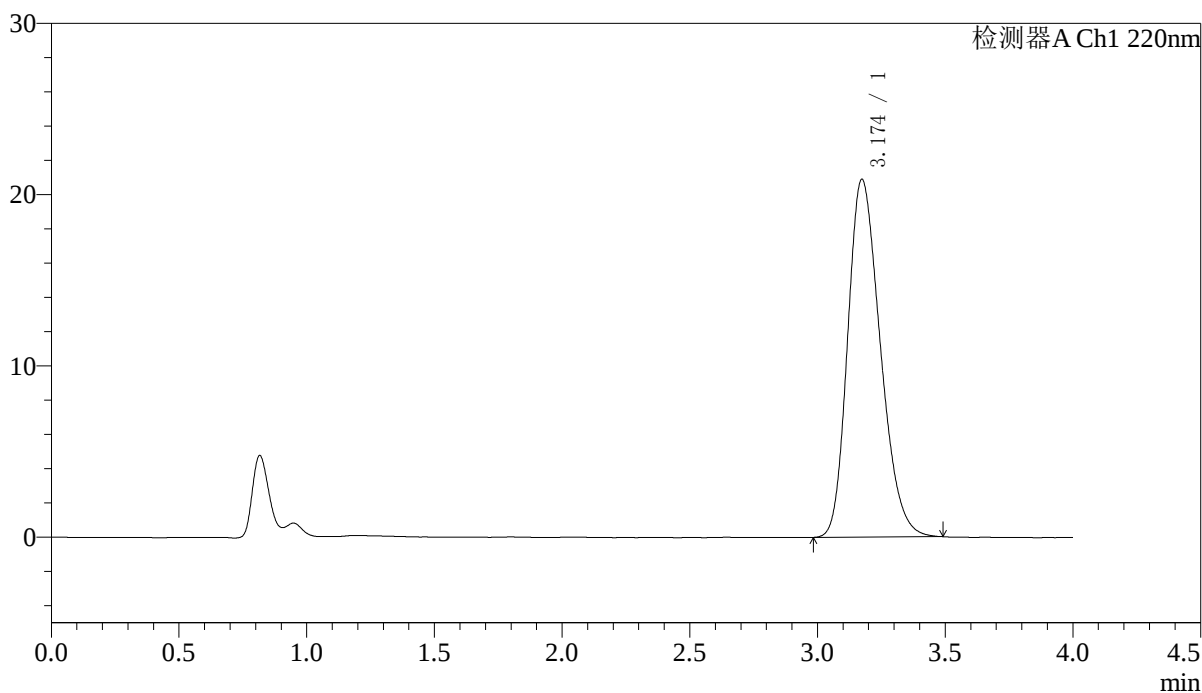

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.174	185638	100.000	20887	2948	1.249	--
总计		185638	100.000	20887			


图68 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1585-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:19:25 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:09 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

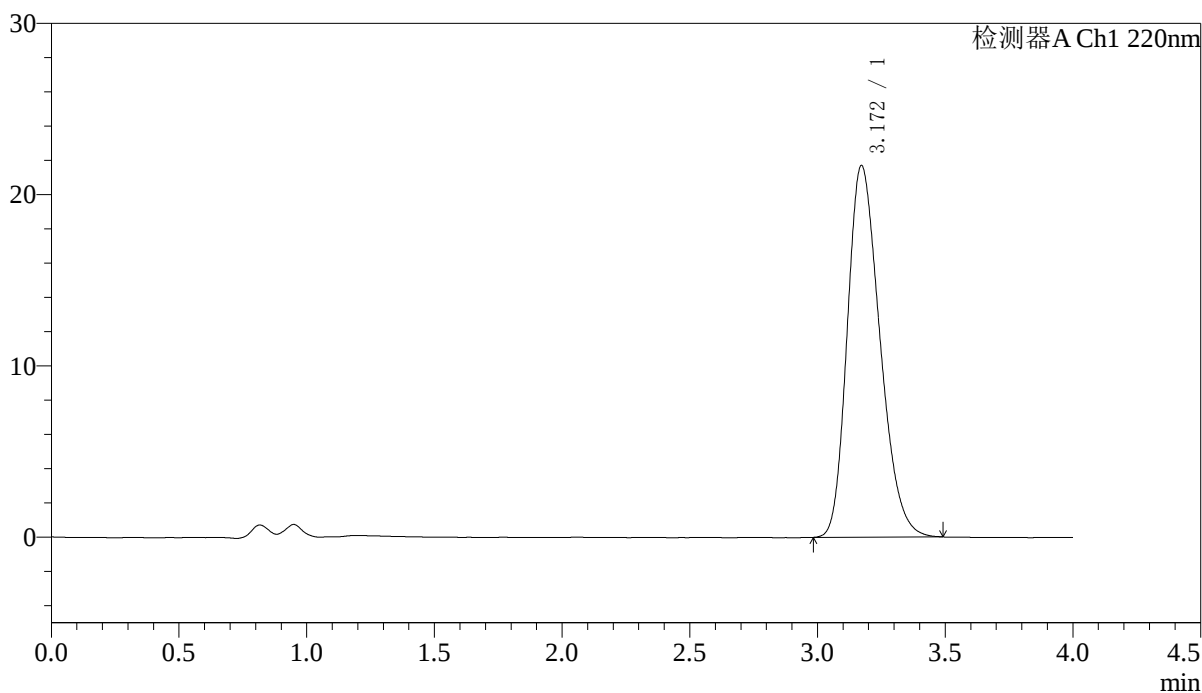

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.172	193135	100.000	21714	2931	1.257	--
总计		193135	100.000	21714			


图69 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1586-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:23:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:16 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

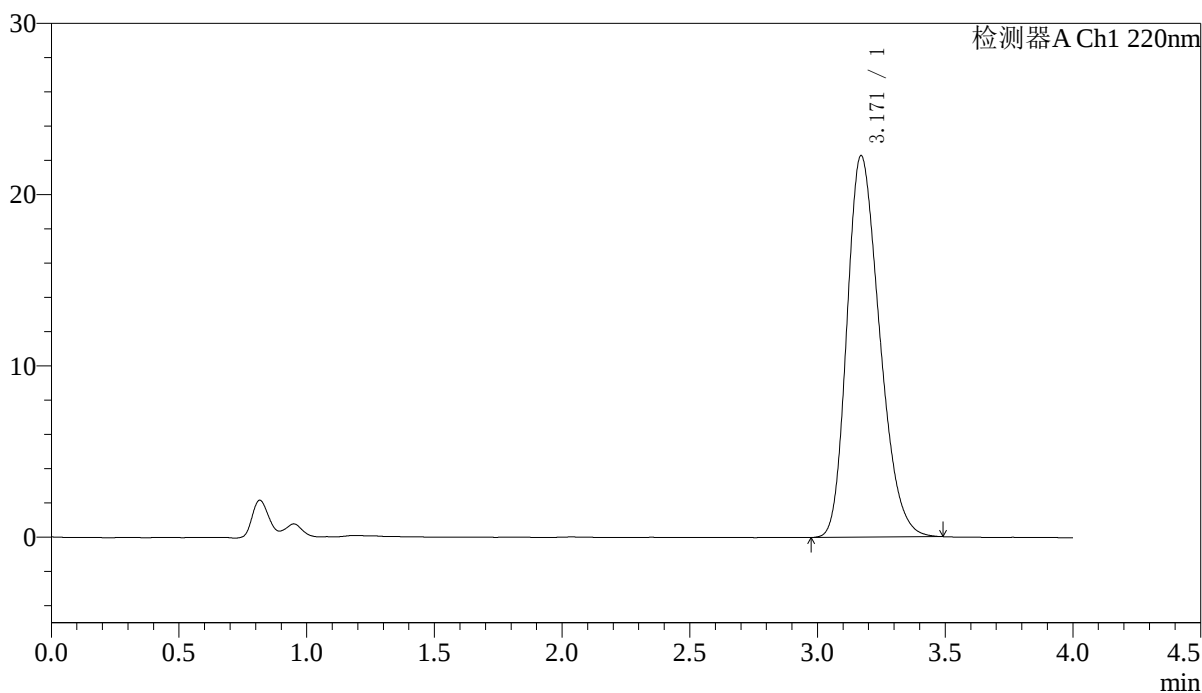

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.171	198343	100.000	22287	2929	1.261	--
总计		198343	100.000	22287			


图70 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1587-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:28:12 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:23 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

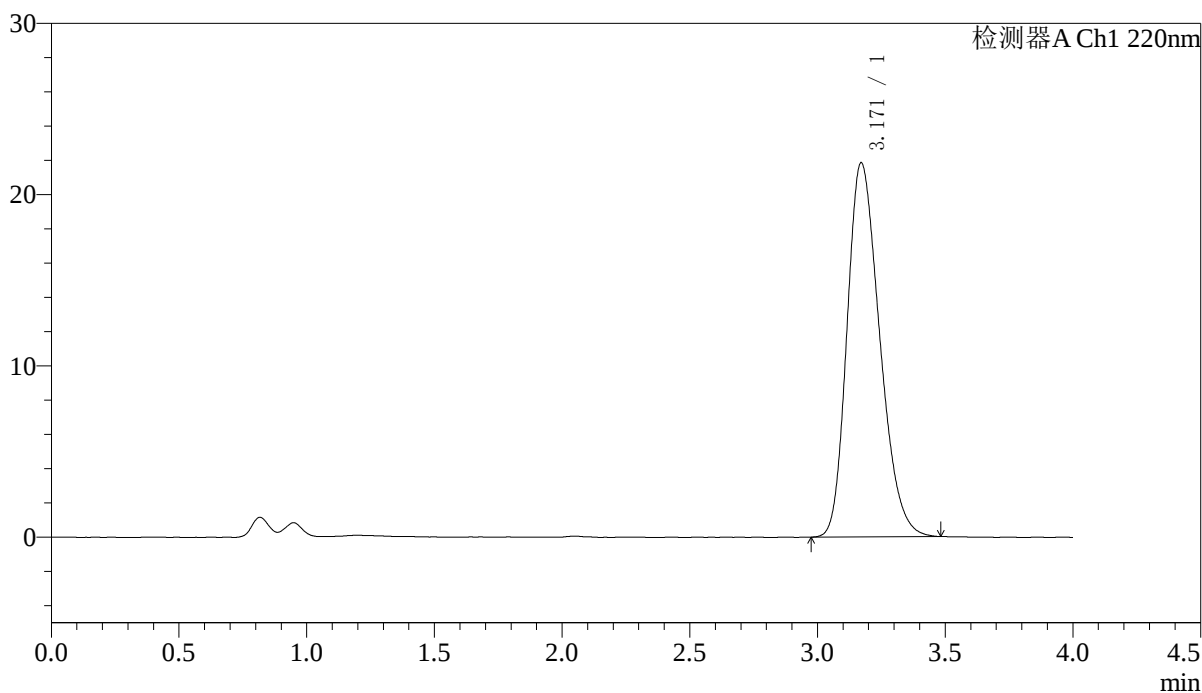

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.171	194249	100.000	21856	2931	1.257	--
总计		194249	100.000	21856			


图71 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1588-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:32:35 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:30 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

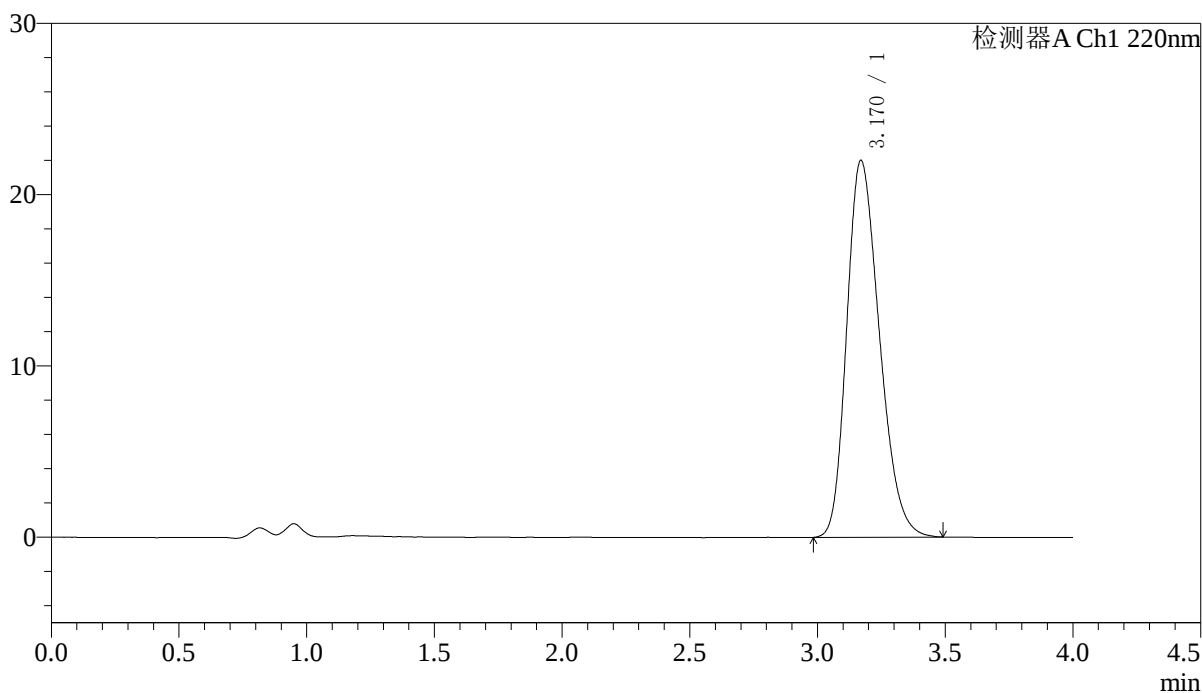

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.170	196054	100.000	22006	2927	1.258	--
总计		196054	100.000	22006			


图72 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1589-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:36:58 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:37 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

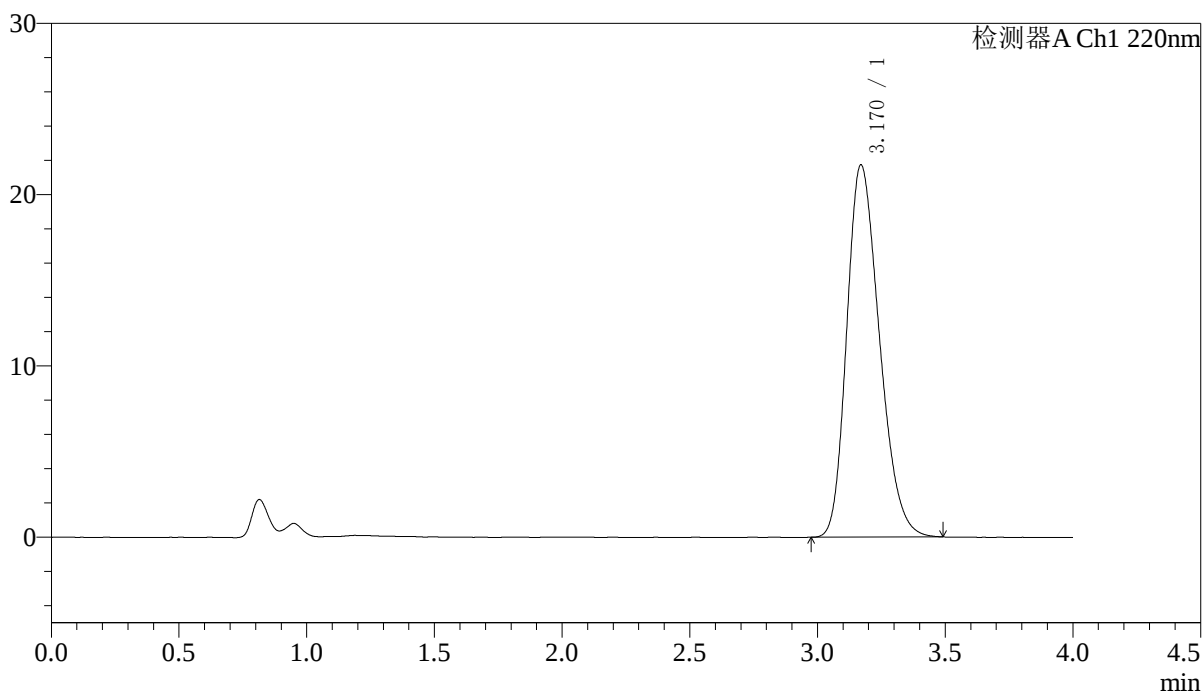

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.170	193483	100.000	21741	2925	1.255	--
总计		193483	100.000	21741			


图73 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1590-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:41:21 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:44 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

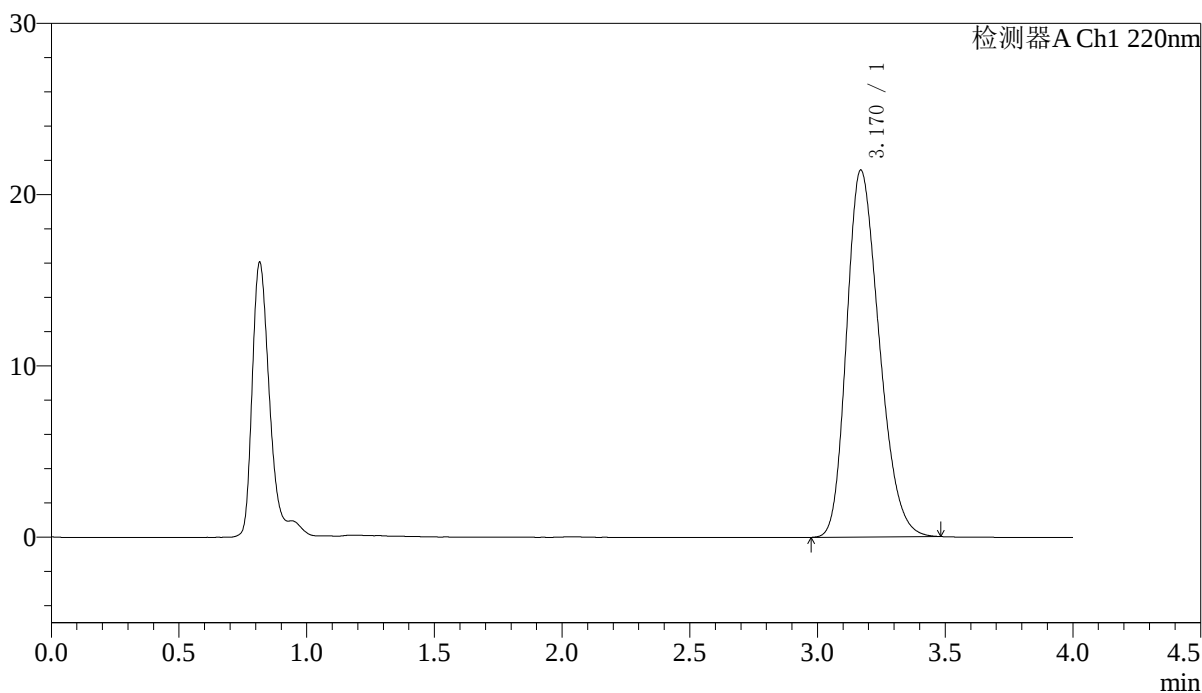

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.170	190359	100.000	21425	2938	1.252	--
总计		190359	100.000	21425			


图74 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1591-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:45:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:51 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

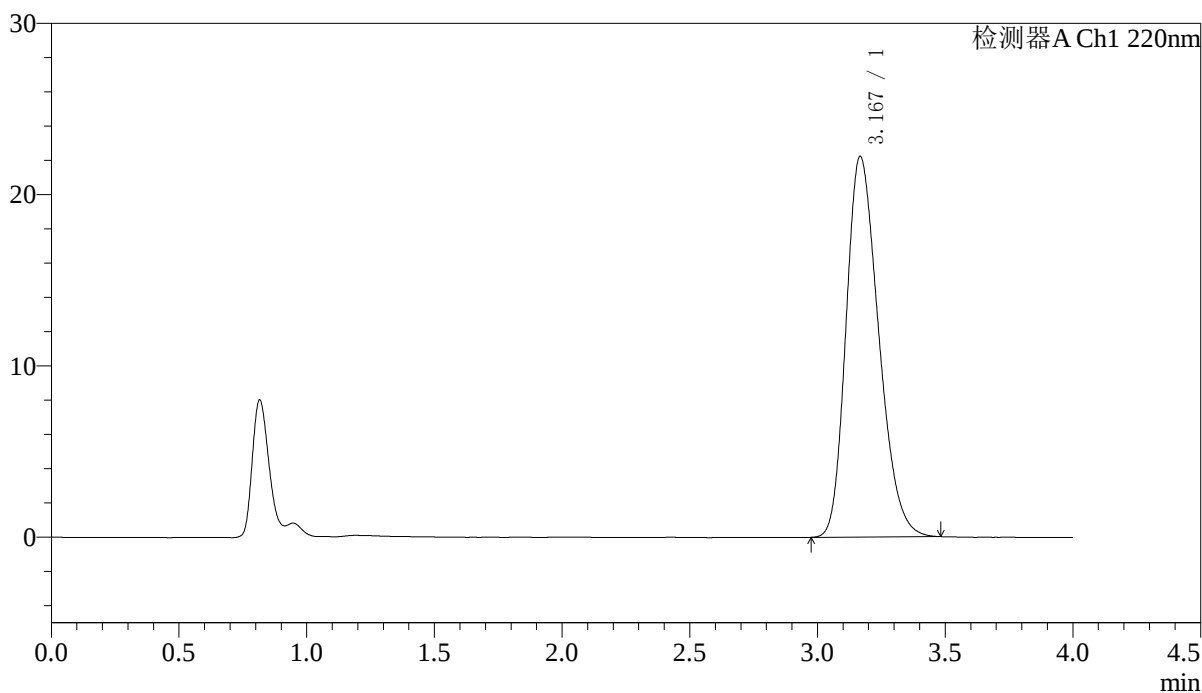

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.167	197494	100.000	22188	2925	1.261	--
总计		197494	100.000	22188			


图75 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1592-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:50:09 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:00:58 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

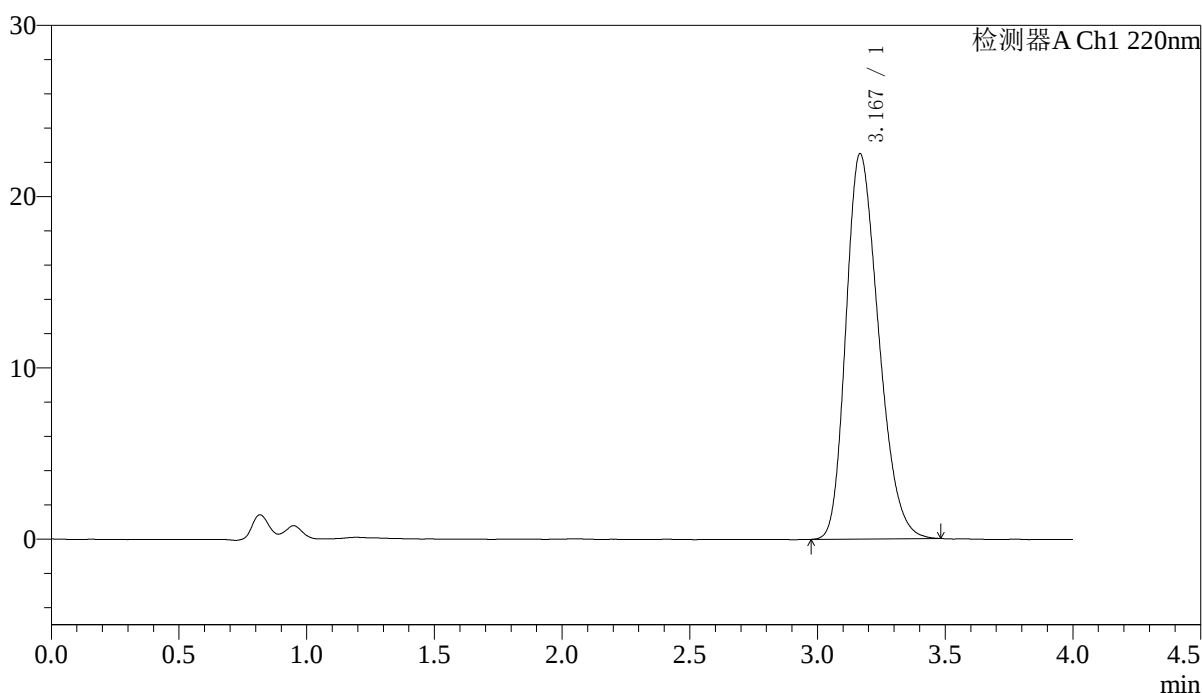

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.167	200200	100.000	22469	2922	1.263	--
总计		200200	100.000	22469			


图76 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1593-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:54:32 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:05 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

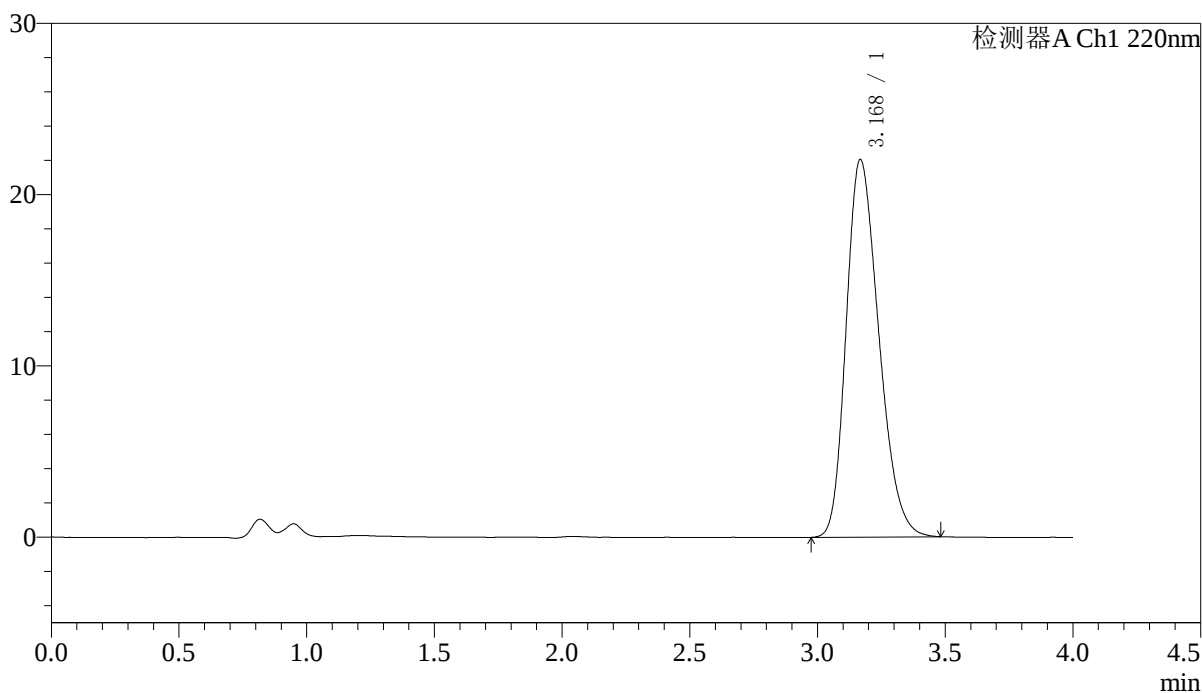

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.168	196211	100.000	22010	2917	1.260	--
总计		196211	100.000	22010			


图77 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1594-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 16:58:56 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:12 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

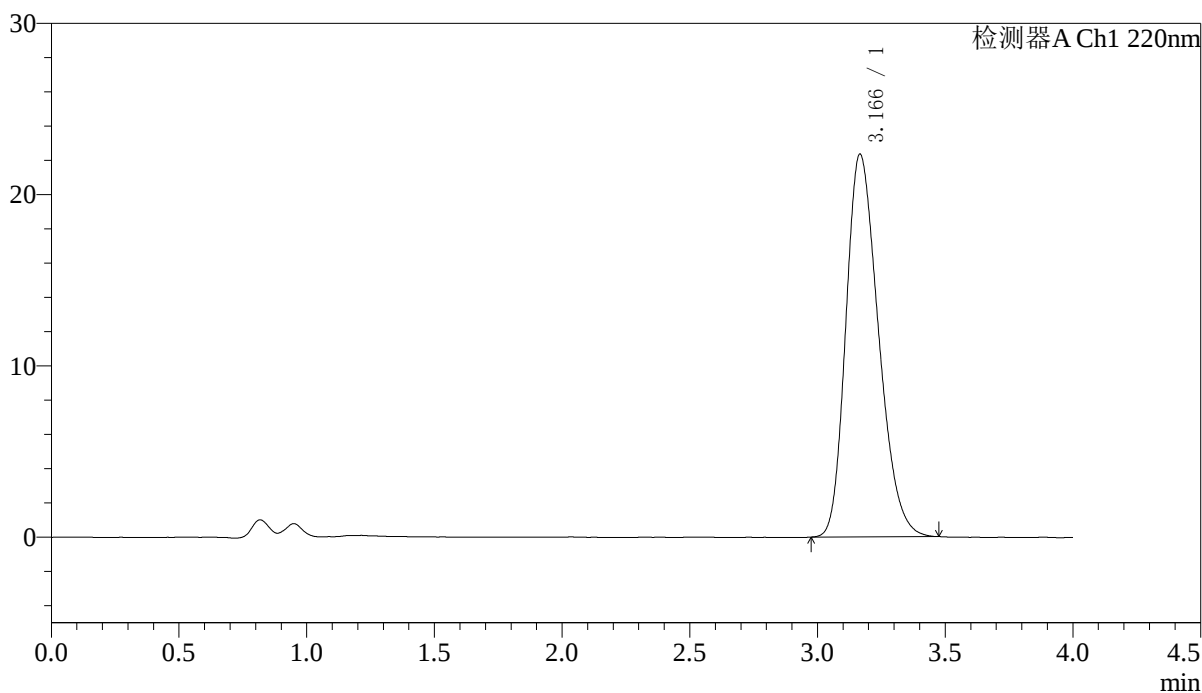

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.166	198518	100.000	22327	2925	1.261	--
总计		198518	100.000	22327			


图78 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1595-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:03:20 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:19 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

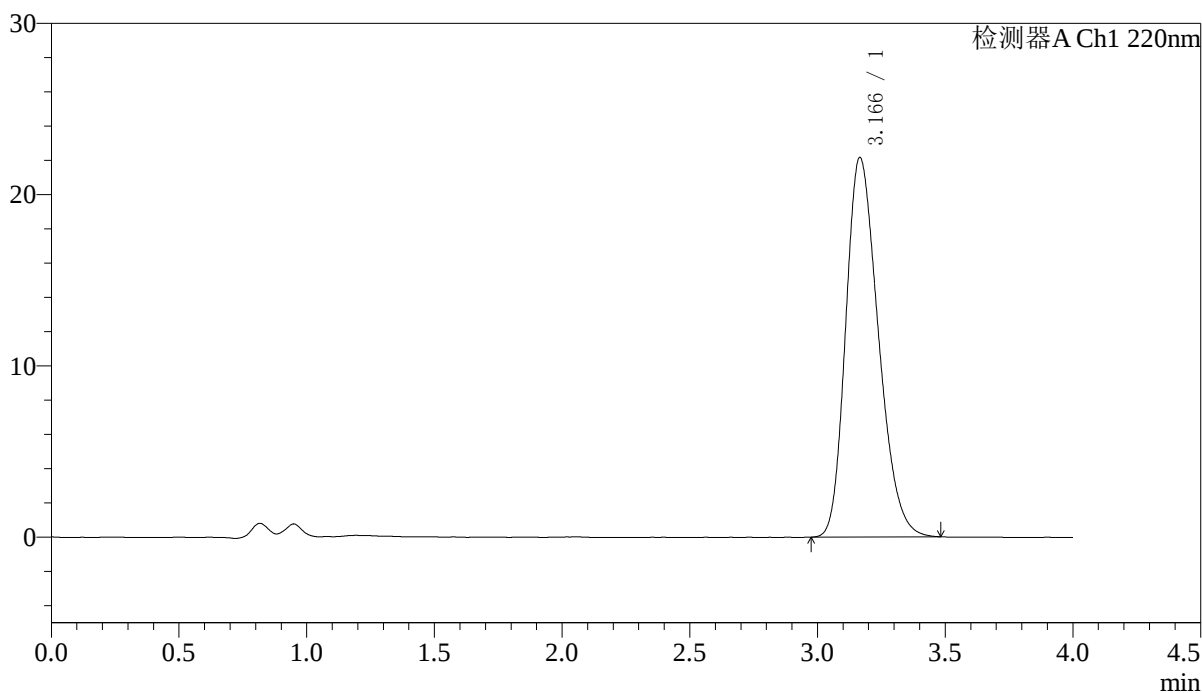

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.166	196990	100.000	22153	2928	1.258	--
总计		196990	100.000	22153			


图79 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1596-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:07:42 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:26 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

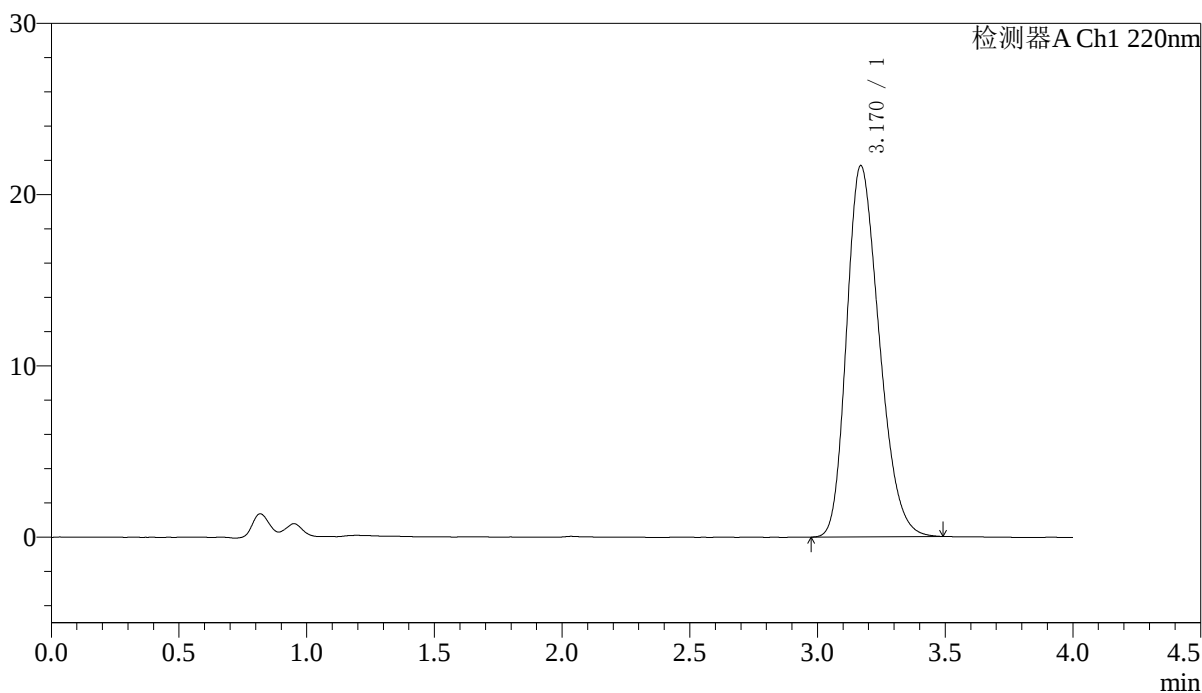

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.170	192562	100.000	21675	2930	1.255	--
总计		192562	100.000	21675			


图80 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1597-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:12:06 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:33 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

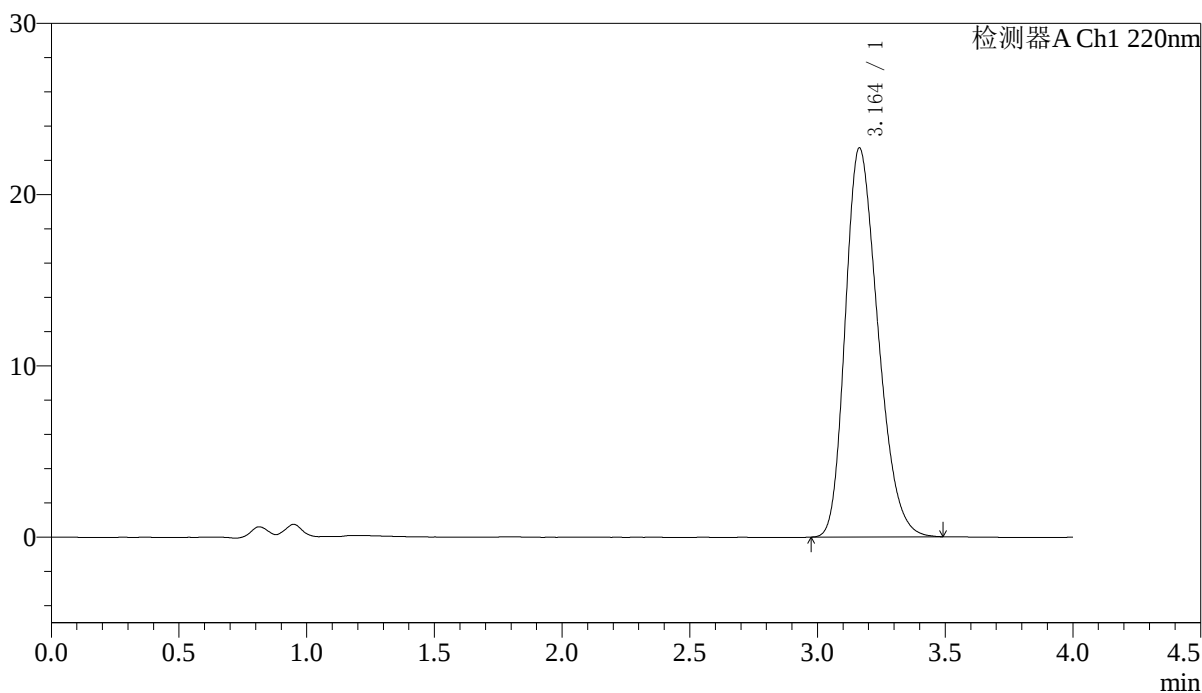

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.164	202164	100.000	22728	2918	1.264	--
总计		202164	100.000	22728			


图81 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1598-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:16:30 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:40 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

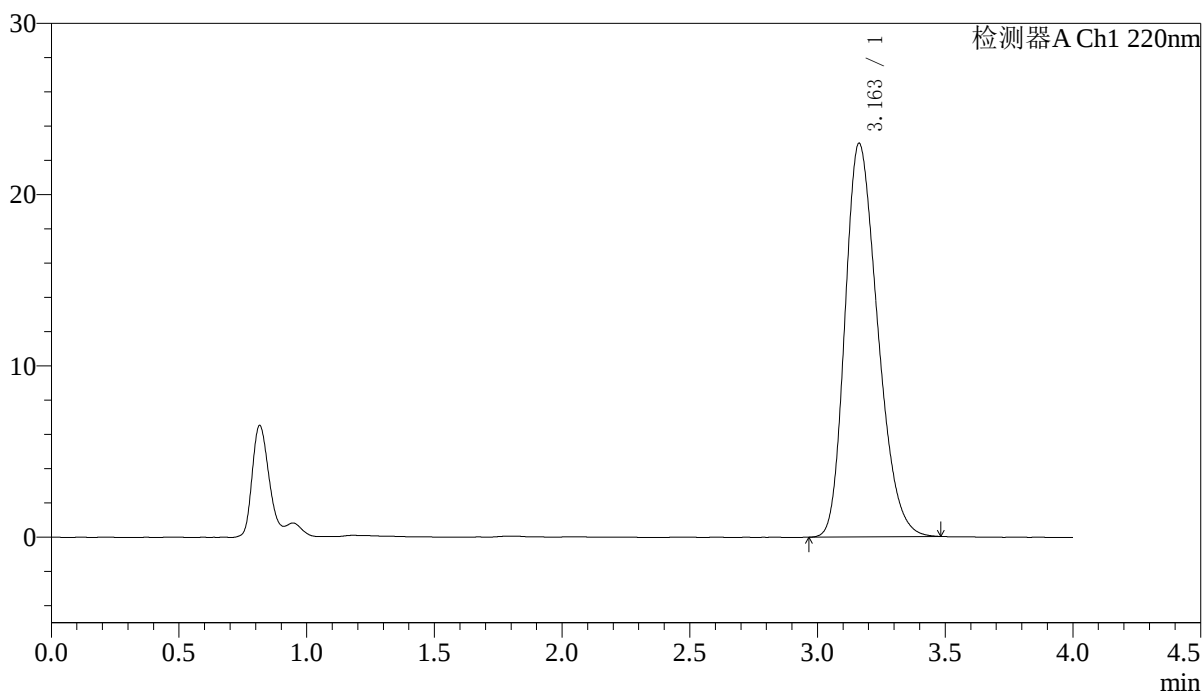

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.163	204622	100.000	22995	2911	1.266	--
总计		204622	100.000	22995			


图82 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1599-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:20:53 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:47 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

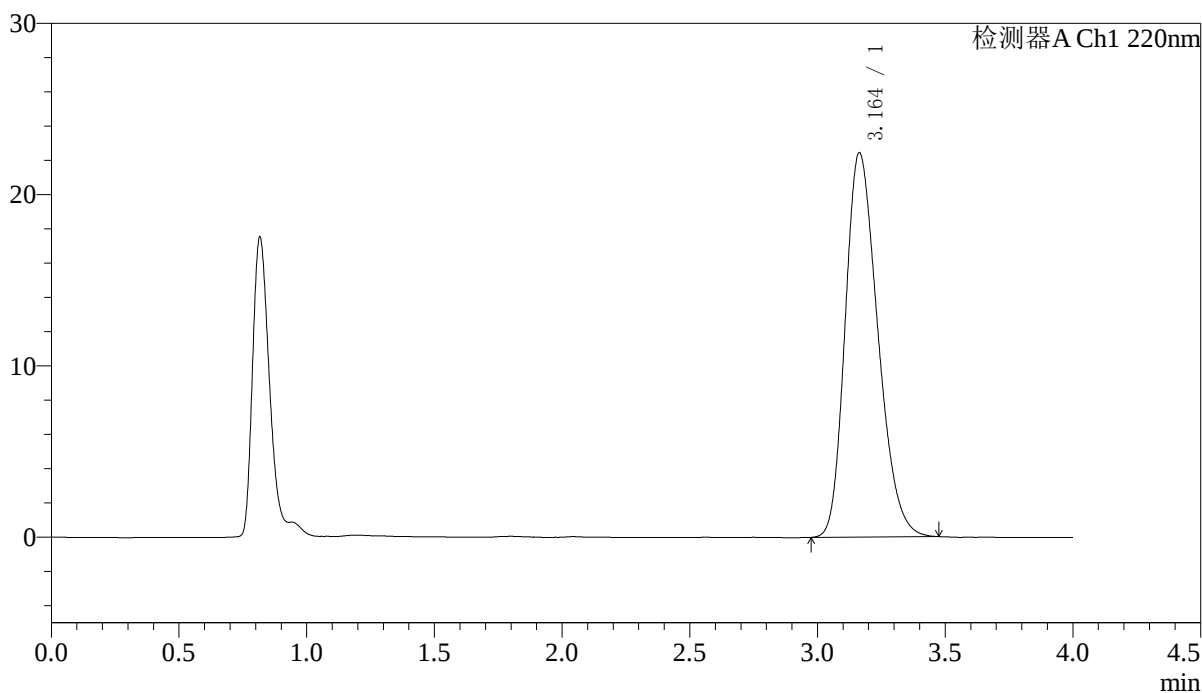

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.164	199408	100.000	22451	2916	1.258	--
总计		199408	100.000	22451			


图83 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1600-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:25:17 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:01:54 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

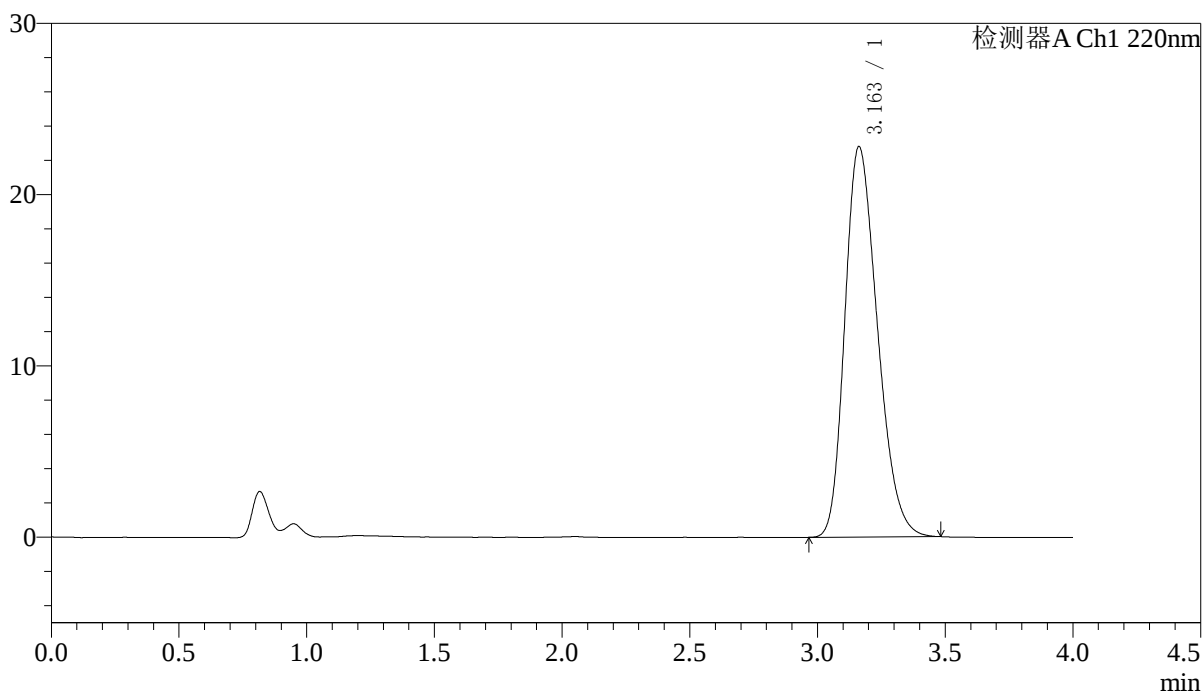

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.163	202630	100.000	22811	2916	1.263	--
总计		202630	100.000	22811			


图84 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1601-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:29:41 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:01 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

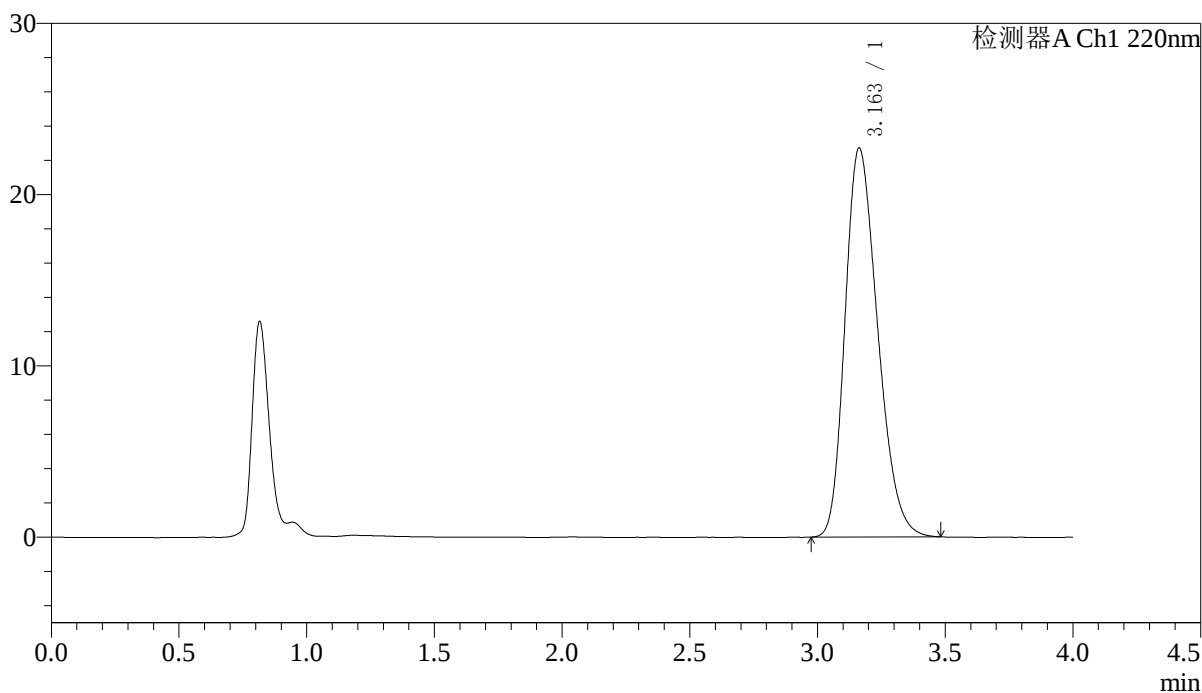

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.163	202119	100.000	22728	2912	1.264	--
总计		202119	100.000	22728			


图85 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1602-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:34:05 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:08 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

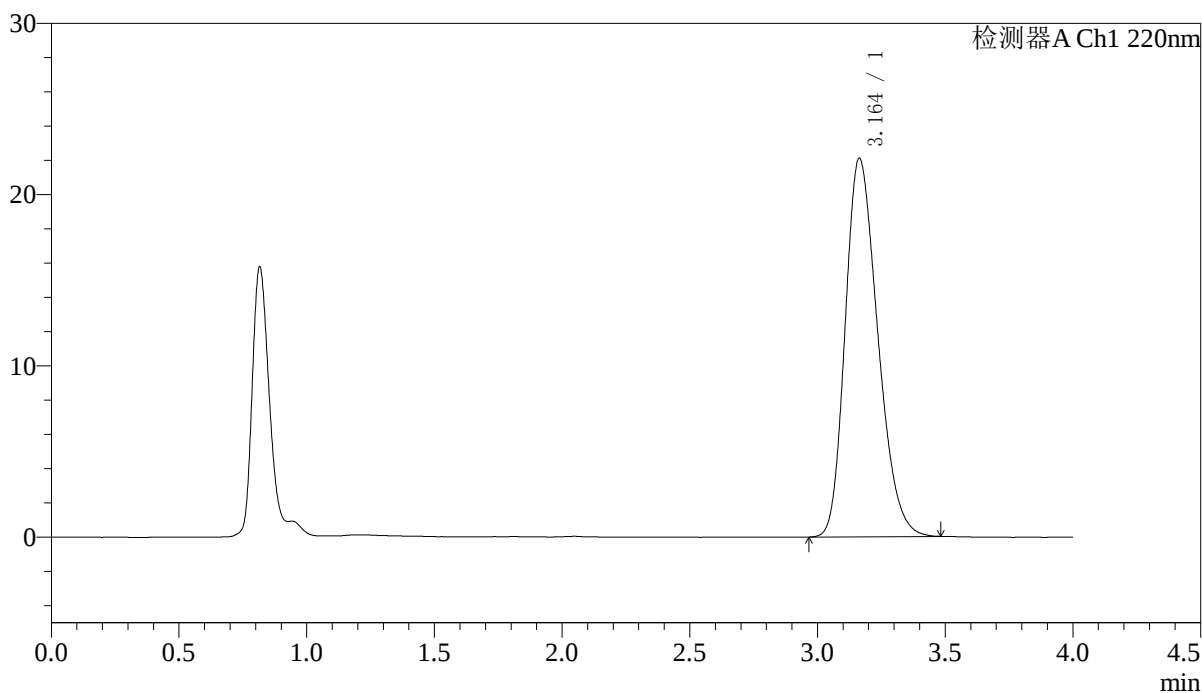

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.164	196333	100.000	22114	2931	1.258	--
总计		196333	100.000	22114			


图86 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1603-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:38:29 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:15 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

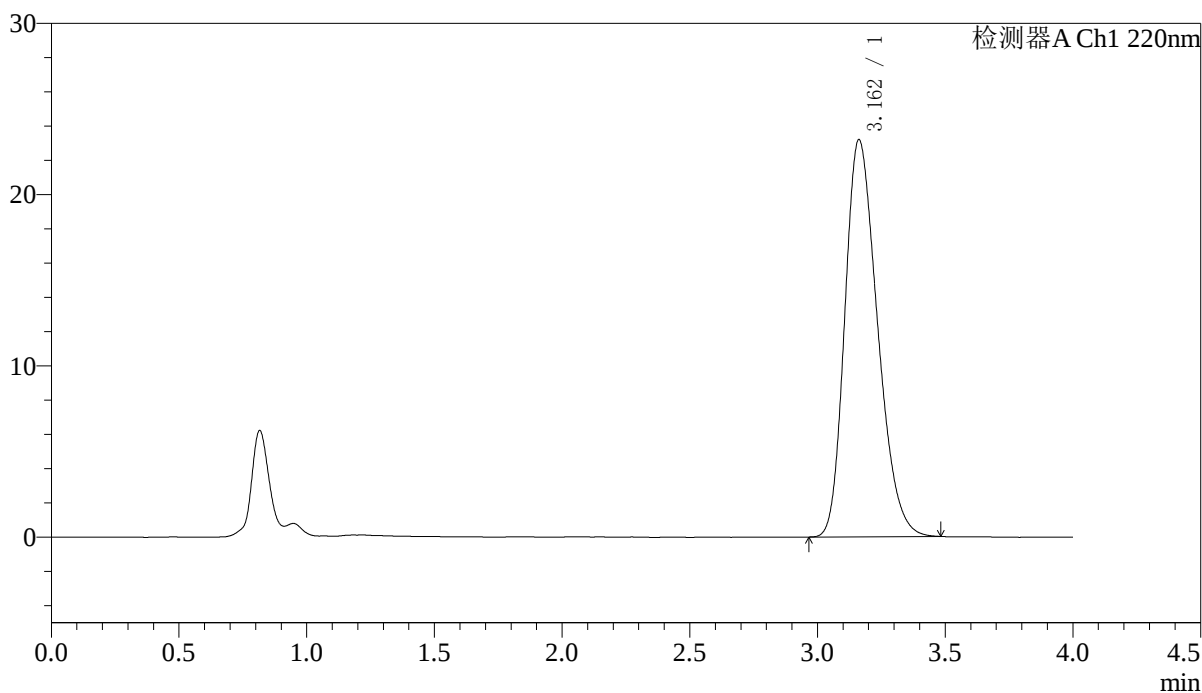

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.162	206452	100.000	23198	2906	1.266	--
总计		206452	100.000	23198			


图87 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1604-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:42:53 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:22 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

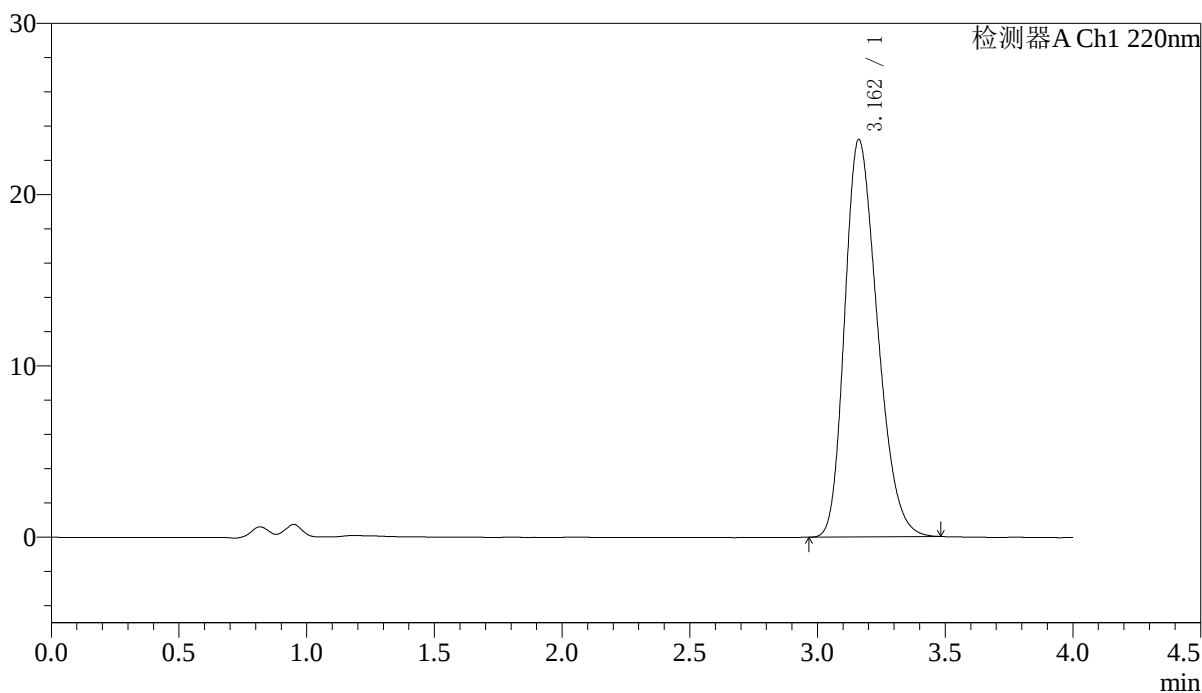

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.162	206614	100.000	23208	2902	1.265	--
总计		206614	100.000	23208			


图88 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1605-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:47:16 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:29 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

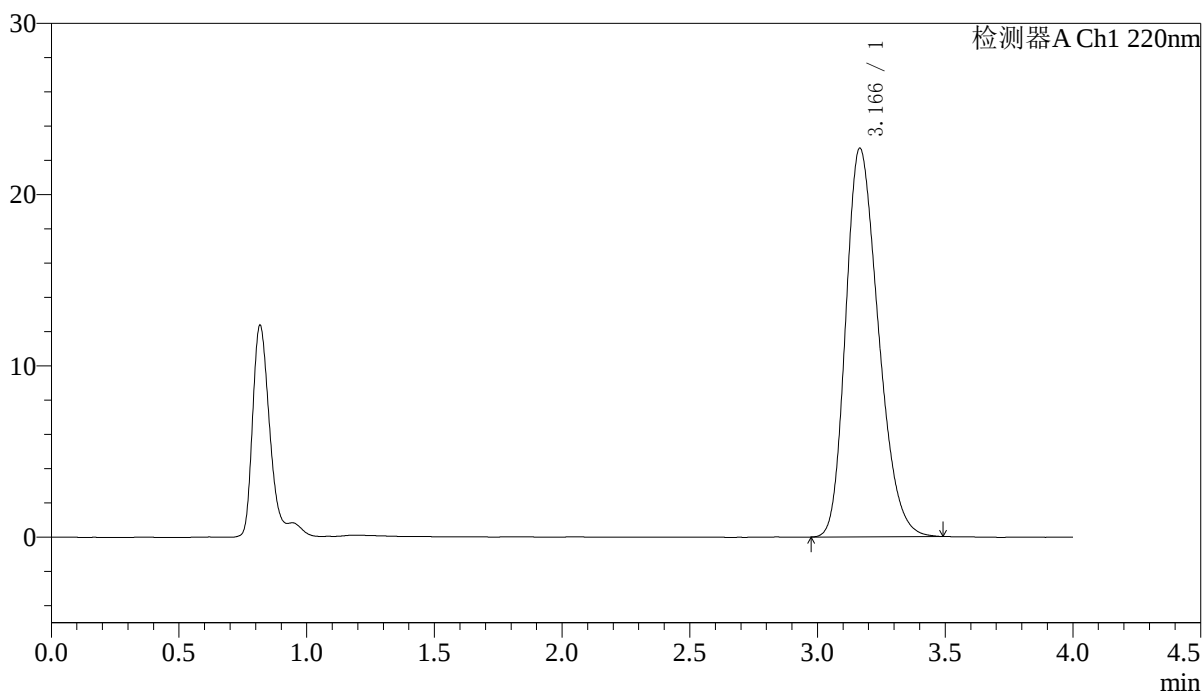

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.166	201876	100.000	22685	2922	1.263	--
总计		201876	100.000	22685			


图89 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1606-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:51:40 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:36 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

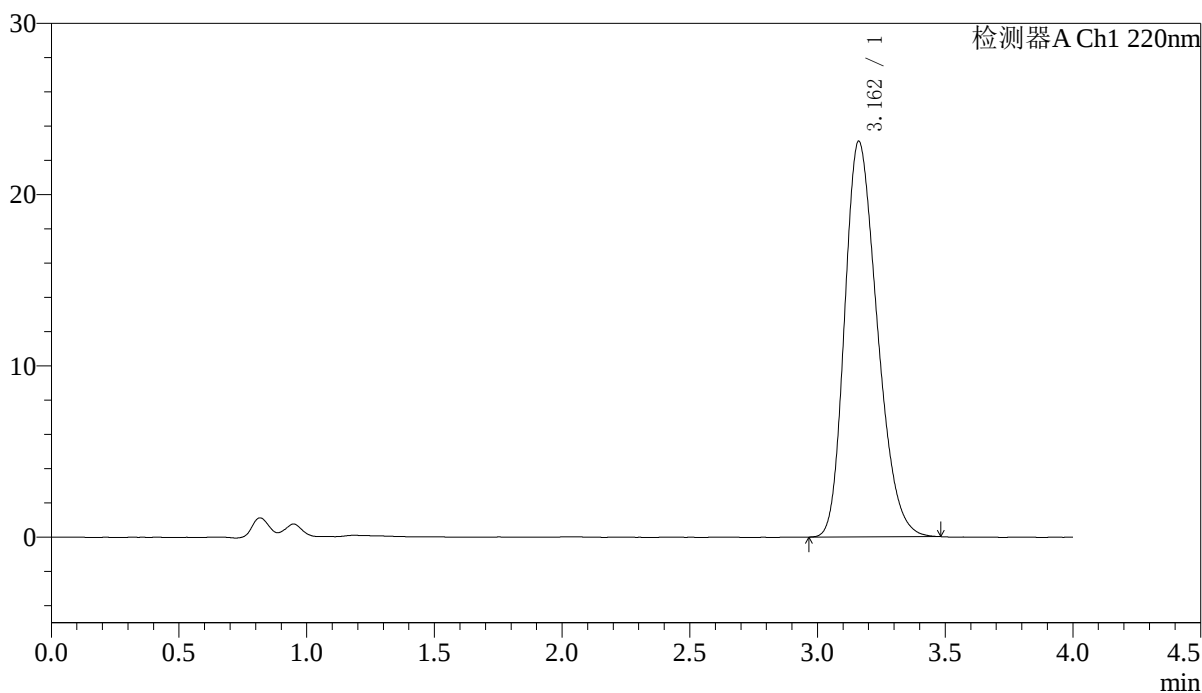

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.162	205506	100.000	23105	2910	1.263	--
总计		205506	100.000	23105			


图90 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1607-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 17:56:04 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:43 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

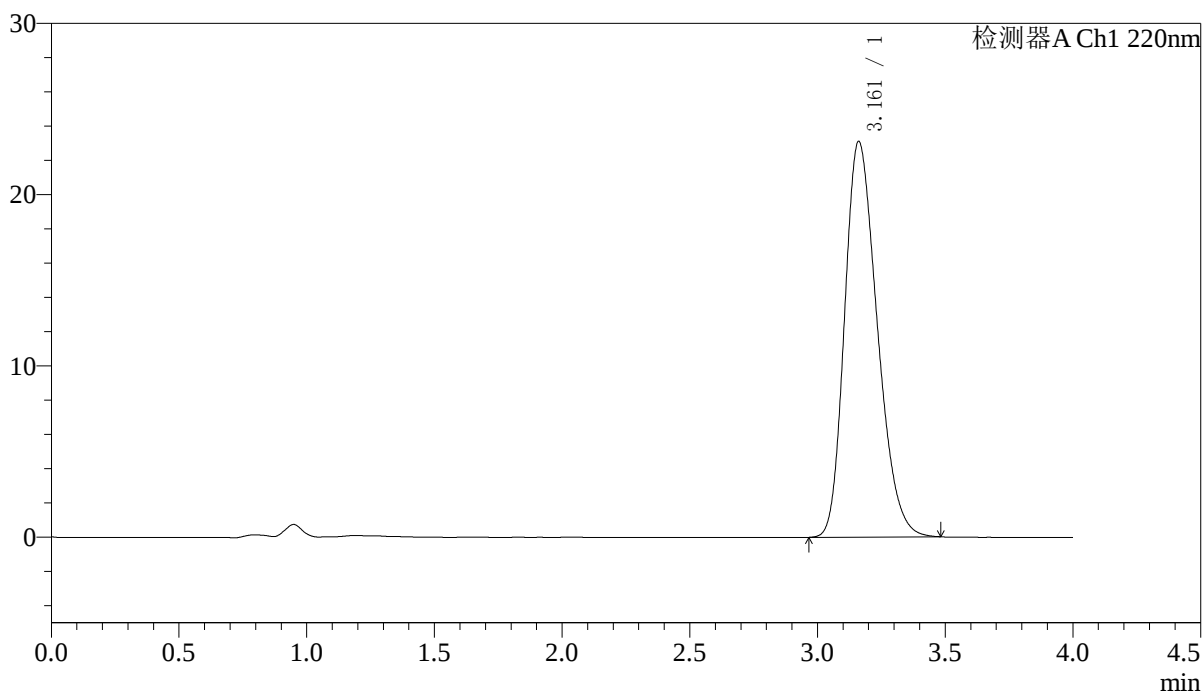

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.161	205744	100.000	23104	2902	1.265	--
总计		205744	100.000	23104			


图91 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1608-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:00:27 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:50 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

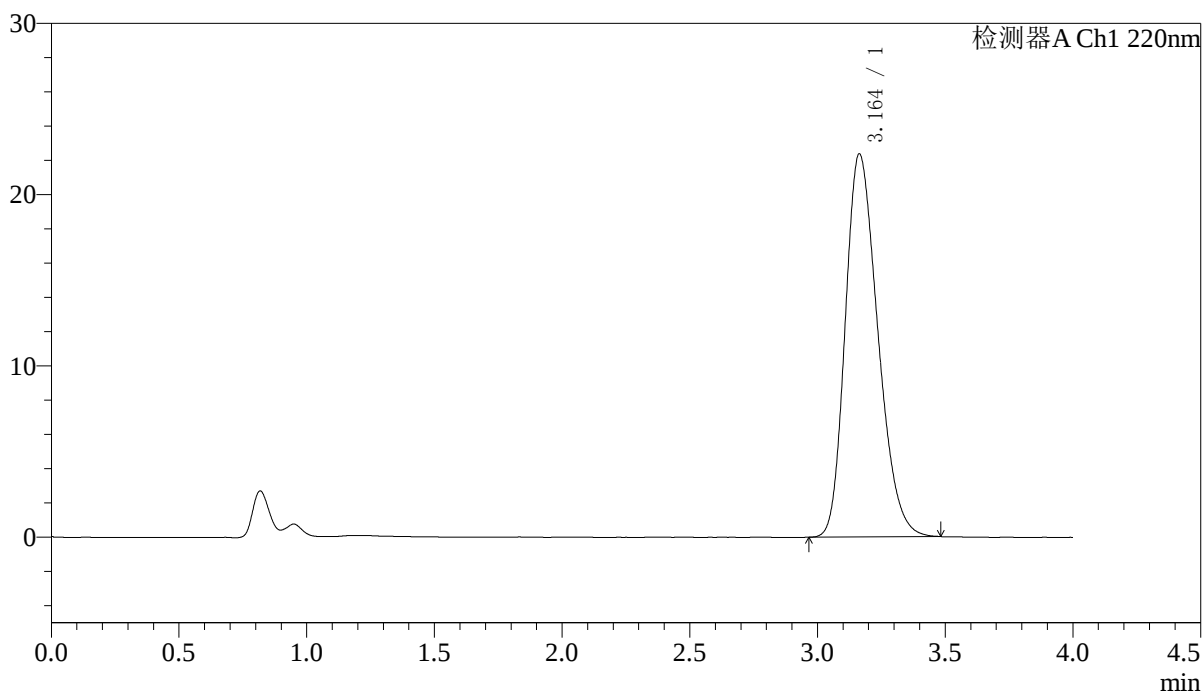

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.164	198738	100.000	22376	2923	1.260	--
总计		198738	100.000	22376			

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1609-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:04:51 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:02:57 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

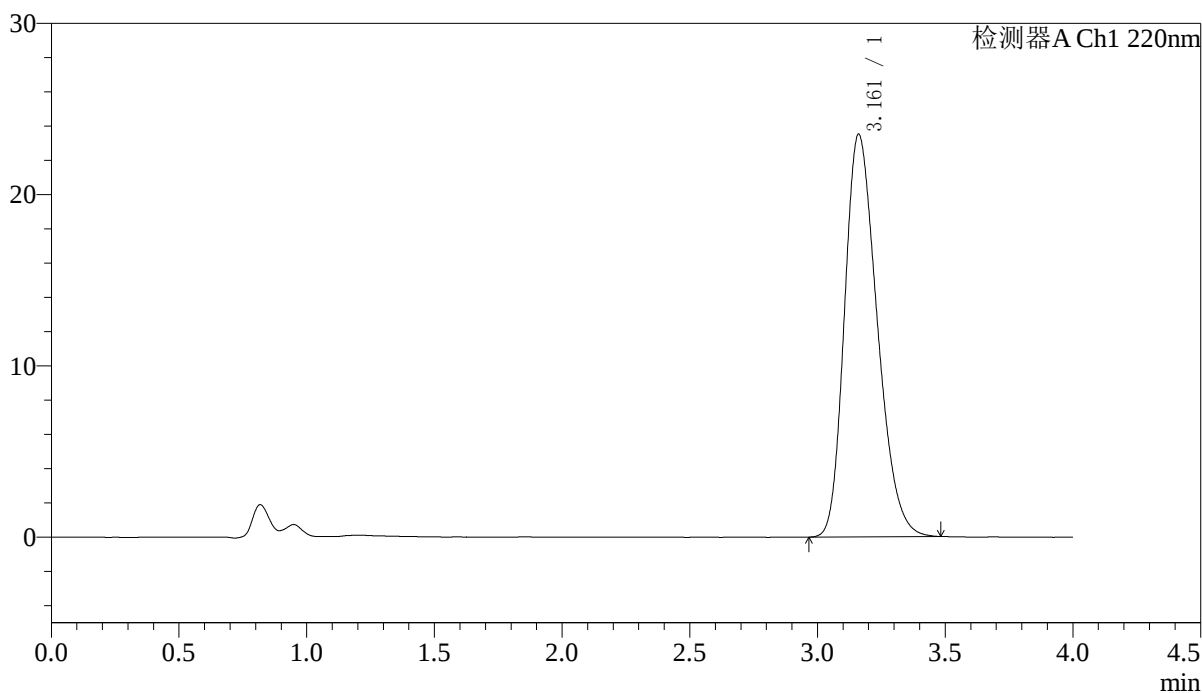

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.161	209499	100.000	23502	2895	1.268	--
总计		209499	100.000	23502			


图93 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1610-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:09:14 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:04 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

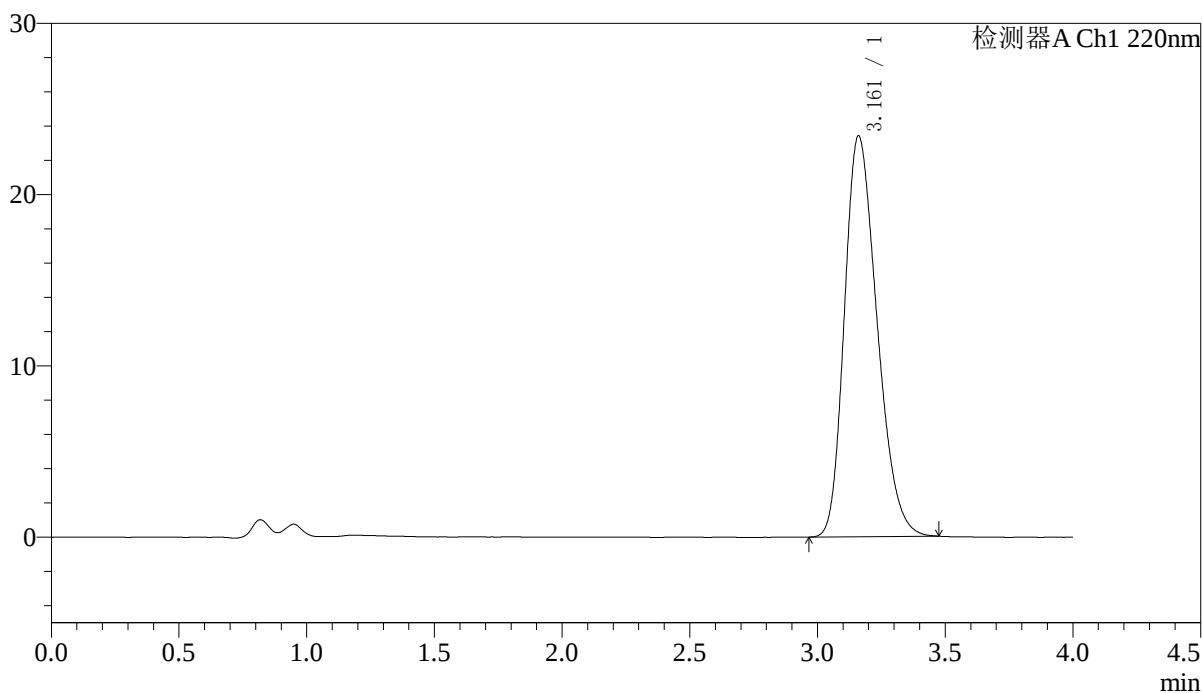

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.161	208175	100.000	23398	2911	1.266	--
总计		208175	100.000	23398			


图94 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1611-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:13:37 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:11 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

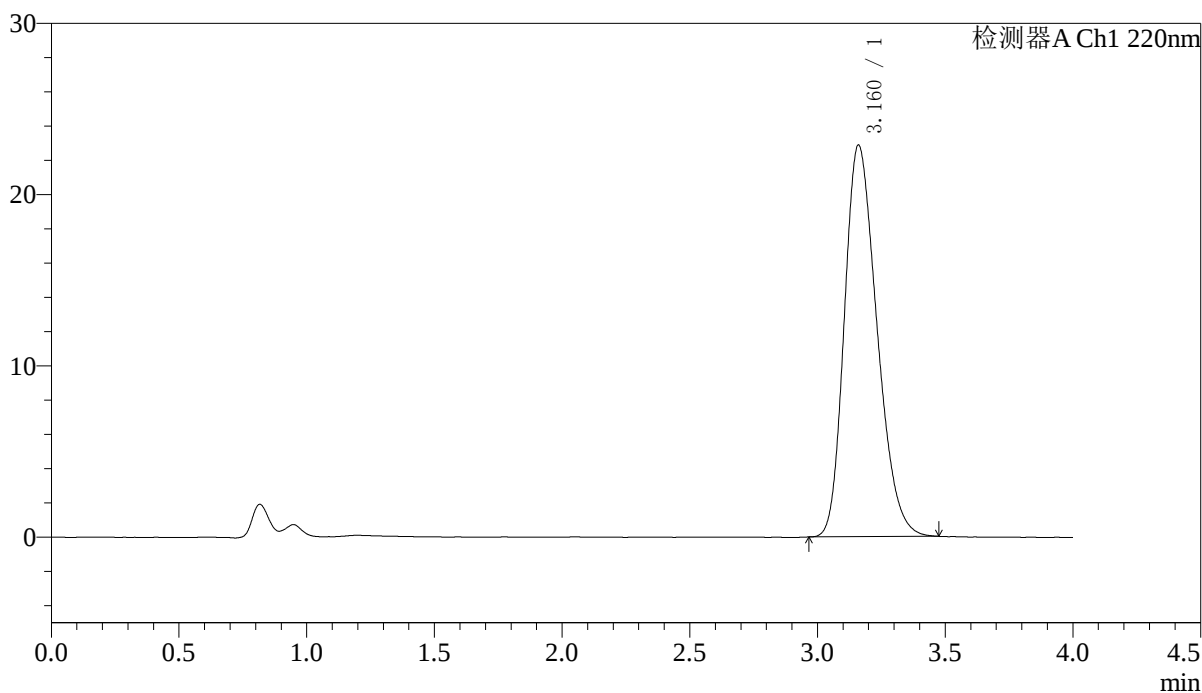

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.160	203213	100.000	22850	2910	1.261	--
总计		203213	100.000	22850			


图95 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1612-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:18:01 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:18 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

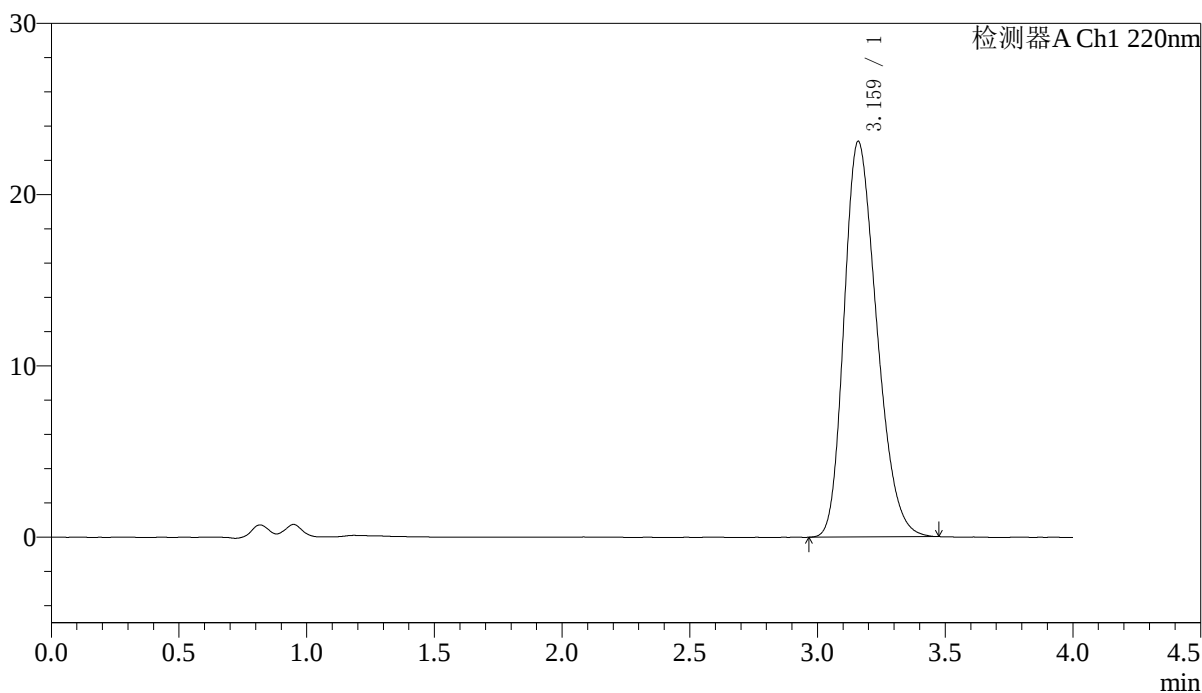

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.159	205623	100.000	23060	2905	1.263	--
总计		205623	100.000	23060			


图96 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1613-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:22:24 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:25 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

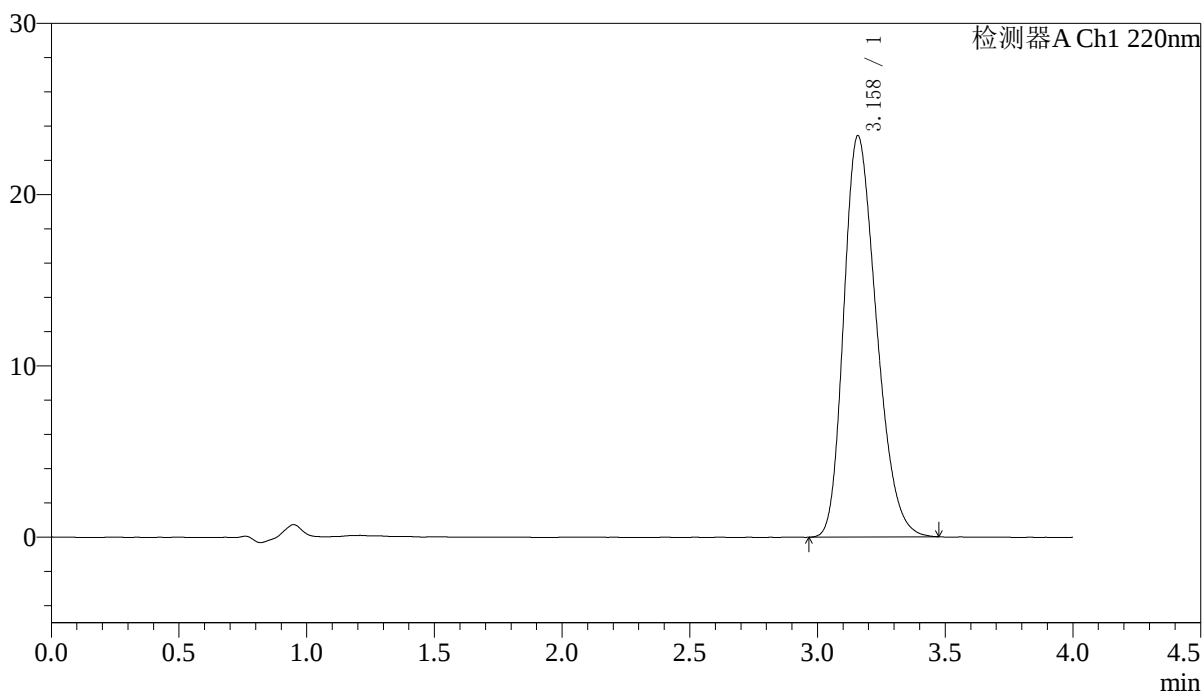

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.158	208724	100.000	23412	2899	1.267	--
总计		208724	100.000	23412			


图97 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1614-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:26:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:32 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

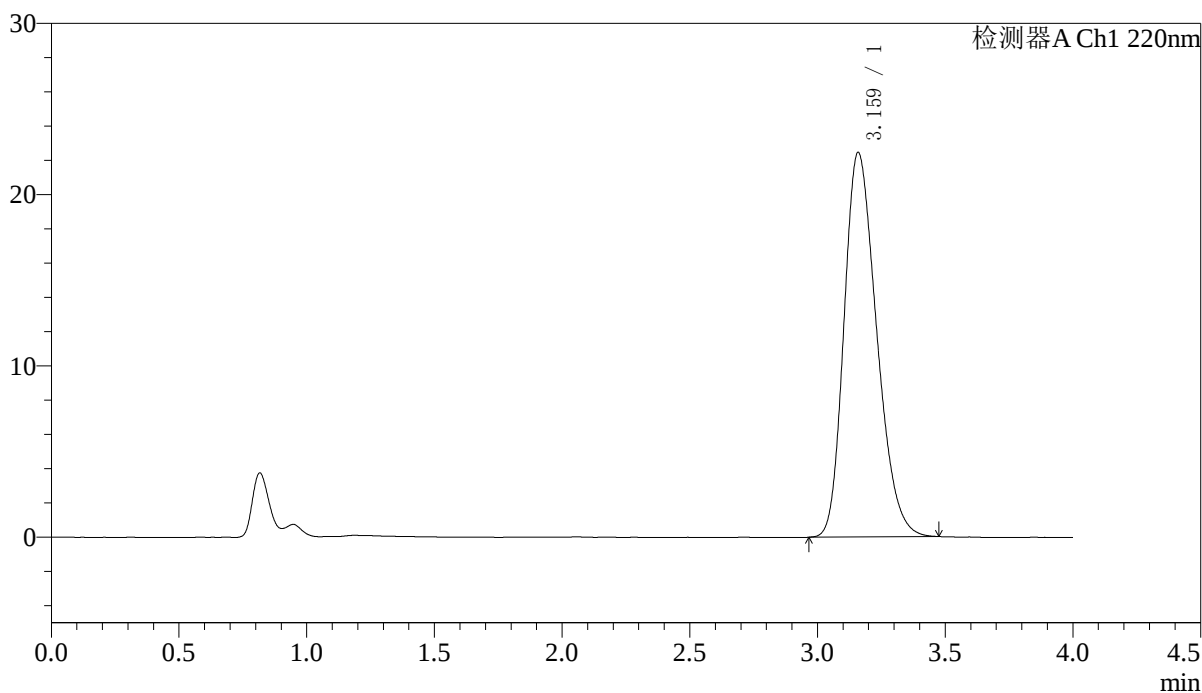

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.159	199476	100.000	22413	2917	1.261	--
总计		199476	100.000	22413			


图98 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1615-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:31:12 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:39 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

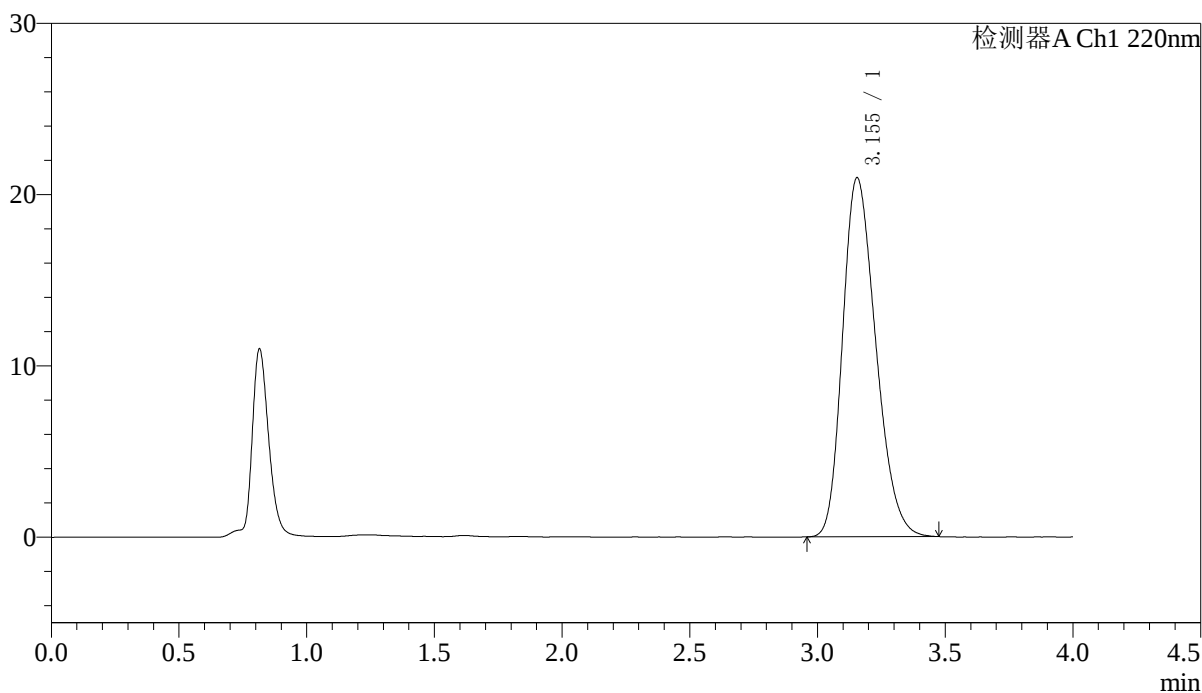

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	189785	100.000	20979	2794	1.252	--
总计		189785	100.000	20979			


图99 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1616-2 - zzp-2022030501p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:35:36 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:46 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

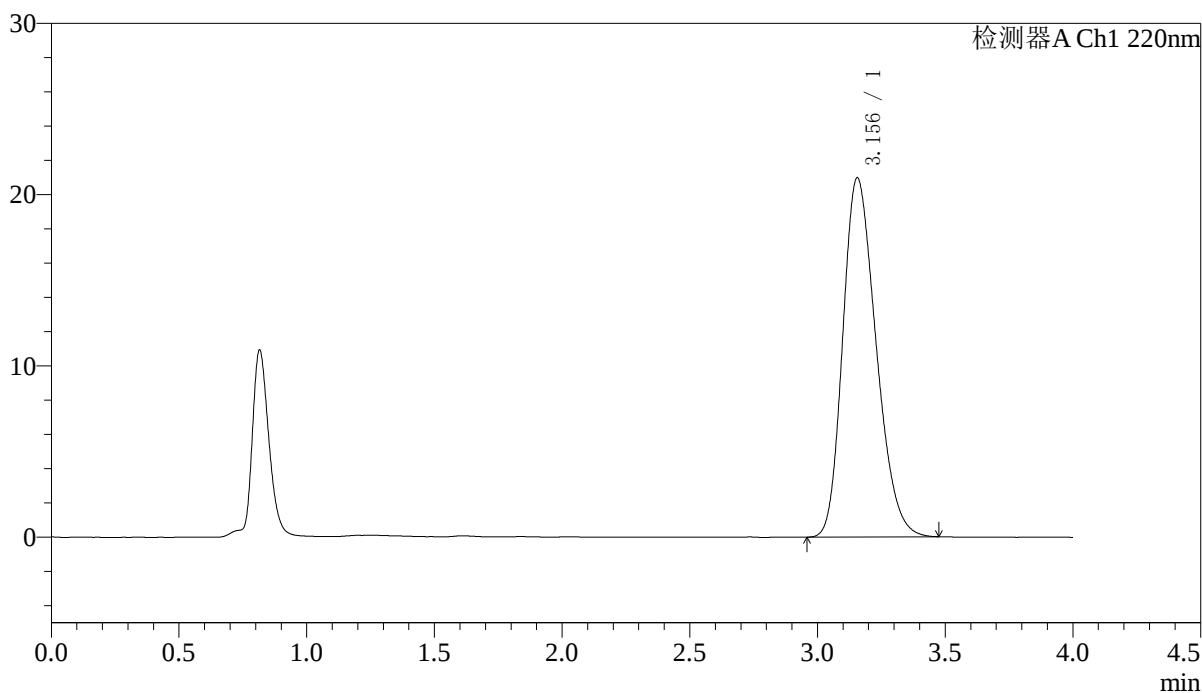

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	190274	100.000	20988	2784	1.251	--
总计		190274	100.000	20988			


图100 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1617-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:39:58 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:03:53 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

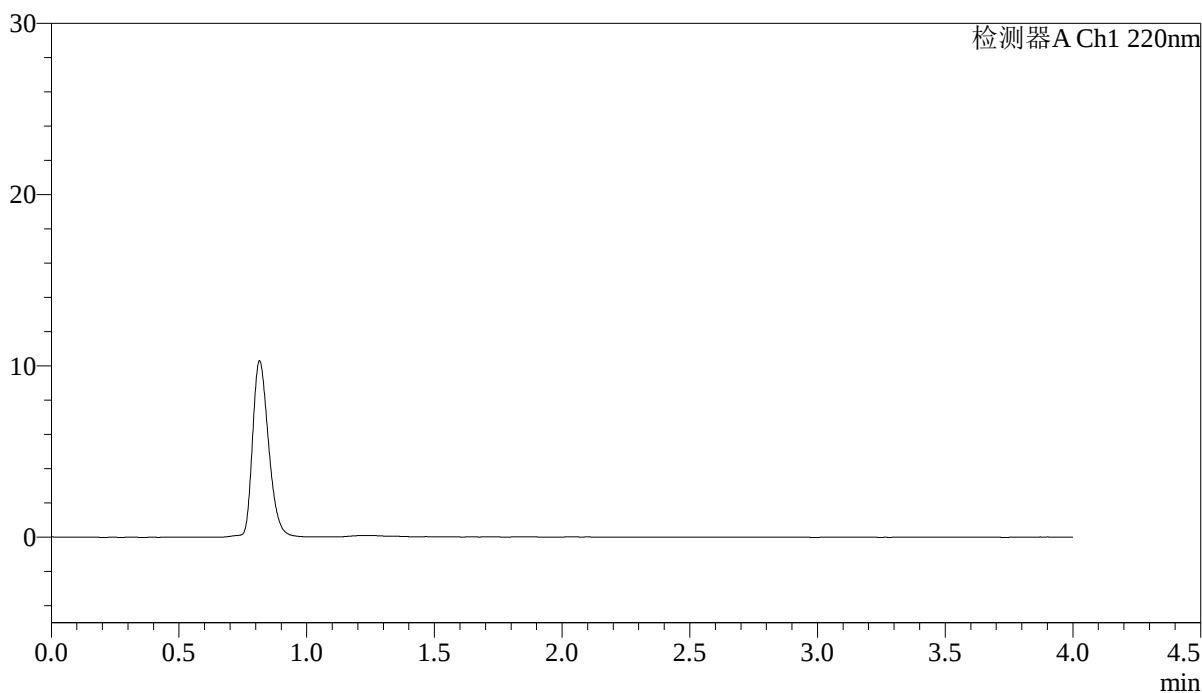

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图101 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1618-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:44:21 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:00 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

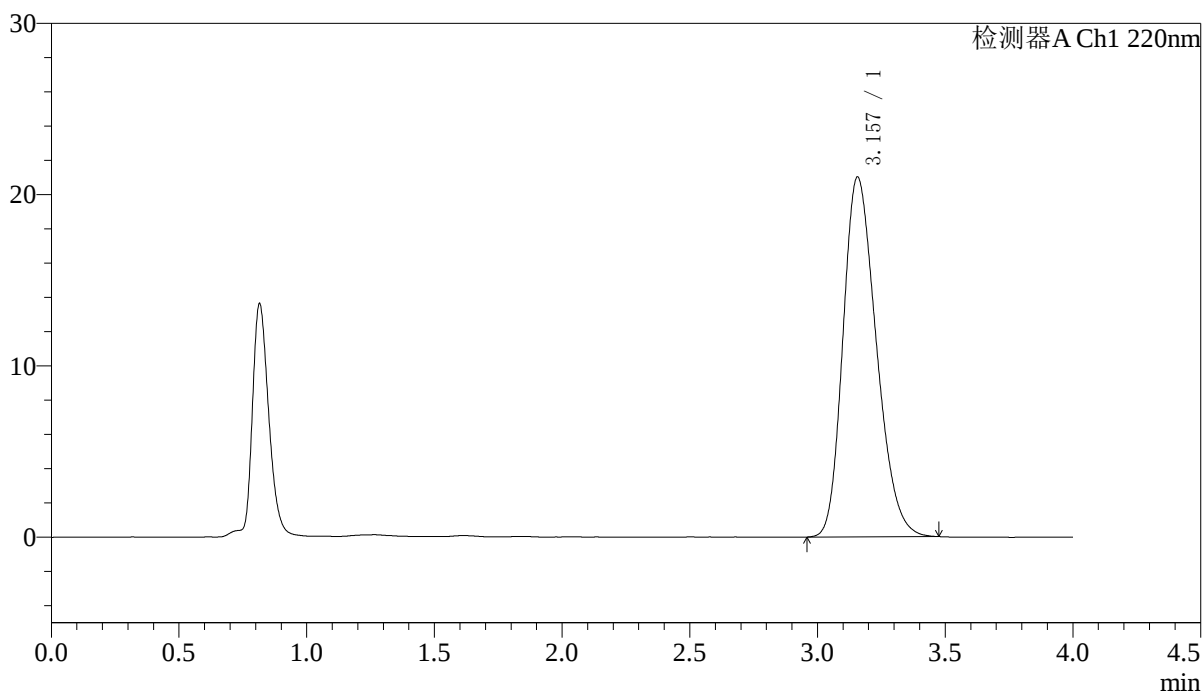

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	190851	100.000	21019	2778	1.250	--
总计		190851	100.000	21019			


图102 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1619-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:48:43 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:07 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

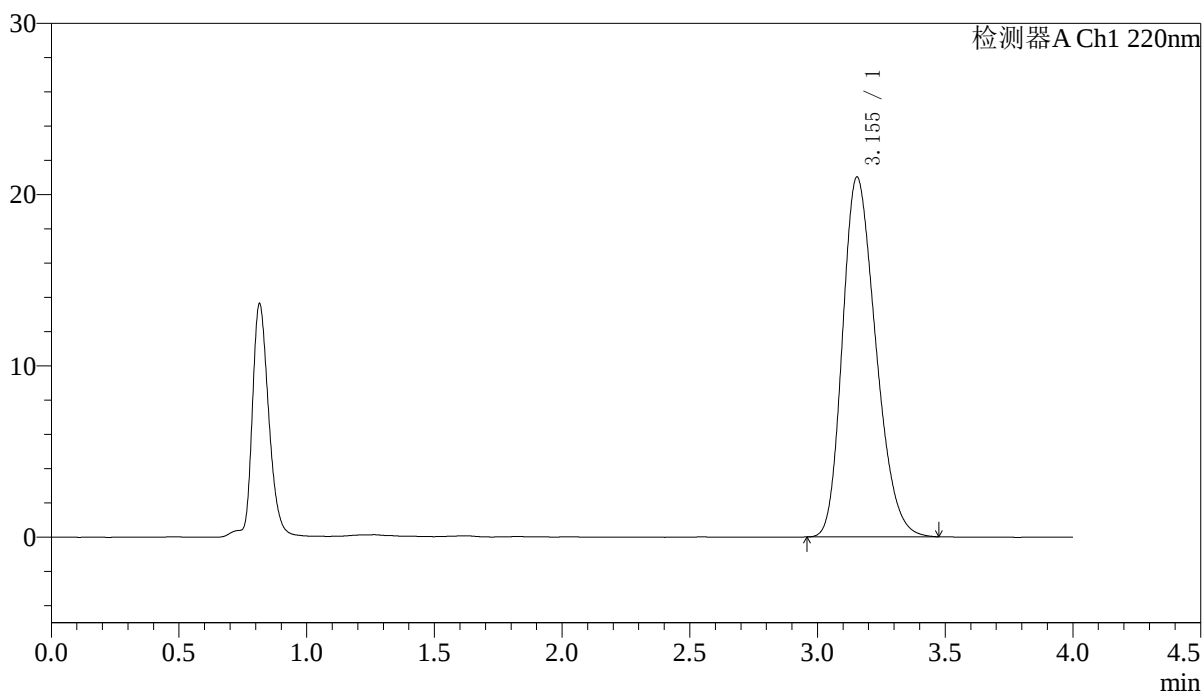

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	190392	100.000	21024	2789	1.253	--
总计		190392	100.000	21024			


图103 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1620-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:53:05 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:14 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

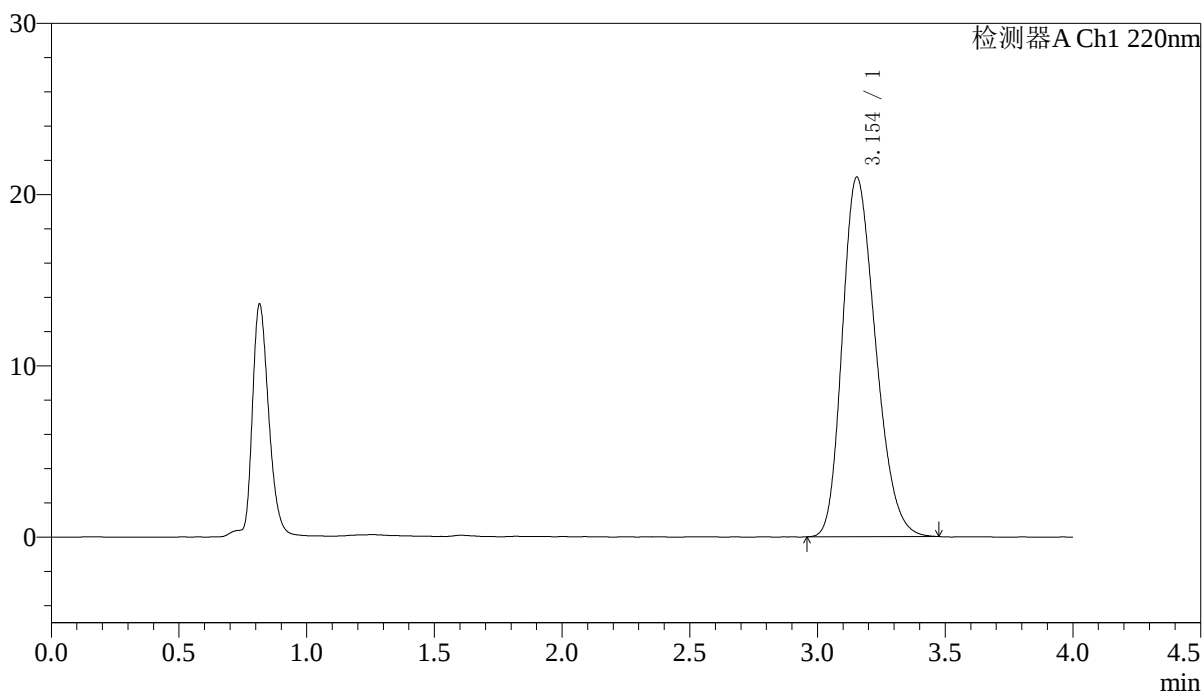

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	190555	100.000	21008	2786	1.252	--
总计		190555	100.000	21008			


图104 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1621-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:57:28 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:21 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

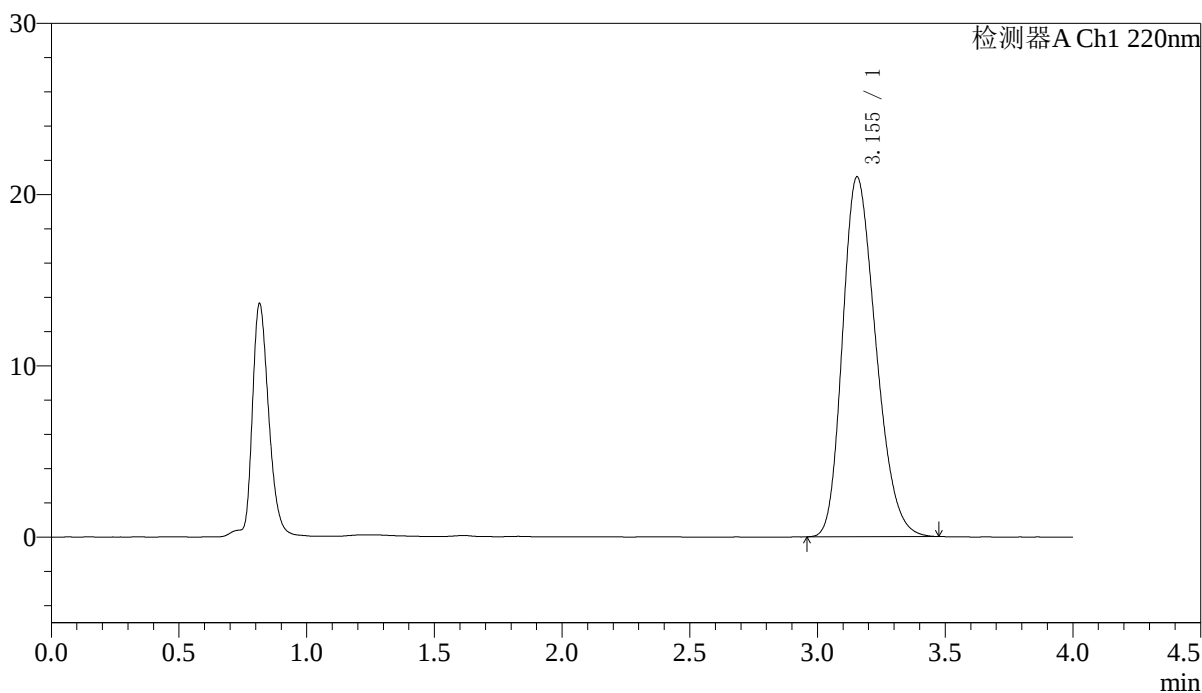

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	190723	100.000	21031	2781	1.254	--
总计		190723	100.000	21031			


图105 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1622-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:01:50 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:28 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

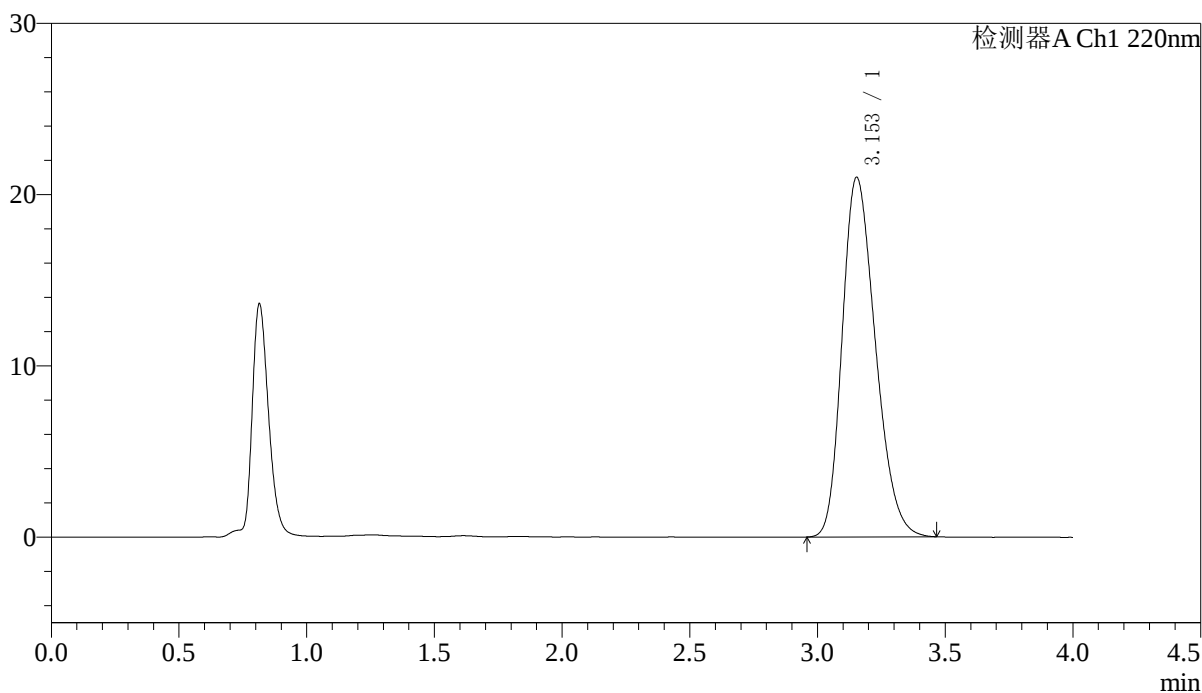

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.153	190329	100.000	21002	2793	1.254	--
总计		190329	100.000	21002			


图106 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1623-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:06:12 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:35 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

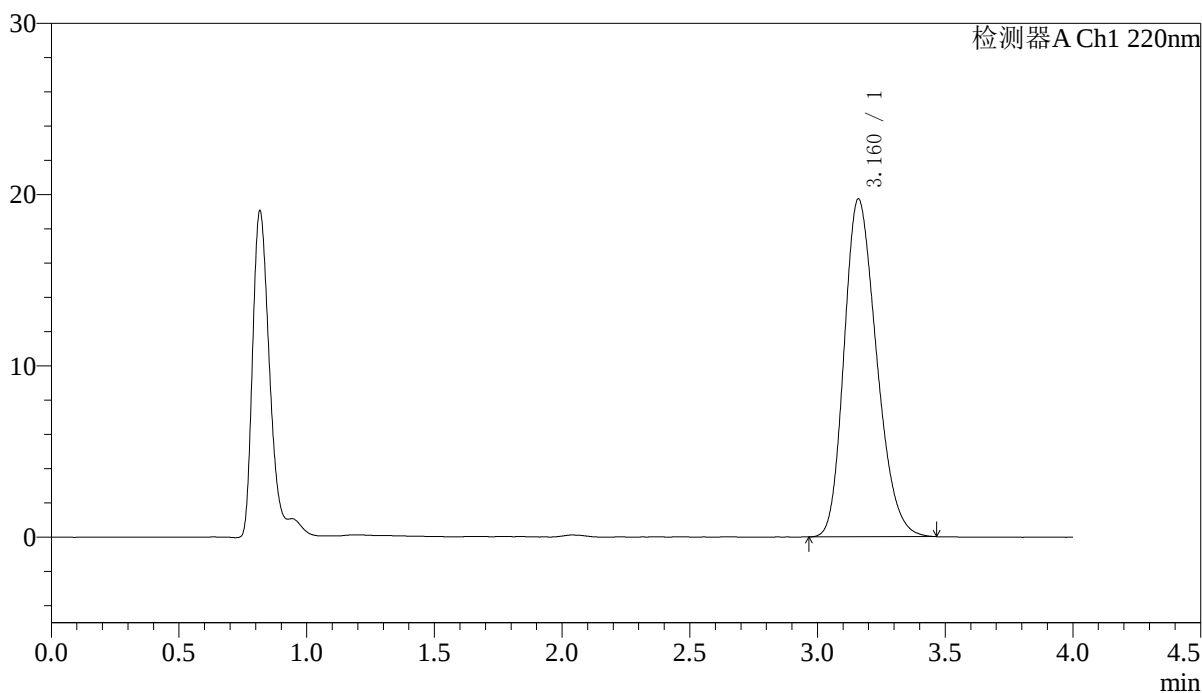

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.160	174370	100.000	19710	2952	1.241	--
总计		174370	100.000	19710			


图107 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1624-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:10:34 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:42 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

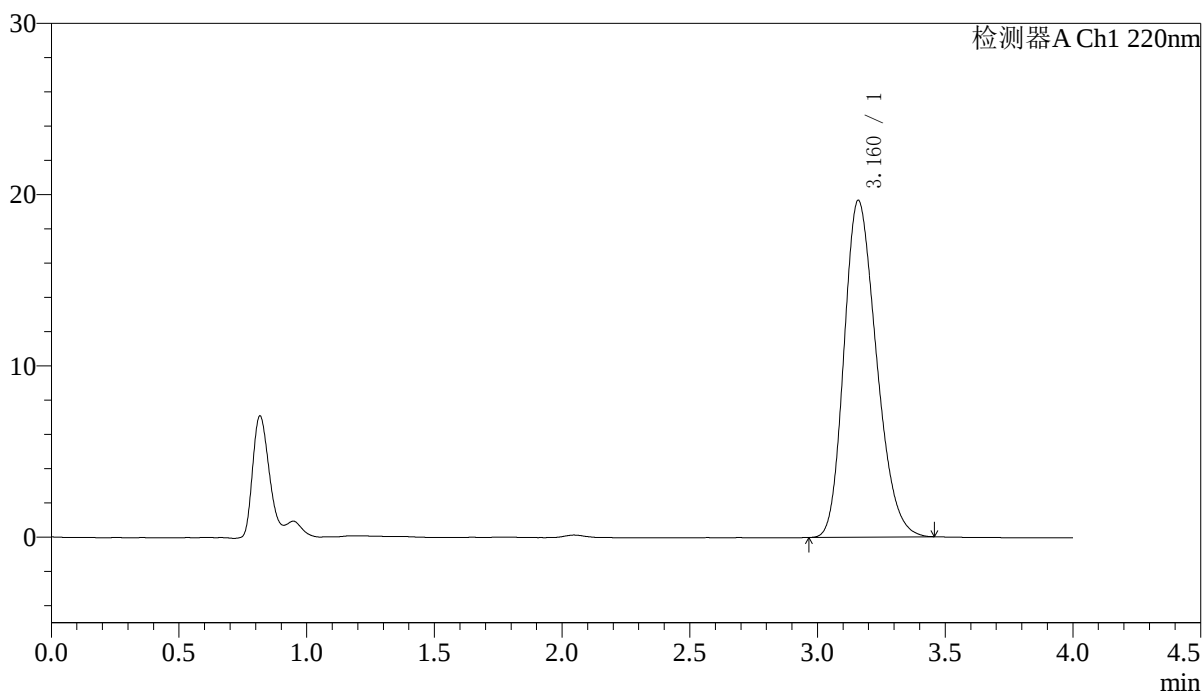

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.160	173538	100.000	19636	2948	1.240	--
总计		173538	100.000	19636			


图108 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1625-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:14:56 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:49 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

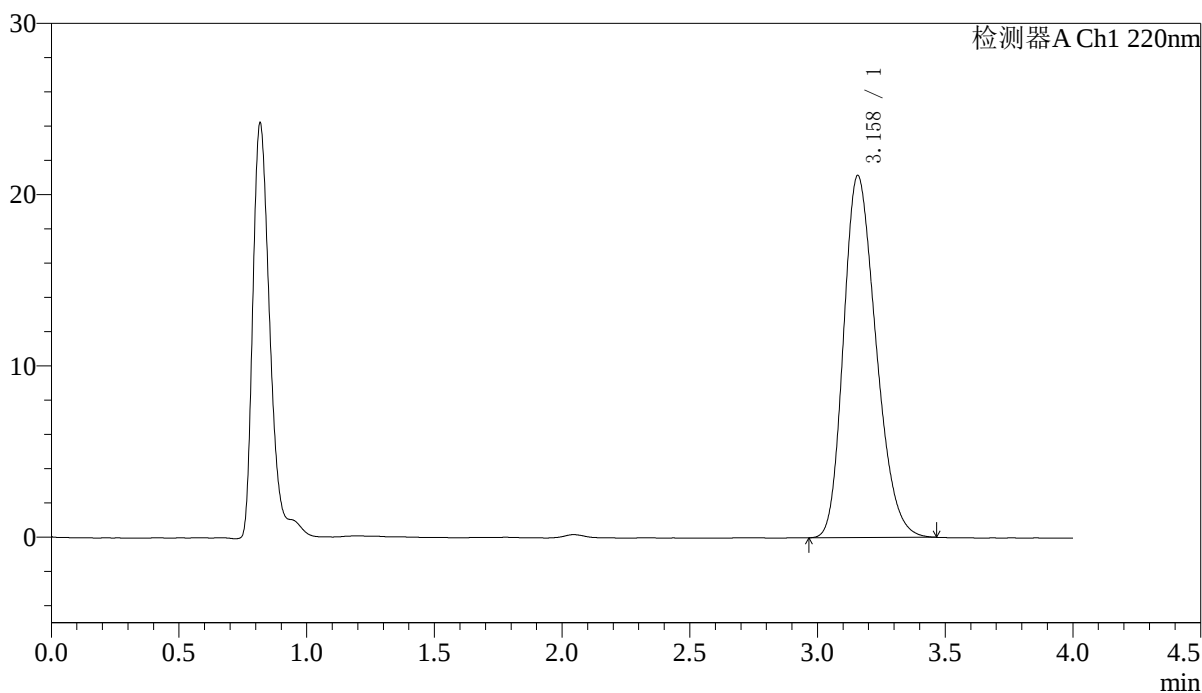

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.158	187116	100.000	21140	2936	1.250	--
总计		187116	100.000	21140			


图109 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1626-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:19:18 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:04:56 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

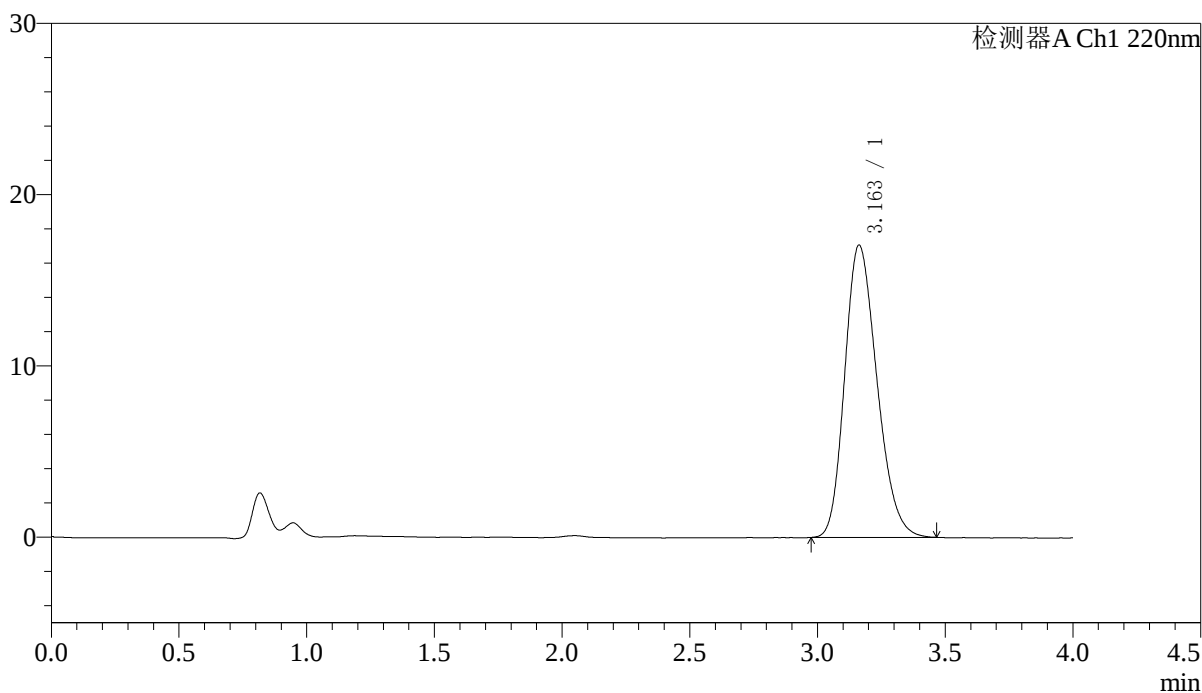

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.163	150047	100.000	17076	2992	1.223	--
总计		150047	100.000	17076			


图110 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1627-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:23:39 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:03 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

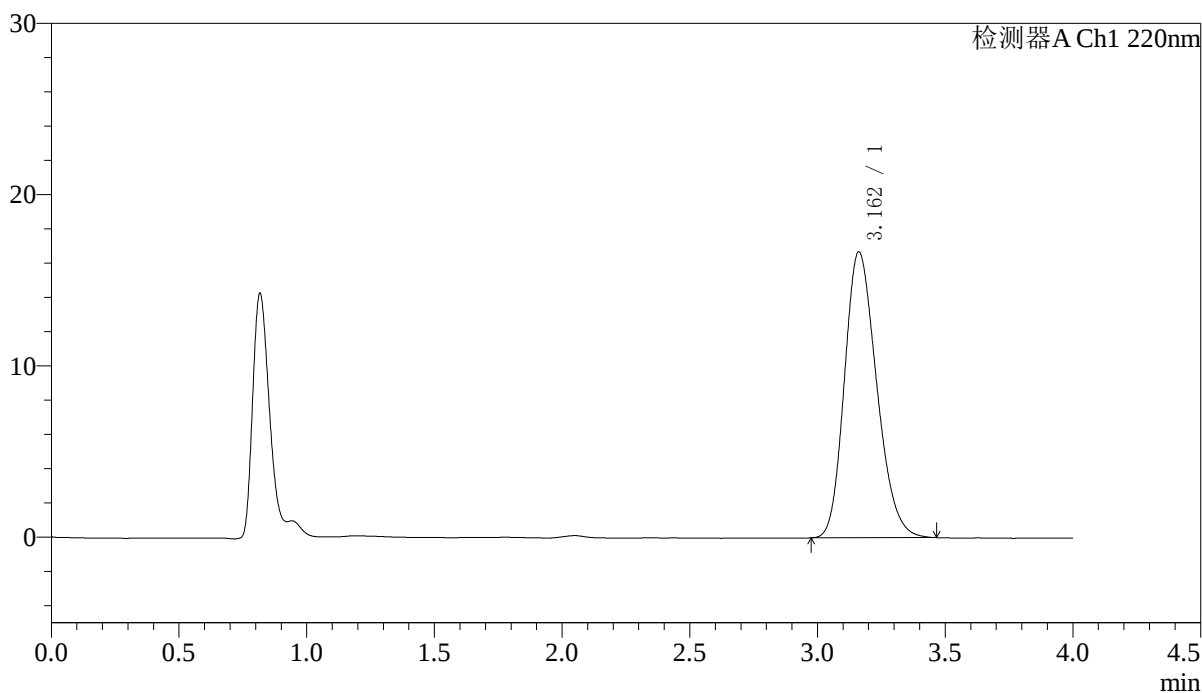

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.162	146604	100.000	16698	2986	1.219	--
总计		146604	100.000	16698			


图111 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1628-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:28:00 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:10 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

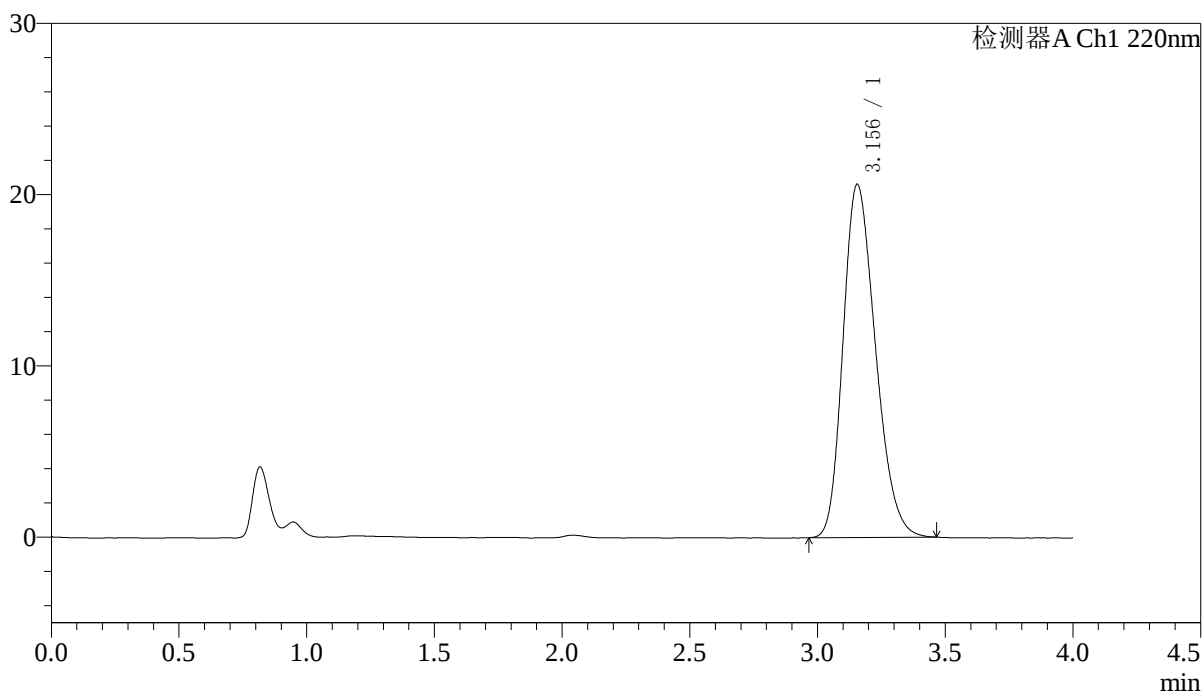

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	182363	100.000	20634	2934	1.246	--
总计		182363	100.000	20634			


图112 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1629-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:32:21 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:17 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

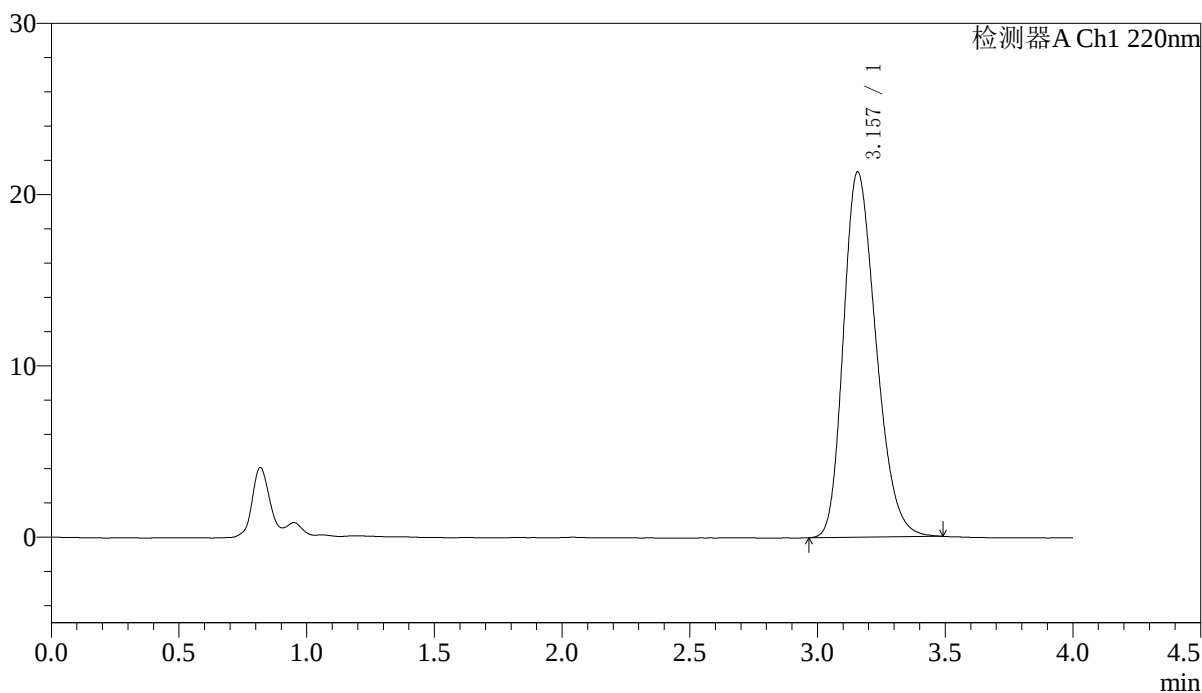

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	189421	100.000	21335	2931	1.258	--
总计		189421	100.000	21335			


图113 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1630-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:36:43 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:24 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

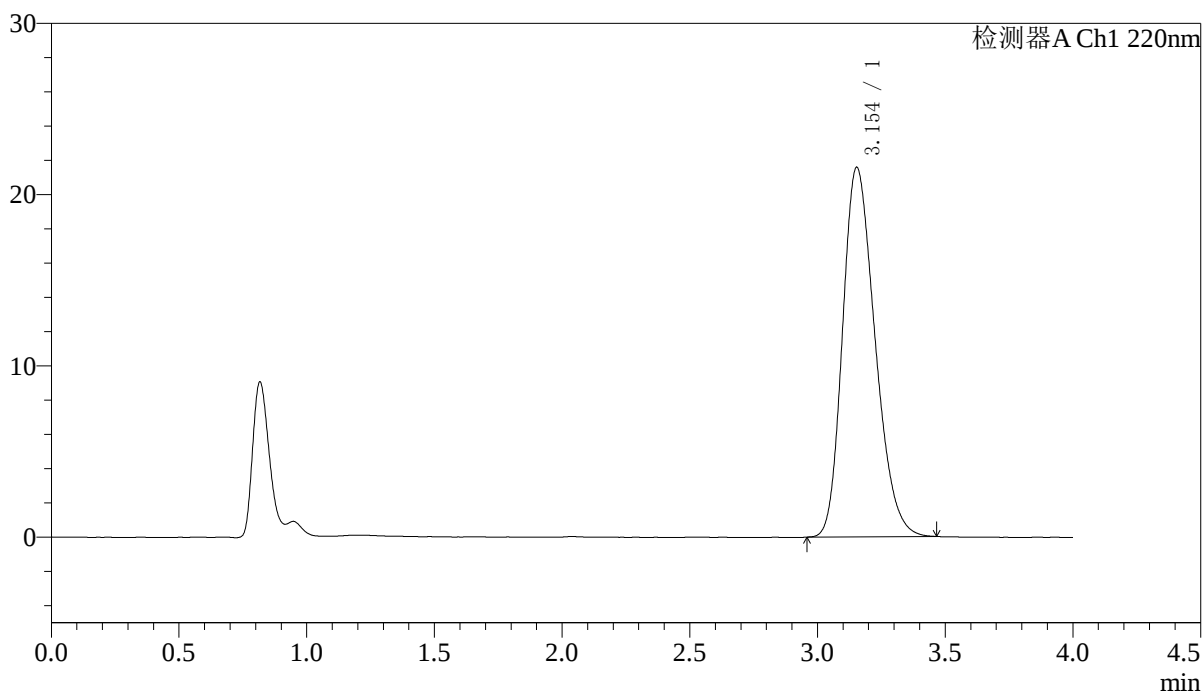

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	190994	100.000	21587	2936	1.253	--
总计		190994	100.000	21587			


图114 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1631-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:41:04 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:31 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

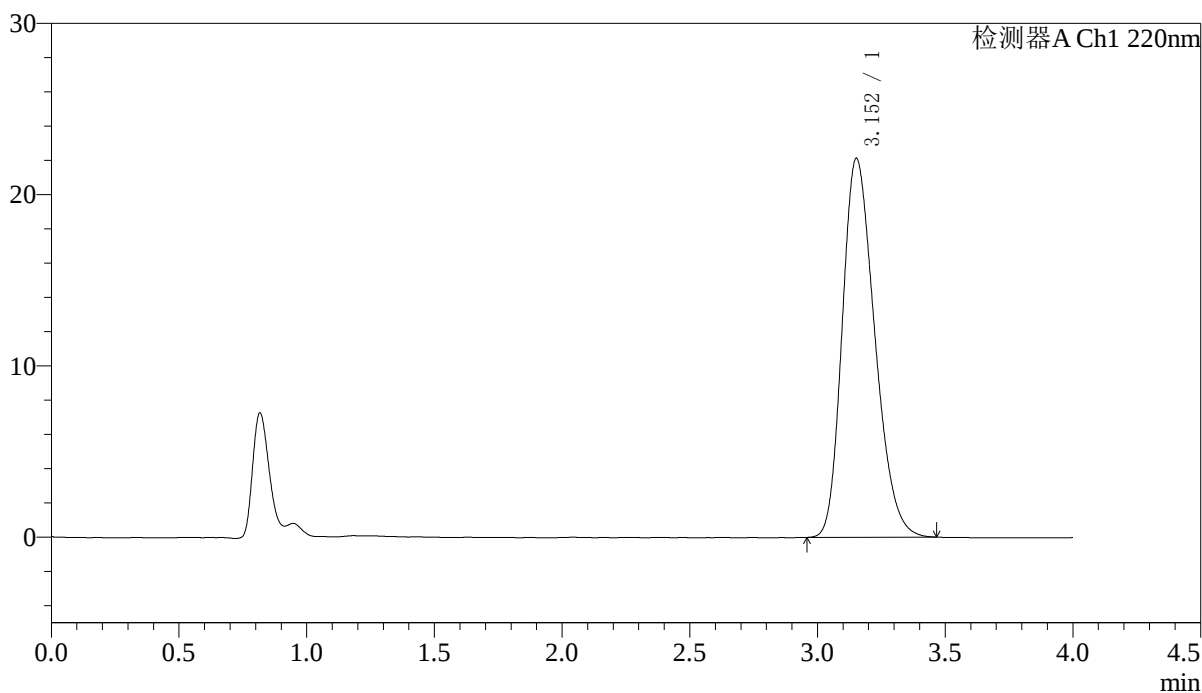

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	196109	100.000	22115	2919	1.258	--
总计		196109	100.000	22115			


图115 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1632-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:45:26 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:38 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

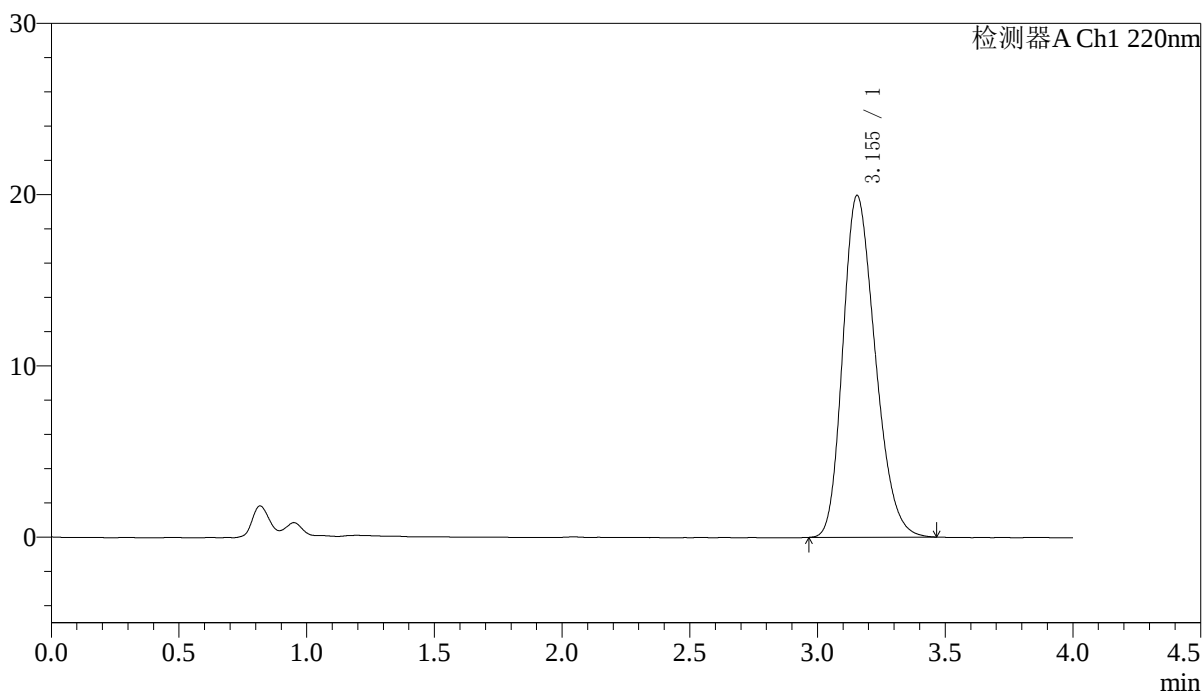

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	176180	100.000	19972	2948	1.242	--
总计		176180	100.000	19972			


图116 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1633-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:49:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:45 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

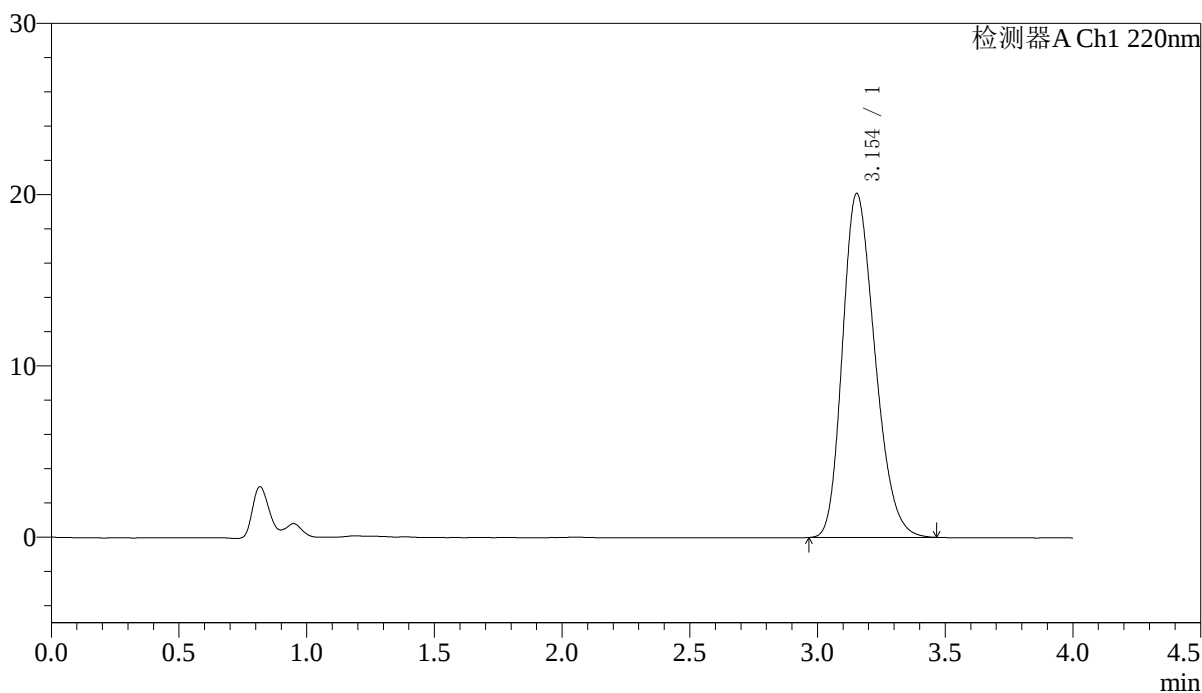

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.154	177257	100.000	20091	2948	1.243	--
总计		177257	100.000	20091			


图117 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1634-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:54:10 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:05:52 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

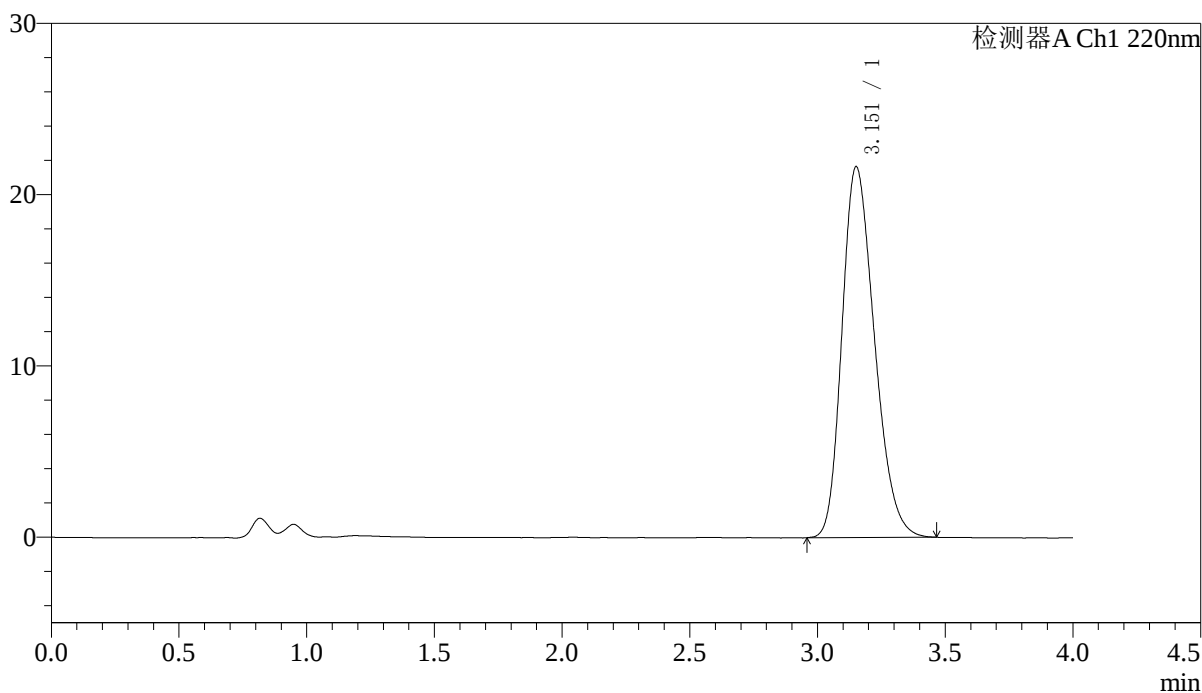

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	191814	100.000	21628	2927	1.254	--
总计		191814	100.000	21628			


图118 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1635-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:58:31 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:00 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

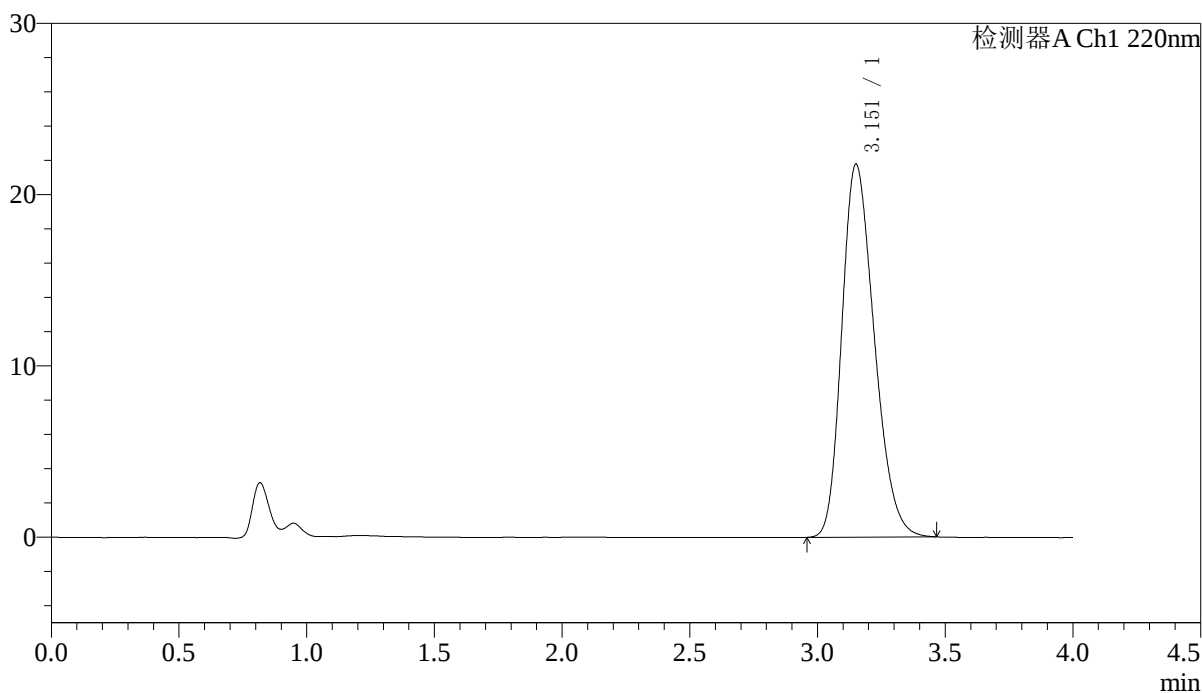

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	192863	100.000	21746	2918	1.254	--
总计		192863	100.000	21746			


图119 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1636-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:02:52 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:07 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

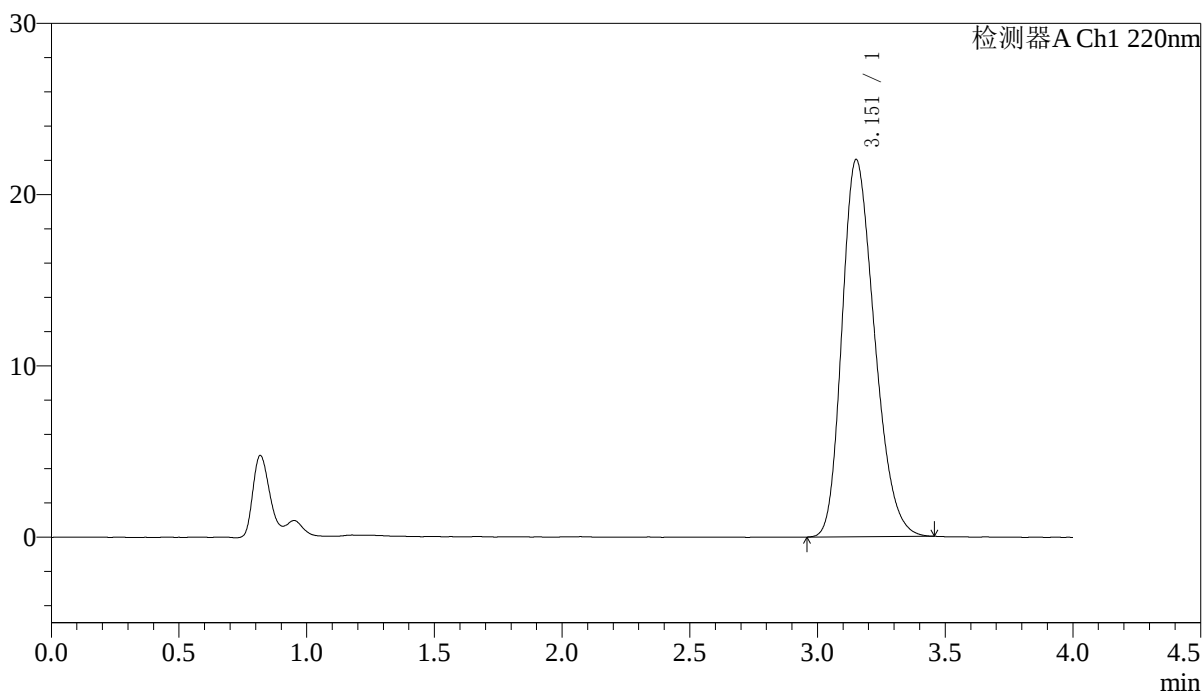

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	195035	100.000	22000	2918	1.257	--
总计		195035	100.000	22000			


图120 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1637-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:07:14 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:14 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

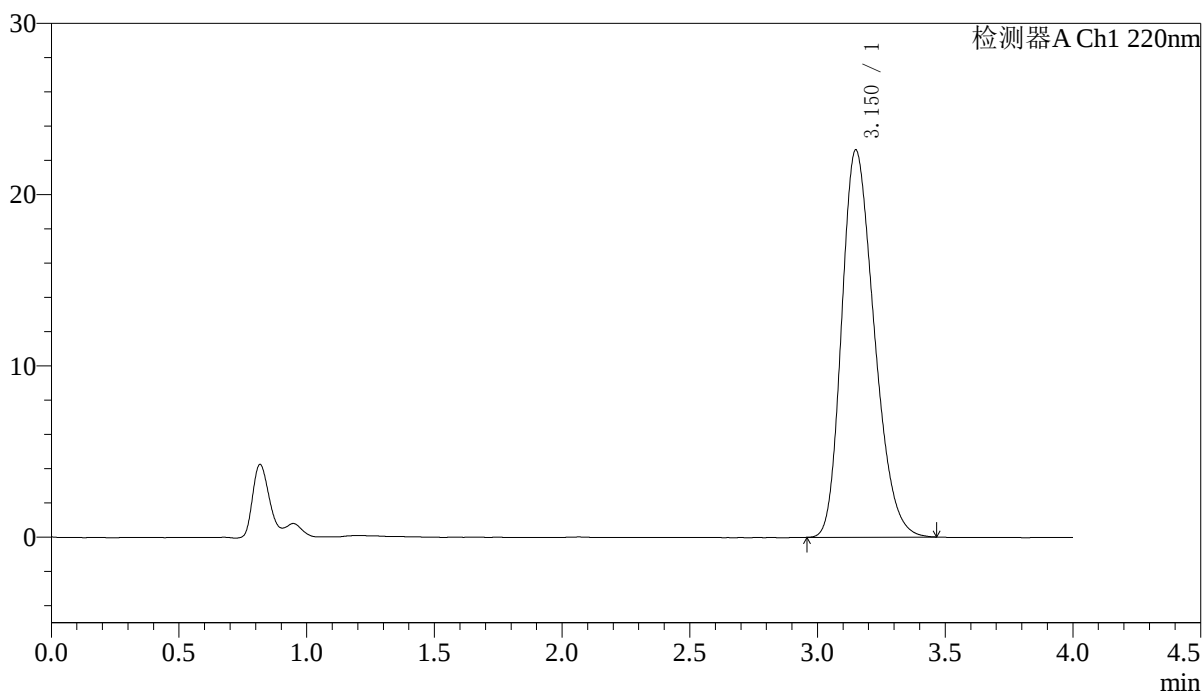

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	200542	100.000	22594	2911	1.262	--
总计		200542	100.000	22594			


图121 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1638-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:11:36 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:21 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

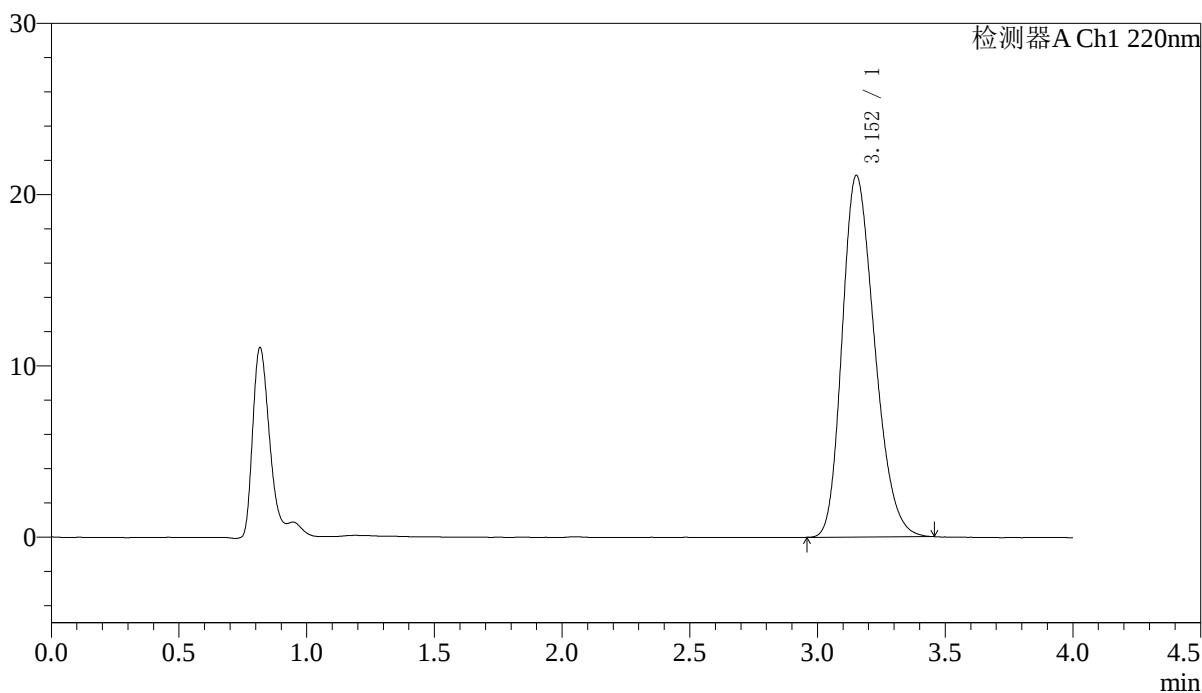

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	186481	100.000	21099	2934	1.251	--
总计		186481	100.000	21099			


图122 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1639-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:15:58 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:28 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

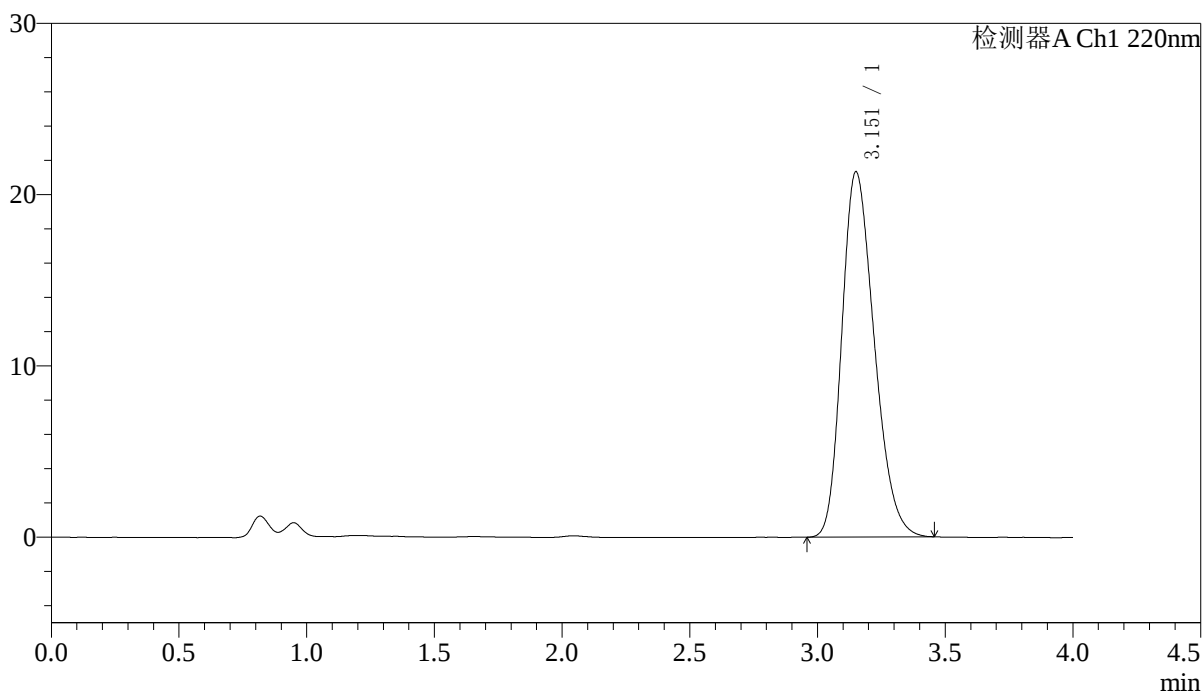

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	188590	100.000	21296	2928	1.253	--
总计		188590	100.000	21296			


图123 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1640-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:20:20 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:34 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

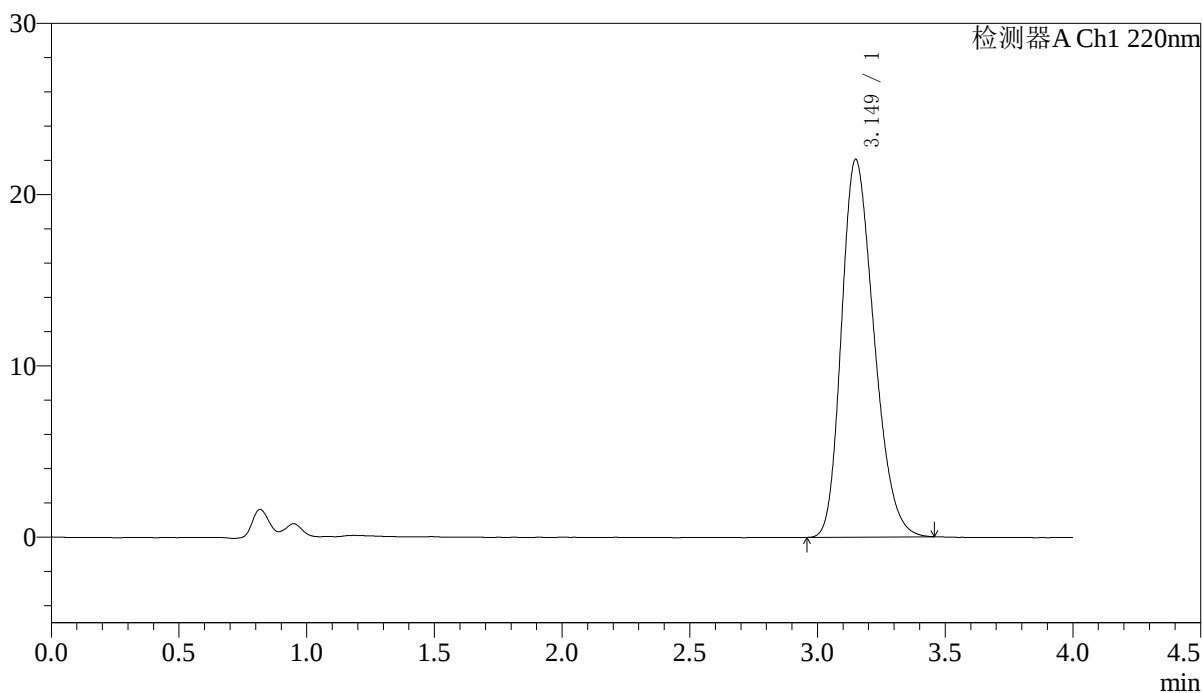

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	195410	100.000	22048	2914	1.255	--
总计		195410	100.000	22048			


图124 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1641-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:24:42 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:41 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

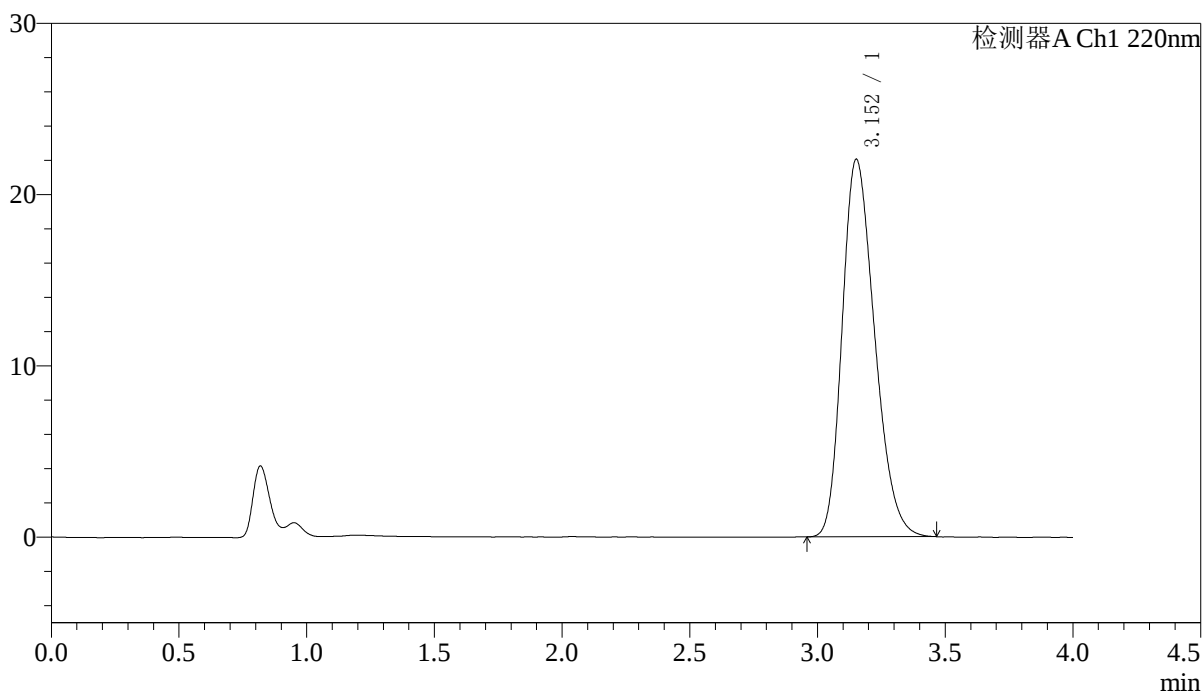

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.152	195104	100.000	22031	2925	1.257	--
总计		195104	100.000	22031			


图125 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1642-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:29:02 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:48 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

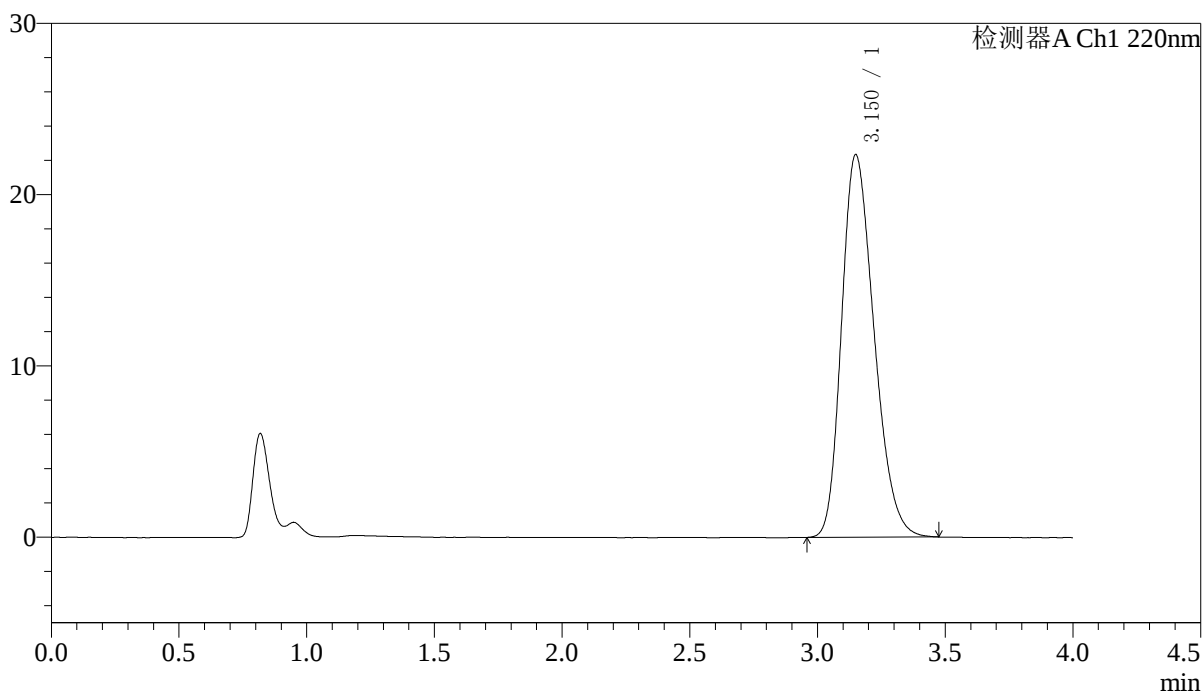

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	198046	100.000	22332	2917	1.260	--
总计		198046	100.000	22332			


图126 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1643-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:33:23 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:06:55 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

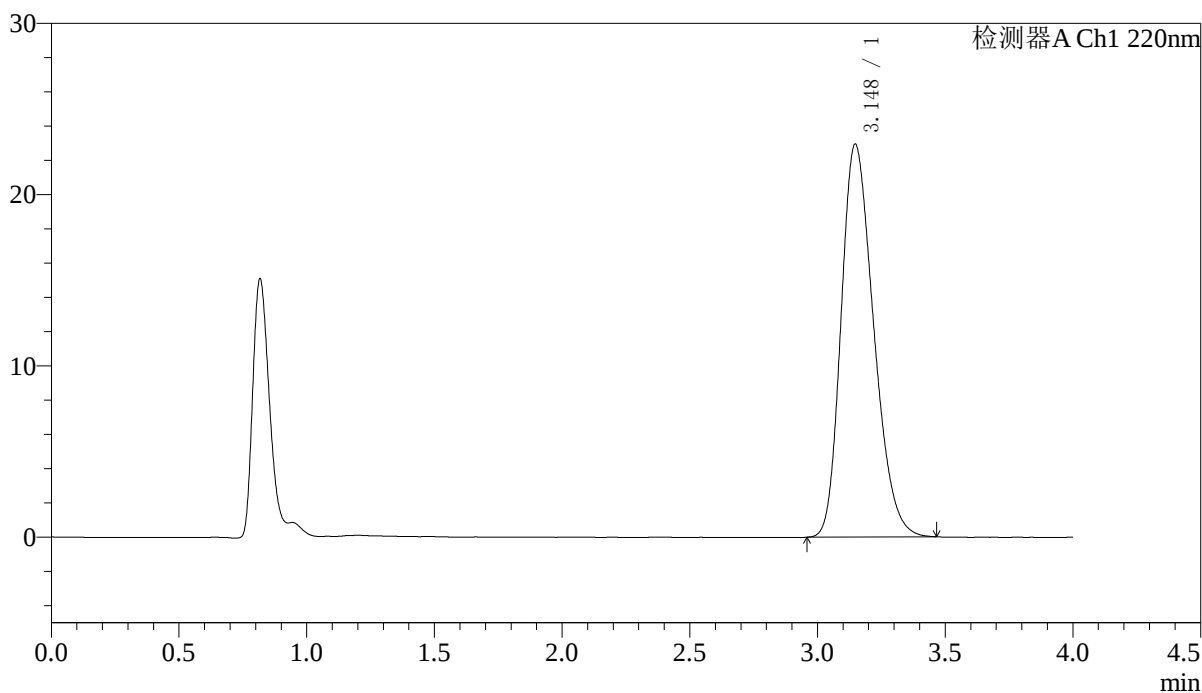

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	203506	100.000	22956	2900	1.262	--
总计		203506	100.000	22956			


图127 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1644-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:37:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:02 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

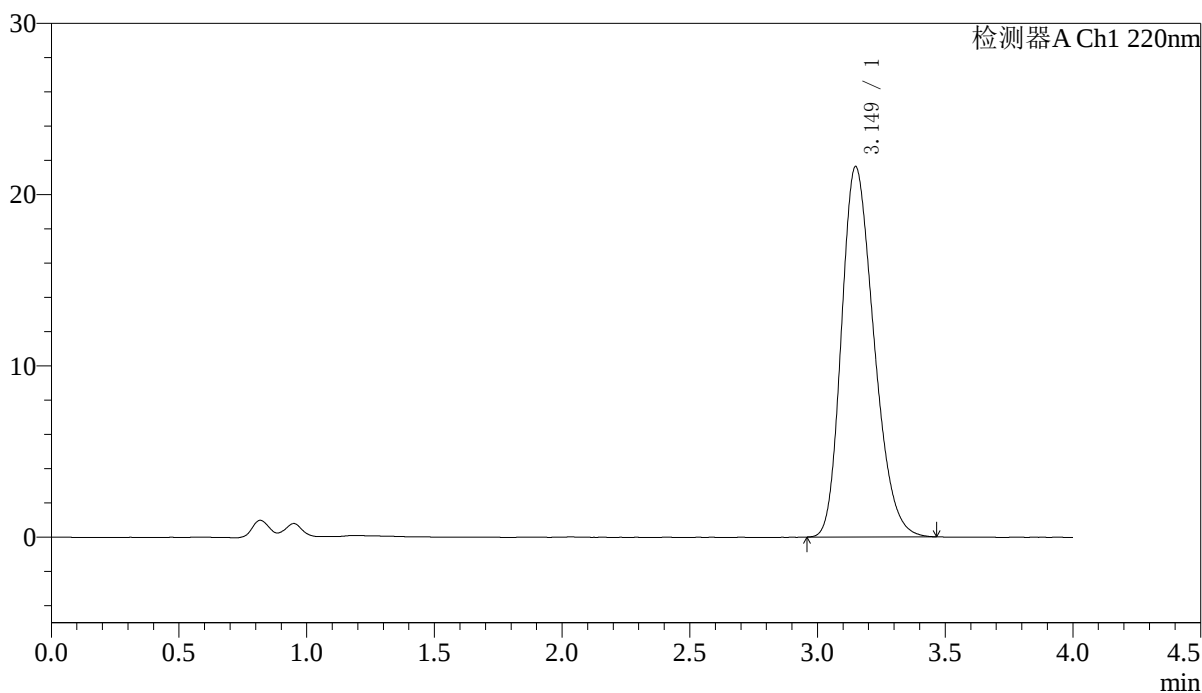

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	191349	100.000	21623	2922	1.256	--
总计		191349	100.000	21623			


图128 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1645-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:42:05 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:09 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

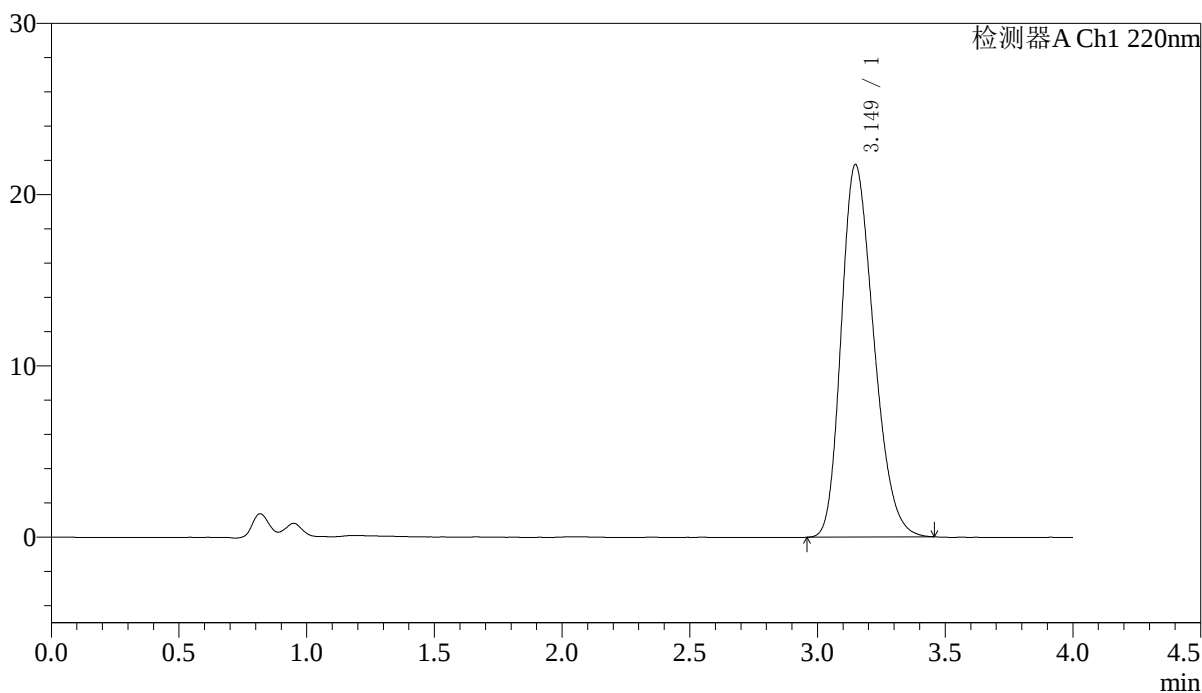

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	192597	100.000	21758	2920	1.255	--
总计		192597	100.000	21758			


图129 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1646-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:46:26 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:16 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

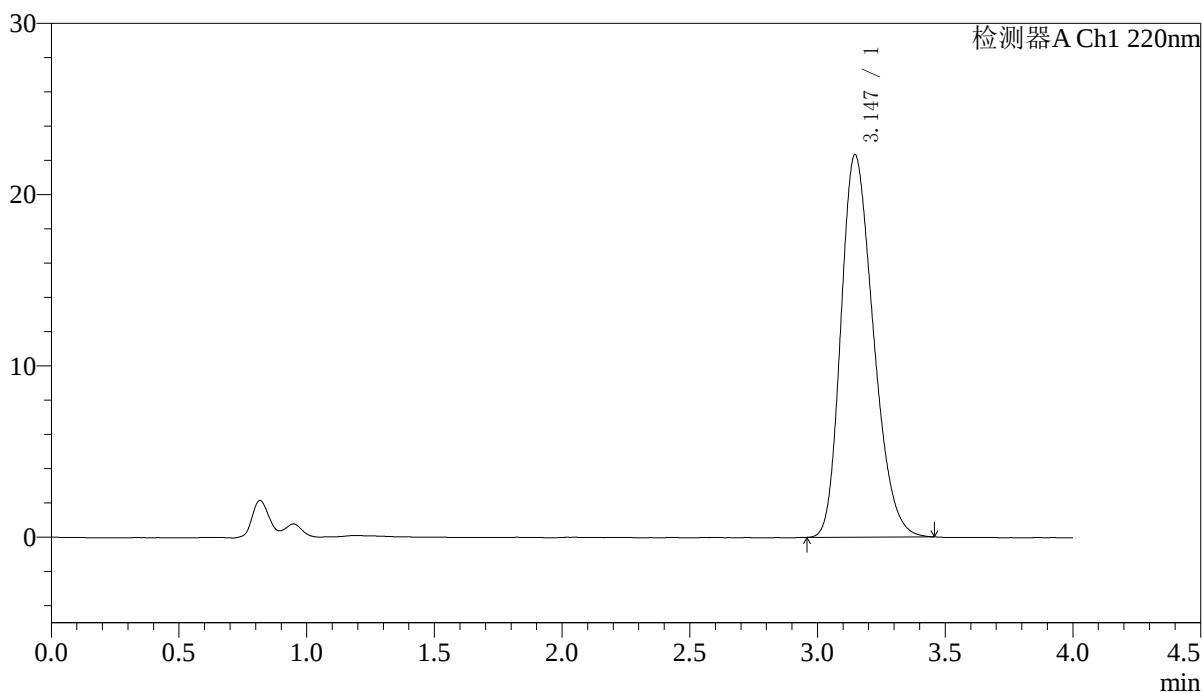

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.147	197625	100.000	22346	2909	1.259	--
总计		197625	100.000	22346			


图130 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1647-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:50:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:24 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

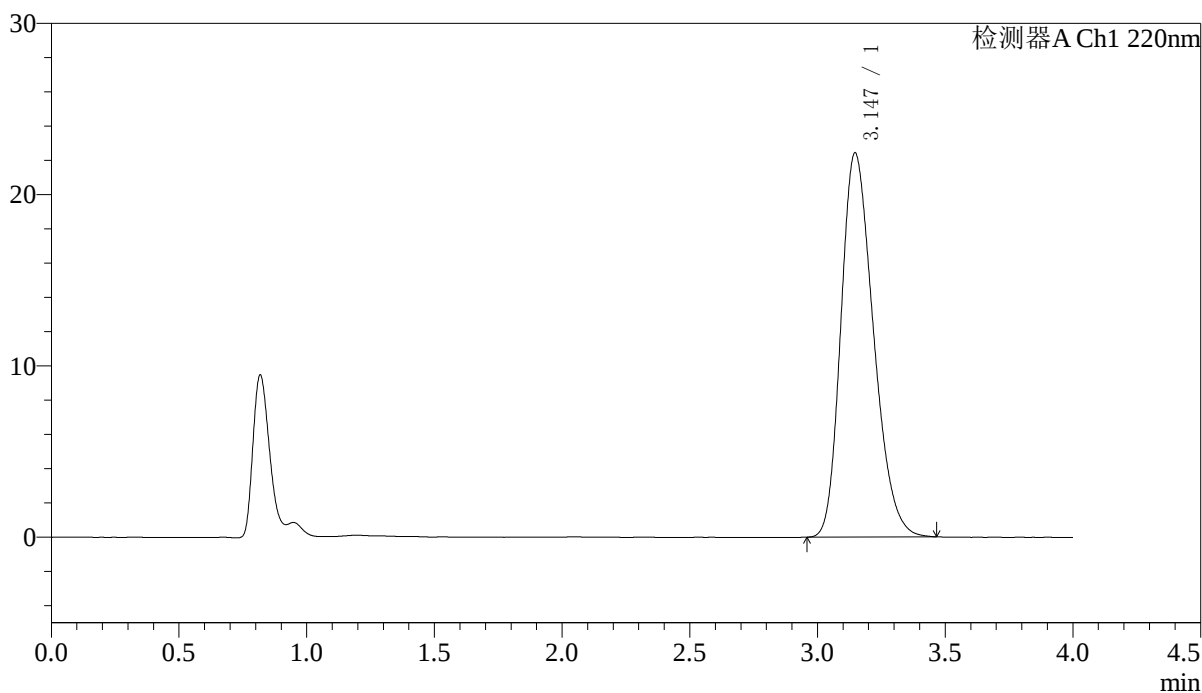

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.147	198653	100.000	22444	2911	1.260	--
总计		198653	100.000	22444			


图131 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1648-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:55:09 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:31 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

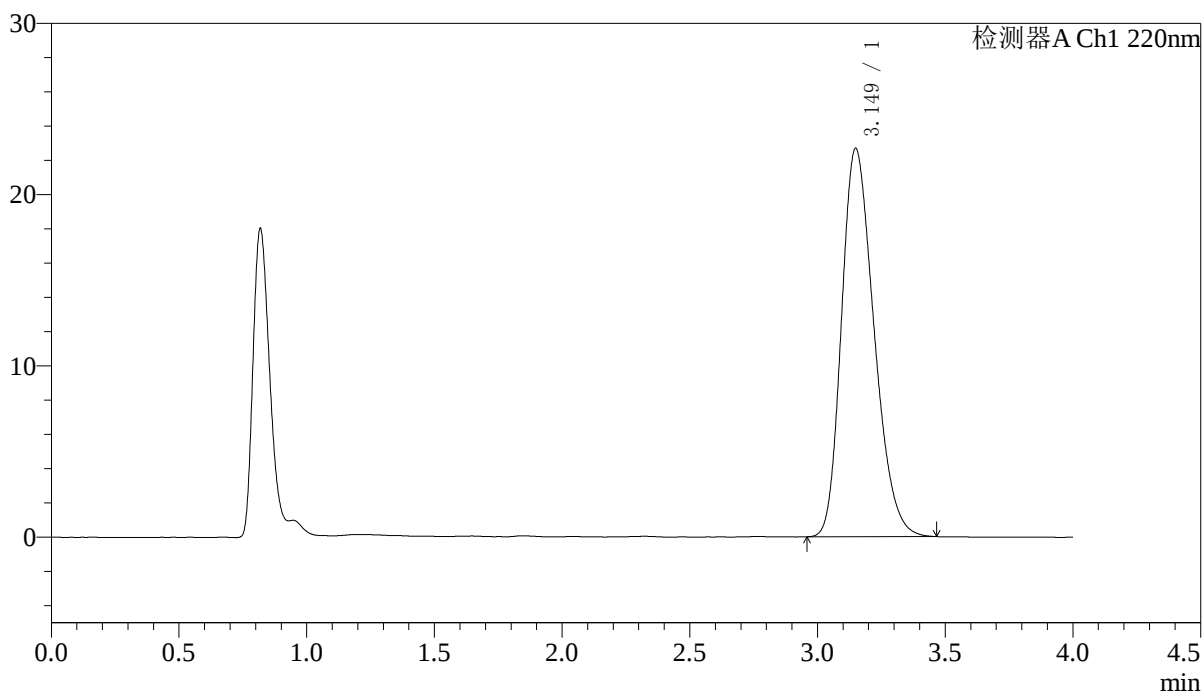

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	200818	100.000	22666	2918	1.264	--
总计		200818	100.000	22666			


图132 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1649-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:59:31 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:38 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

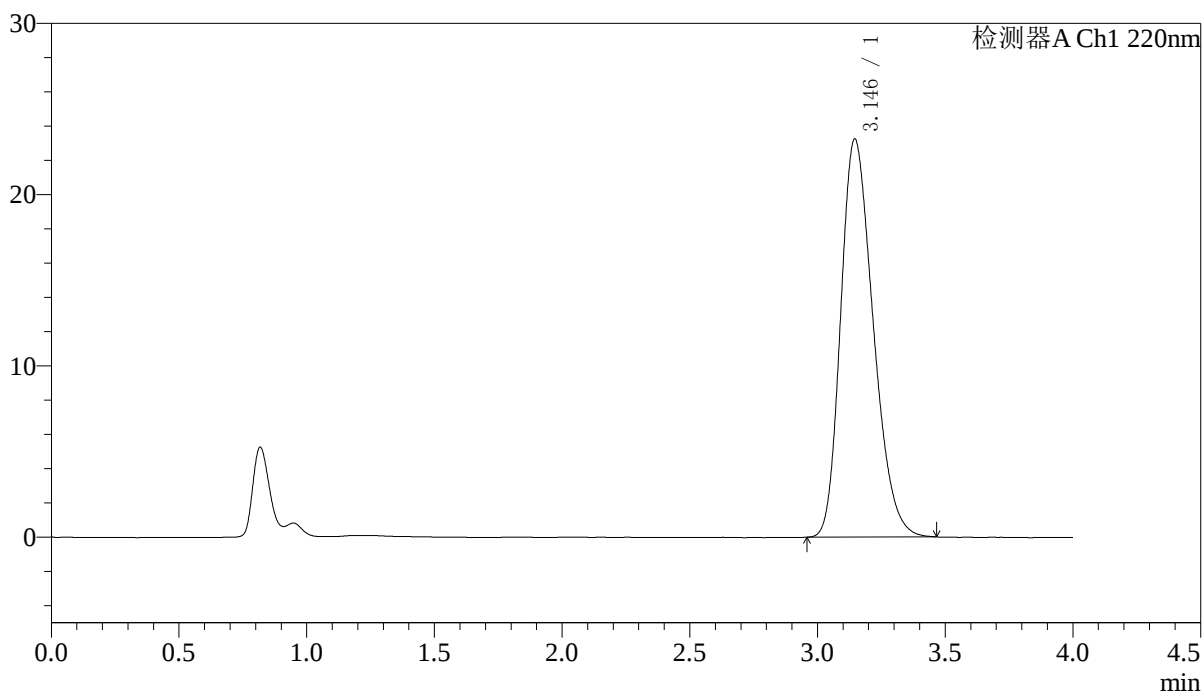

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	206018	100.000	23253	2905	1.266	--
总计		206018	100.000	23253			


图133 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1650-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:03:52 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:45 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

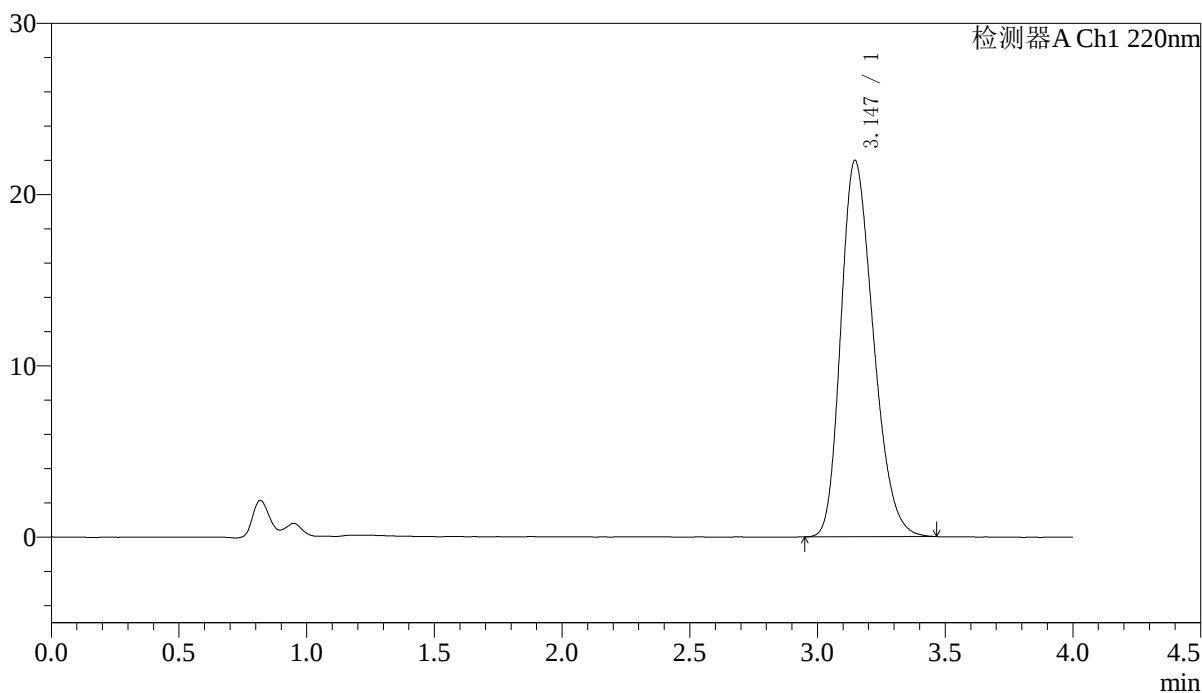

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.147	194592	100.000	21991	2918	1.256	--
总计		194592	100.000	21991			


图134 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1651-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:08:13 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:52 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

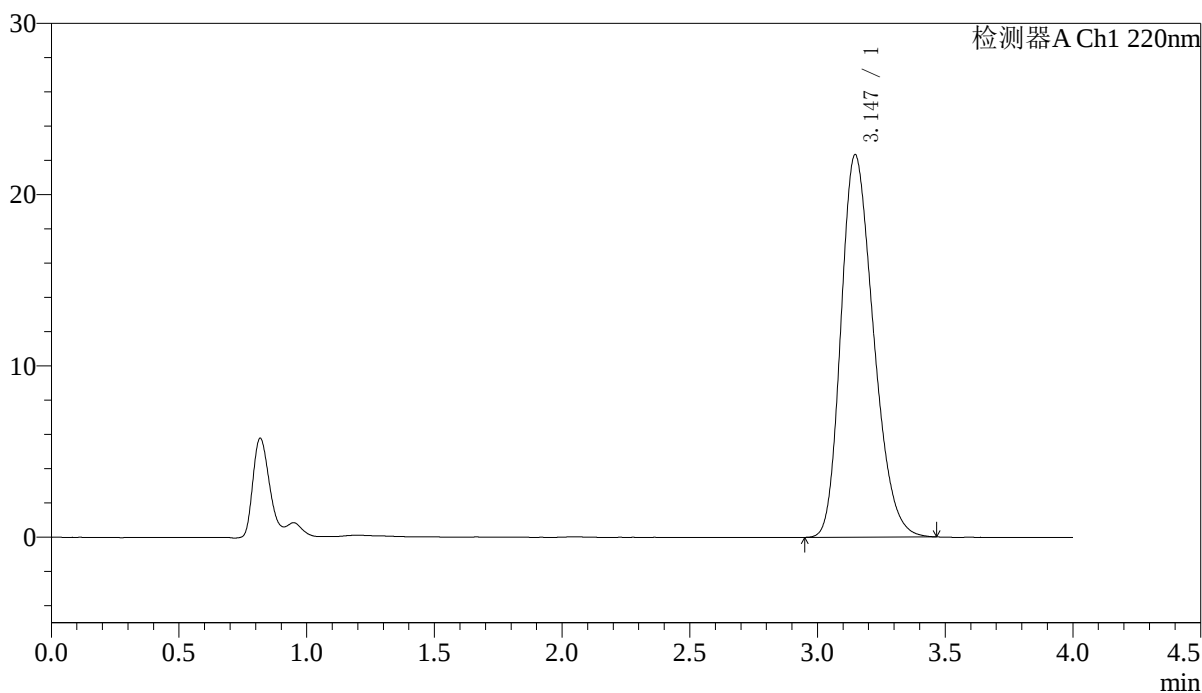

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.147	197883	100.000	22346	2914	1.257	--
总计		197883	100.000	22346			


图135 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1652-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:12:35 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:07:59 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

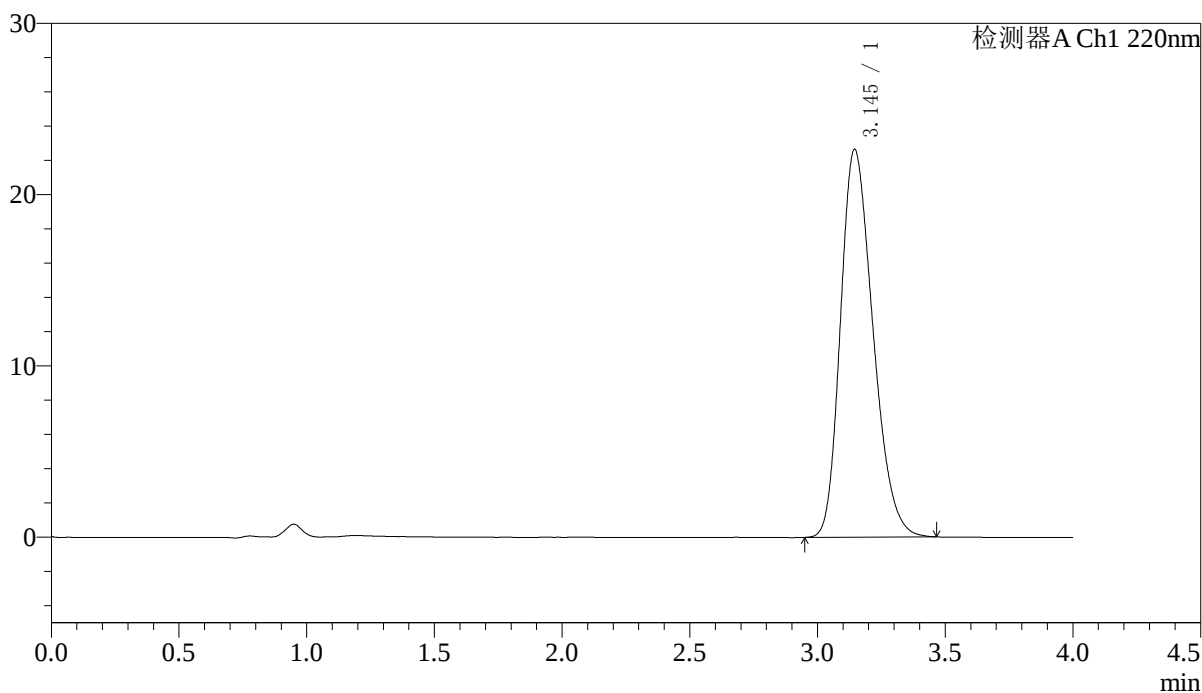

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	200490	100.000	22643	2910	1.263	--
总计		200490	100.000	22643			


图136 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1653-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:16:55 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:06 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

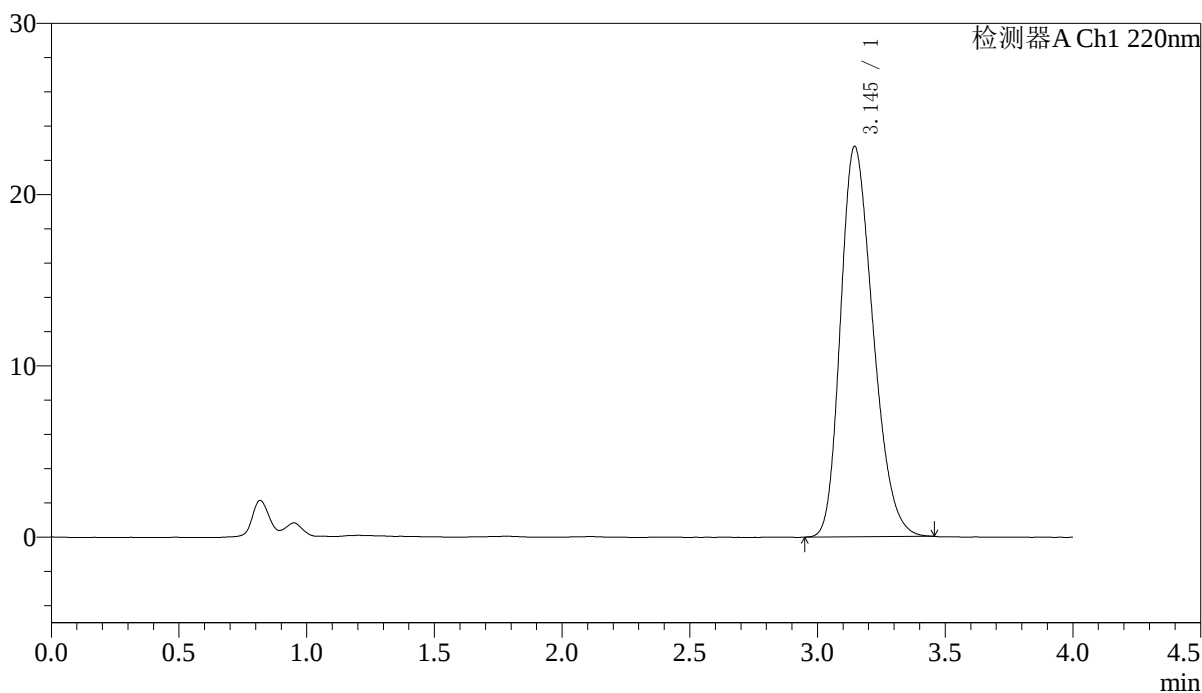

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	201778	100.000	22806	2906	1.260	--
总计		201778	100.000	22806			


图137 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1654-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:21:16 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:13 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

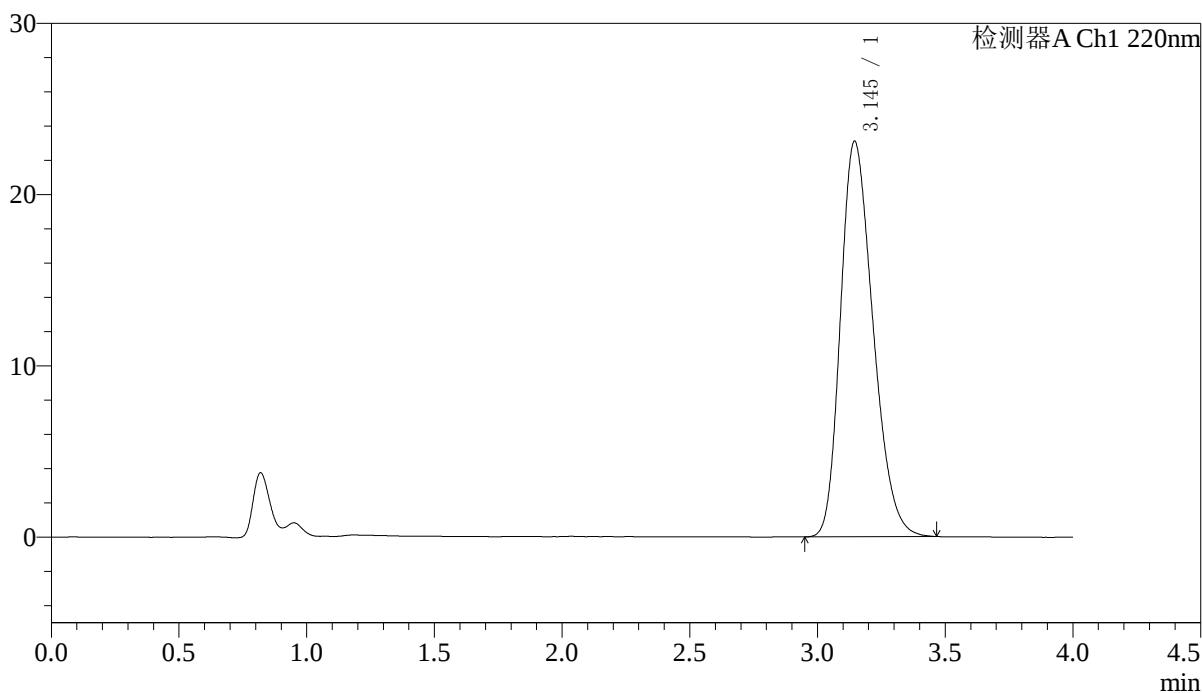

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	204738	100.000	23095	2905	1.265	--
总计		204738	100.000	23095			


图138 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1655-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:25:38 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:20 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

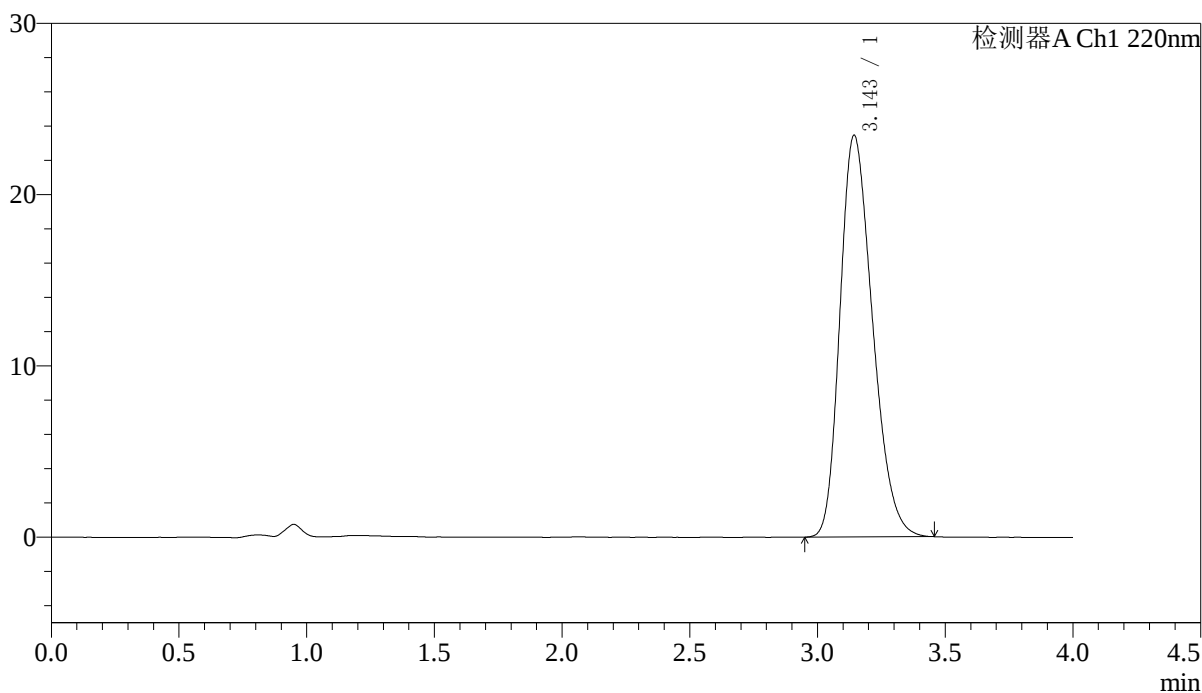

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	207941	100.000	23424	2892	1.269	--
总计		207941	100.000	23424			


图139 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1656-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:29:59 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:27 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

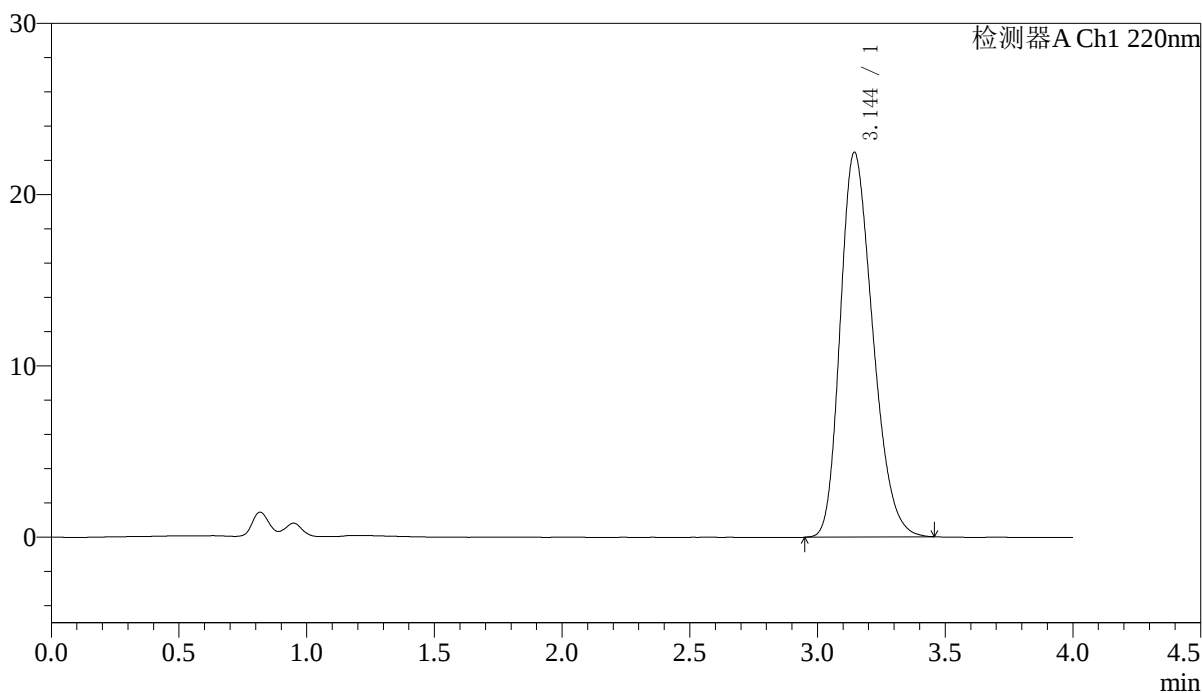

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.144	198884	100.000	22460	2911	1.260	--
总计		198884	100.000	22460			


图140 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1657-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:34:20 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:34 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

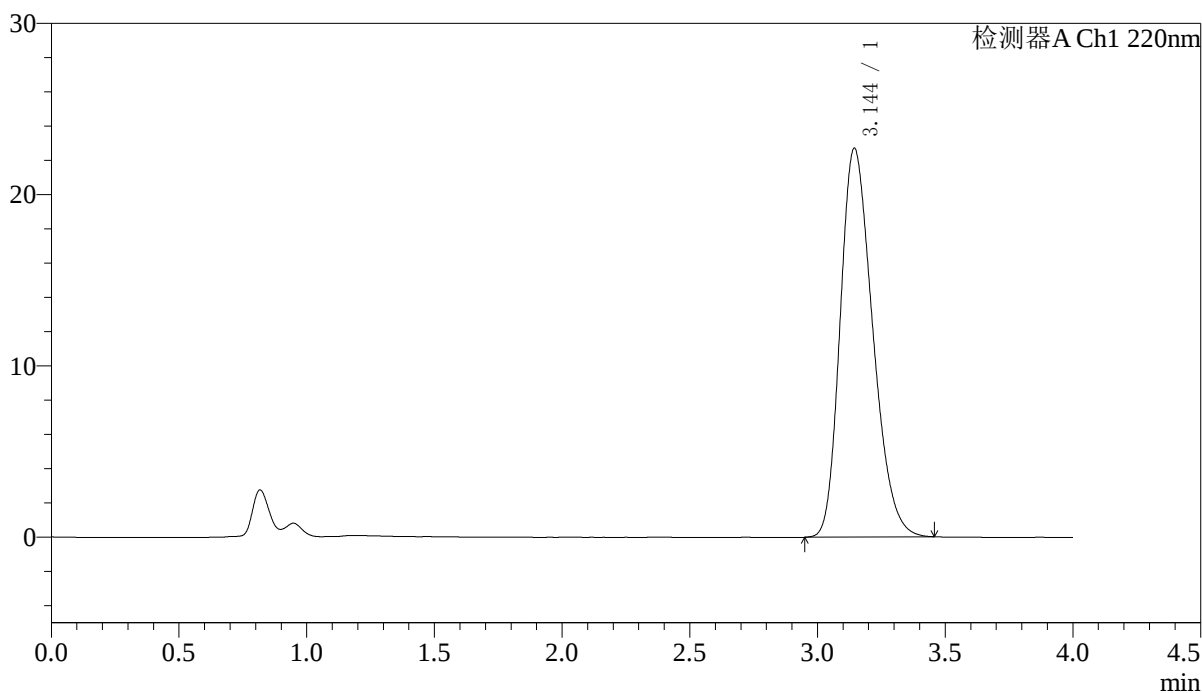

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.144	201078	100.000	22690	2906	1.263	--
总计		201078	100.000	22690			


图141 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1658-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:38:41 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:41 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

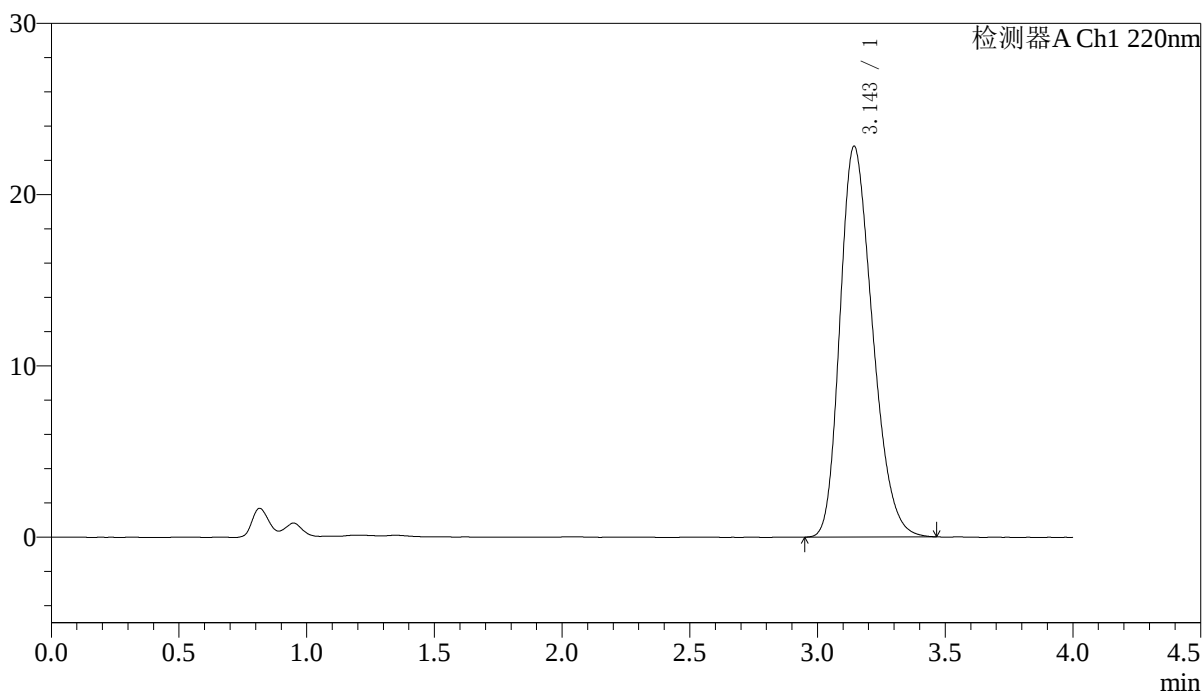

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	202167	100.000	22791	2902	1.264	--
总计		202167	100.000	22791			


图142 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1659-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:43:03 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:48 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

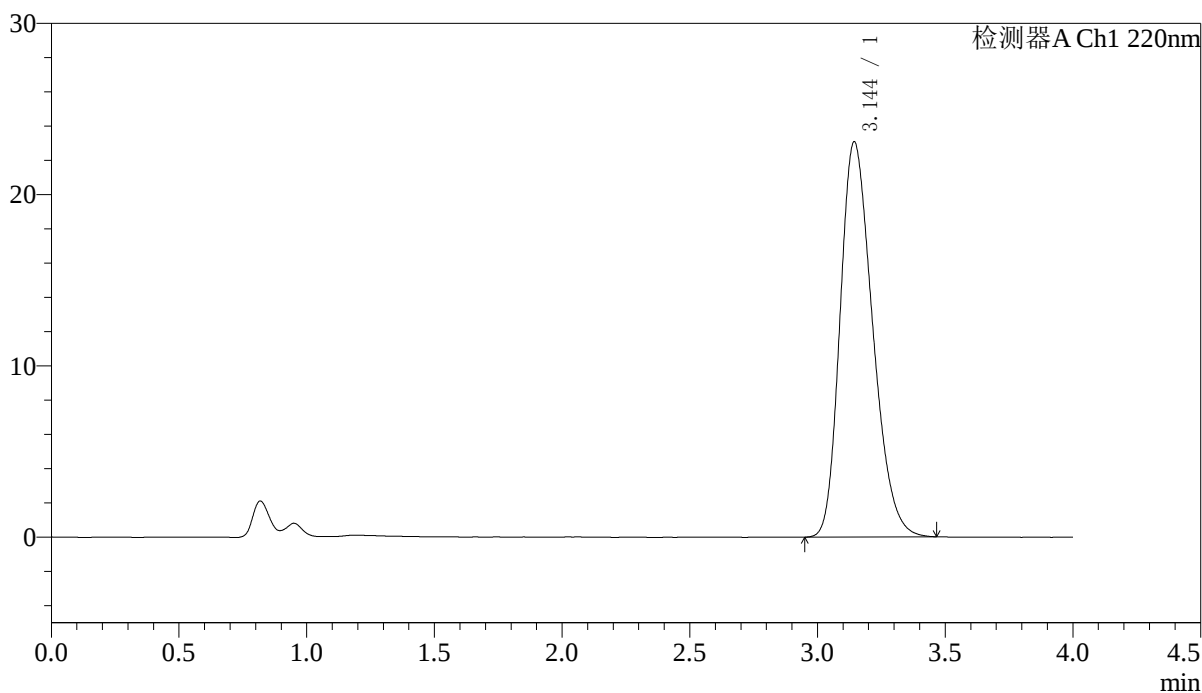

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.144	204631	100.000	23056	2900	1.266	--
总计		204631	100.000	23056			


图143 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1660-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:47:24 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:08:55 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

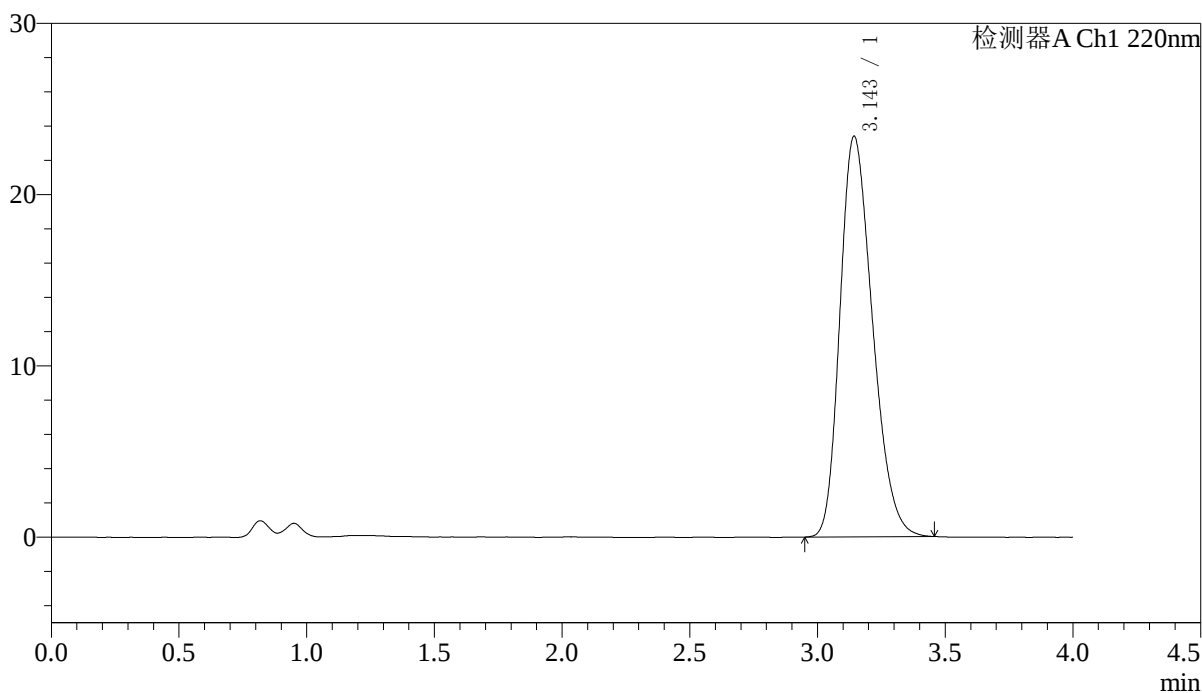

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	207419	100.000	23358	2892	1.266	--
总计		207419	100.000	23358			


图144 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1661-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:51:46 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:02 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

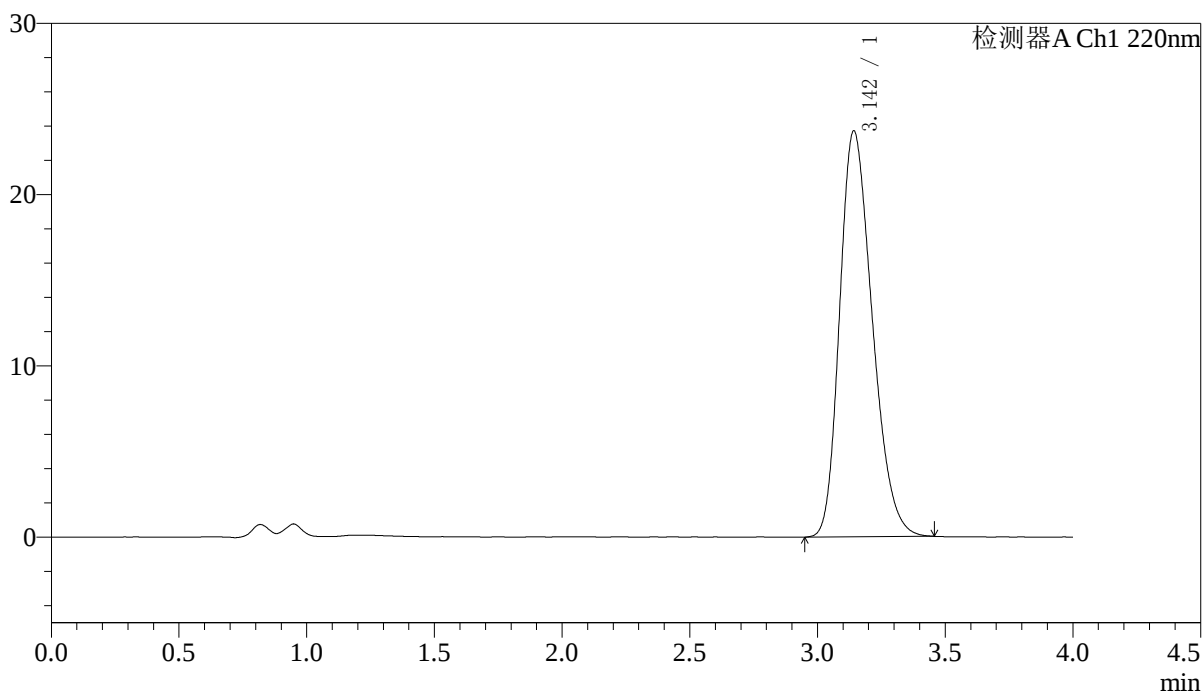

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	210645	100.000	23668	2883	1.268	--
总计		210645	100.000	23668			


图145 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1662-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 21:56:07 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:10 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

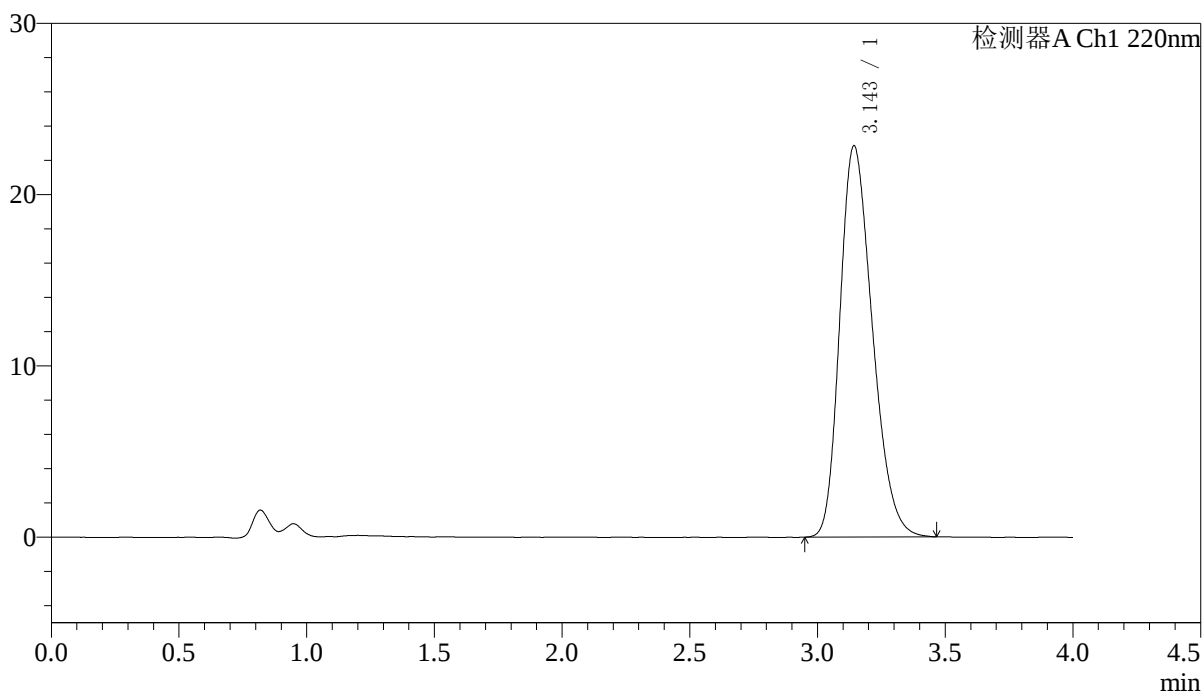

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	202480	100.000	22799	2900	1.264	--
总计		202480	100.000	22799			


图146 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1663-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:00:28 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:17 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

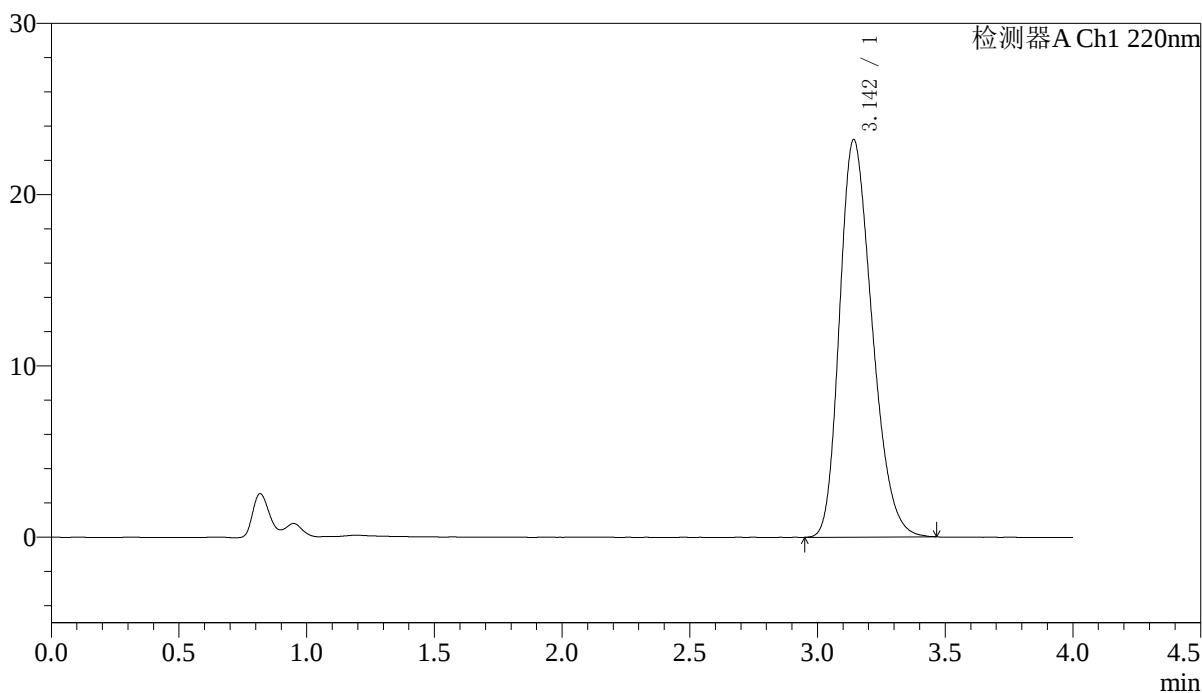

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	205788	100.000	23184	2892	1.266	--
总计		205788	100.000	23184			


图147 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1664-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:04:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:24 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

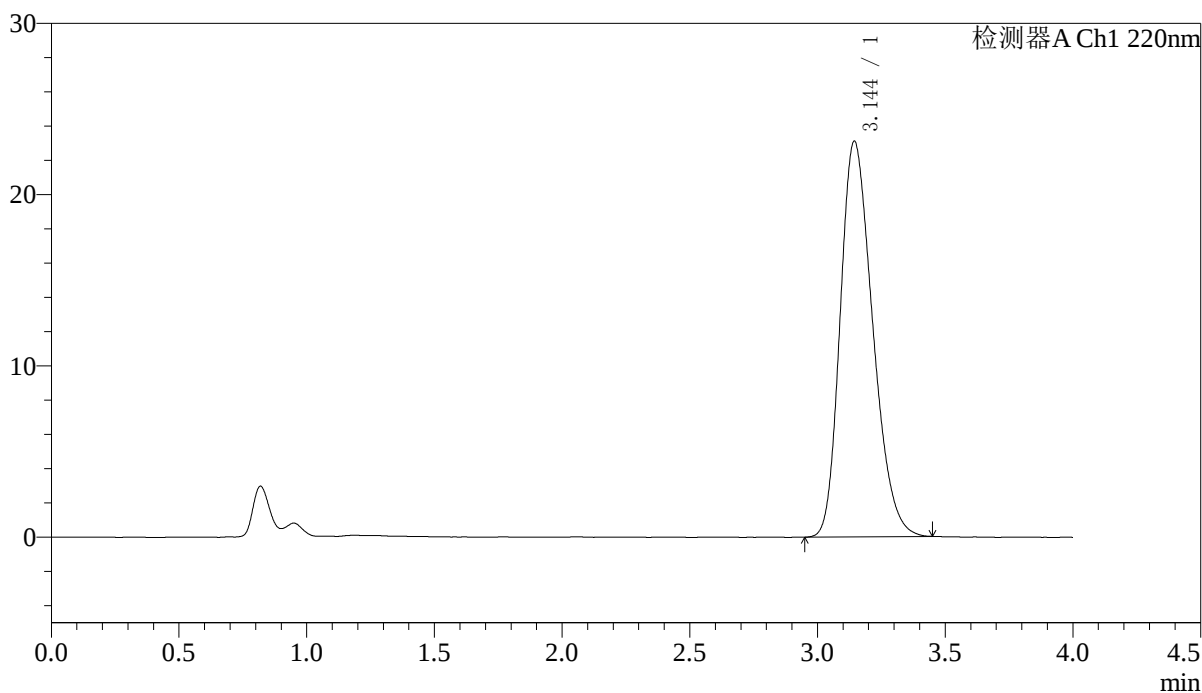

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.144	204565	100.000	23091	2904	1.264	--
总计		204565	100.000	23091			


图148 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1665-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:09:10 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:31 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

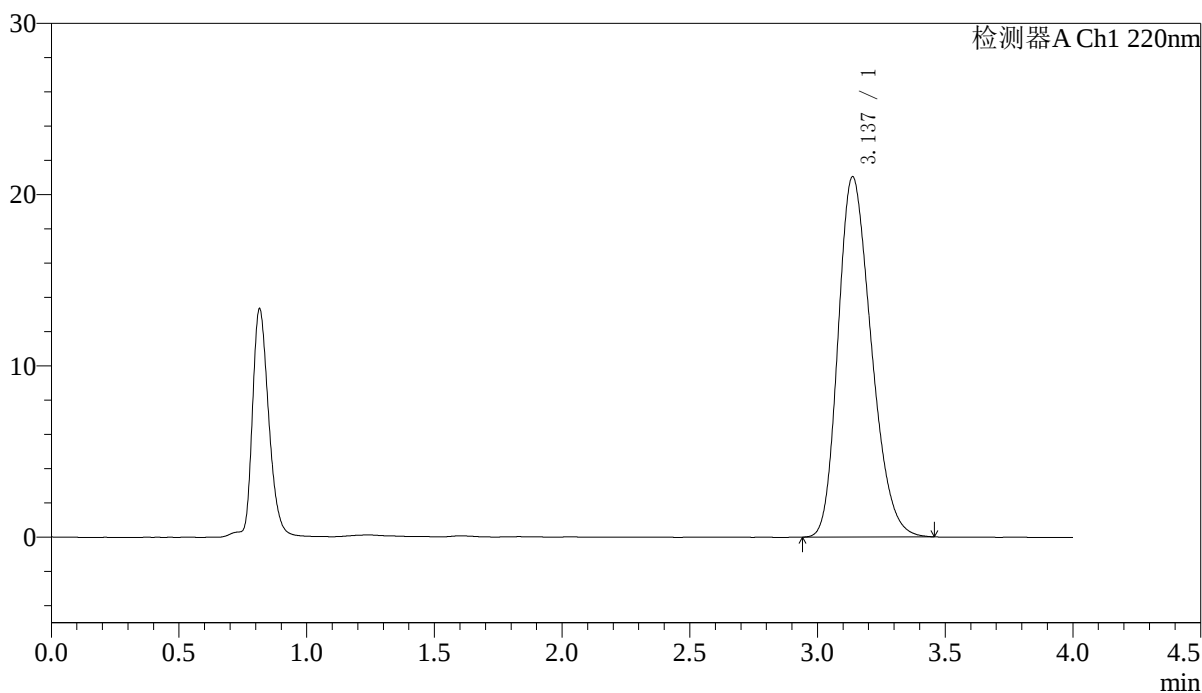

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	189955	100.000	21041	2778	1.252	--
总计		189955	100.000	21041			


图149 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1666-2 - zzp-2022030601p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:13:33 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:38 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

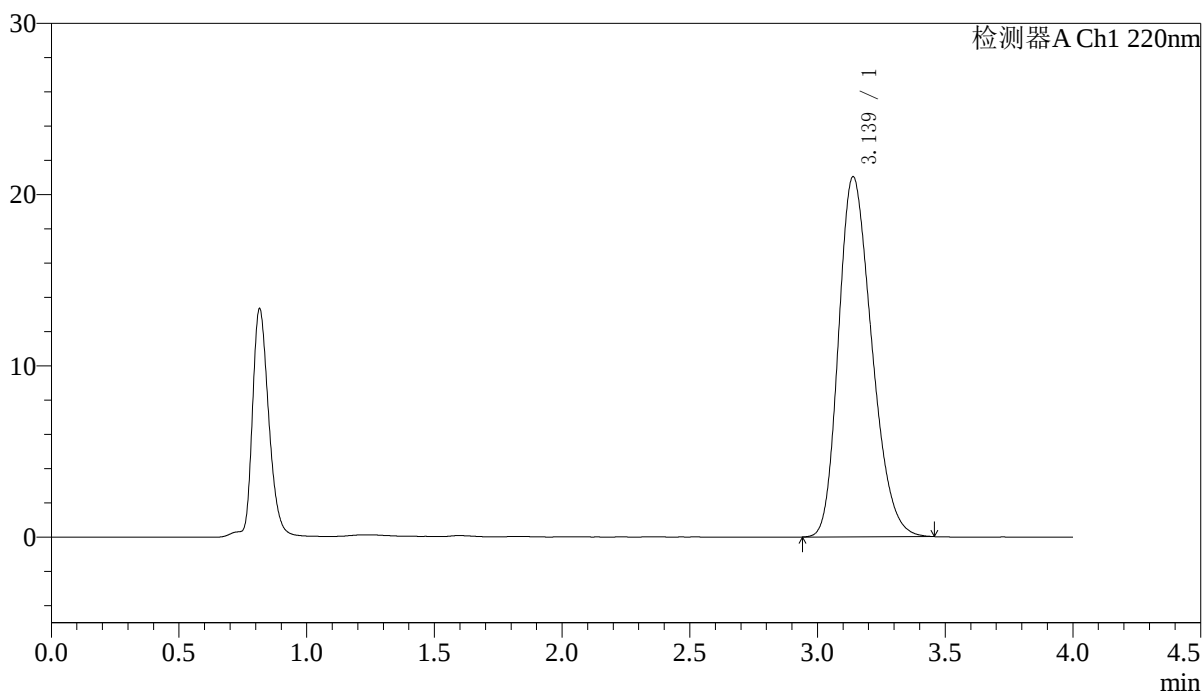

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	190103	100.000	21038	2776	1.253	--
总计		190103	100.000	21038			


图150 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1667-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:17:57 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:45 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

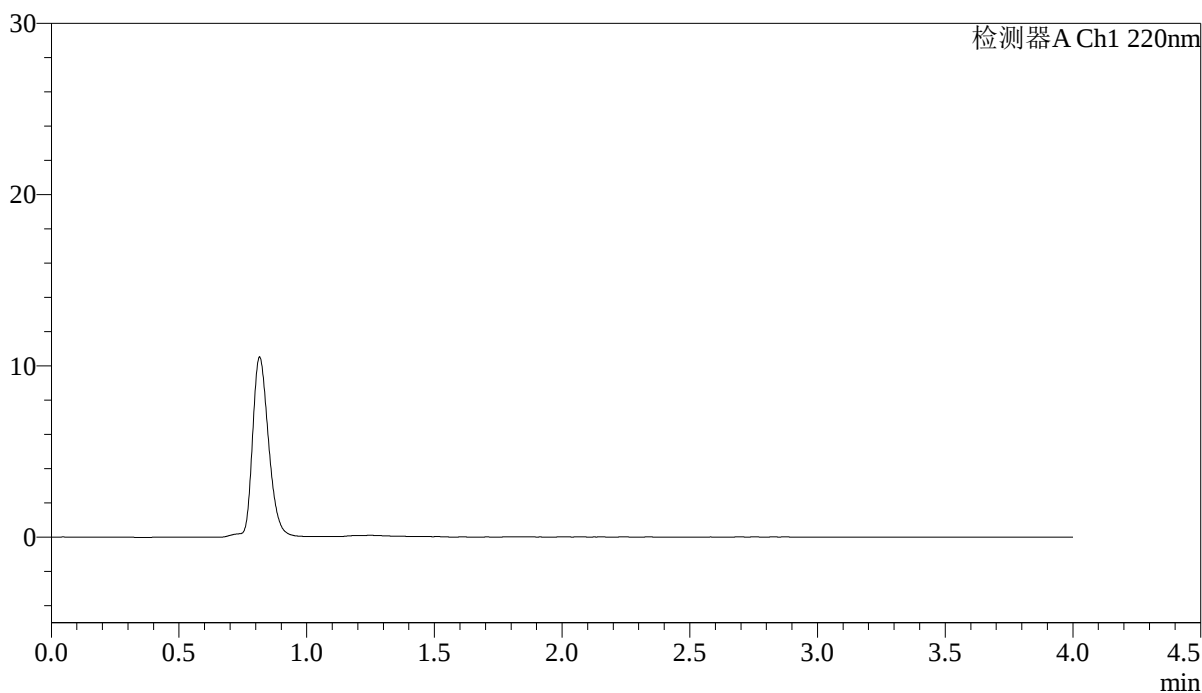

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图151 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1668-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:22:22 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:52 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

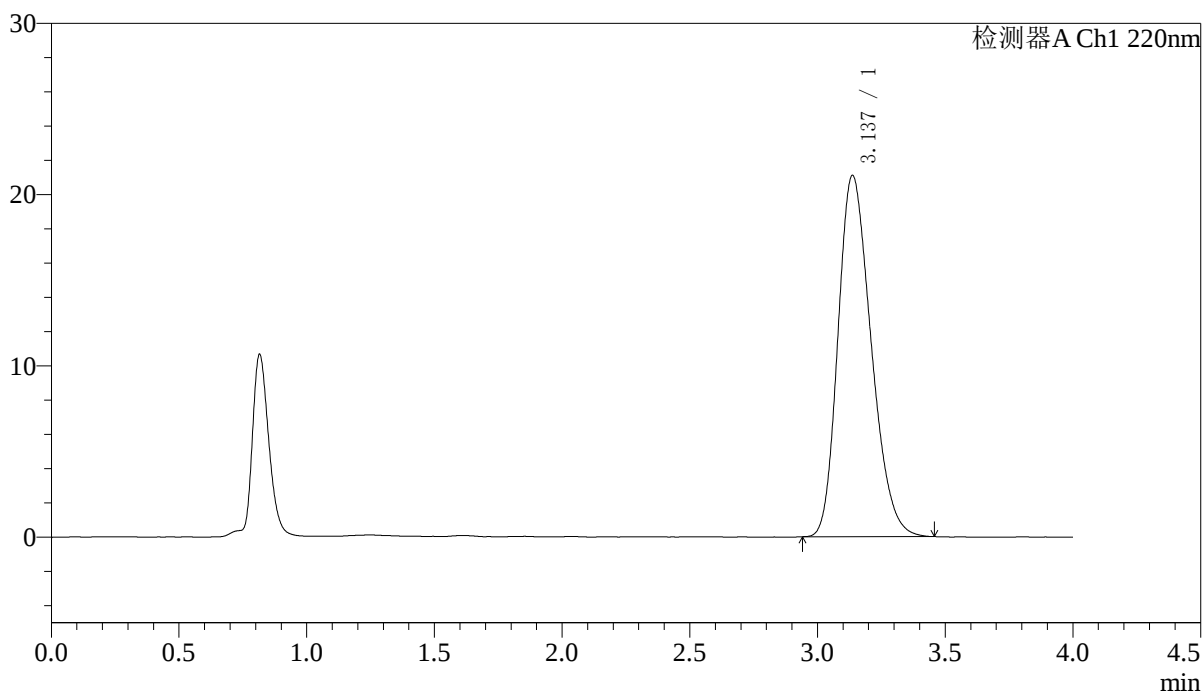

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	190408	100.000	21097	2782	1.253	--
总计		190408	100.000	21097			


图152 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1669-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:26:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:09:59 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

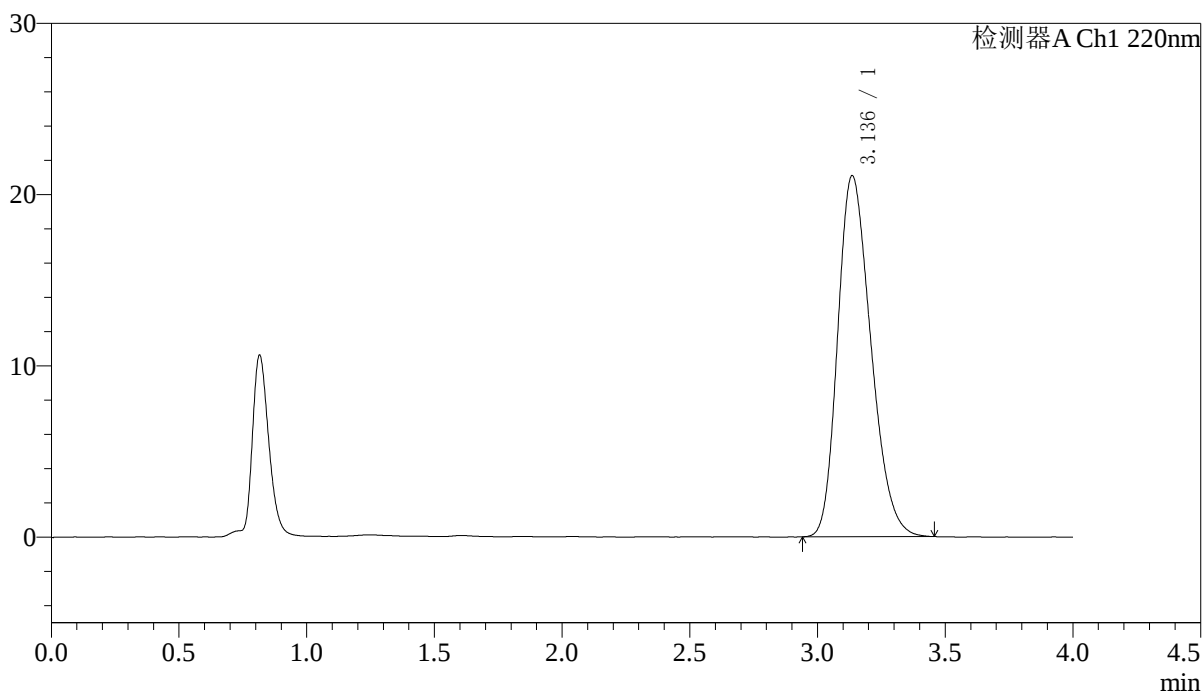

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	190614	100.000	21073	2769	1.254	--
总计		190614	100.000	21073			


图153 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1670-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:31:08 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:06 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

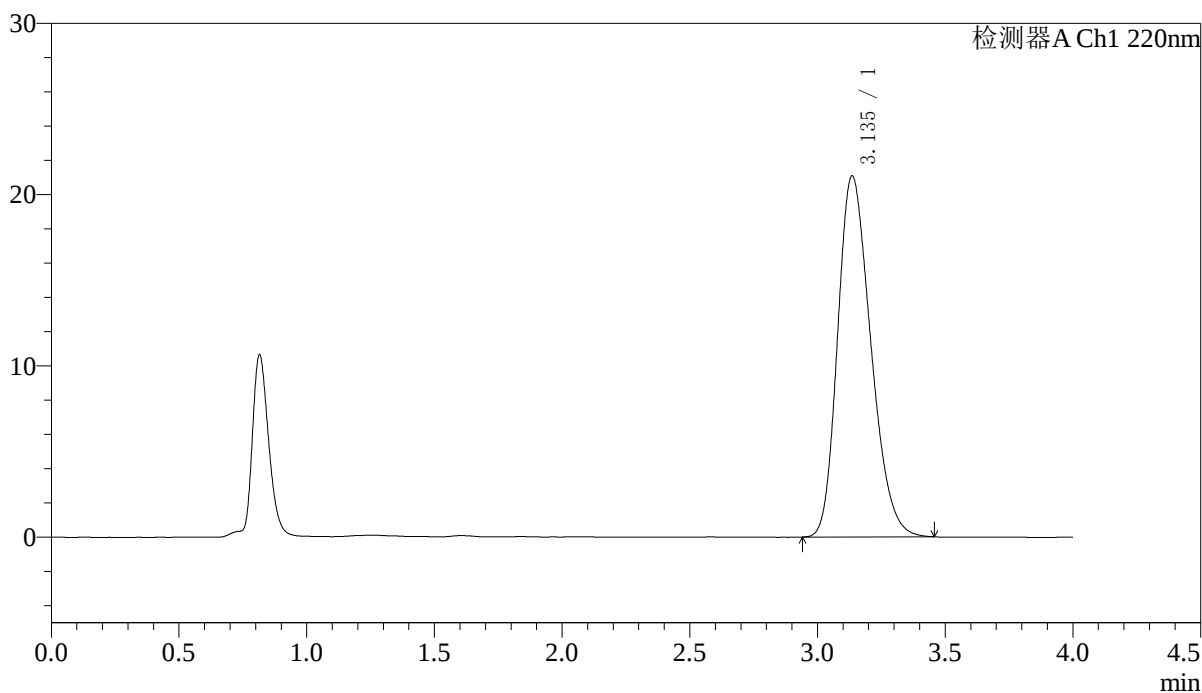

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	190394	100.000	21065	2777	1.255	--
总计		190394	100.000	21065			


图154 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1671-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:35:32 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:12 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

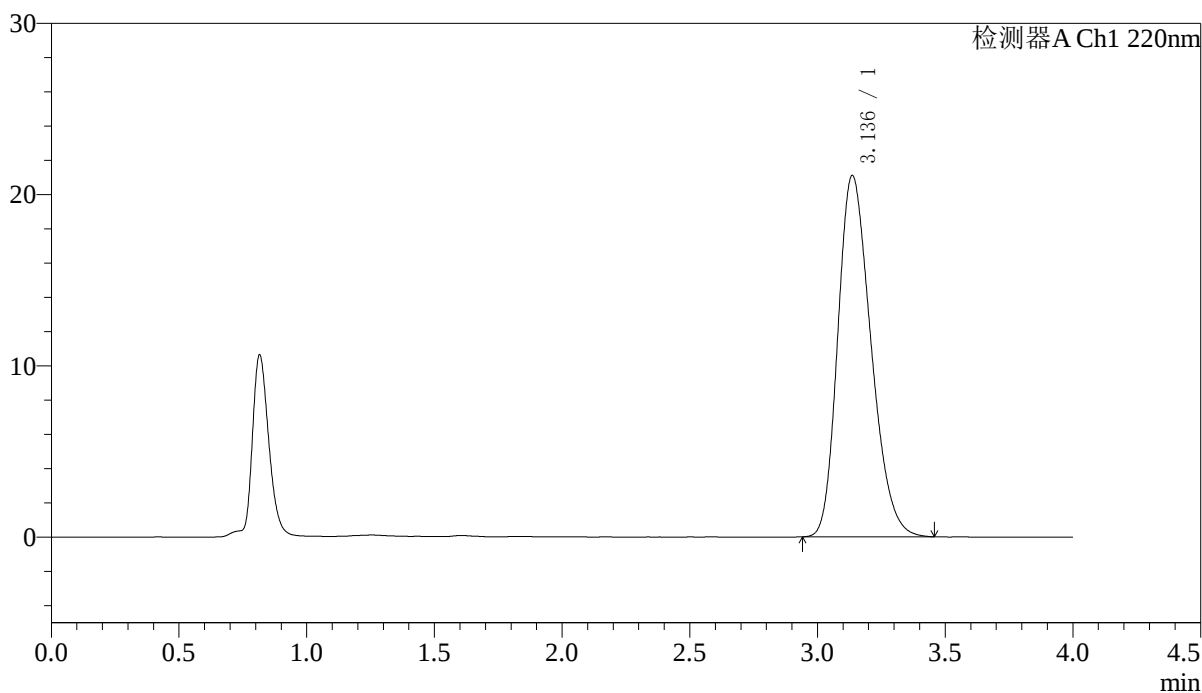

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	190592	100.000	21091	2774	1.255	--
总计		190592	100.000	21091			


图155 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1672-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:39:55 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:20 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

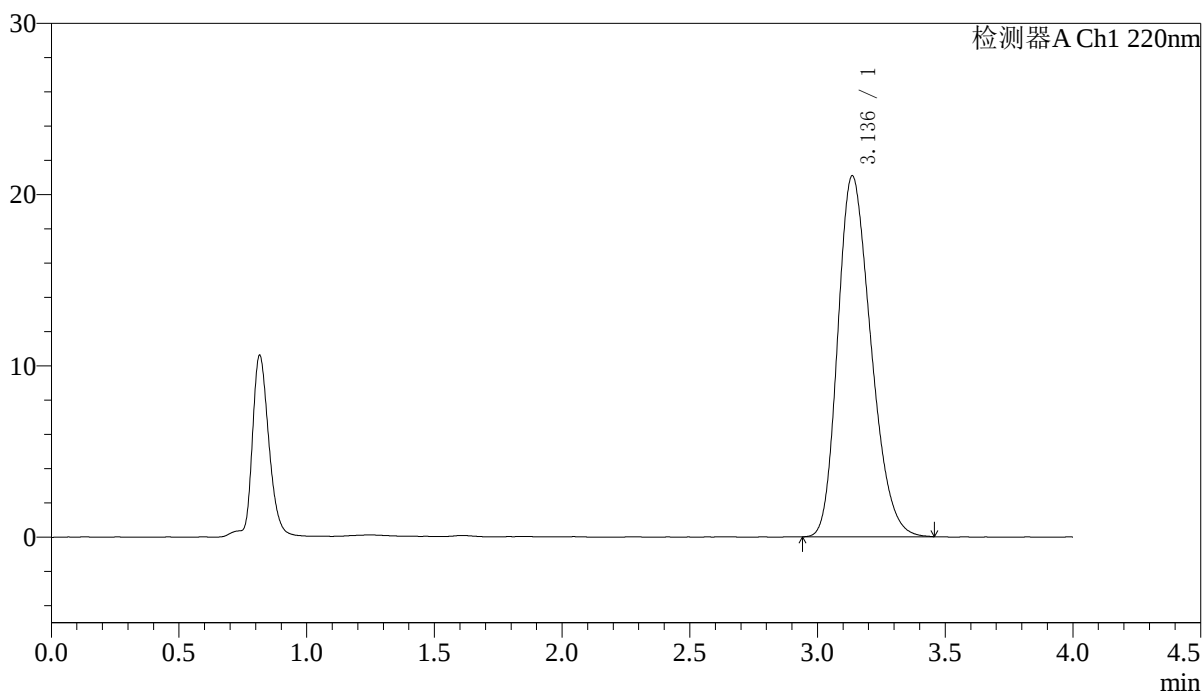

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	190438	100.000	21067	2772	1.255	--
总计		190438	100.000	21067			


图156 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1673-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:44:18 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:27 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

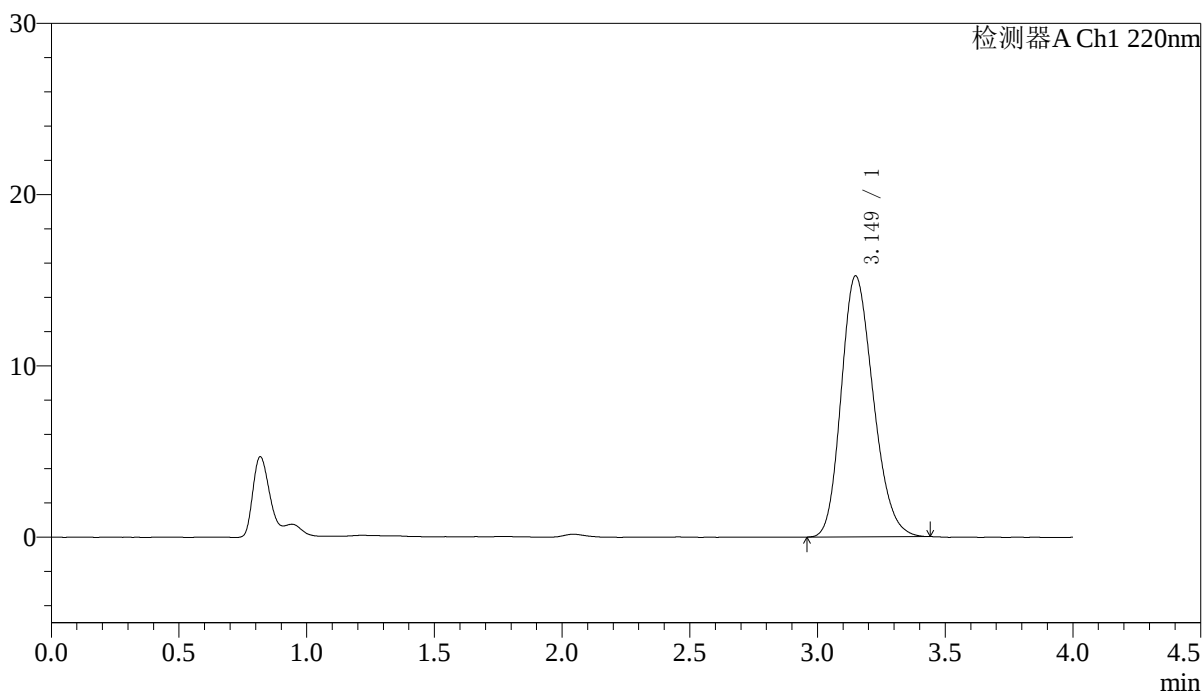

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	133008	100.000	15240	3004	1.209	--
总计		133008	100.000	15240			


图157 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1674-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:48:40 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:33 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

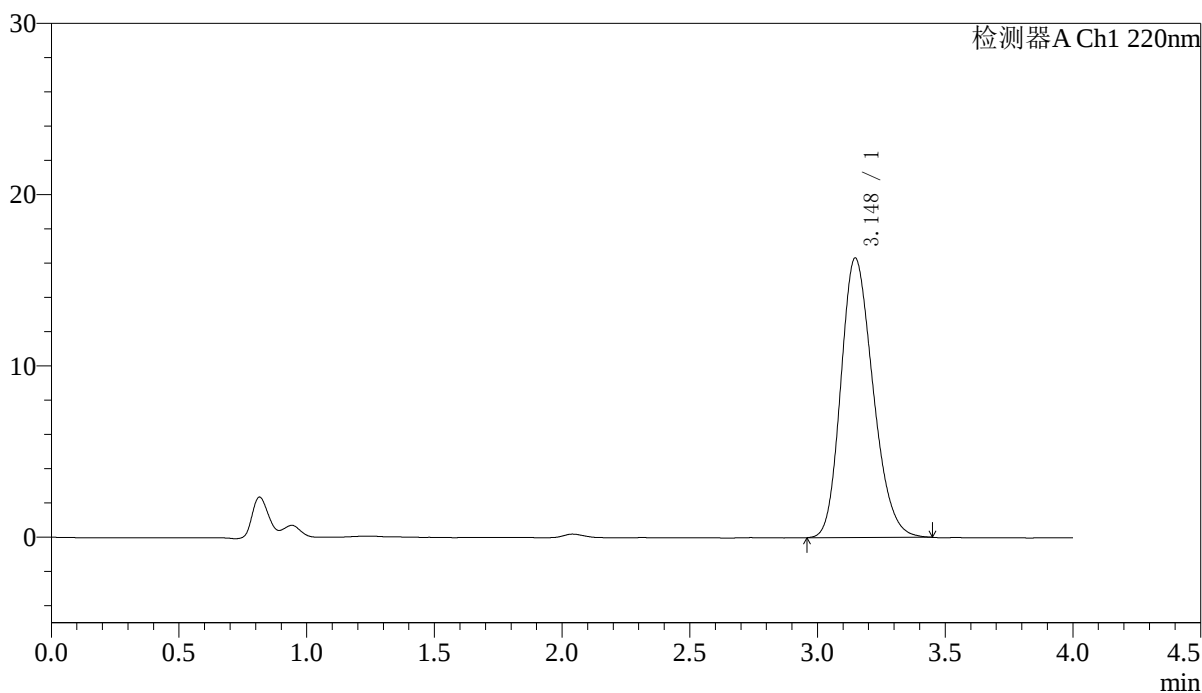

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	142916	100.000	16334	2994	1.218	--
总计		142916	100.000	16334			


图158 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1675-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:53:03 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:40 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

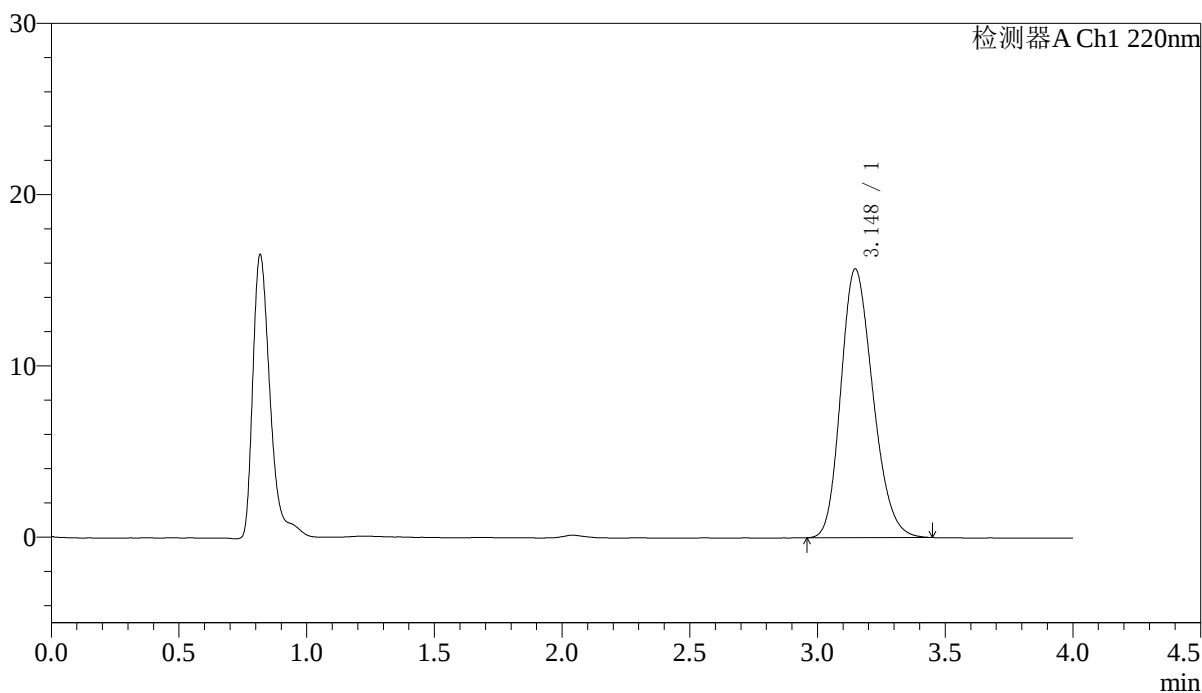

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	137158	100.000	15703	3001	1.213	--
总计		137158	100.000	15703			


图159 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1676-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 22:57:25 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:47 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

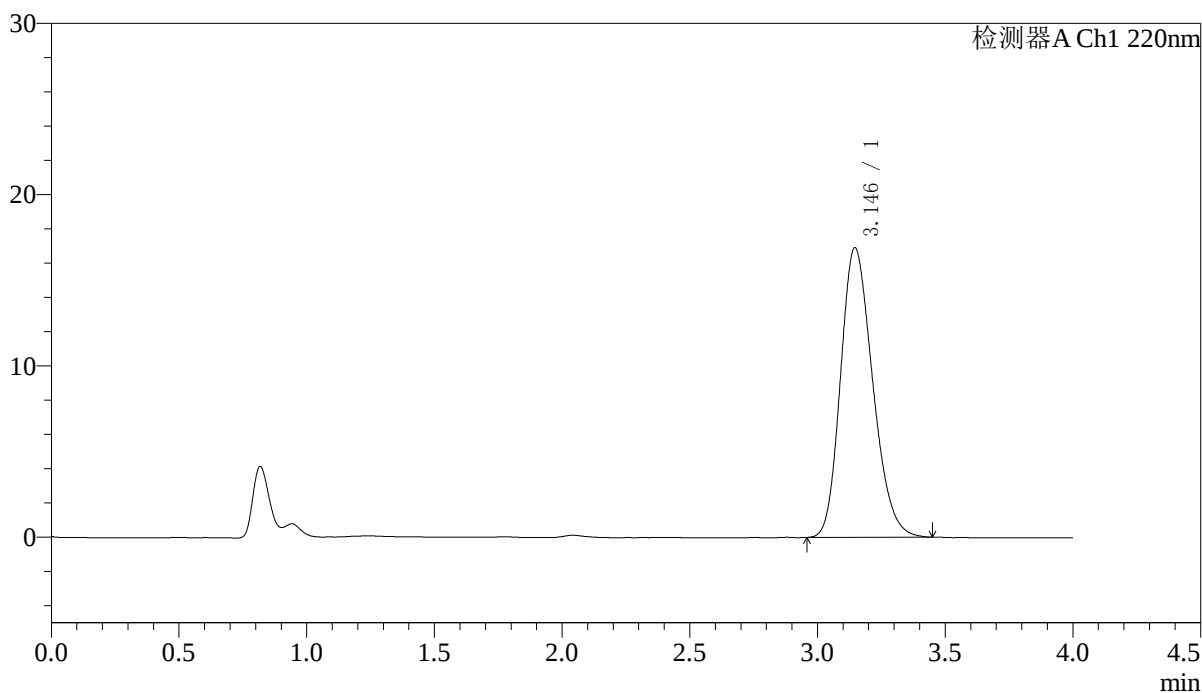

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	148195	100.000	16922	2983	1.222	--
总计		148195	100.000	16922			


图160 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1677-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:01:47 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:10:54 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

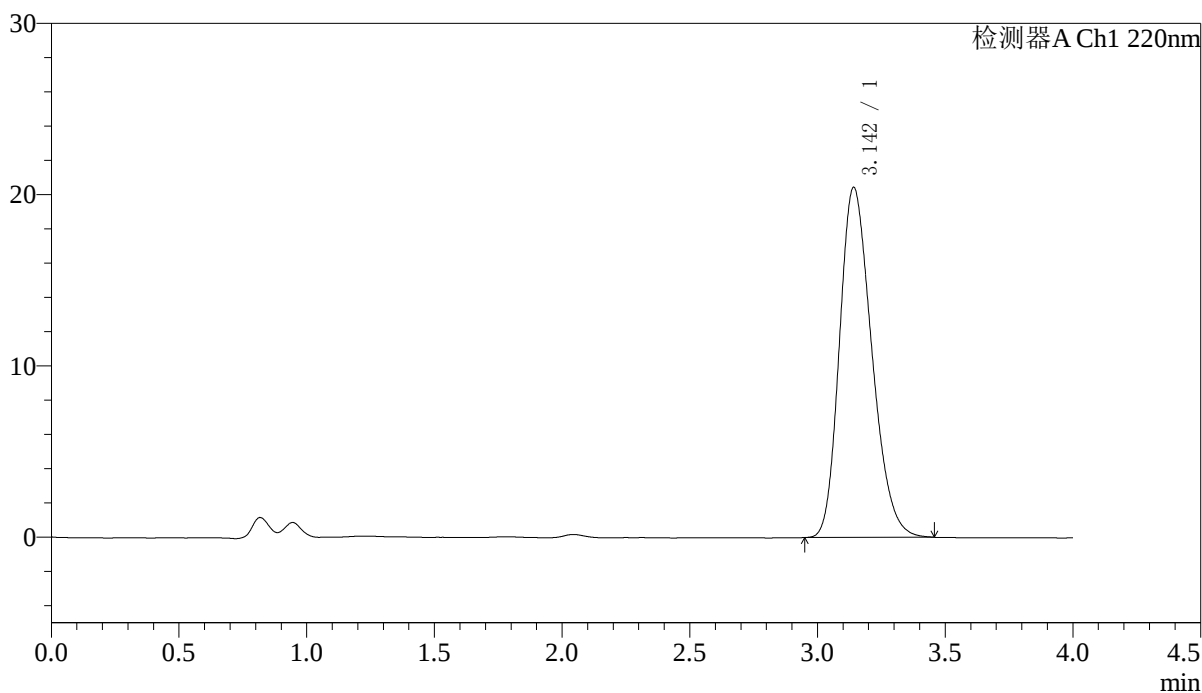

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	179976	100.000	20420	2942	1.246	--
总计		179976	100.000	20420			


图161 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1678-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:06:09 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:01 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

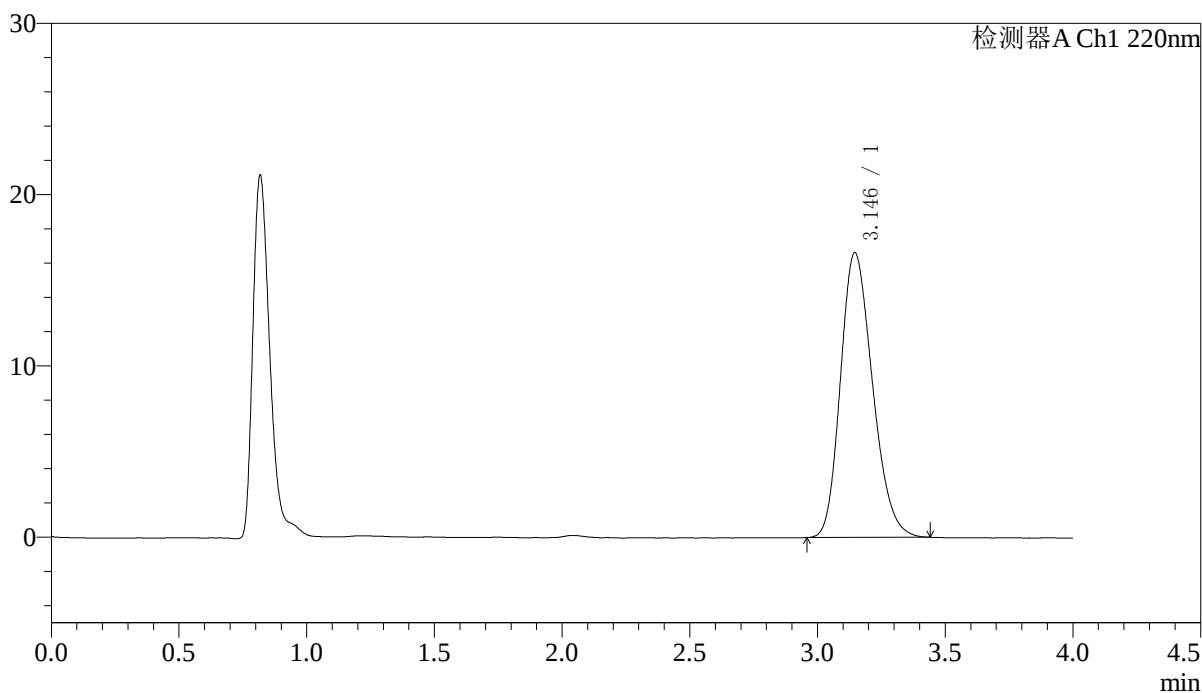

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	145377	100.000	16635	2993	1.220	--
总计		145377	100.000	16635			


图162 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1679-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:10:31 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:09 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

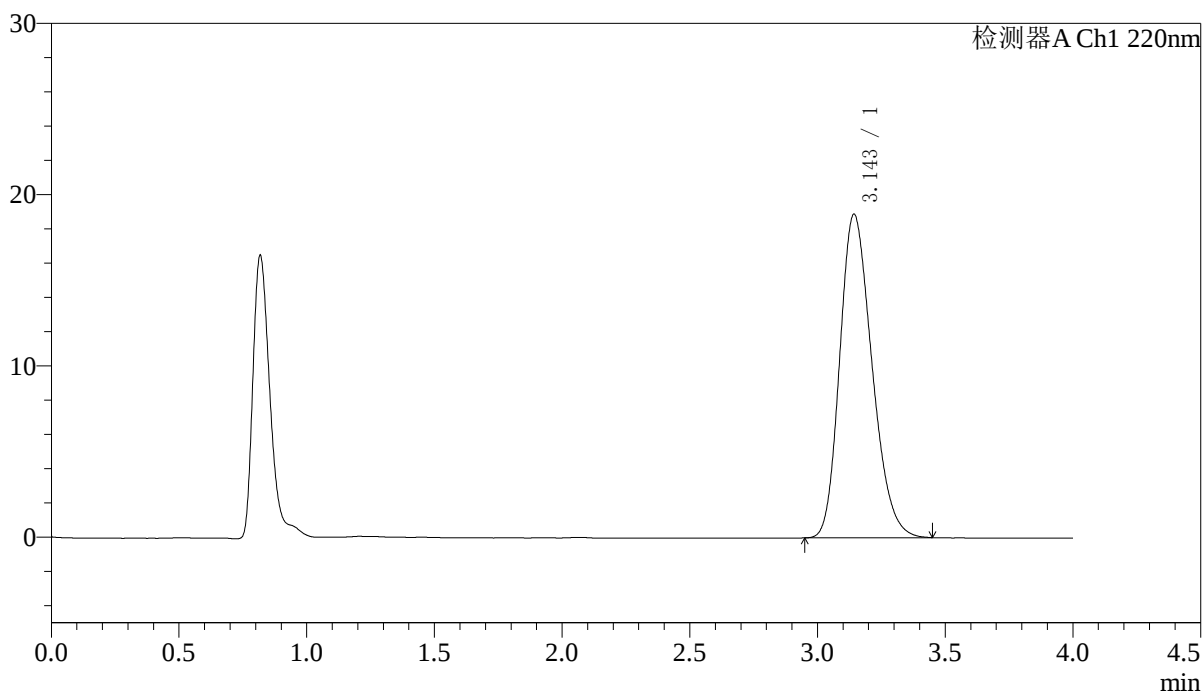

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	165965	100.000	18856	2960	1.237	--
总计		165965	100.000	18856			


图163 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1680-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:14:54 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:16 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

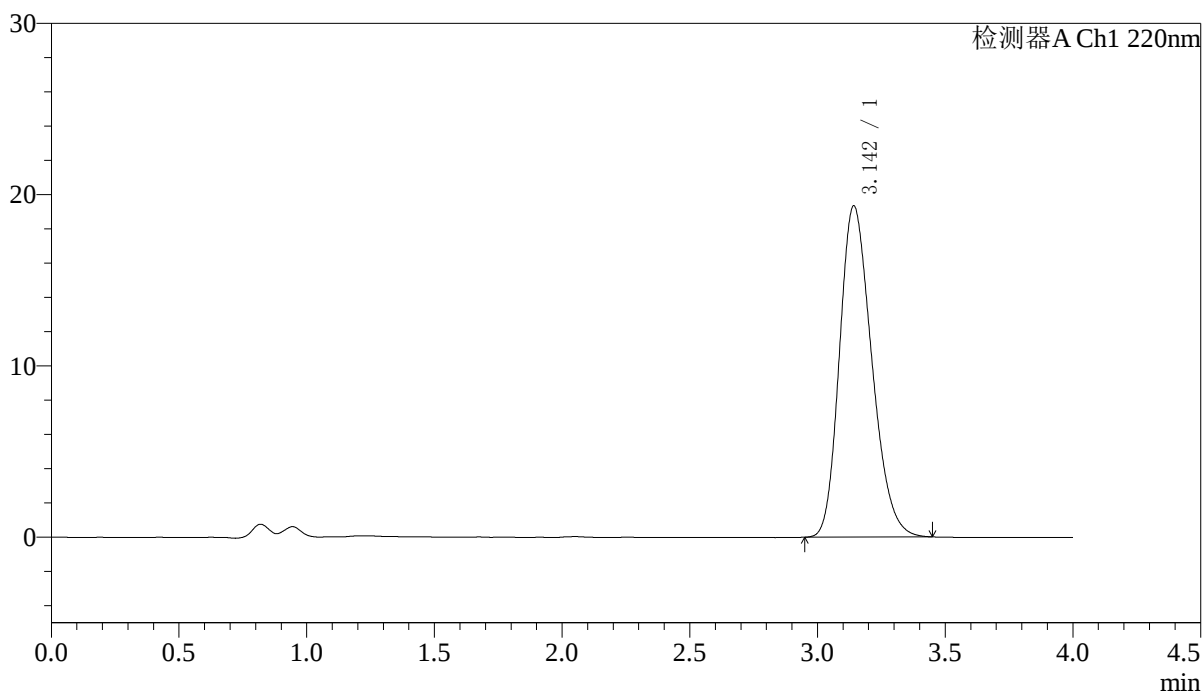

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	170057	100.000	19316	2945	1.238	--
总计		170057	100.000	19316			


图164 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1681-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:19:16 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:23 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

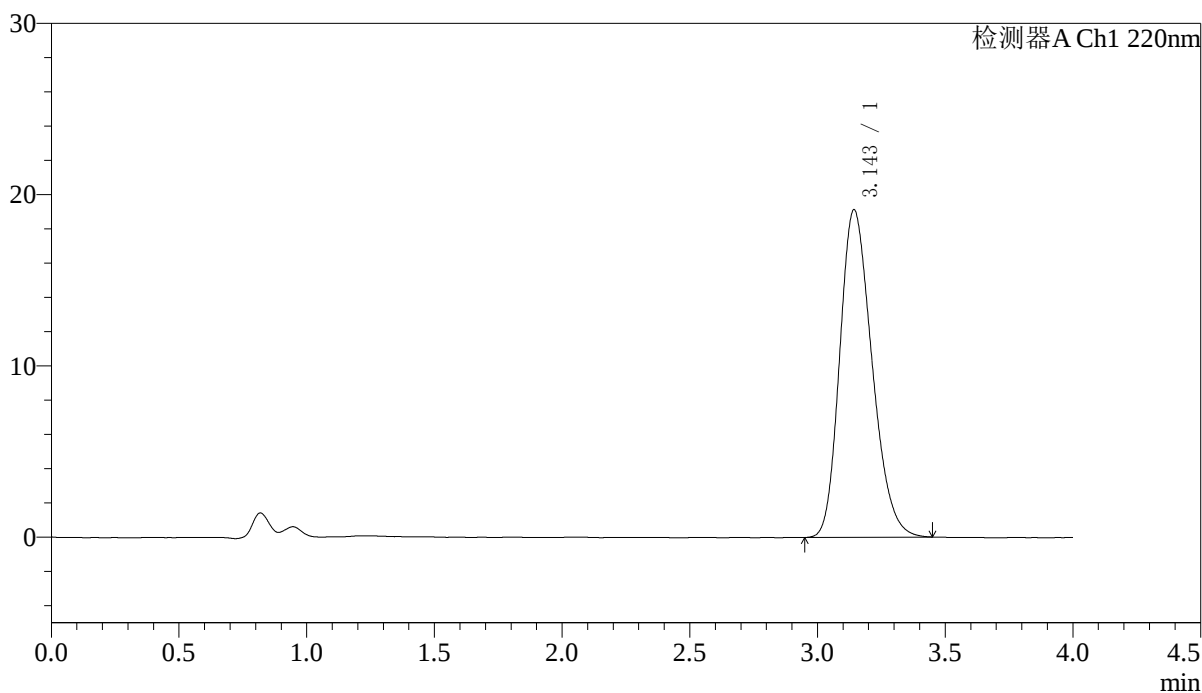

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	168153	100.000	19092	2952	1.236	--
总计		168153	100.000	19092			


图165 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1682-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:23:38 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:30 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

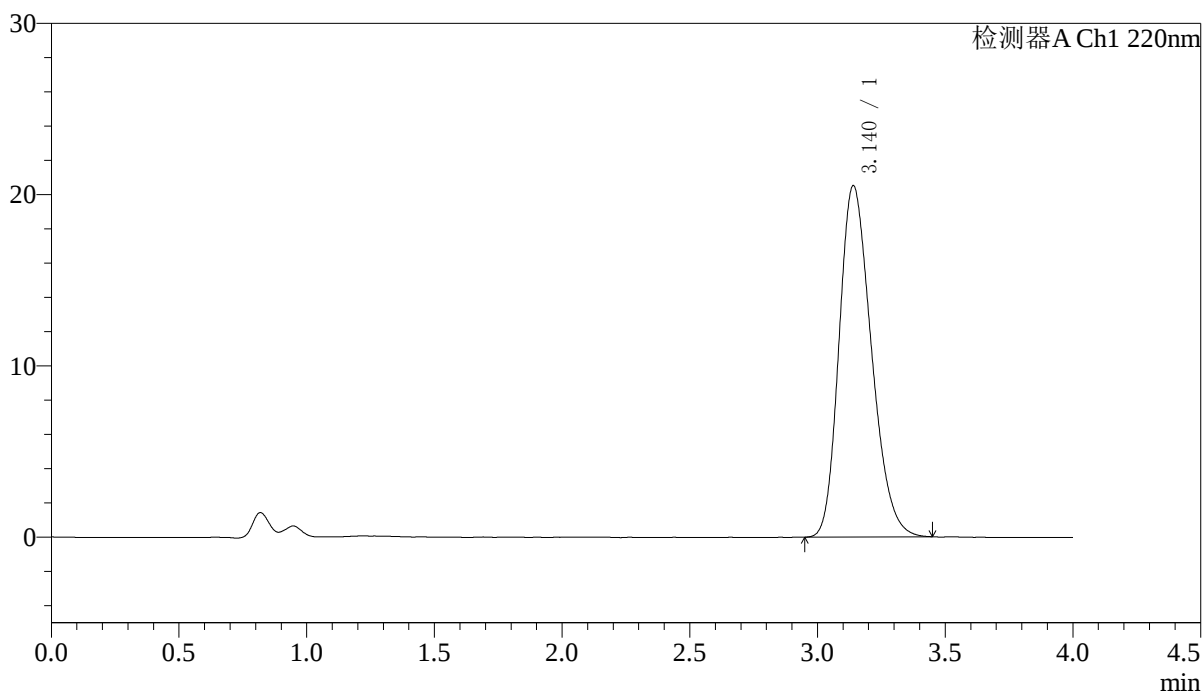

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	180678	100.000	20518	2934	1.246	--
总计		180678	100.000	20518			


图166 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1683-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:28:00 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:37 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

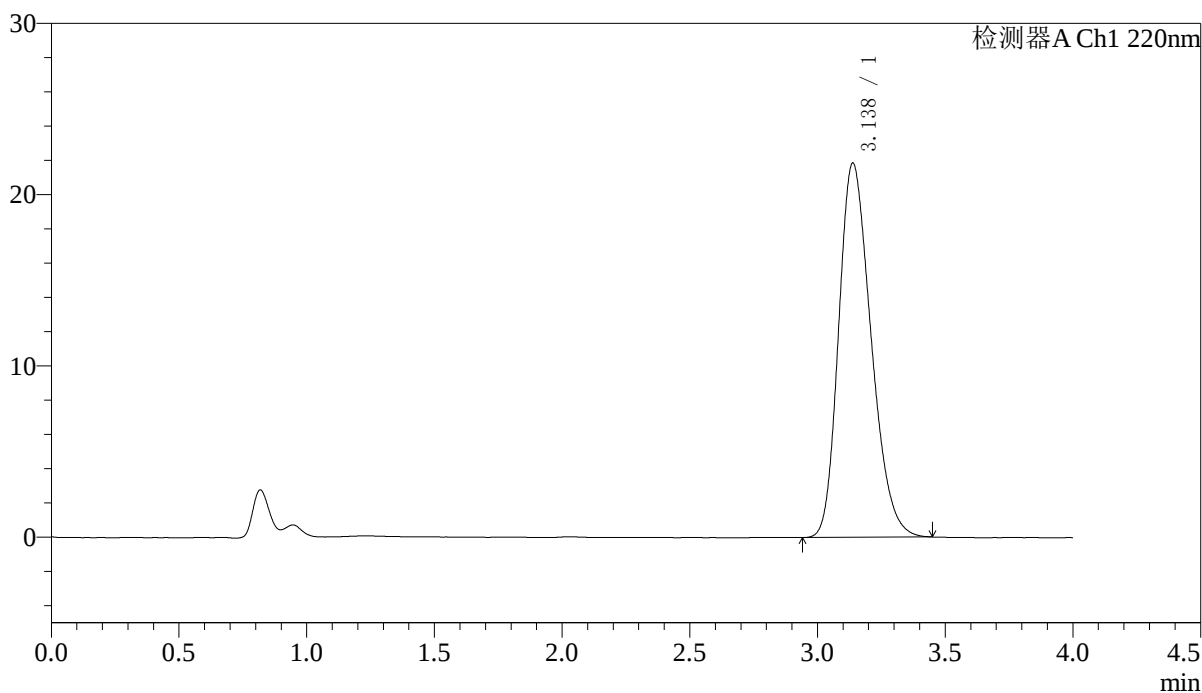

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	192867	100.000	21862	2912	1.255	--
总计		192867	100.000	21862			


图167 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1684-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:32:22 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:44 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

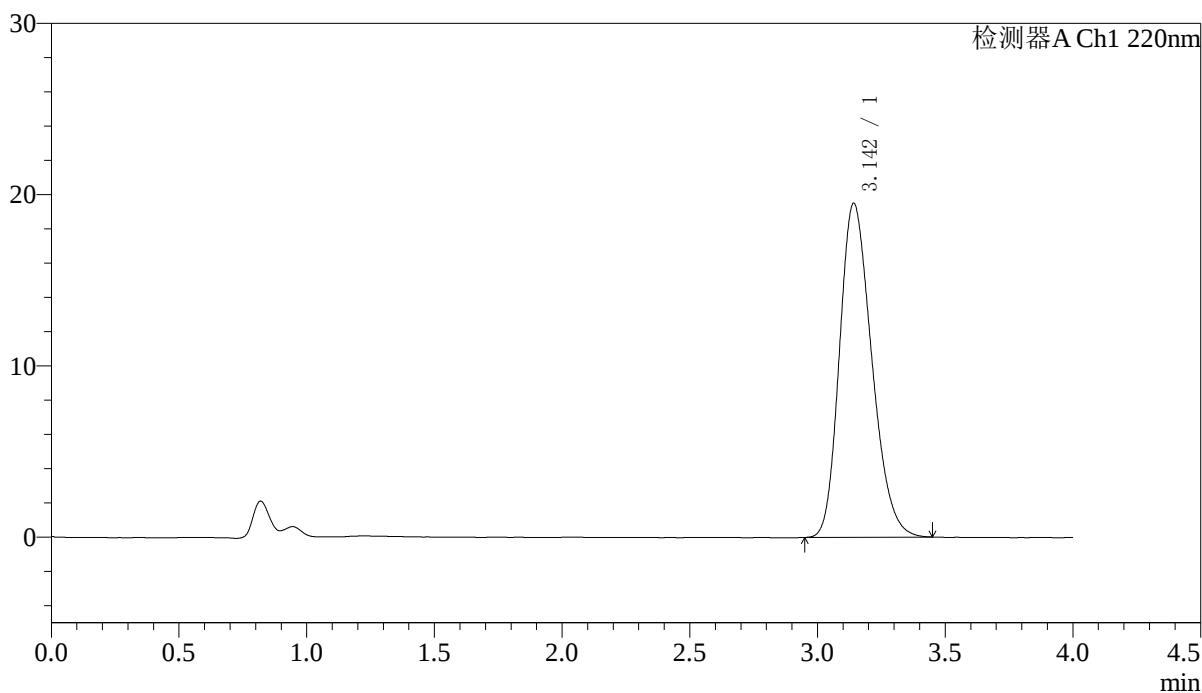

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	171439	100.000	19484	2951	1.240	--
总计		171439	100.000	19484			


图168 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1685-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:36:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:51 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

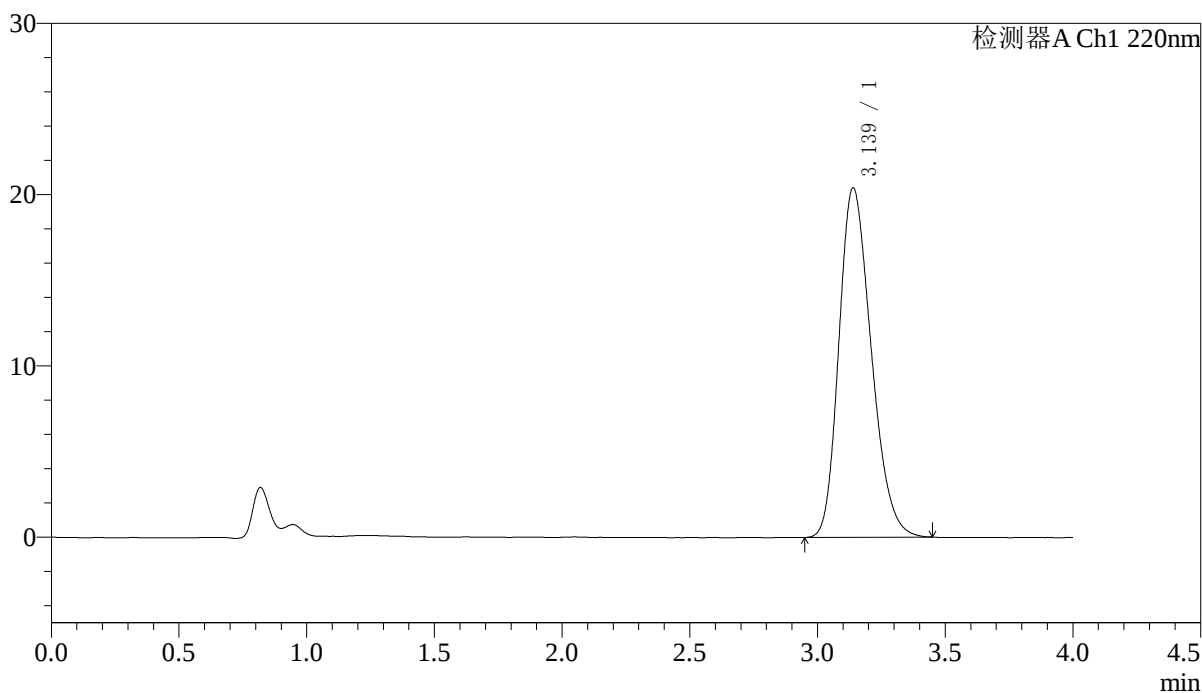

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	179756	100.000	20413	2935	1.246	--
总计		179756	100.000	20413			


图169 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1686-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:41:06 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:11:58 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

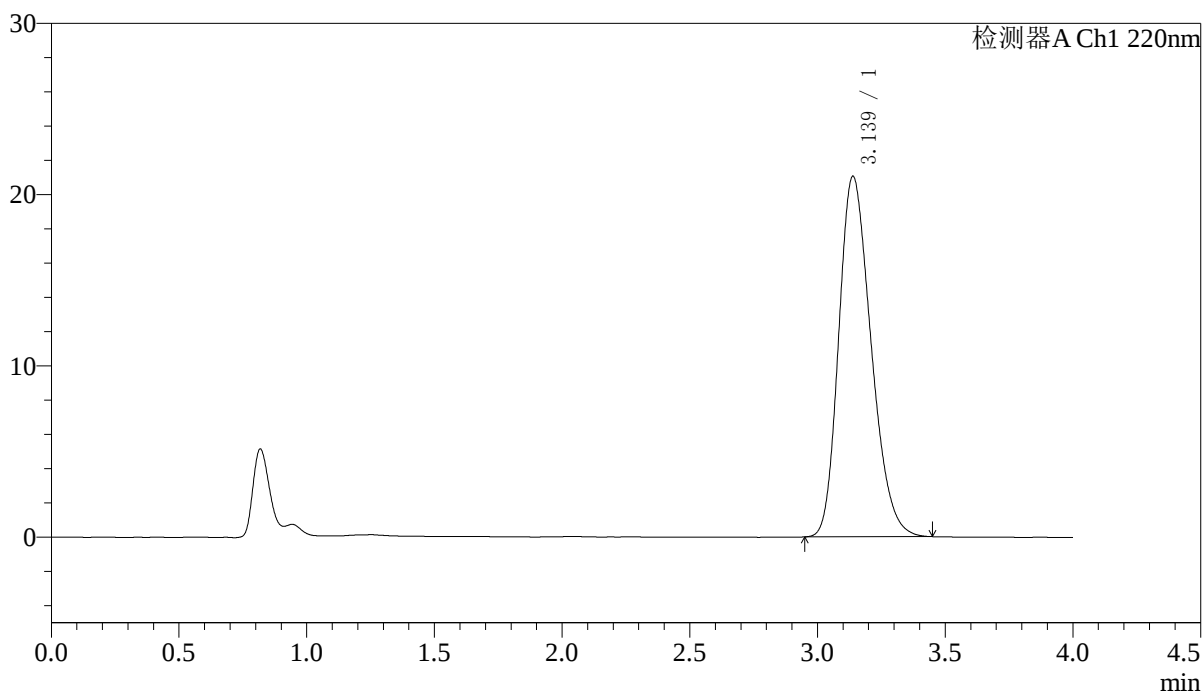

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	185522	100.000	21062	2926	1.250	--
总计		185522	100.000	21062			


图170 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1687-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:45:29 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:05 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

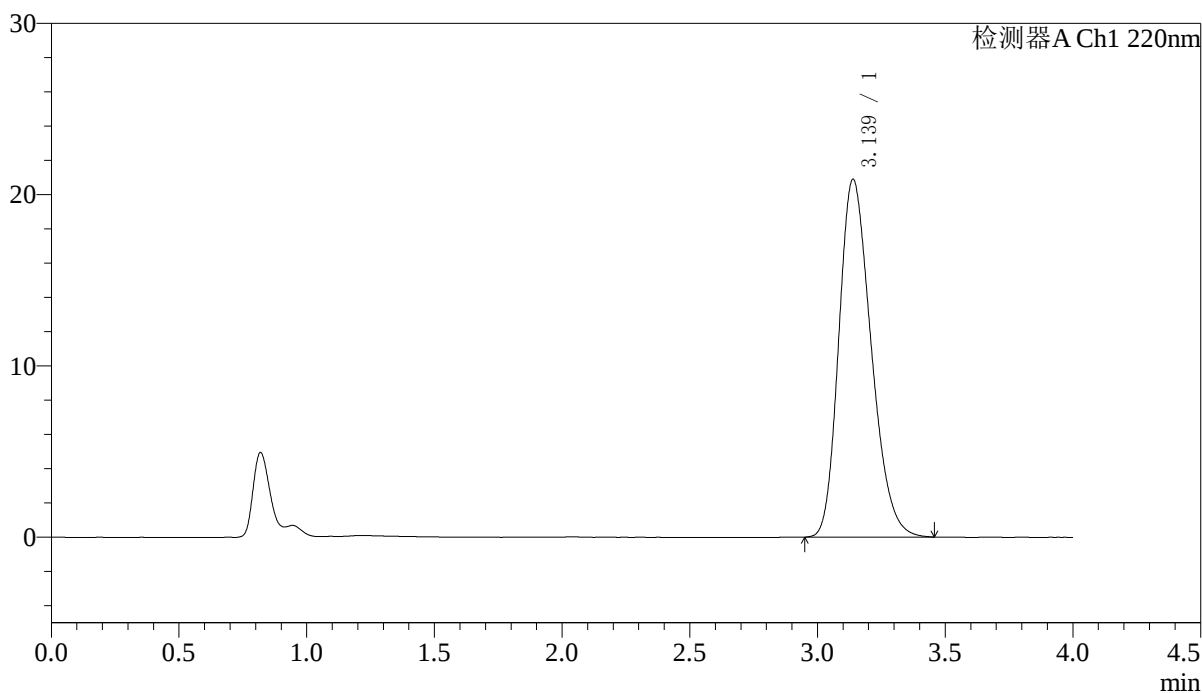

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	184111	100.000	20905	2936	1.250	--
总计		184111	100.000	20905			


图171 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1688-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:49:51 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:12 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

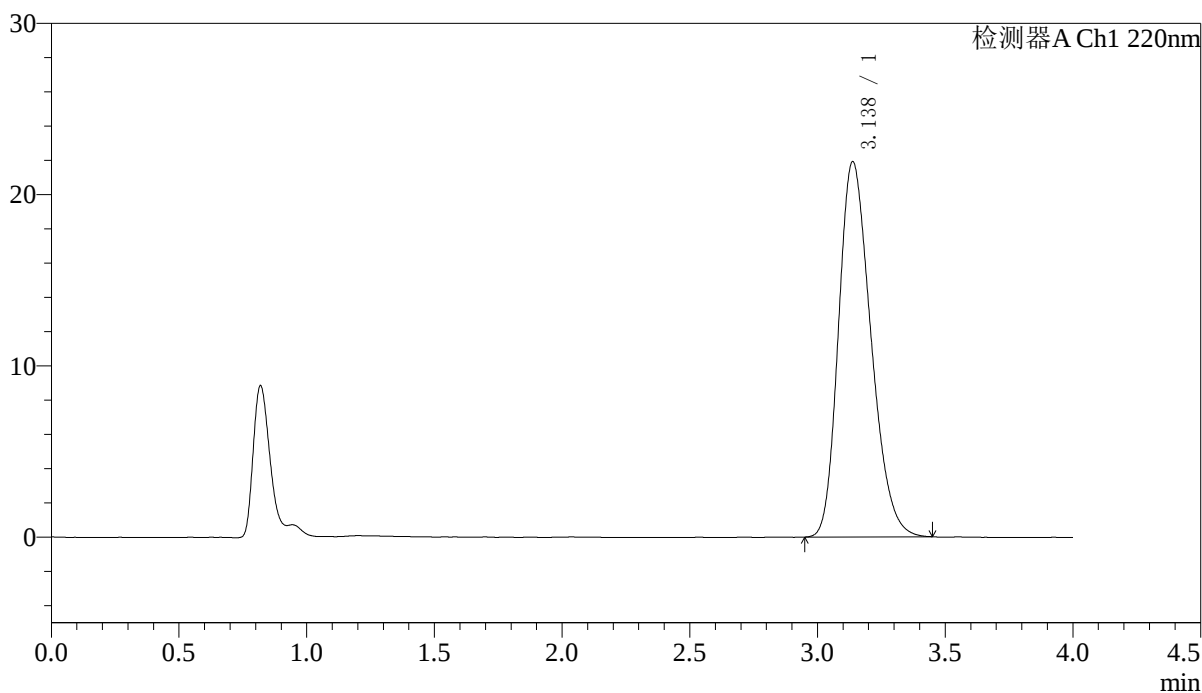

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	193336	100.000	21924	2915	1.254	--
总计		193336	100.000	21924			


图172 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1689-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:54:14 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:19 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

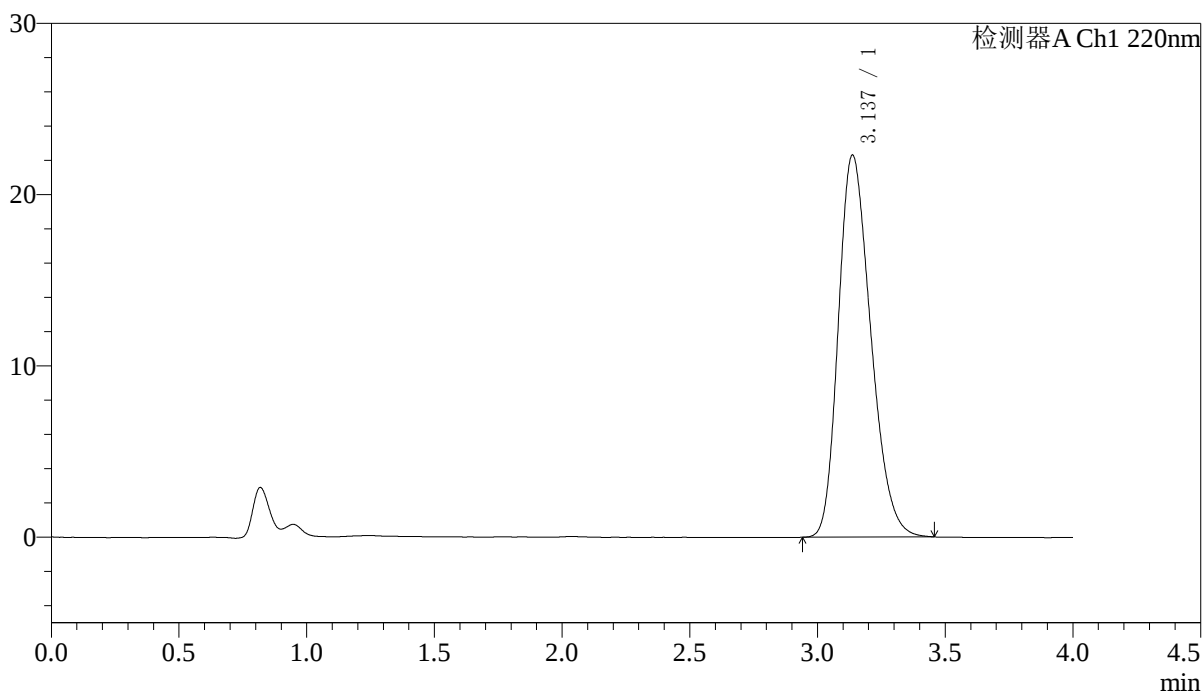

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	197074	100.000	22309	2913	1.258	--
总计		197074	100.000	22309			


图173 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1690-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 23:58:35 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:26 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

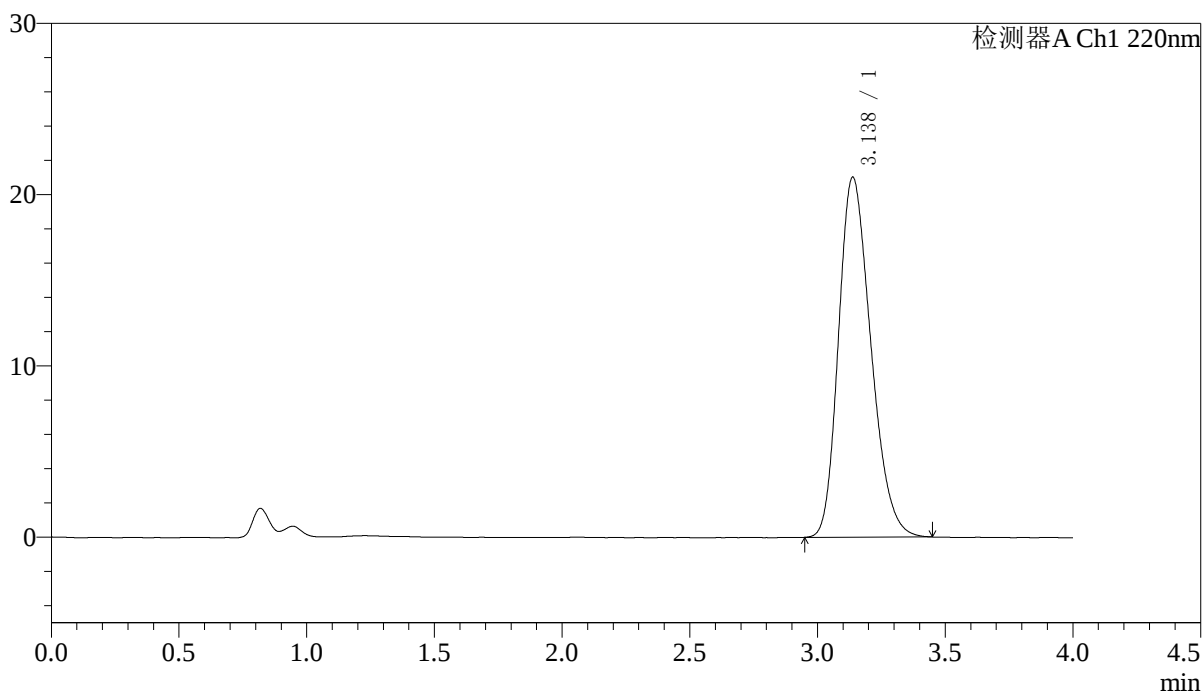

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	185216	100.000	21029	2926	1.250	--
总计		185216	100.000	21029			


图174 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1691-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:02:59 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:33 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

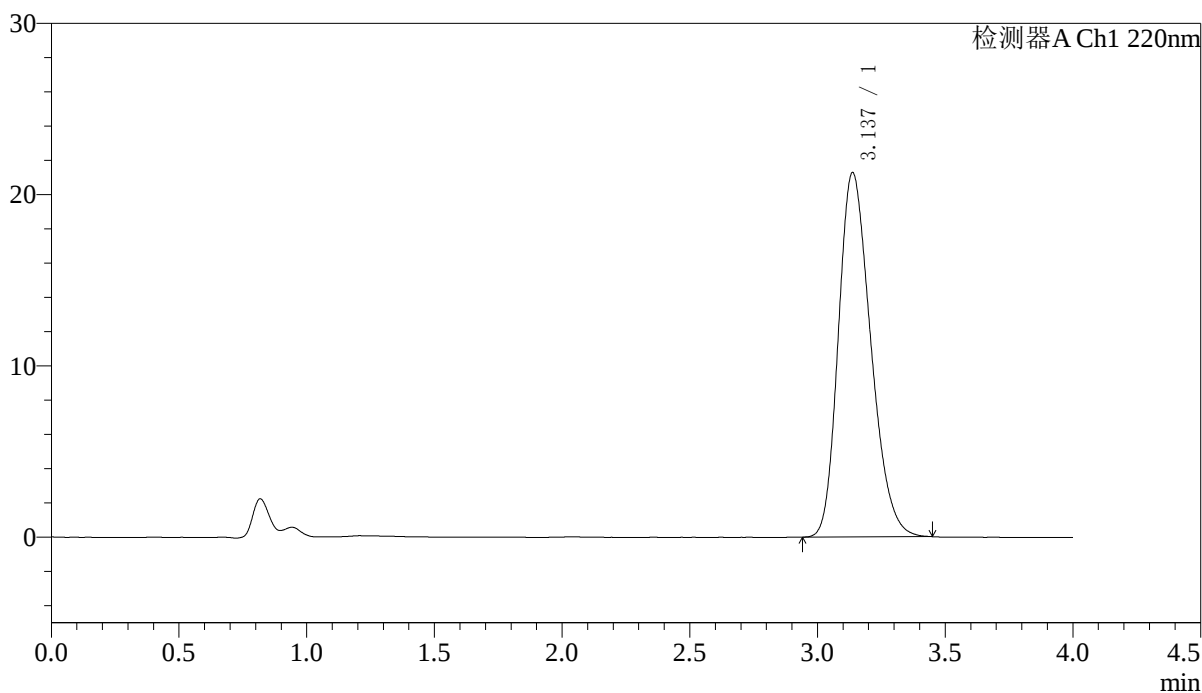

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	187499	100.000	21279	2921	1.250	--
总计		187499	100.000	21279			


图175 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1692-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:07:21 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:40 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

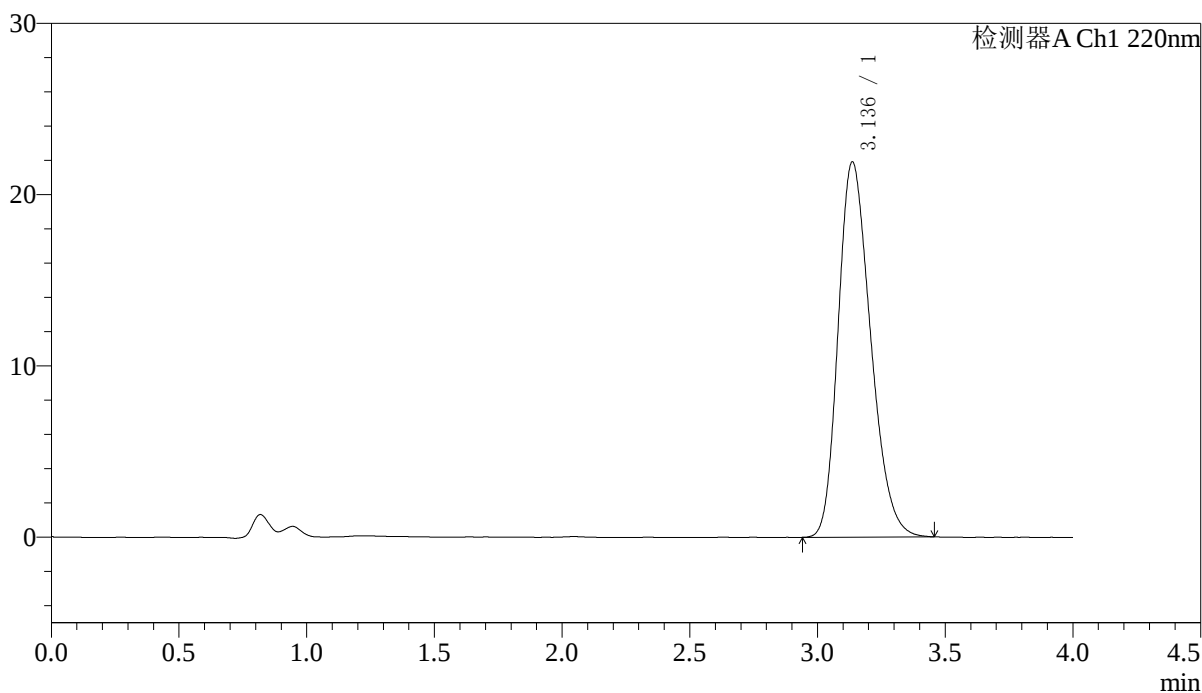

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	193687	100.000	21905	2905	1.257	--
总计		193687	100.000	21905			


图176 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1693-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:11:44 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:47 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

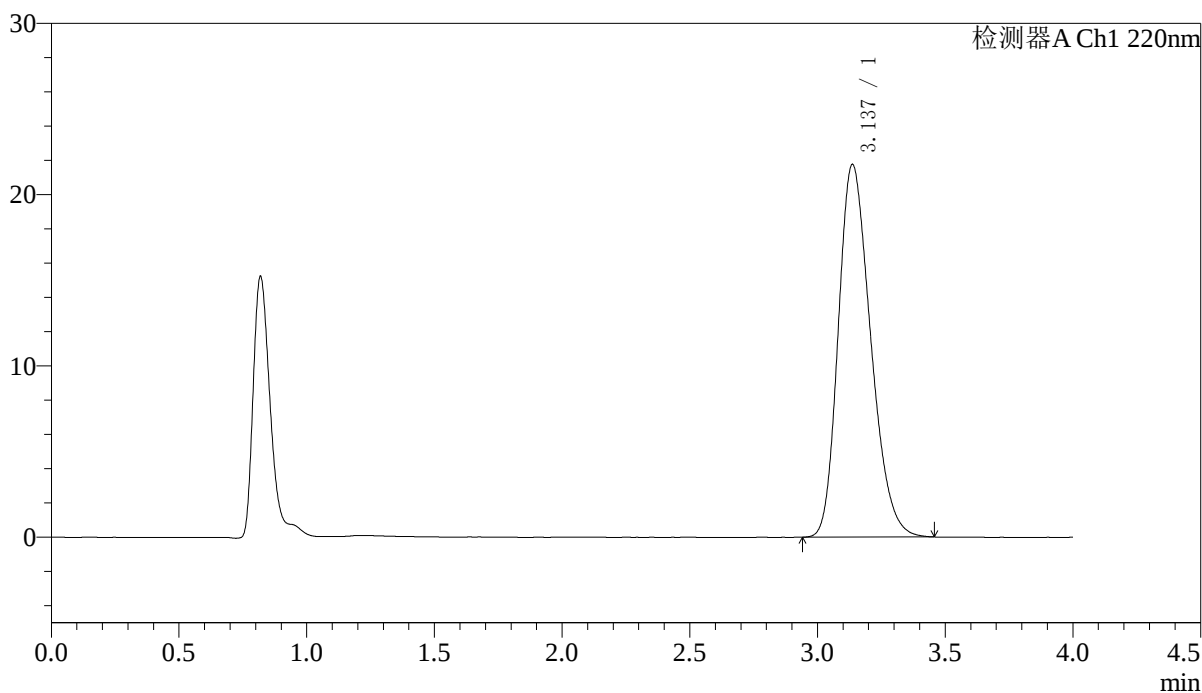

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	191962	100.000	21762	2918	1.256	--
总计		191962	100.000	21762			


图177 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1694-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:16:06 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:12:54 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

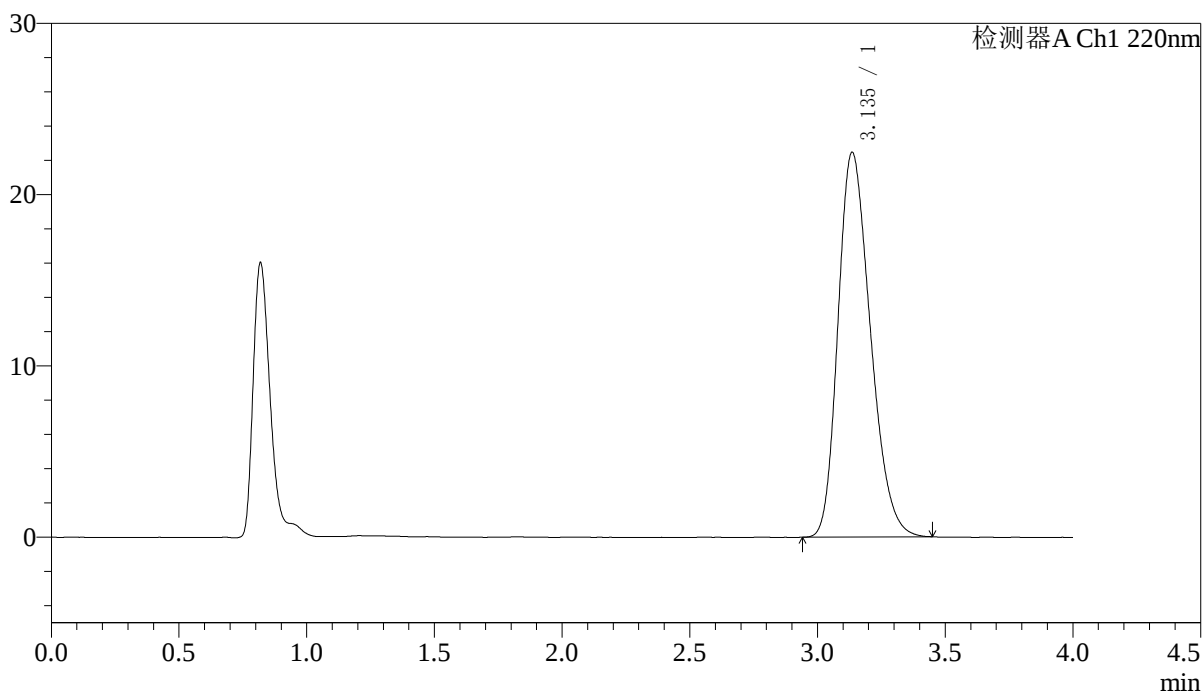

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	198208	100.000	22448	2911	1.260	--
总计		198208	100.000	22448			


图178 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1695-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:20:29 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:01 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

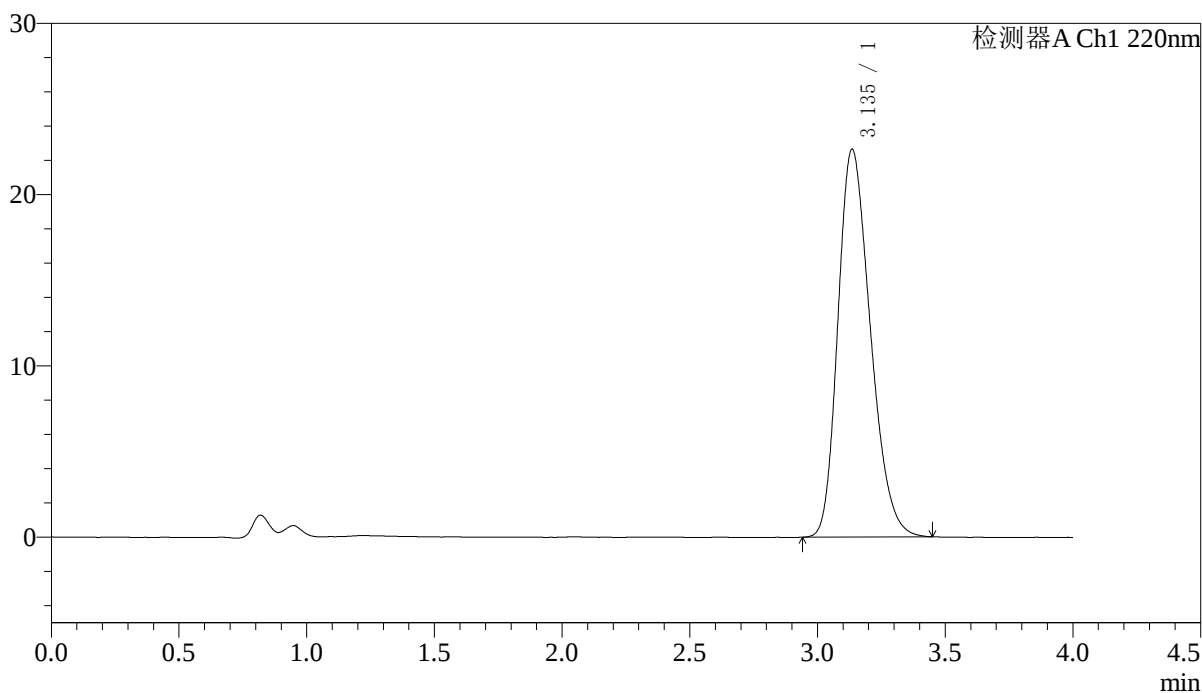

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	200087	100.000	22621	2903	1.260	--
总计		200087	100.000	22621			


图179 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1696-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:24:52 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:08 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

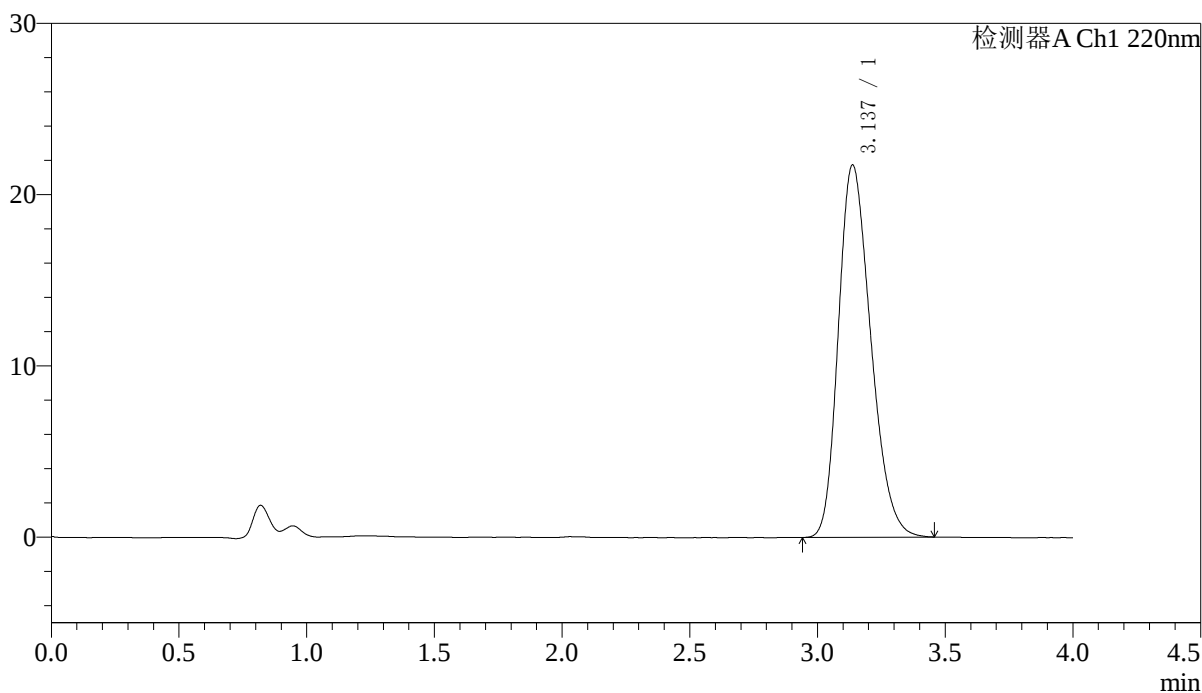

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	191857	100.000	21747	2921	1.256	--
总计		191857	100.000	21747			


图180 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1697-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:29:15 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:15 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

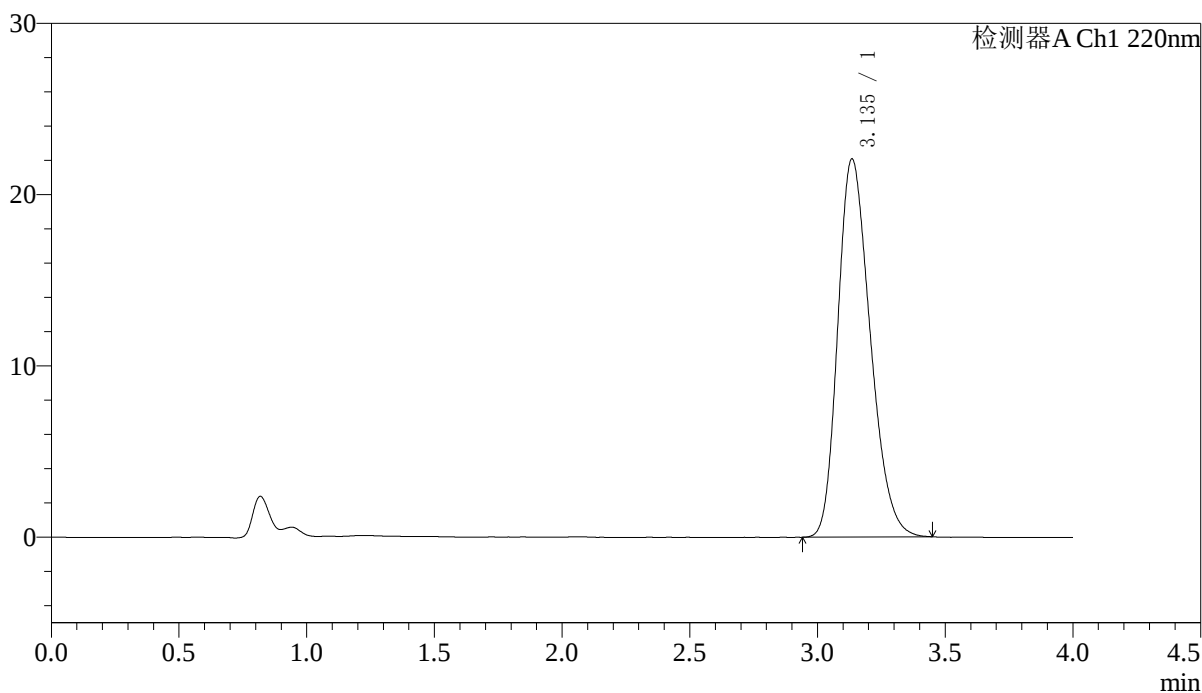

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	195079	100.000	22050	2908	1.258	--
总计		195079	100.000	22050			


图181 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1698-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:33:38 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:22 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

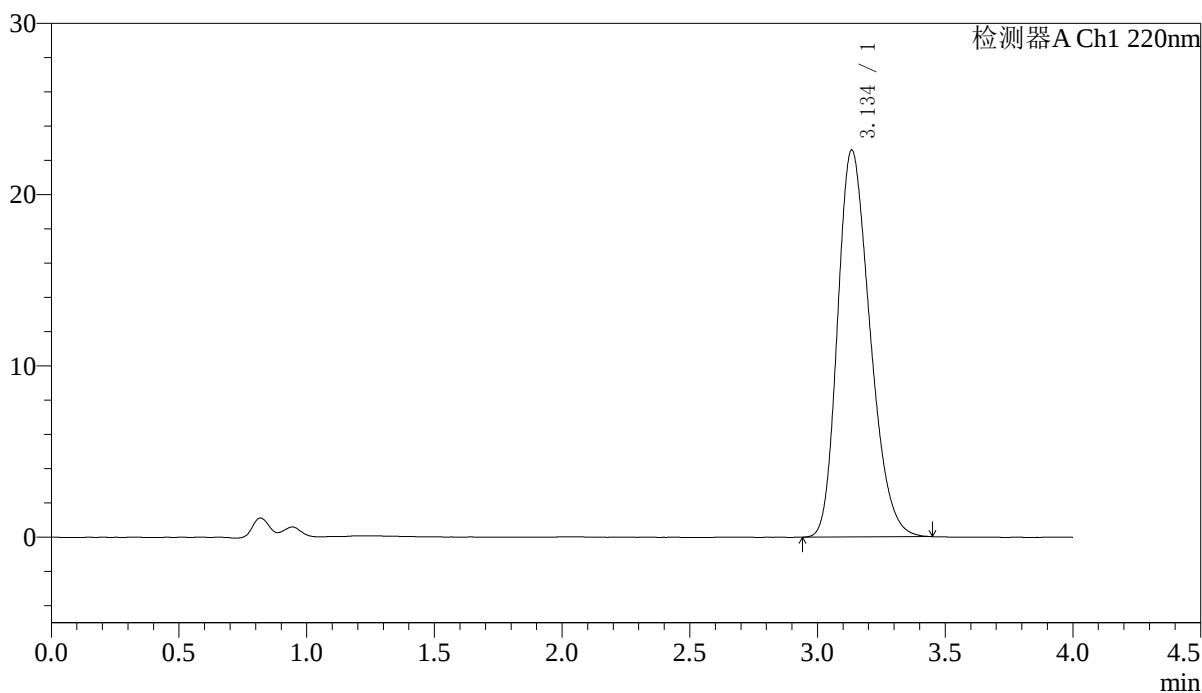

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	199598	100.000	22556	2908	1.261	--
总计		199598	100.000	22556			


图182 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1699-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:38:01 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:29 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

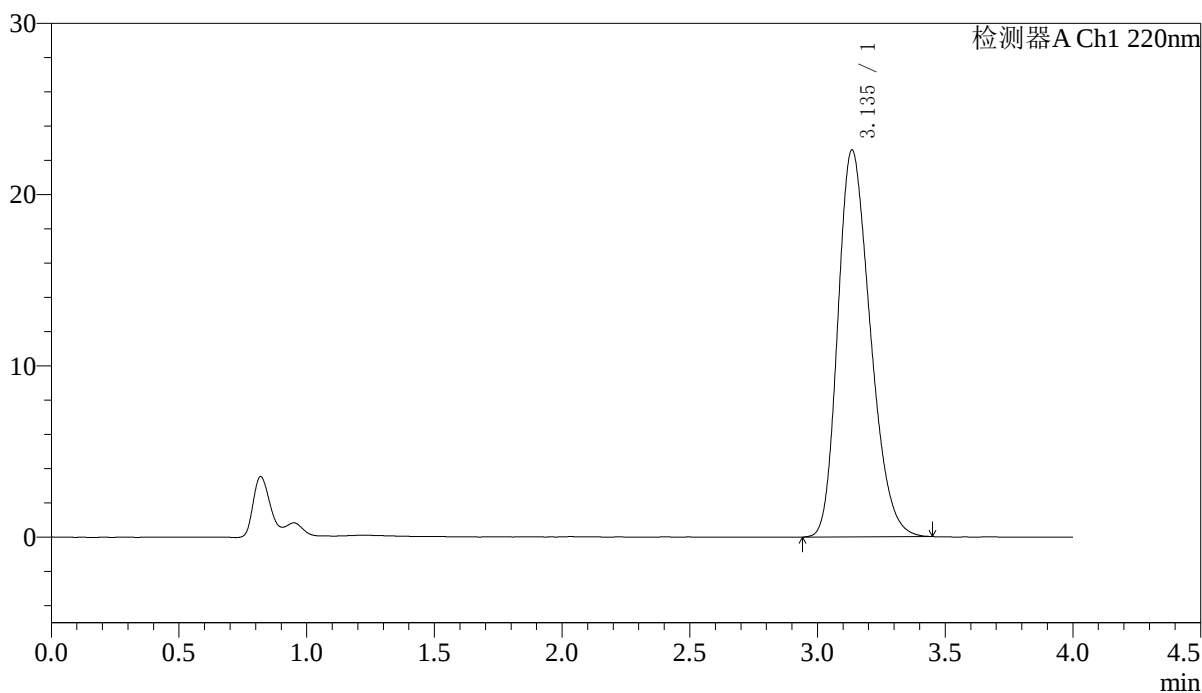

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	199755	100.000	22561	2898	1.259	--
总计		199755	100.000	22561			


图183 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1700-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:42:24 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:36 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

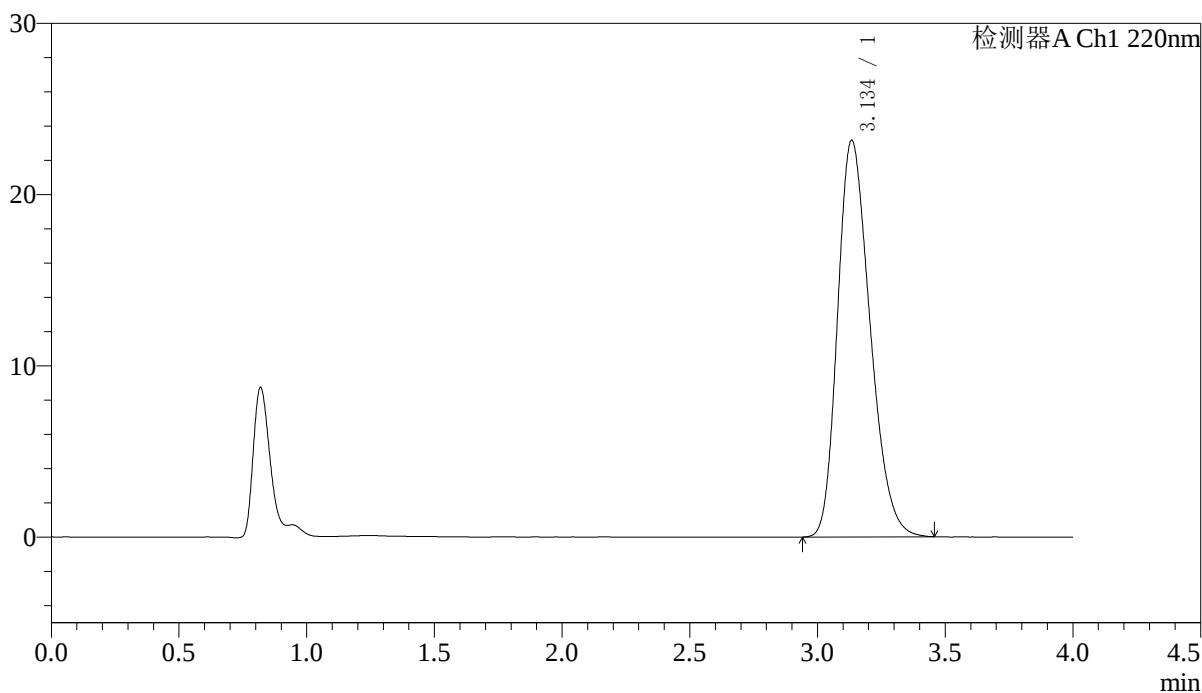

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	205001	100.000	23123	2896	1.265	--
总计		205001	100.000	23123			


图184 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1701-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:46:48 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:43 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

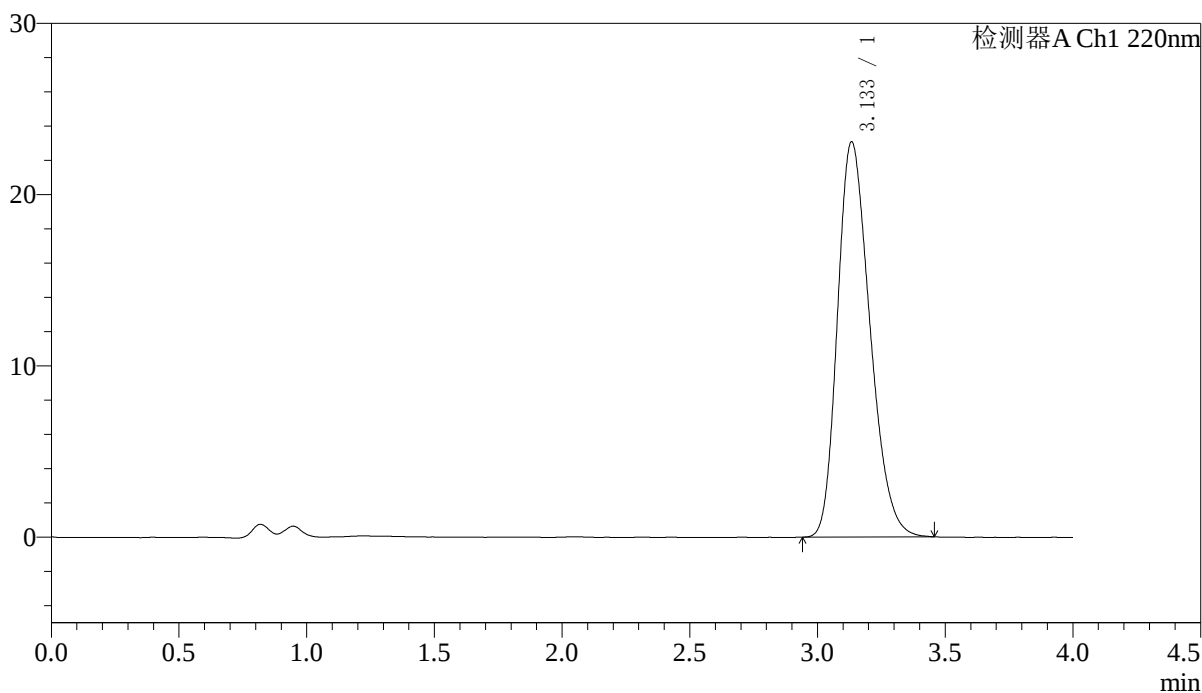

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	204059	100.000	23050	2896	1.265	--
总计		204059	100.000	23050			


图185 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1702-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:51:10 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:50 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

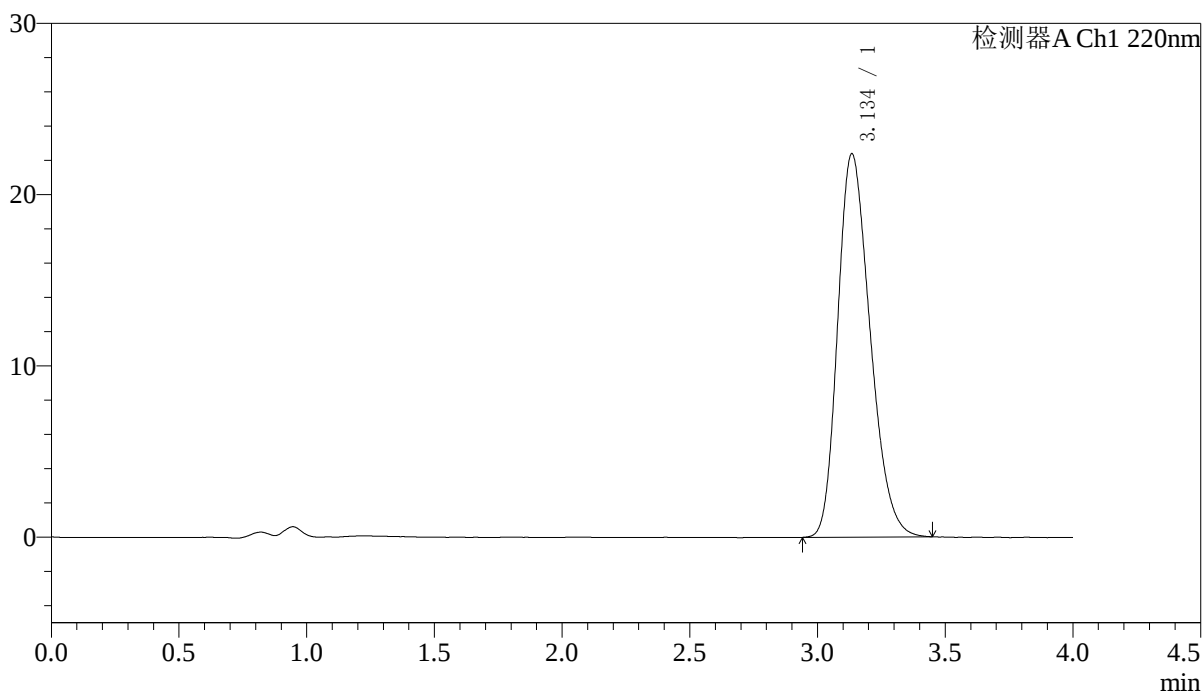

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	197632	100.000	22339	2905	1.260	--
总计		197632	100.000	22339			


图186 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1703-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:55:33 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:13:57 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

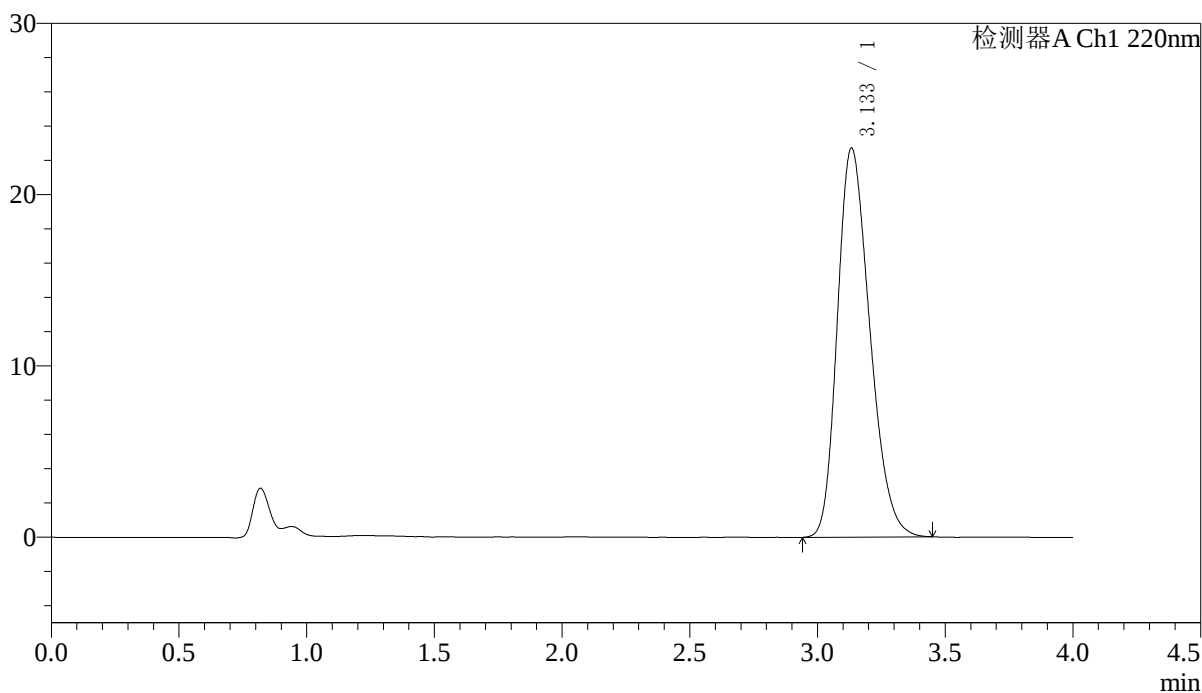

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	200796	100.000	22699	2903	1.260	--
总计		200796	100.000	22699			


图187 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1704-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 00:59:56 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:04 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

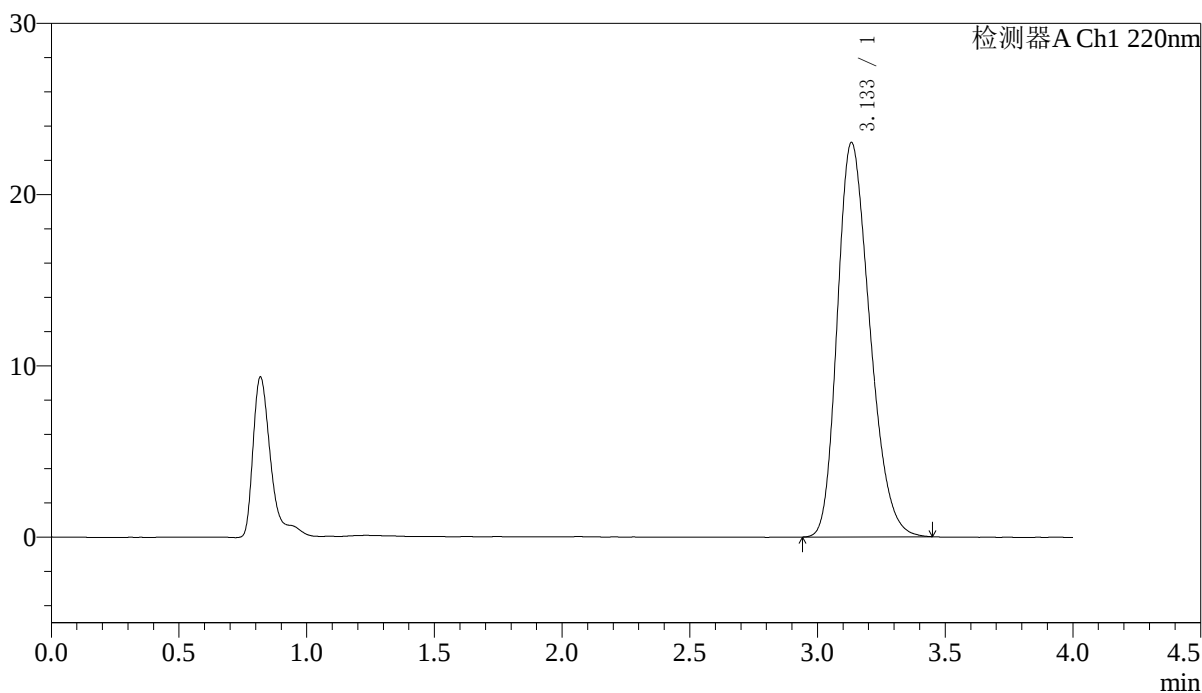

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	203605	100.000	23012	2897	1.263	--
总计		203605	100.000	23012			


图188 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1705-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:04:20 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:11 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

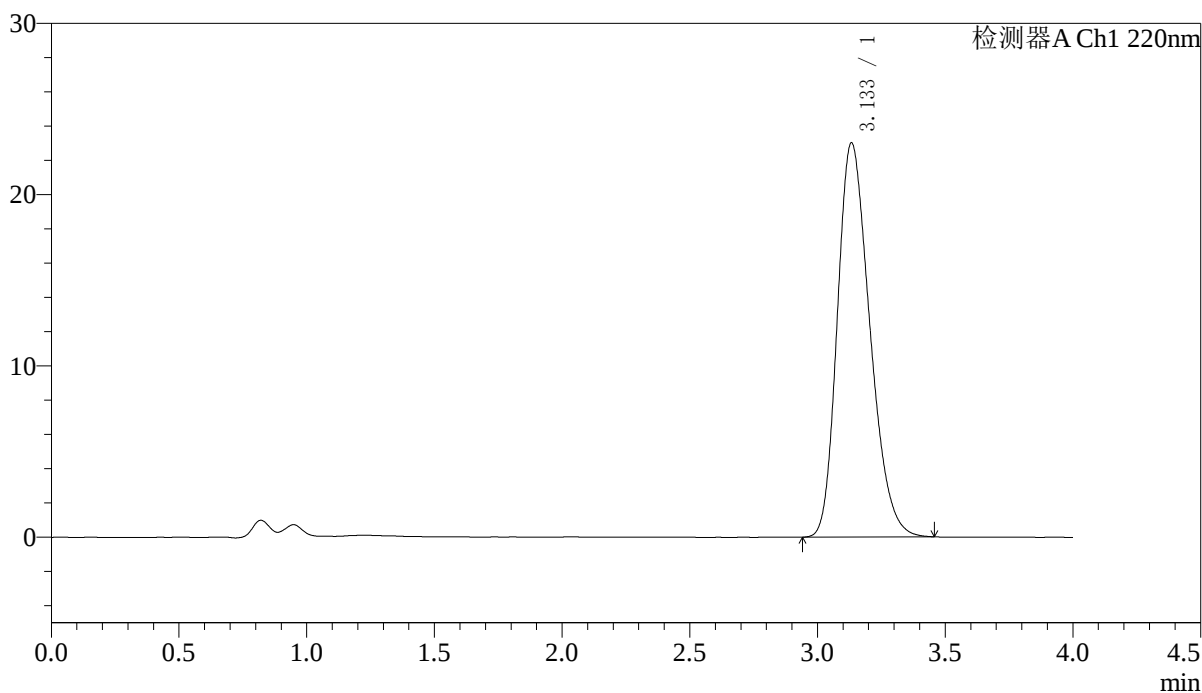

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	203698	100.000	23002	2893	1.265	--
总计		203698	100.000	23002			


图189 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1706-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:08:42 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:18 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

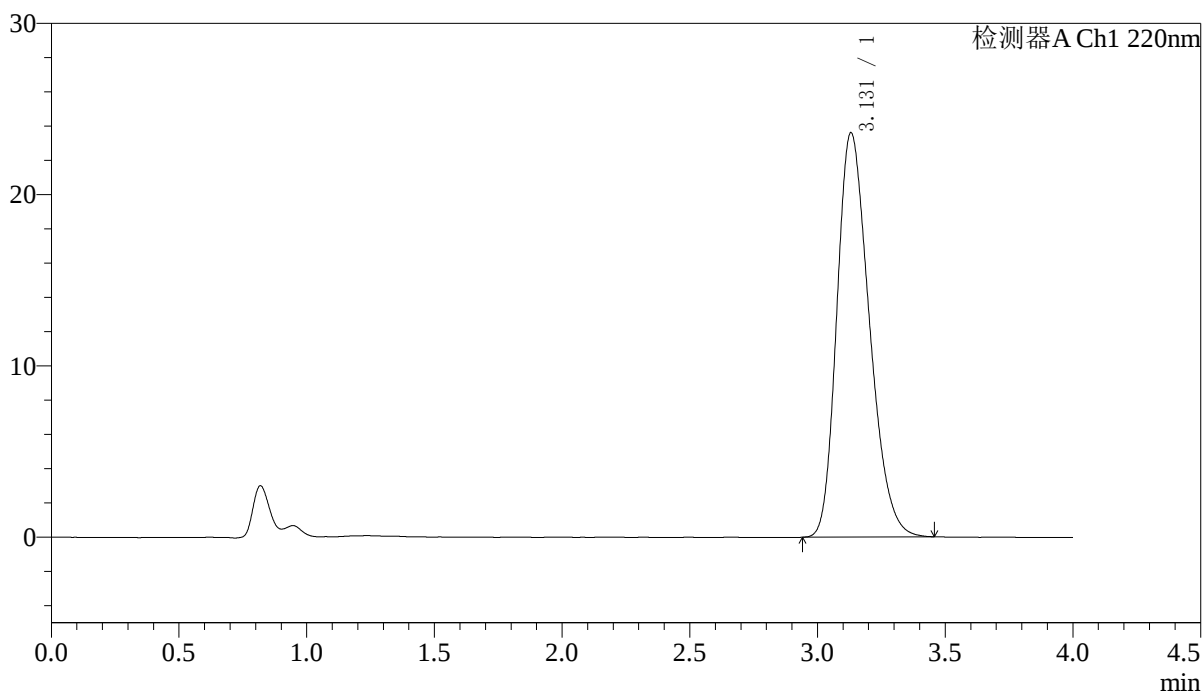

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	208904	100.000	23619	2886	1.270	--
总计		208904	100.000	23619			


图190 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1707-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:13:05 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:25 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

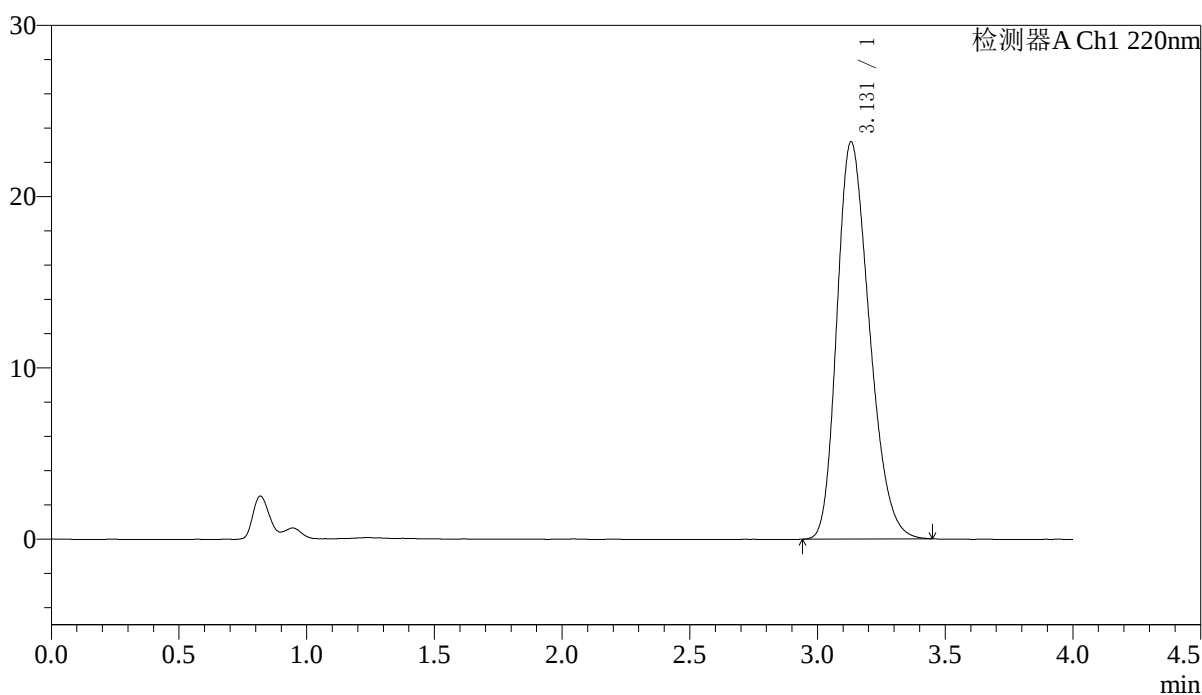

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	205089	100.000	23200	2890	1.265	--
总计		205089	100.000	23200			


图191 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1708-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:17:28 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:32 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

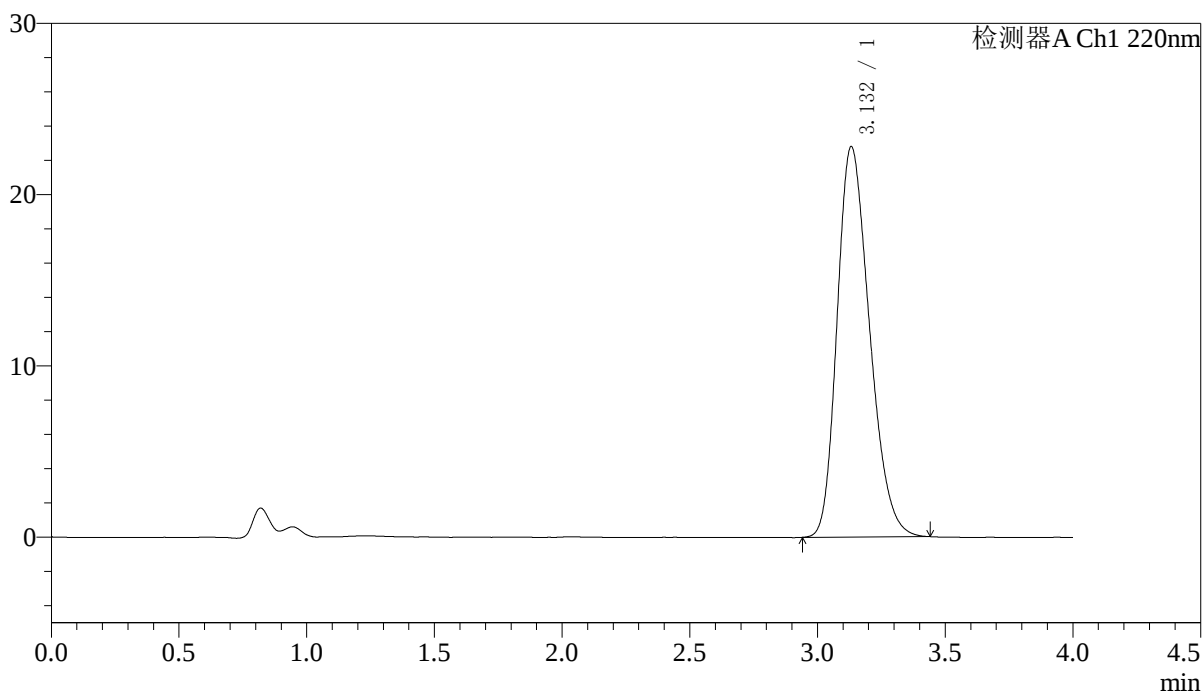

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	201200	100.000	22797	2903	1.259	--
总计		201200	100.000	22797			


图192 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1709-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:21:50 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:39 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

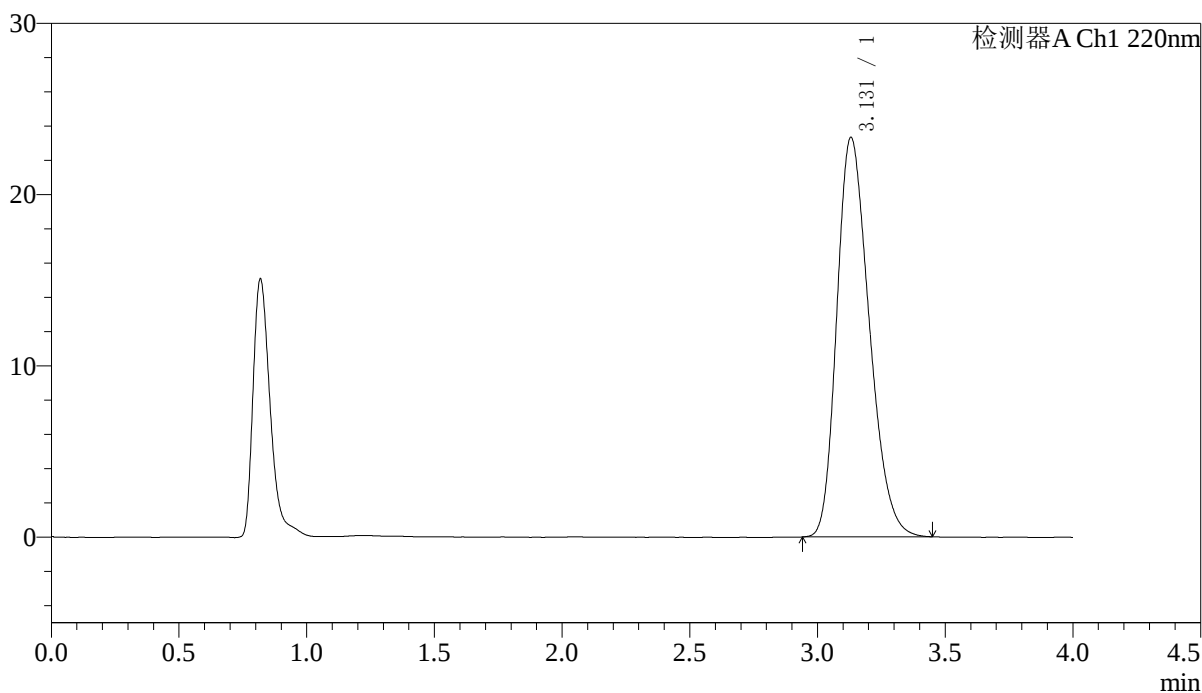

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	206107	100.000	23335	2888	1.265	--
总计		206107	100.000	23335			


图193 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1710-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:26:13 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:46 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

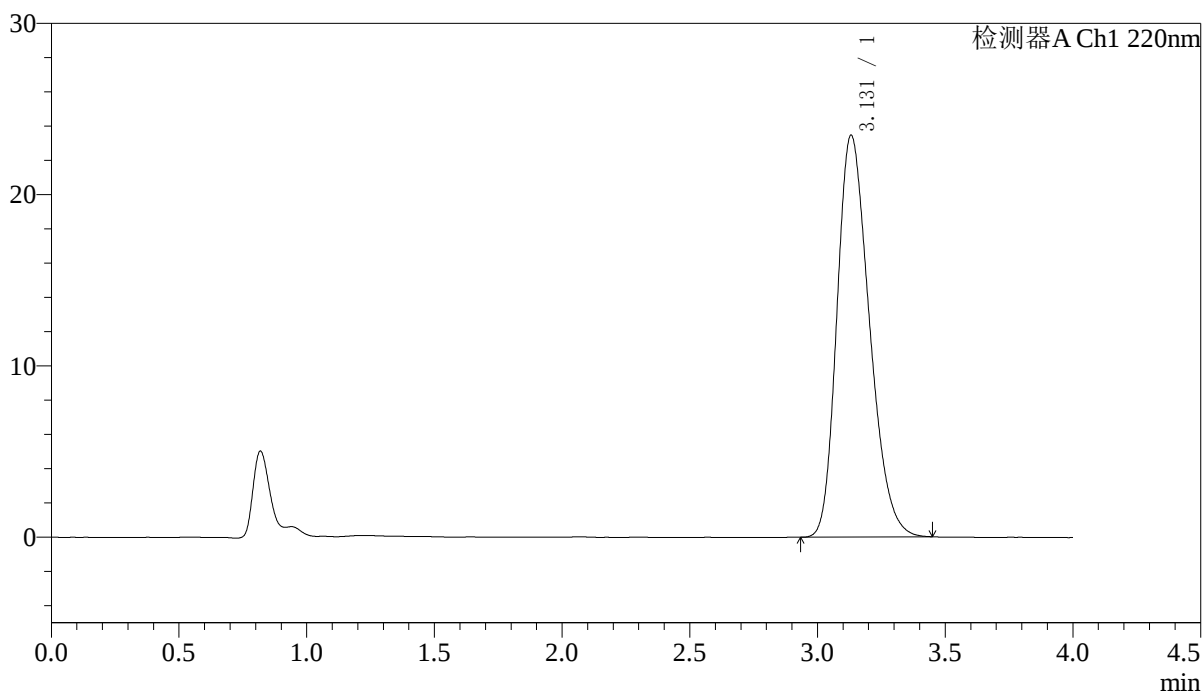

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	207583	100.000	23470	2891	1.265	--
总计		207583	100.000	23470			


图194 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1711-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:30:36 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:14:53 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

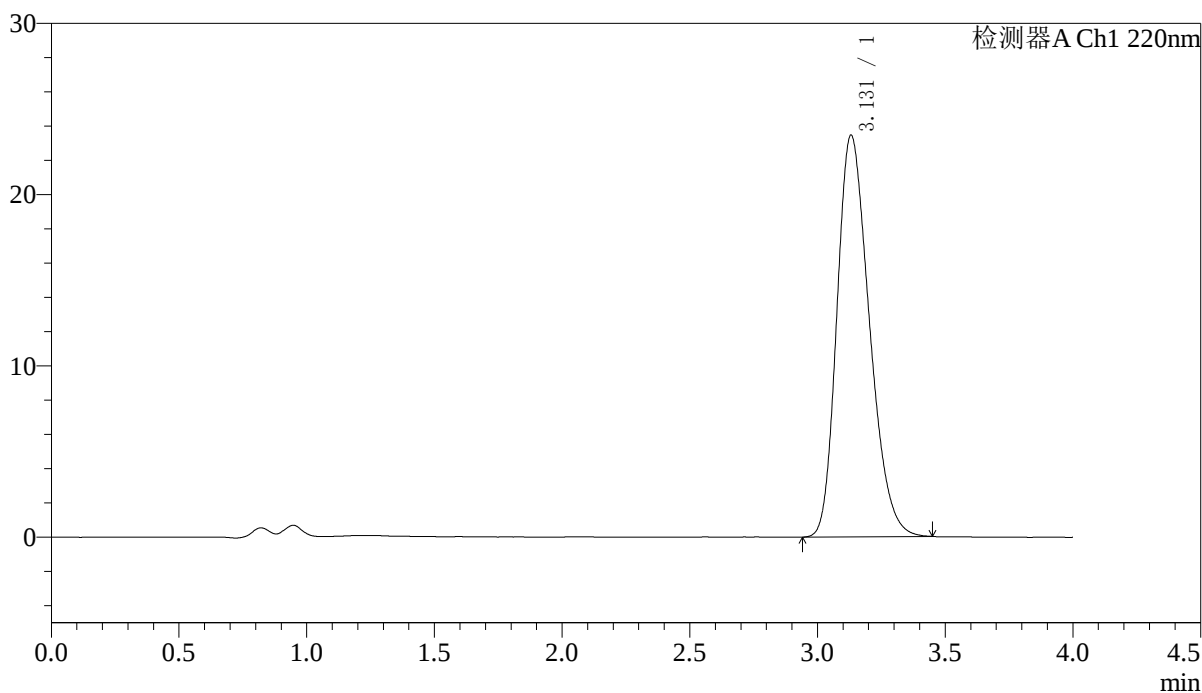

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	207324	100.000	23461	2893	1.265	--
总计		207324	100.000	23461			


图195 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1712-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:34:59 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:15:00 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

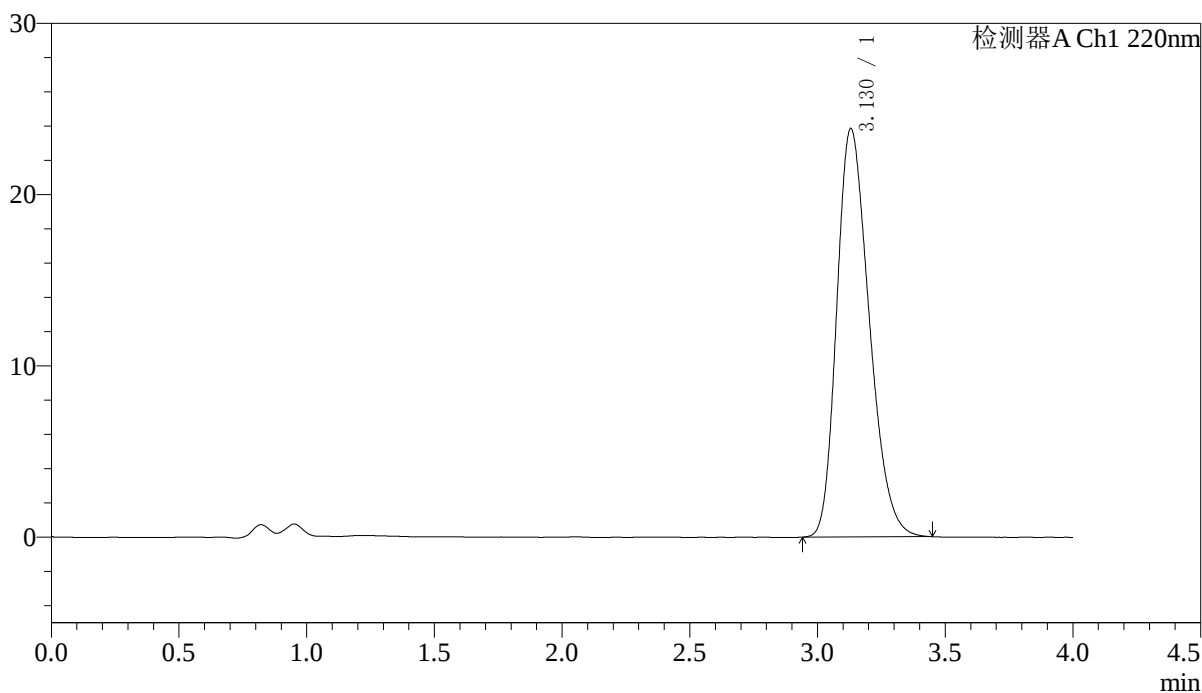

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	211169	100.000	23855	2879	1.270	--
总计		211169	100.000	23855			


图196 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1713-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:39:23 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:15:07 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

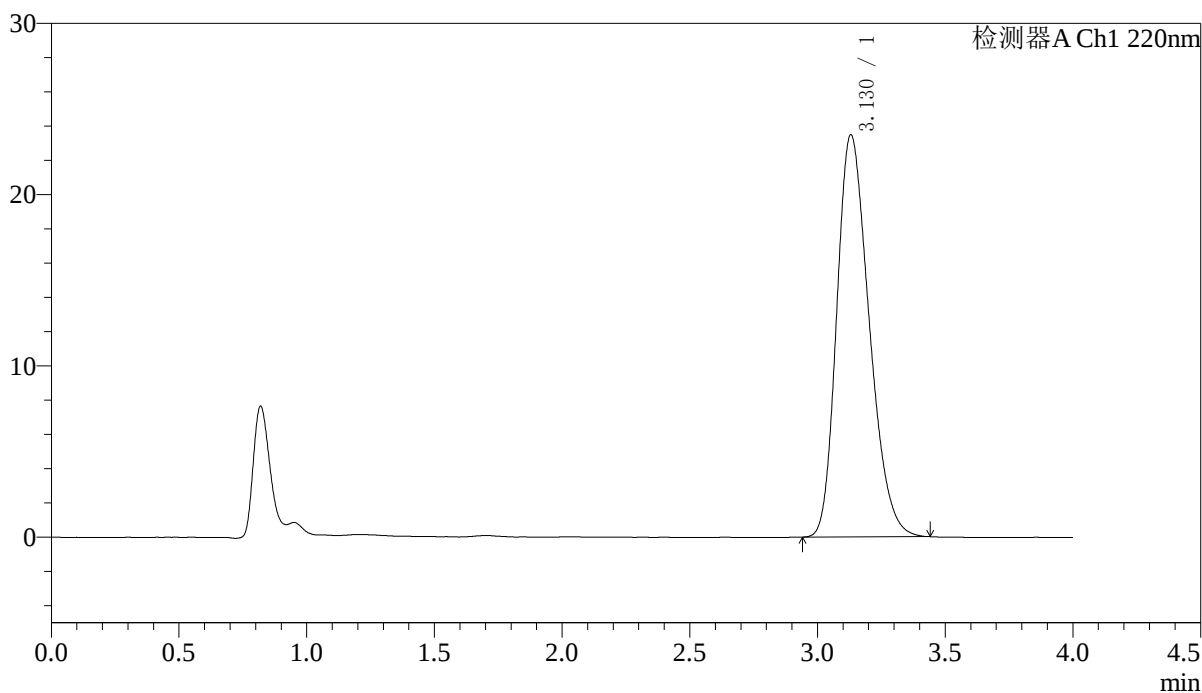

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	207419	100.000	23491	2893	1.265	--
总计		207419	100.000	23491			


图197 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1714-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:43:45 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:15:14 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV

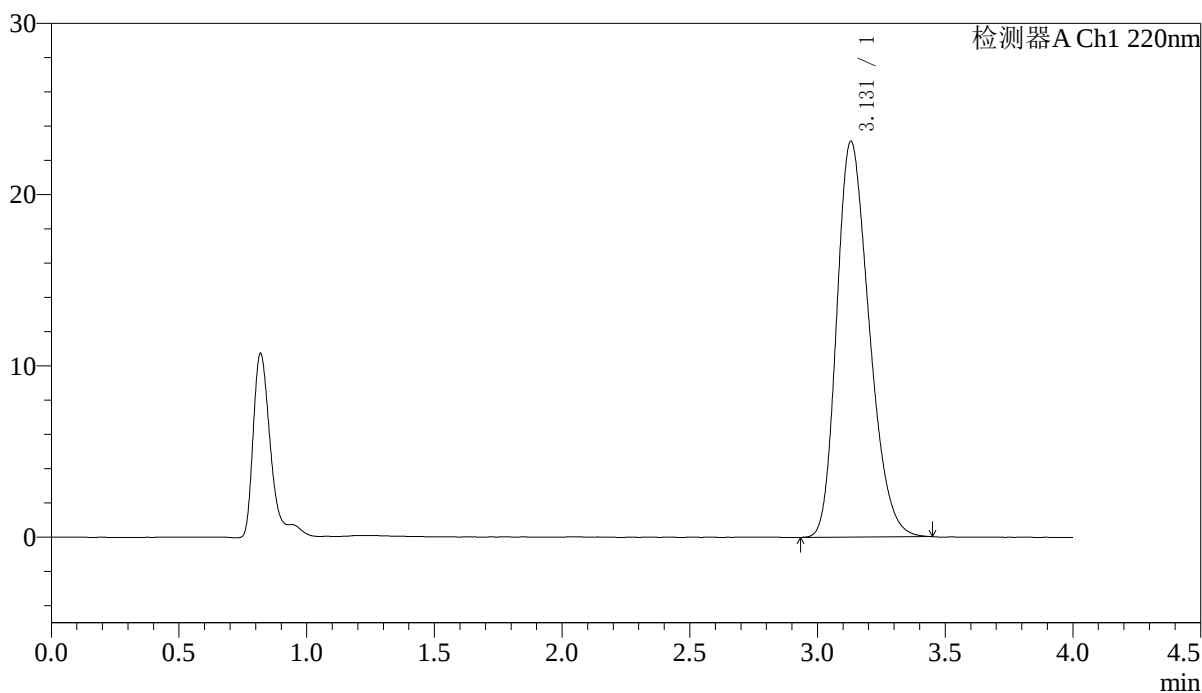

<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	204324	100.000	23126	2891	1.262	--
总计		204324	100.000	23126			


图198 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1715-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:48:08 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:15:21 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

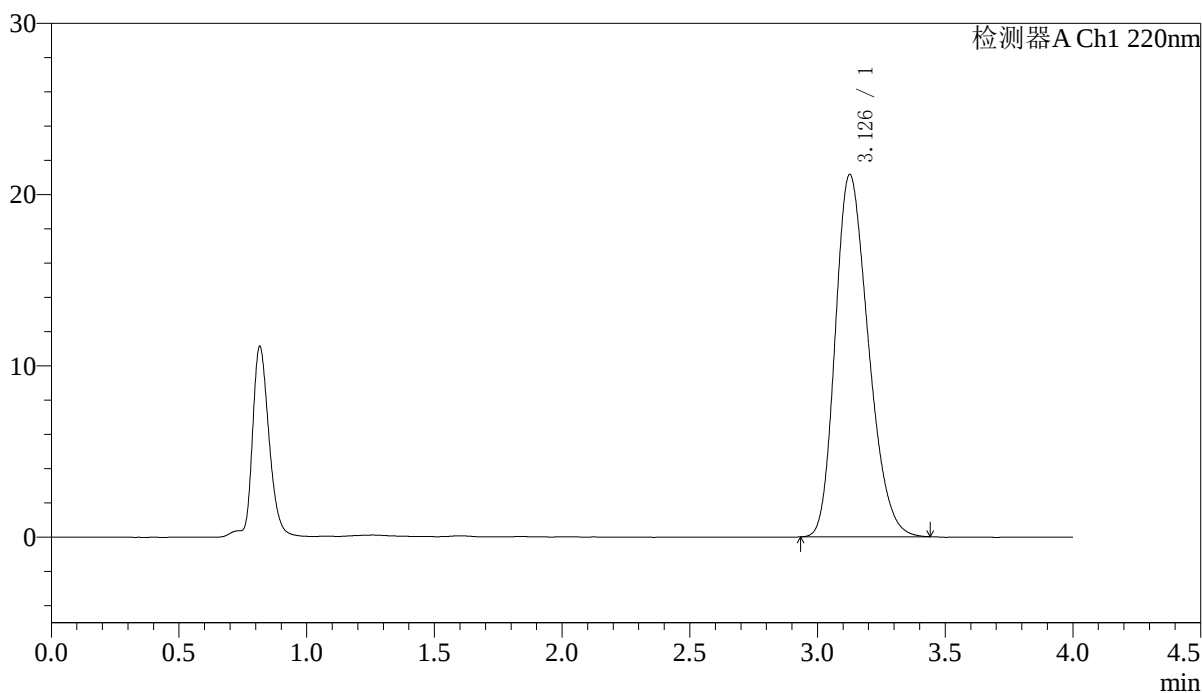

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	190661	100.000	21124	2775	1.253	--
总计		190661	100.000	21124			


图199 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-70/31-1716-2 - cb-U028516p-zjtj24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/29 01:52:32 分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 09:15:28 处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

〈色谱图〉

mV

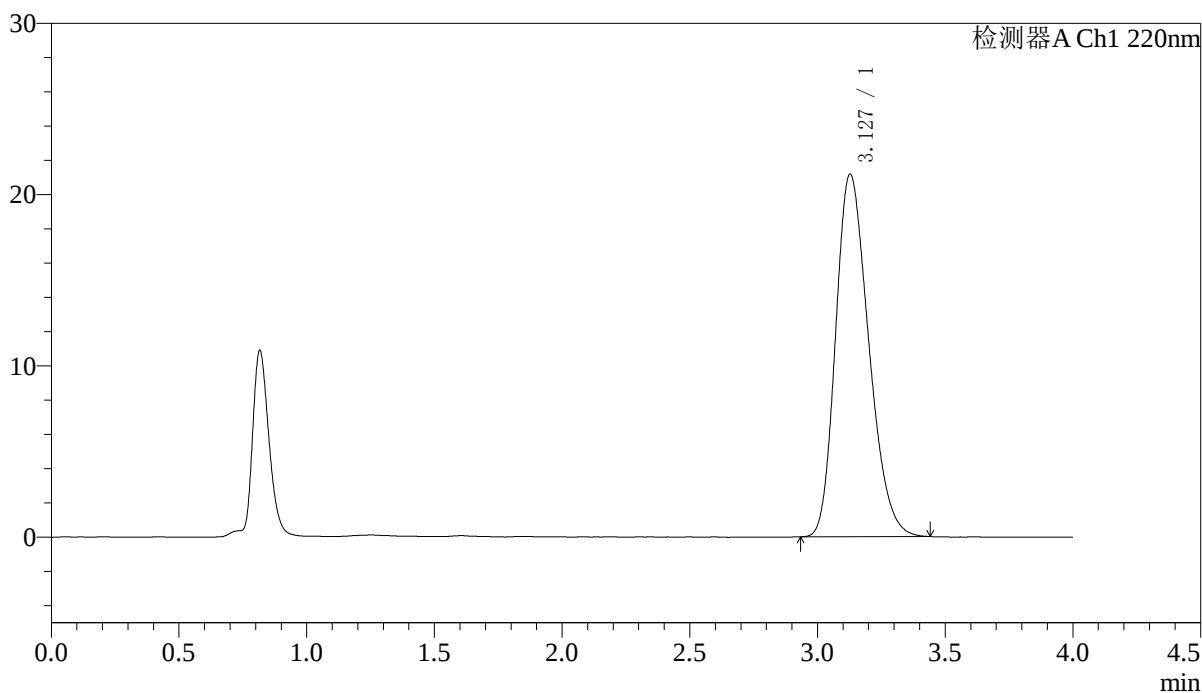

〈峰表〉

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	190770	100.000	21157	2769	1.254	--
总计		190770	100.000	21157			

图200 磷酸西格列汀片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2