



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.53	106064	106026	106005	105856	105982	105987	0.08
2	10.55	105865	105929				105897	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
10065.24	10037.63	0.20	数据可信

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

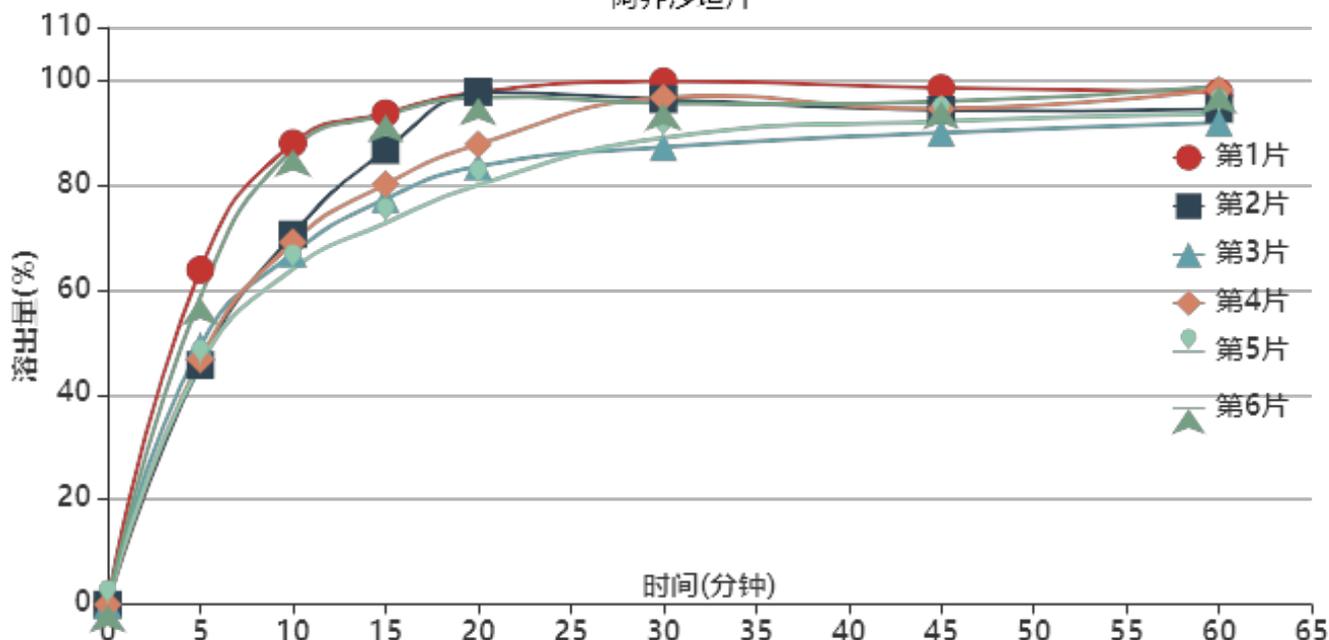

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



长期6月-供试品溶液-2023111721批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	71471	-	71471	63.803	51.62	14.89	63.80	51.62	14.90
	2	51118	-	51118	45.634			45.63		
	3	55197	-	55197	49.275			49.27		
	4	52346	-	52346	46.730			46.73		
	5	51260	-	51260	45.760			45.76		
	6	65528	-	65528	58.497			58.50		
10min	1	98093	-	98093	87.569	73.90	14.10	87.92	74.18	14.09
	2	78722	-	78722	70.276			70.53		
	3	74632	-	74632	66.625			66.90		
	4	77038	-	77038	68.773			69.03		
	5	71315	-	71315	63.664			63.92		
	6	96868	-	96868	86.475			86.80		
15min	1	103932	-	103932	92.781	83.24	10.30	93.62	83.93	10.32
	2	96291	-	96291	85.960			86.60		
	3	85861	-	85861	76.649			77.29		
	4	88987	-	88987	79.440			80.08		
	5	80740	-	80740	72.077			72.69		
	6	103634	-	103634	92.515			93.32		
20min	1	107916	-	107916	96.338	89.36	8.66	97.69	90.52	8.68
	2	108172	-	108172	96.566			97.69		
	3	92329	-	92329	82.423			83.49		
	4	97022	-	97022	86.613			87.70		
	5	88456	-	88456	78.966			79.97		
	6	106713	-	106713	95.264			96.58		
30min	1	109567	-	109567	97.812	92.38	5.15	99.70	94.04	5.20
	2	105978	-	105978	94.608			96.27		
	3	95910	-	95910	85.620			87.15		
	4	106467	-	106467	95.044			96.61		
	5	98022	-	98022	87.505			88.95		
	6	104945	-	104945	93.685			95.53		
45min	1	107519	-	107519	95.983	91.97	3.03	98.42	94.14	3.15
	2	103093	-	103093	92.032			94.22		
	3	98426	-	98426	87.866			89.87		
	4	103478	-	103478	92.376			94.47		
	5	100970	-	100970	90.137			92.07		
	6	104673	-	104673	93.443			95.81		
60min	1	106040	-	106040	94.663	93.02	2.89	97.63	95.70	2.97
	2	102749	-	102749	91.725			94.42		
	3	100033	-	100033	89.300			91.79		
	4	106956	-	106956	95.481			98.09		
	5	102028	-	102028	91.081			93.52		
	6	107367	-	107367	95.848			98.74		
极限	1	109248	-	109248	97.527	96.06	1.26	101.02	99.26	1.32
	2	108407	-	108407	96.776			99.98		
	3	105491	-	105491	94.173			97.16		
	4	107847	-	107847	96.276			99.41		
	5	108063	-	108063	96.469			99.41		
	6	106559	-	106559	95.126			98.55		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.53	106132	106006	106177	105896	106028	106048	0.11
2	10.55	106537	106594				106566	0.04
单位质量响应值			RSD%		判断			
10071.04		10101.04		0.22		数据可信		

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

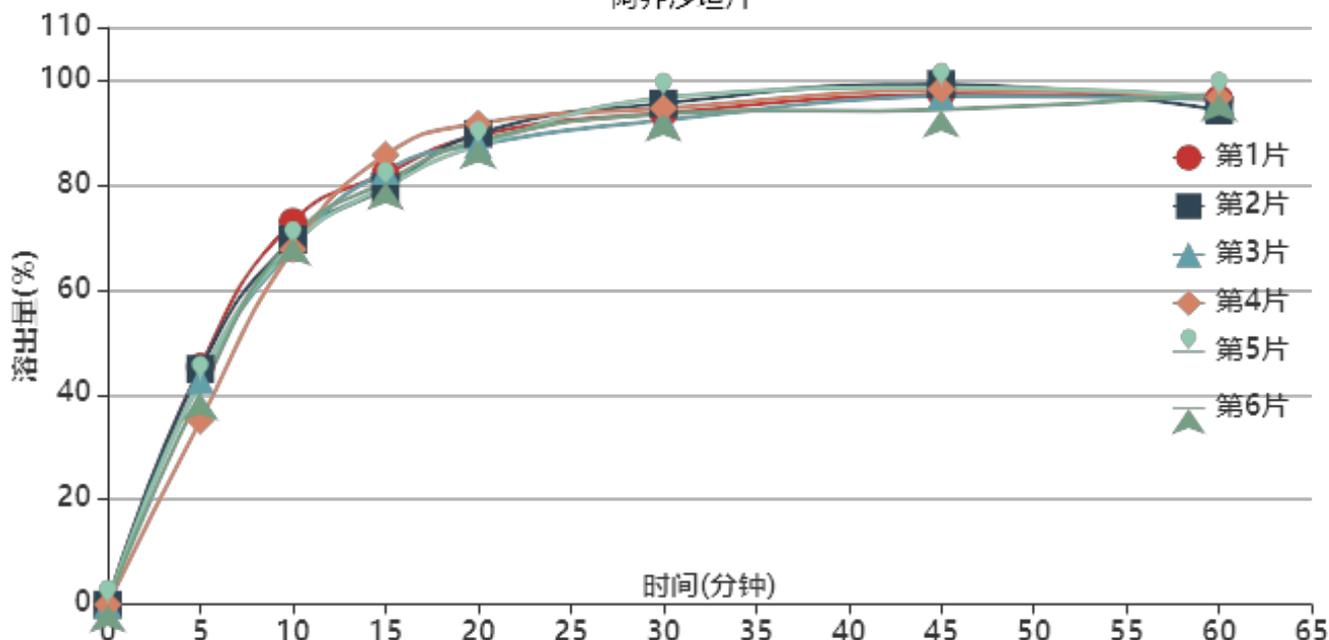

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



长期6月-供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	50907	-	50907	45.289	41.82	9.03	45.29	41.82	9.03
	2	50448	-	50448	44.881			44.88		
	3	48026	-	48026	42.726			42.73		
	4	39384	-	39384	35.038			35.04		
	5	47974	-	47974	42.680			42.68		
	6	45309	-	45309	40.309			40.31		
10min	1	81688	-	81688	72.674	69.17	2.78	72.93	69.41	2.79
	2	77907	-	77907	69.310			69.56		
	3	76198	-	76198	67.789			68.03		
	4	75818	-	75818	67.451			67.65		
	5	76598	-	76598	68.145			68.38		
	6	78318	-	78318	69.675			69.90		
15min	1	91476	-	91476	81.381	81.04	2.93	82.04	81.66	2.89
	2	88536	-	88536	78.766			79.40		
	3	92239	-	92239	82.060			82.67		
	4	95651	-	95651	85.096			85.67		
	5	88798	-	88798	78.999			79.61		
	6	89872	-	89872	79.954			80.57		
20min	1	99206	-	99206	88.258	87.96	1.79	89.37	89.03	1.77
	2	99617	-	99617	88.624			89.70		
	3	97266	-	97266	86.532			87.60		
	4	101853	-	101853	90.613			91.66		
	5	97158	-	97158	86.436			87.49		
	6	98124	-	98124	87.296			88.35		
30min	1	103436	-	103436	92.022	92.80	1.69	93.62	94.36	1.66
	2	105585	-	105585	93.933			95.50		
	3	102014	-	102014	90.757			92.31		
	4	104532	-	104532	92.997			94.54		
	5	106940	-	106940	95.139			96.67		
	6	103356	-	103356	91.950			93.49		
45min	1	106988	-	106988	95.182	95.33	1.82	97.29	97.40	1.79
	2	109131	-	109131	97.088			99.17		
	3	106637	-	106637	94.869			96.92		
	4	108037	-	108037	96.115			98.18		
	5	108467	-	108467	96.497			98.56		
	6	103660	-	103660	92.221			94.27		
60min	1	105352	-	105352	93.726	93.64	1.16	96.36	96.24	1.11
	2	102942	-	102942	91.582			94.21		
	3	105233	-	105233	93.620			96.20		
	4	105656	-	105656	93.997			96.59		
	5	105902	-	105902	94.215			96.81		
	6	106450	-	106450	94.703			97.27		
极限	1	107264	-	107264	95.427	93.93	1.17	98.59	97.06	1.15
	2	106222	-	106222	94.500			97.63		
	3	104034	-	104034	92.554			95.66		
	4	105798	-	105798	94.123			97.24		
	5	104252	-	104252	92.748			95.87		
	6	105947	-	105947	94.255			97.34		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.53	105892	105948	105815	105879	105856	105878	0.05
2	10.55	105950	106005				105978	0.04
单位质量响应值			RSD%		判断			
10054.89		10045.31		0.07		数据可信		

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

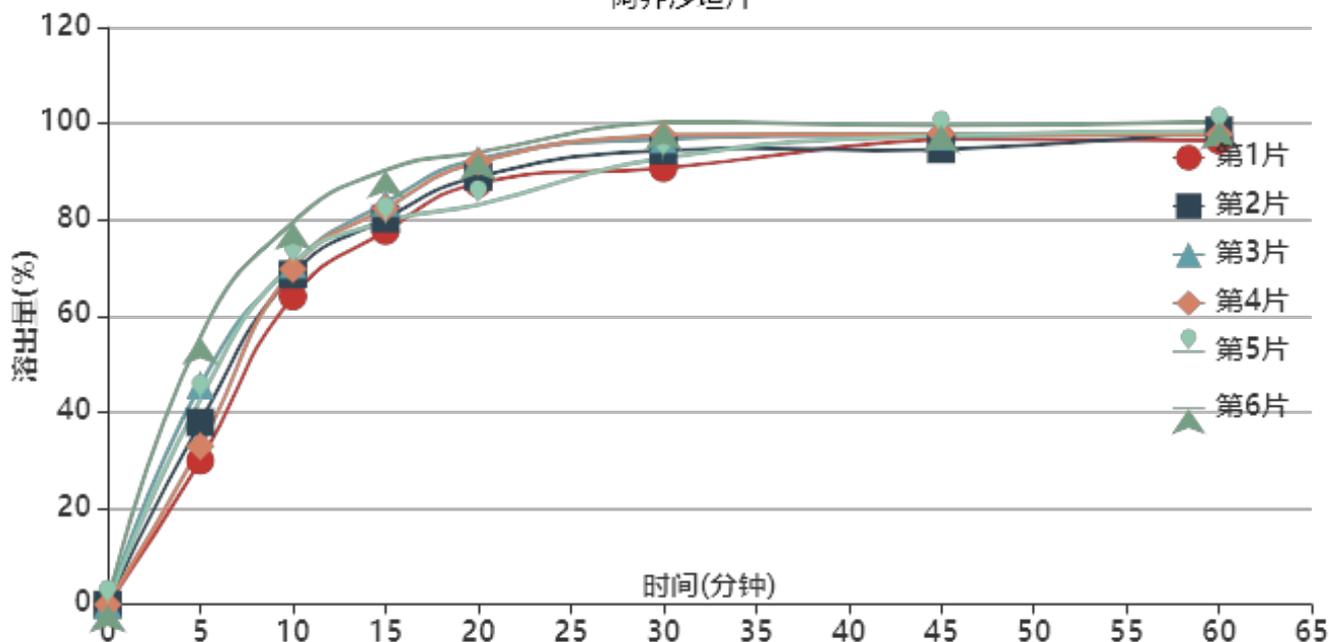

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



长期6月-供试品溶液-2023111921批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	33493	-	33493	29.903	40.77	22.93	29.90	40.77	22.93
	2	42418	-	42418	37.872			37.87		
	3	51074	-	51074	45.600			45.60		
	4	36848	-	36848	32.899			32.90		
	5	47826	-	47826	42.700			42.70		
	6	62323	-	62323	55.644			55.64		
10min	1	71528	-	71528	63.862	70.34	7.09	64.03	70.57	7.14
	2	76666	-	76666	68.449			68.66		
	3	78900	-	78900	70.444			70.70		
	4	77907	-	77907	69.557			69.74		
	5	79029	-	79029	70.559			70.80		
	6	88685	-	88685	79.180			79.49		
15min	1	86364	-	86364	77.108	81.64	5.37	77.63	82.26	5.41
	2	89226	-	89226	79.663			80.25		
	3	92836	-	92836	82.887			83.53		
	4	91593	-	91593	81.777			82.35		
	5	88361	-	88361	78.891			79.52		
	6	100272	-	100272	89.526			90.27		
20min	1	96966	-	96966	86.574	88.61	4.48	87.52	89.68	4.49
	2	98474	-	98474	87.920			88.95		
	3	102453	-	102453	91.473			92.58		
	4	101849	-	101849	90.934			91.96		
	5	91873	-	91873	82.027			83.09		
	6	103887	-	103887	92.753			94.00		
30min	1	99978	-	99978	89.263	93.87	3.60	90.69	95.43	3.64
	2	104047	-	104047	92.896			94.42		
	3	106565	-	106565	95.144			96.76		
	4	107585	-	107585	96.055			97.58		
	5	102261	-	102261	91.301			92.82		
	6	110360	-	110360	98.532			100.29		
45min	1	106205	-	106205	94.823	95.19	1.62	96.75	97.27	1.67
	2	103682	-	103682	92.570			94.61		
	3	106617	-	106617	95.191			97.33		
	4	107203	-	107203	95.714			97.78		
	5	106990	-	106990	95.524			97.55		
	6	108978	-	108978	97.299			99.61		
60min	1	105313	-	105313	94.026	95.67	1.21	96.48	98.28	1.30
	2	107505	-	107505	95.983			98.54		
	3	106984	-	106984	95.518			98.19		
	4	106563	-	106563	95.142			97.74		
	5	107282	-	107282	95.784			98.35		
	6	109257	-	109257	97.548			100.40		
极限	1	105782	-	105782	94.445	95.34	1.15	97.42	98.49	1.13
	2	109111	-	109111	97.417			100.50		
	3	106768	-	106768	95.325			98.53		
	4	106649	-	106649	95.219			98.34		
	5	105791	-	105791	94.453			97.55		
	6	106635	-	106635	95.207			98.60		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.53	105471	105555	105531	105490	105457	105501	0.04
2	10.55	105604	105782				105693	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
10019.09		10018.29		0.01	数据可信			

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

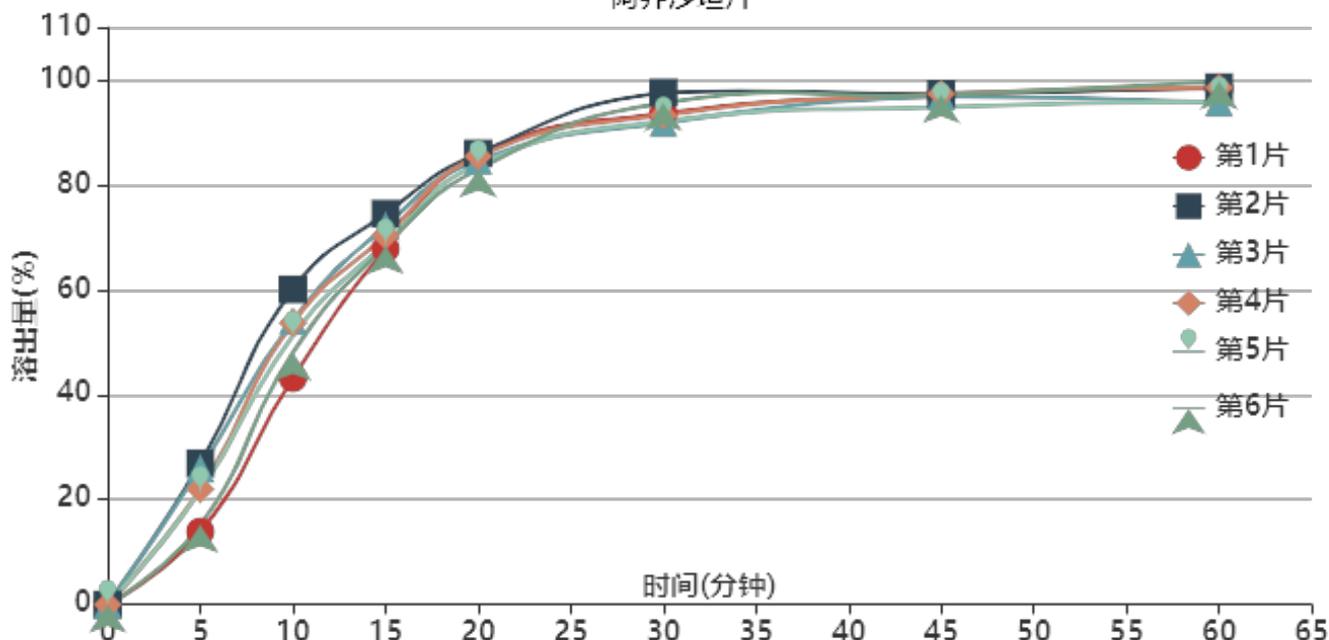

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本



长期6月-供试品溶液批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	15513	-	15513	13.894	20.91	25.77	13.89	20.91	25.76
	2	30058	-	30058	26.921			26.92		
	3	28934	-	28934	25.914			25.91		
	4	24536	-	24536	21.975			21.98		
	5	24135	-	24135	21.616			21.62		
	6	16923	-	16923	15.157			15.16		
10min	1	48077	-	48077	43.059	51.57	11.13	43.14	51.69	11.16
	2	66877	-	66877	59.897			60.05		
	3	60195	-	60195	53.912			54.06		
	4	59761	-	59761	53.524			53.65		
	5	57032	-	57032	51.079			51.20		
	6	53537	-	53537	47.949			48.03		
15min	1	75340	-	75340	67.476	69.89	3.62	67.79	70.29	3.68
	2	82618	-	82618	73.995			74.48		
	3	80033	-	80033	71.680			72.12		
	4	78016	-	78016	69.873			70.29		
	5	76376	-	76376	68.404			68.81		
	6	75836	-	75836	67.921			68.27		
20min	1	94645	-	94645	84.767	83.91	1.35	85.46	84.70	1.37
	2	94995	-	94995	85.080			85.97		
	3	93543	-	93543	83.780			84.62		
	4	94489	-	94489	84.627			85.43		
	5	92709	-	92709	83.033			83.82		
	6	91763	-	91763	82.185			82.91		
30min	1	103202	-	103202	92.430	92.72	2.38	93.59	93.97	2.37
	2	107415	-	107415	96.204			97.57		
	3	101010	-	101010	90.467			91.77		
	4	102680	-	102680	91.963			93.24		
	5	101408	-	101408	90.824			92.07		
	6	105406	-	105406	94.404			95.59		
45min	1	106423	-	106423	95.315	94.96	1.00	96.99	96.74	1.00
	2	106569	-	106569	95.446			97.35		
	3	106094	-	106094	95.021			96.83		
	4	106676	-	106676	95.542			97.33		
	5	103916	-	103916	93.070			94.82		
	6	106501	-	106501	95.385			97.09		
60min	1	107353	-	107353	96.148	95.47	1.73	98.35	97.77	1.68
	2	107375	-	107375	96.168			98.60		
	3	104183	-	104183	93.309			95.65		
	4	107392	-	107392	96.183			98.50		
	5	104500	-	104500	93.593			95.86		
	6	108801	-	108801	97.445			99.68		
极限	1	106999	-	106999	95.831	95.91	1.41	98.57	98.74	1.43
	2	110043	-	110043	98.557			101.52		
	3	106098	-	106098	95.024			97.88		
	4	105997	-	105997	94.934			97.79		
	5	106980	-	106980	95.814			98.60		
	6	106407	-	106407	95.301			98.08		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-06-06

复核者:

未审阅版本




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3283-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:15:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:27:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

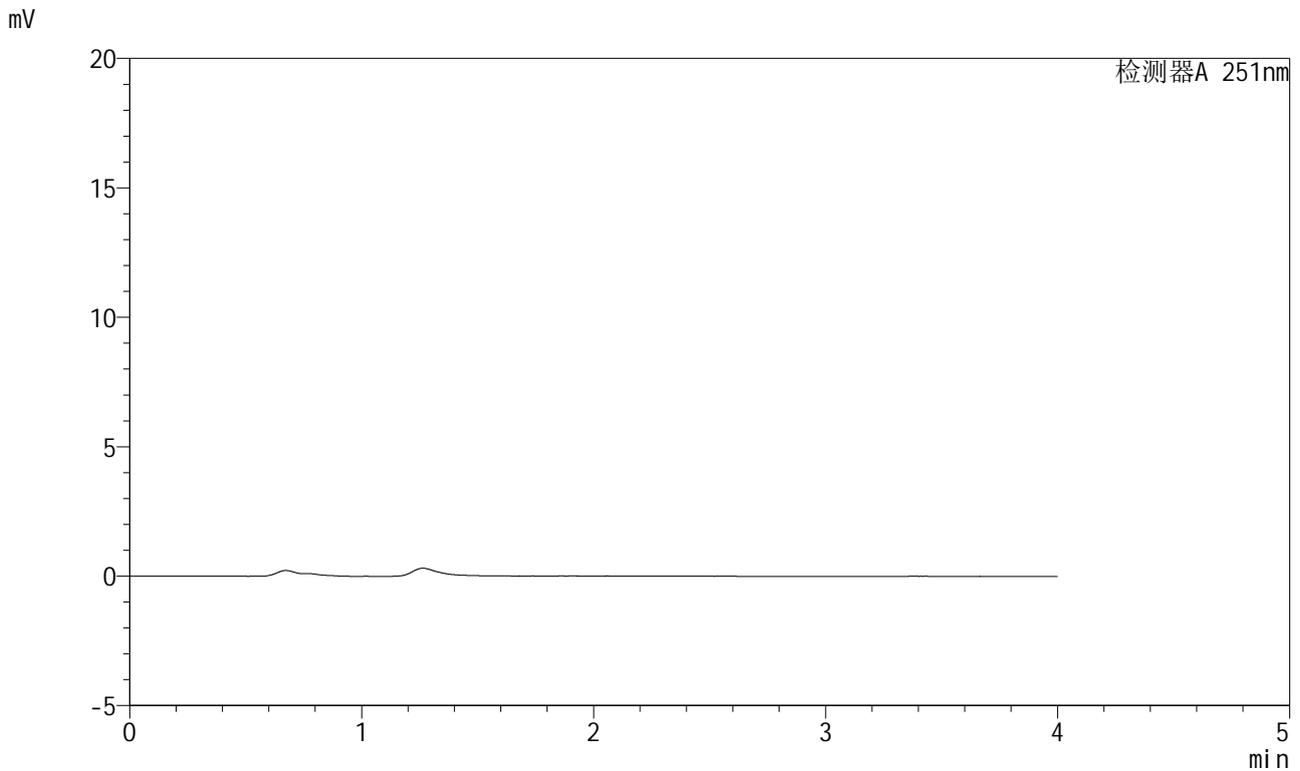

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3284-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:19:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:27:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

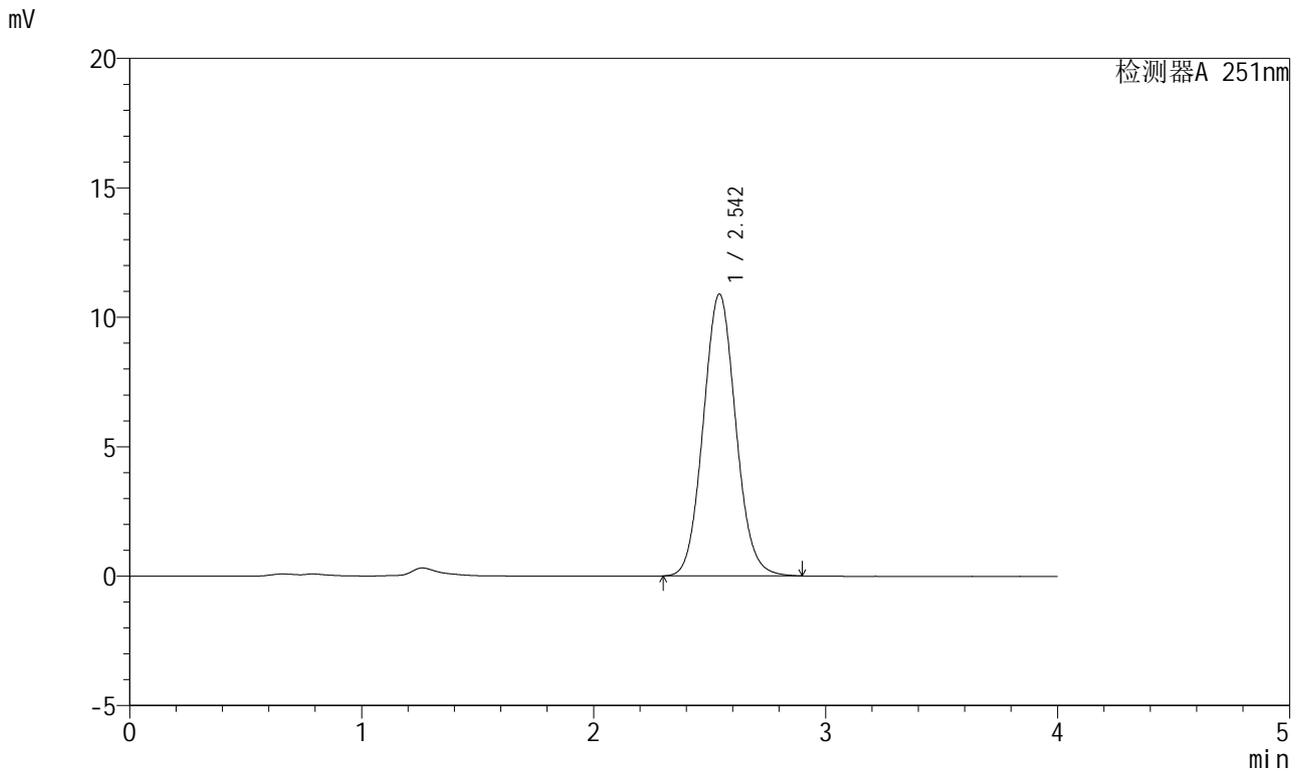

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	106064	100.000	10872	1586	1.074	--
总计		106064	100.000	10872			

图2 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3285-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:24:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

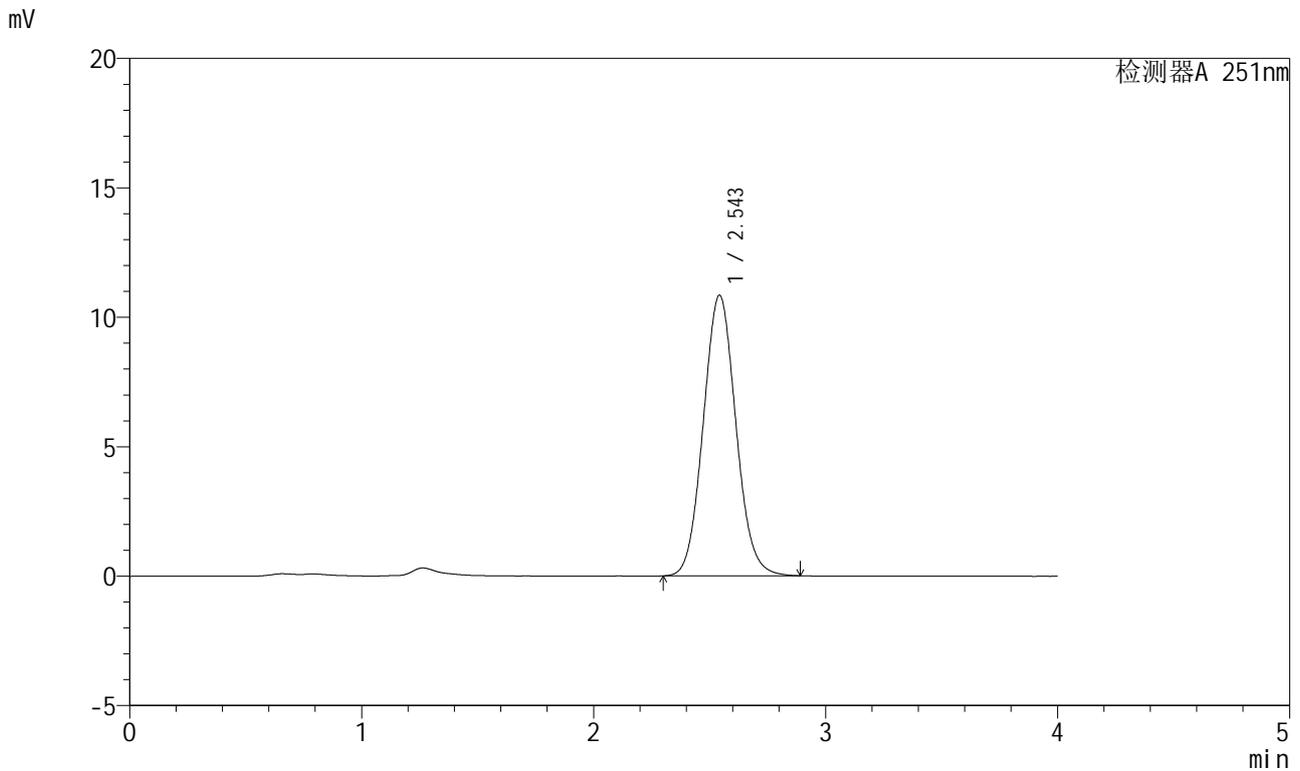

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	106026	100.000	10823	1570	1.073	--
总计		106026	100.000	10823			

图3 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3286-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:28:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

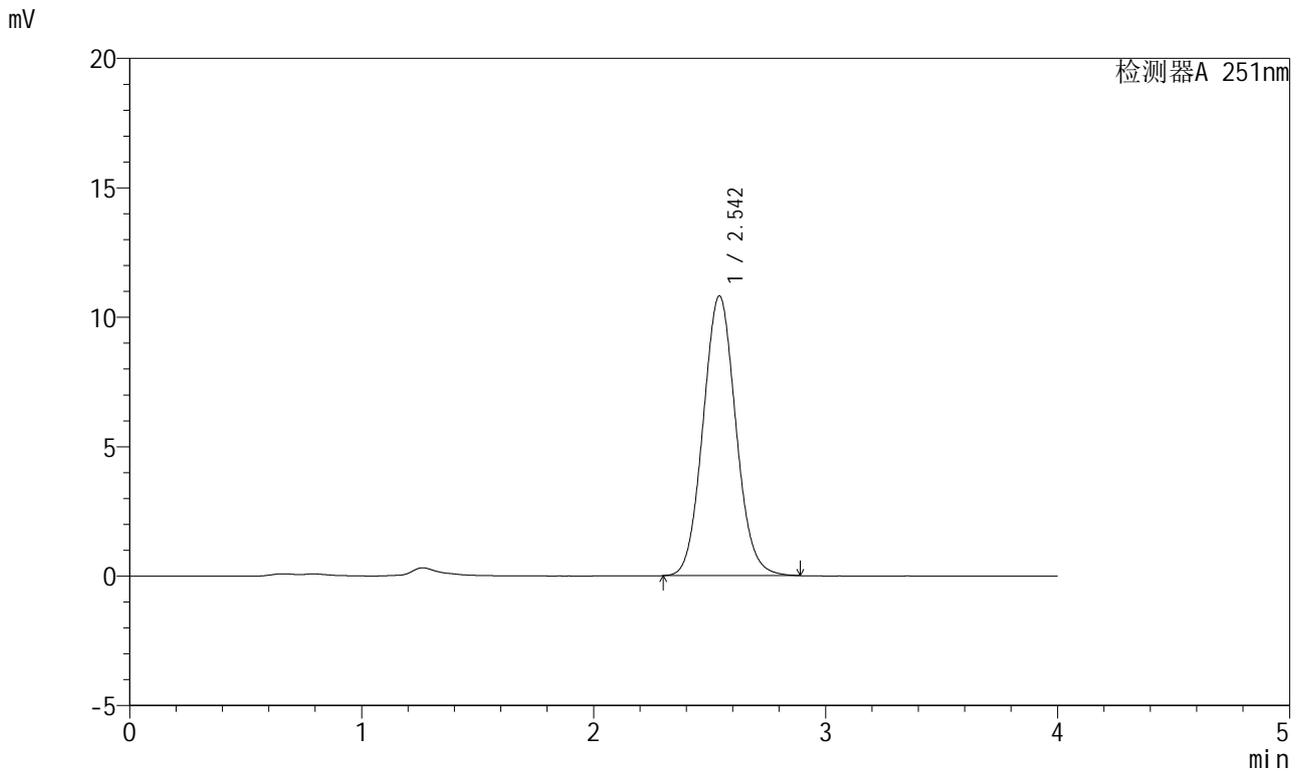

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	106005	100.000	10788	1560	1.071	--
总计		106005	100.000	10788			

图4 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3287-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:32:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

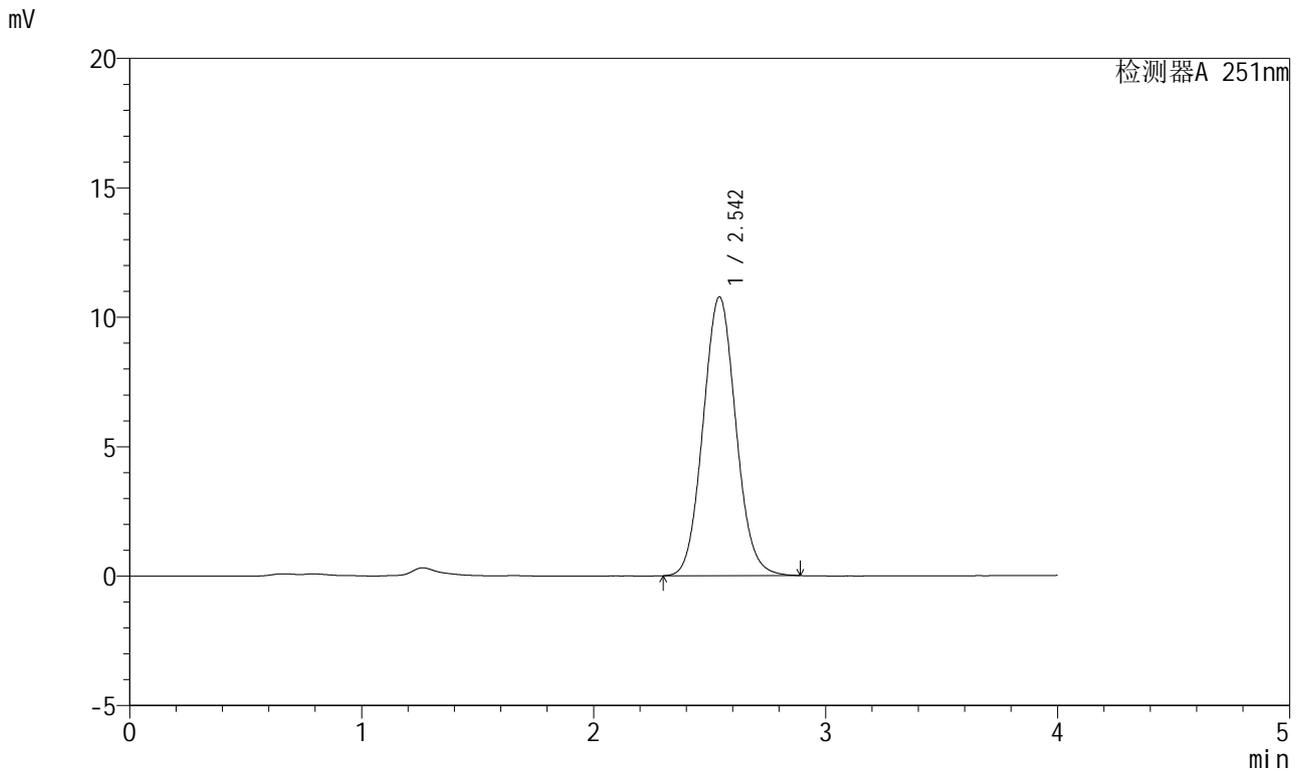

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105856	100.000	10749	1554	1.071	--
总计		105856	100.000	10749			

图5 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3288-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:37:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

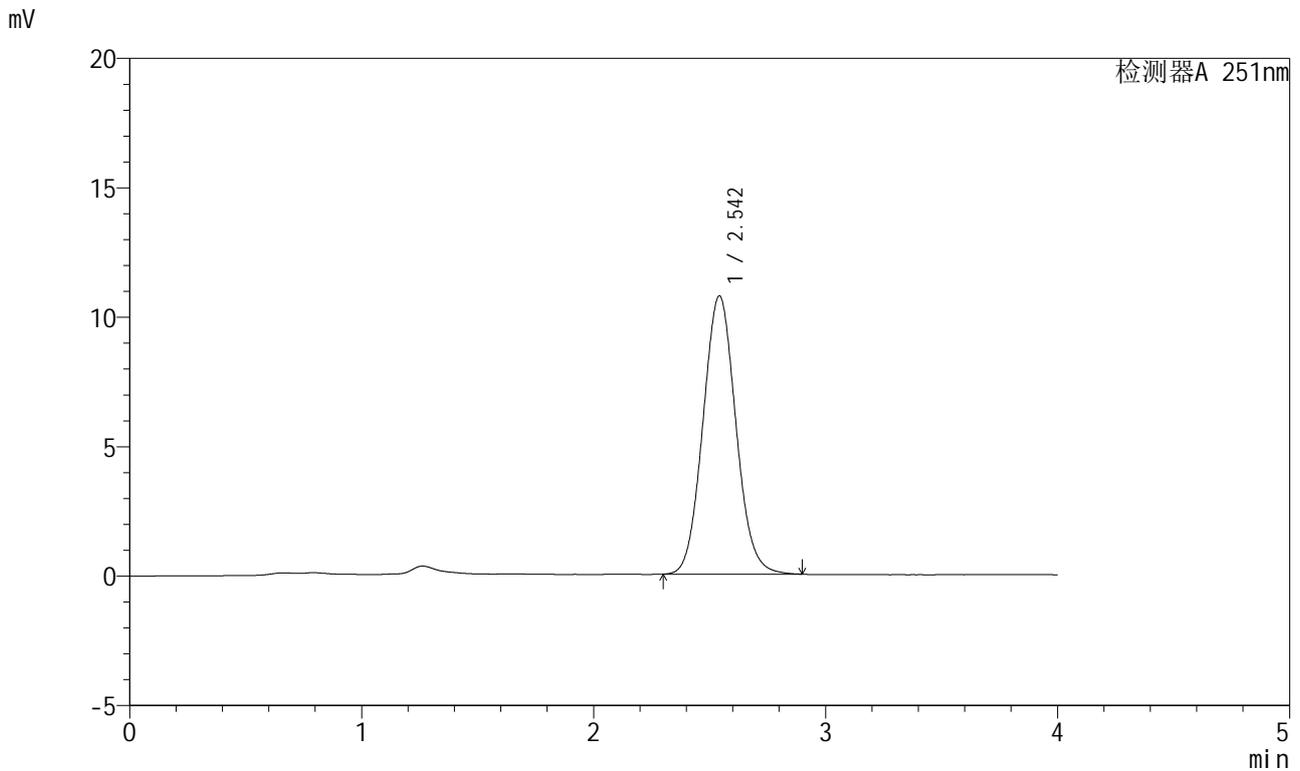

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105982	100.000	10733	1547	1.072	--
总计		105982	100.000	10733			

图6 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3289-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:41:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

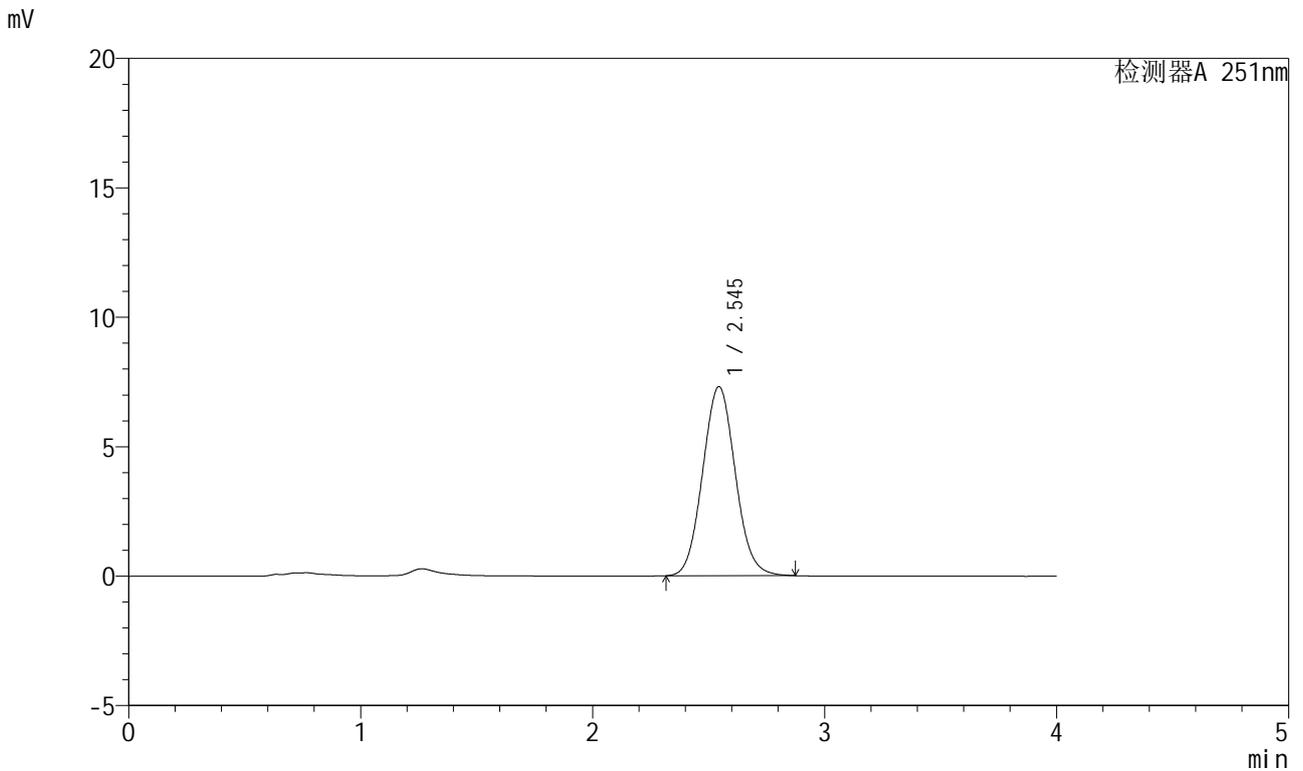

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	71471	100.000	7303	1567	1.069	--
总计		71471	100.000	7303			

图7 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3290-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:45:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

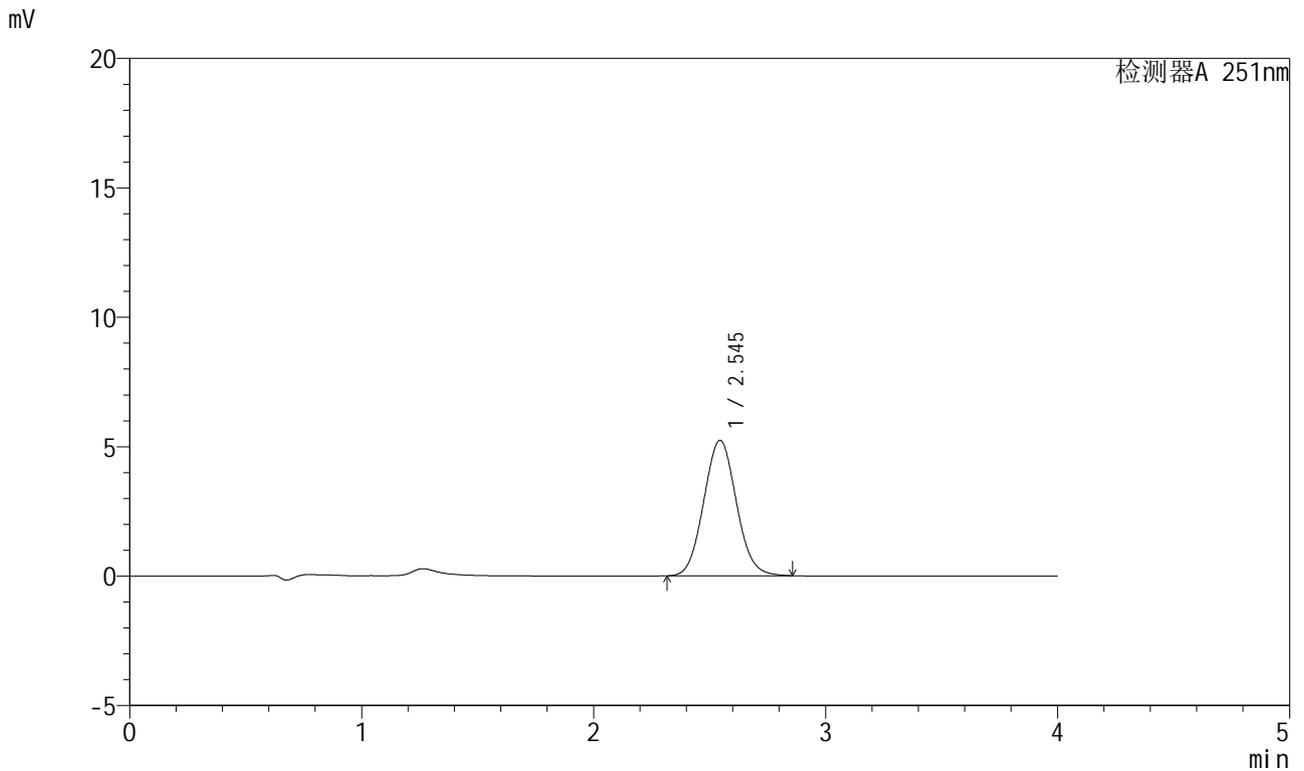

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	51118	100.000	5234	1565	1.067	--
总计		51118	100.000	5234			

图8 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3291-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:50:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

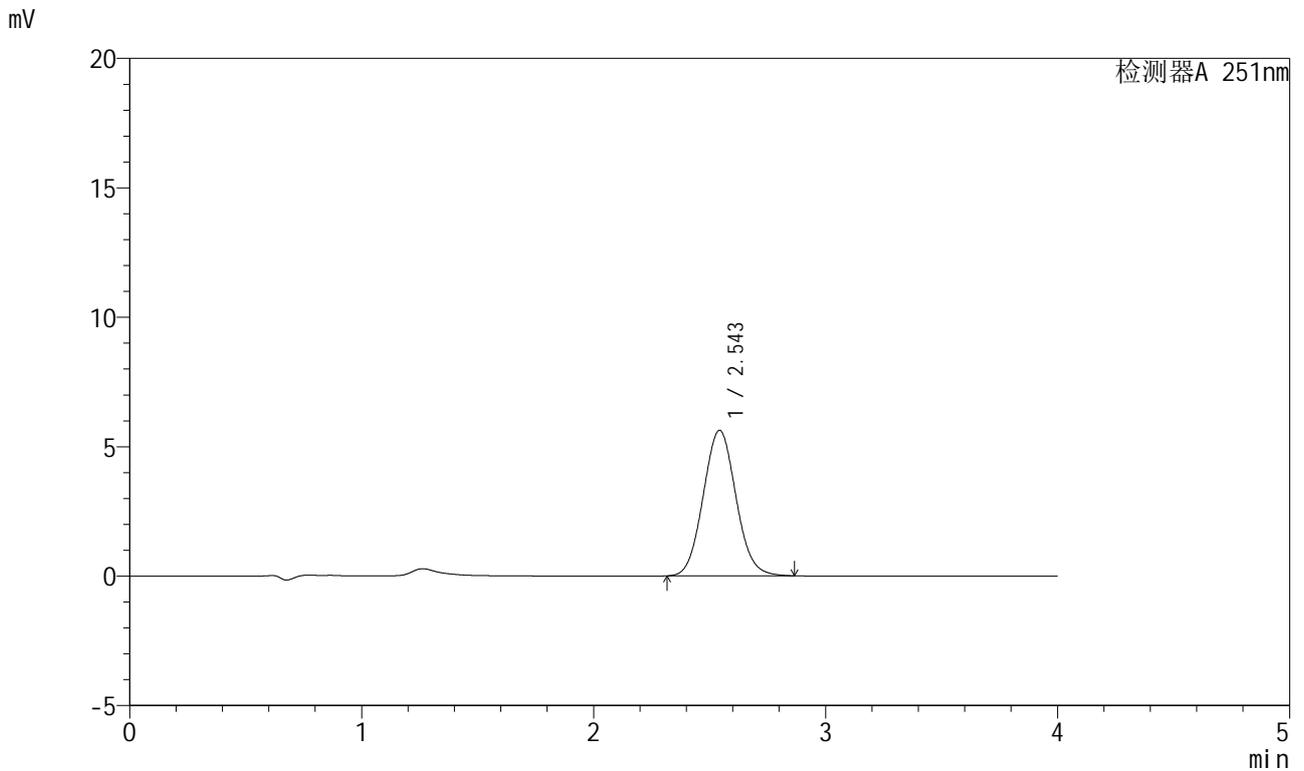

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	55197	100.000	5618	1555	1.066	--
总计		55197	100.000	5618			

图9 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3292-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 10:54:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

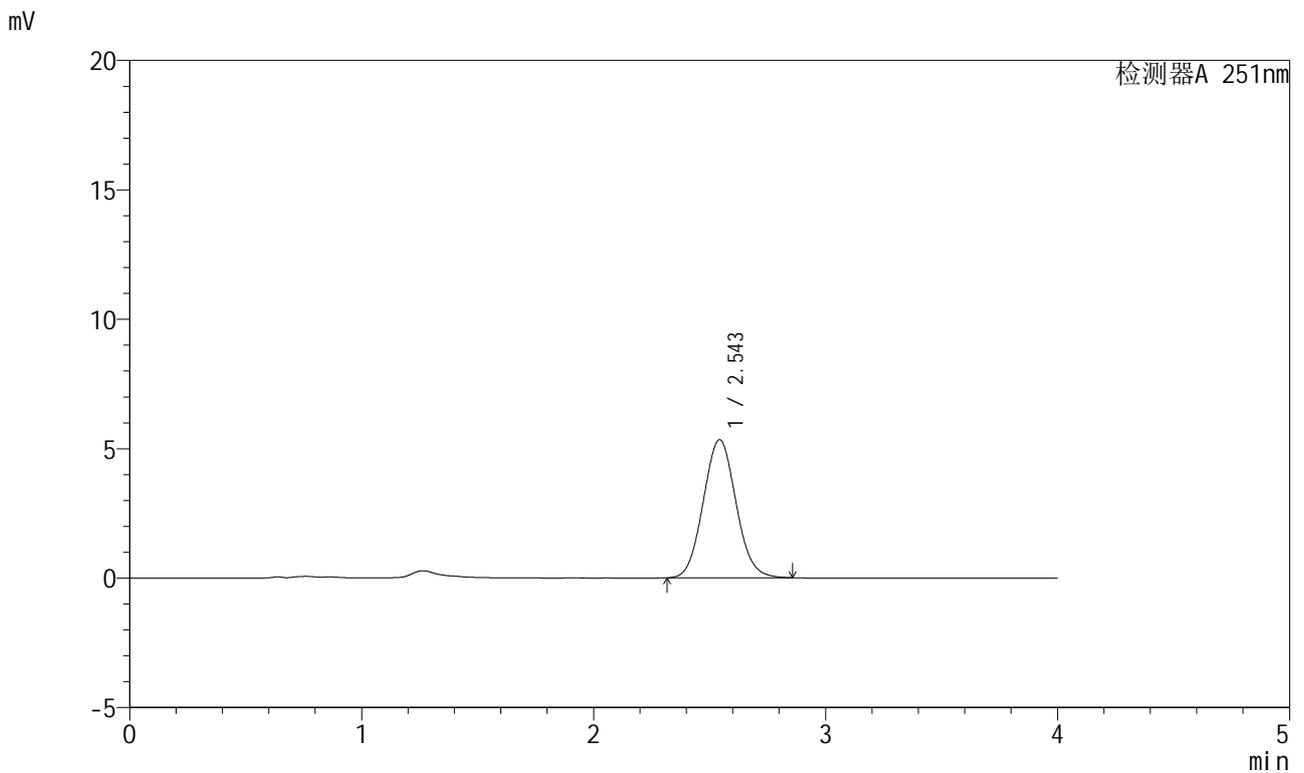

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	52346	100.000	5328	1552	1.067	--
总计		52346	100.000	5328			

图10 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3302-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:40:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

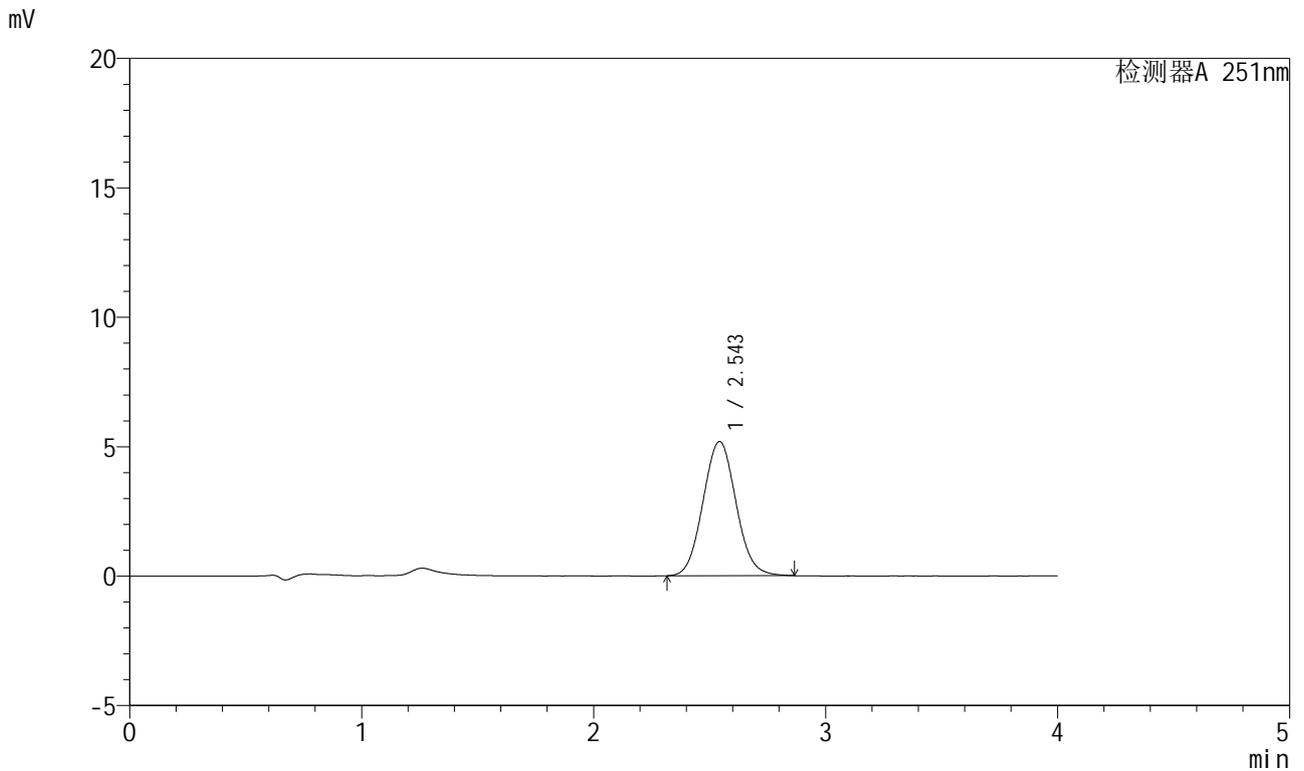

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	51260	100.000	5177	1529	1.065	--
总计		51260	100.000	5177			

图11 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3294-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:03:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

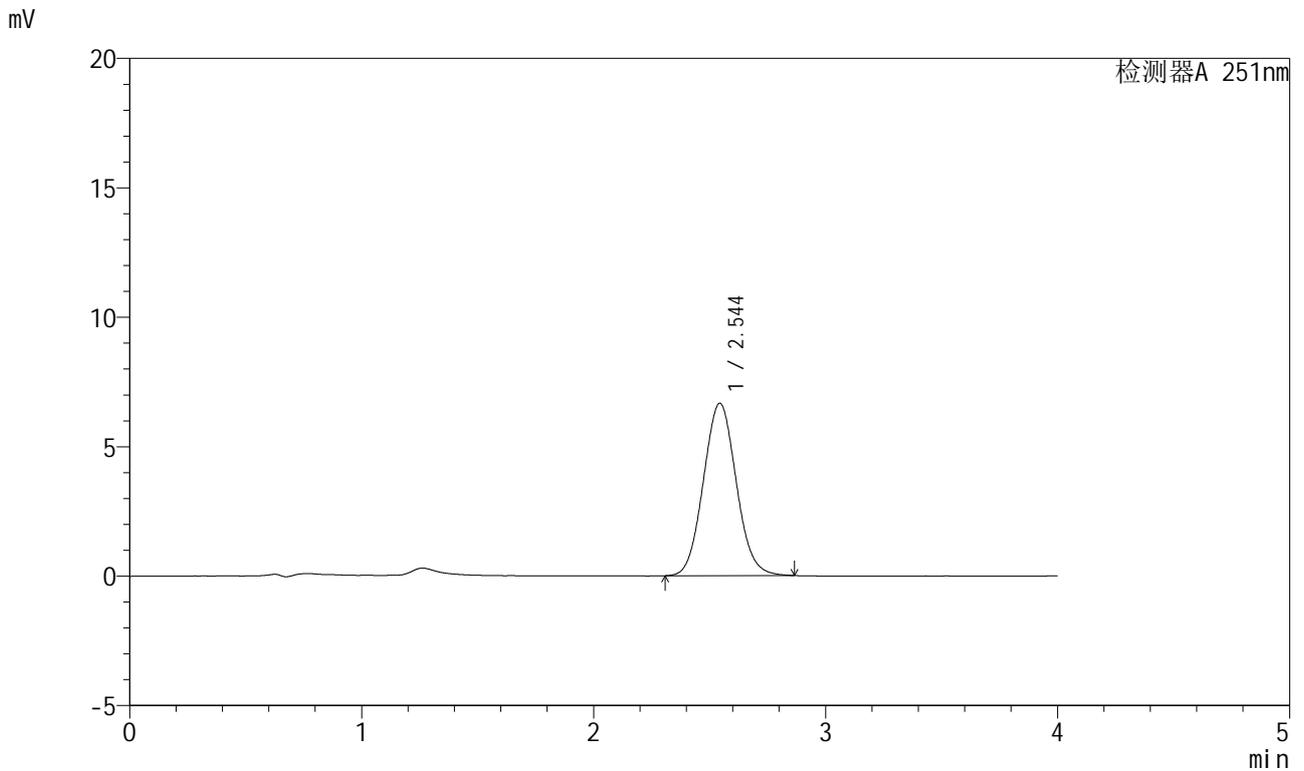

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	65528	100.000	6656	1547	1.068	--
总计		65528	100.000	6656			

图12 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3295-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:07:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

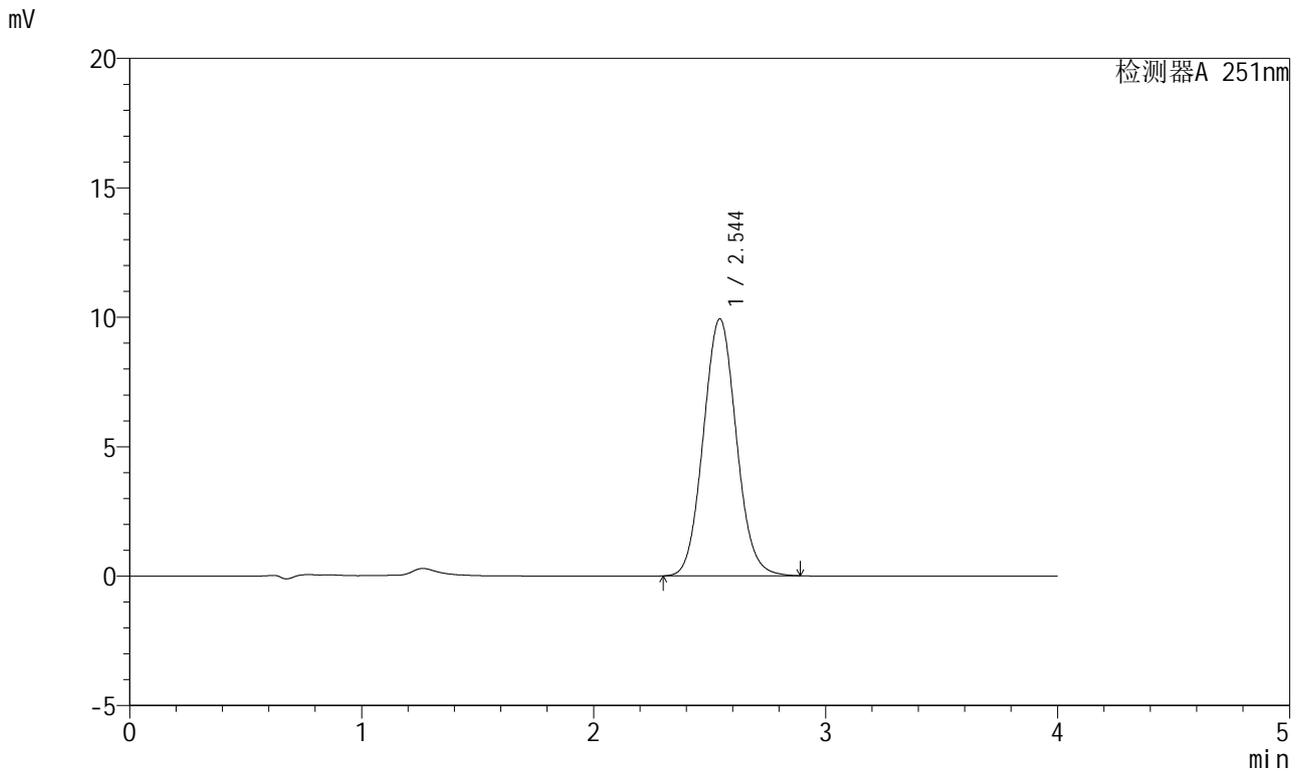

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	98093	100.000	9922	1540	1.068	--
总计		98093	100.000	9922			

图13 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3296-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:12:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

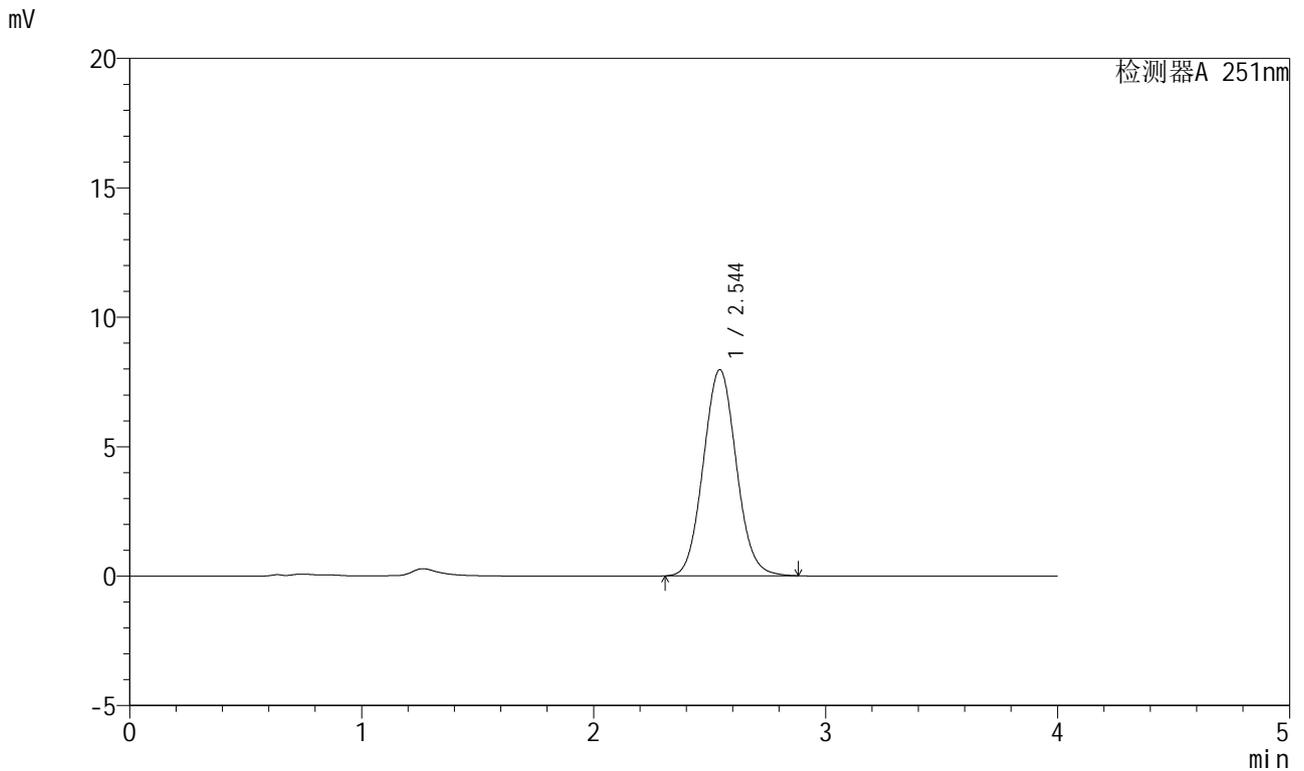

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	78722	100.000	7961	1539	1.068	--
总计		78722	100.000	7961			

图14 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3297-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:16:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

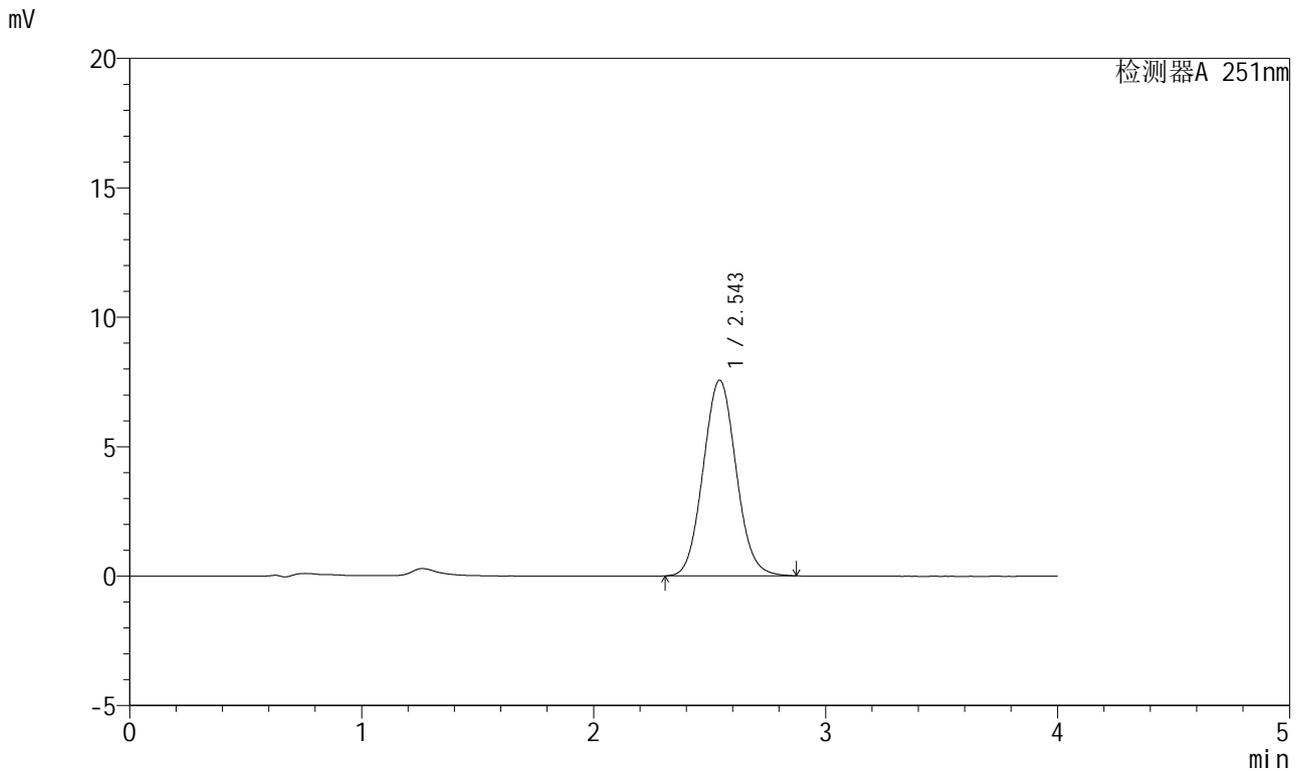

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	74632	100.000	7553	1538	1.067	--
总计		74632	100.000	7553			

图15 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3298-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:21:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

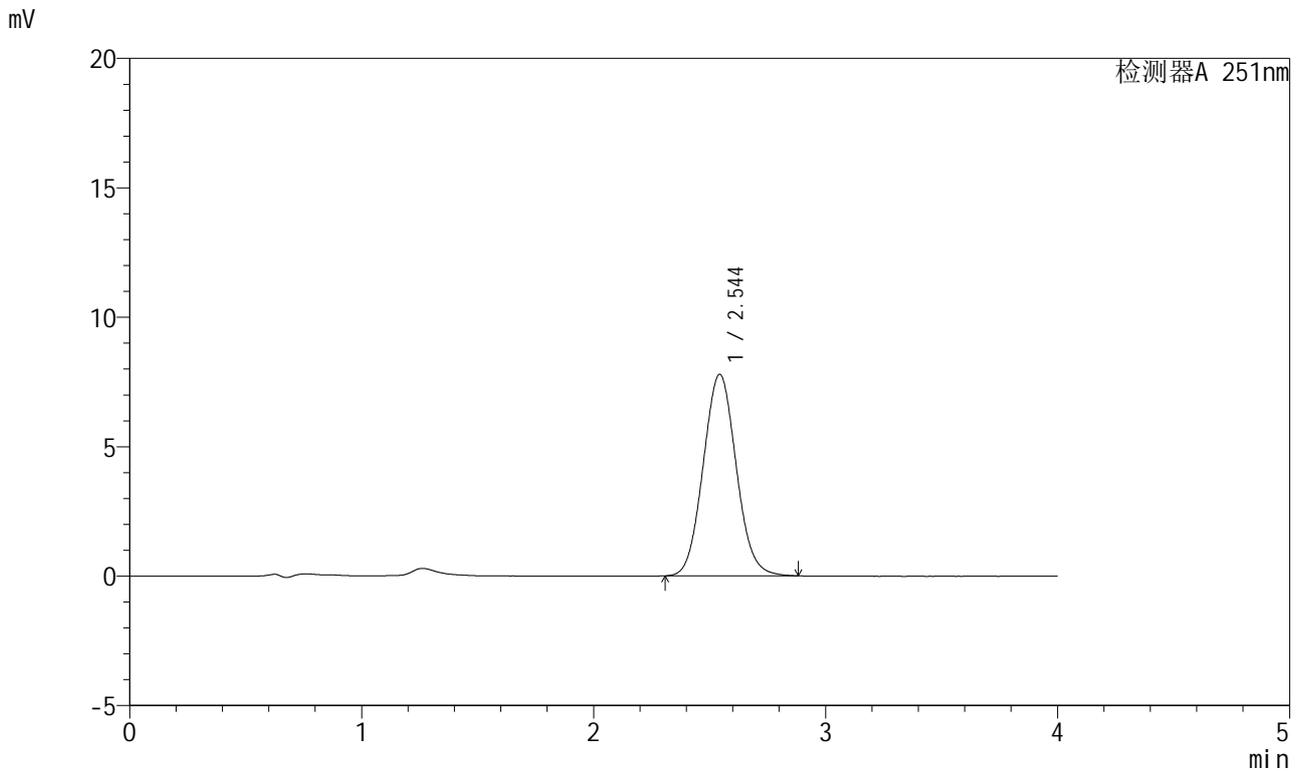

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	77038	100.000	7778	1531	1.069	--
总计		77038	100.000	7778			

图16 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3299-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:25:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

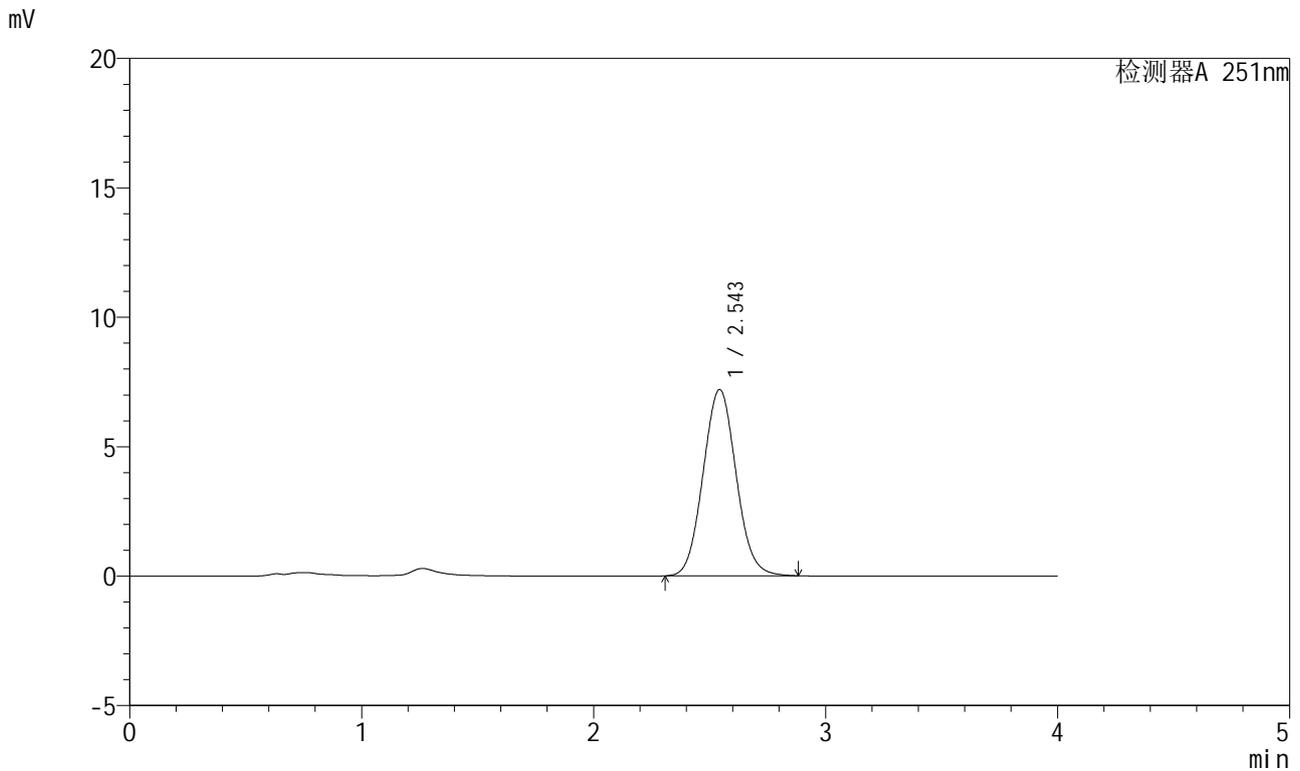

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	71315	100.000	7191	1528	1.068	--
总计		71315	100.000	7191			

图17 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3300-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:29:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

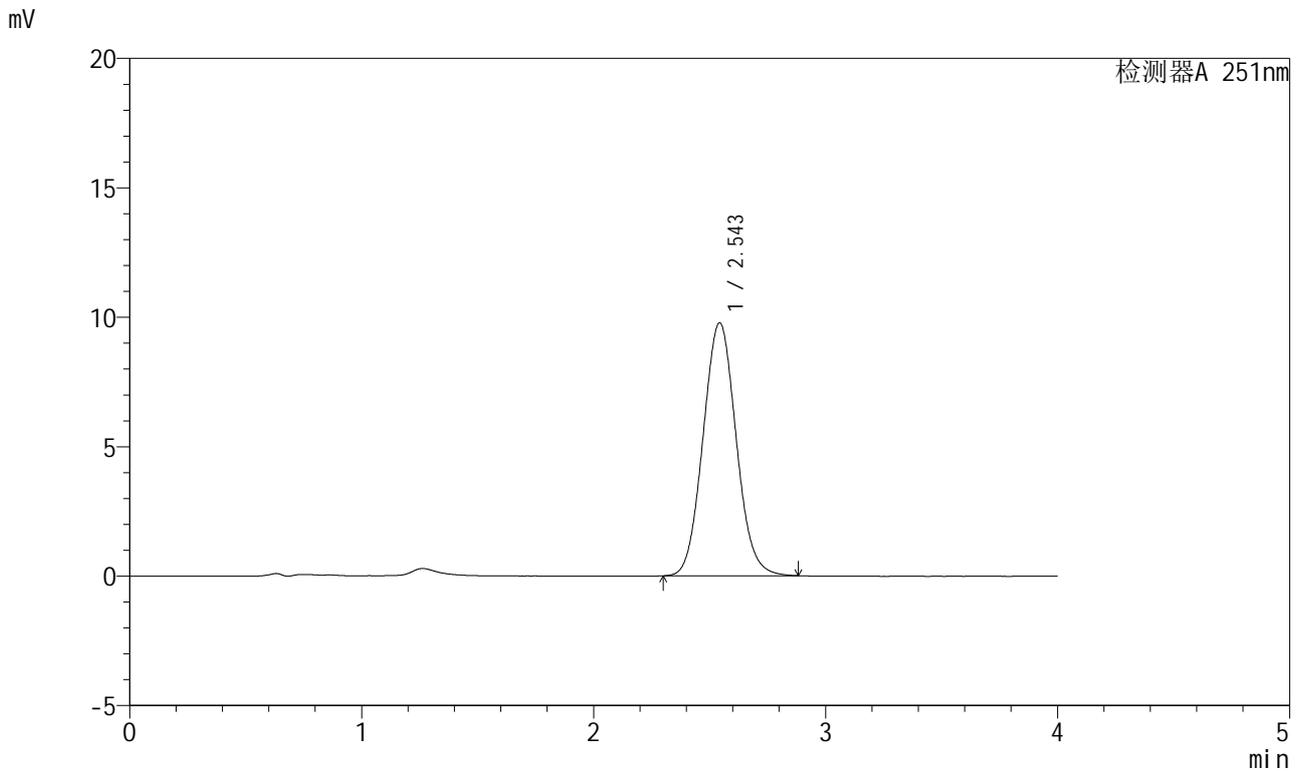

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	96868	100.000	9764	1526	1.068	--
总计		96868	100.000	9764			

图18 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3301-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:34:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

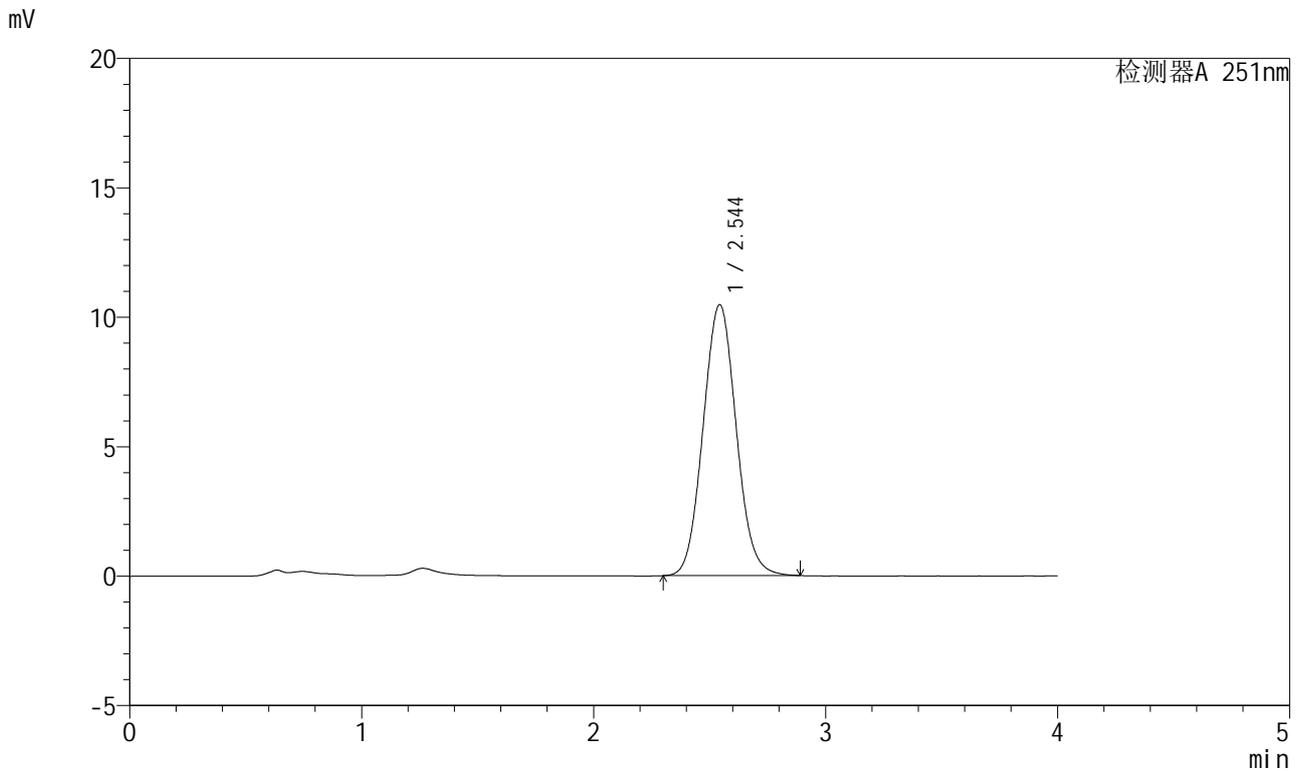

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	103932	100.000	10459	1523	1.068	--
总计		103932	100.000	10459			

图19 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3303-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:45:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

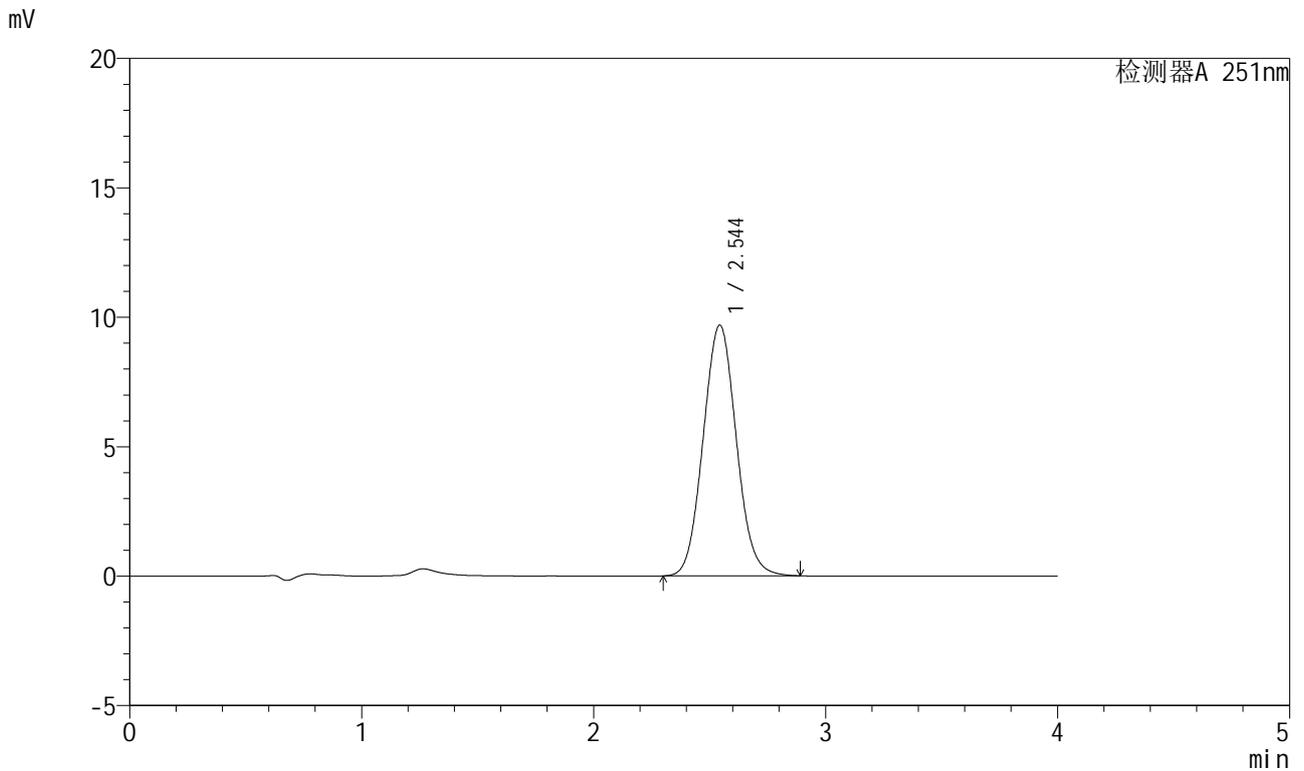

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	96291	100.000	9682	1519	1.067	--
总计		96291	100.000	9682			

图20 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3305-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:54:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

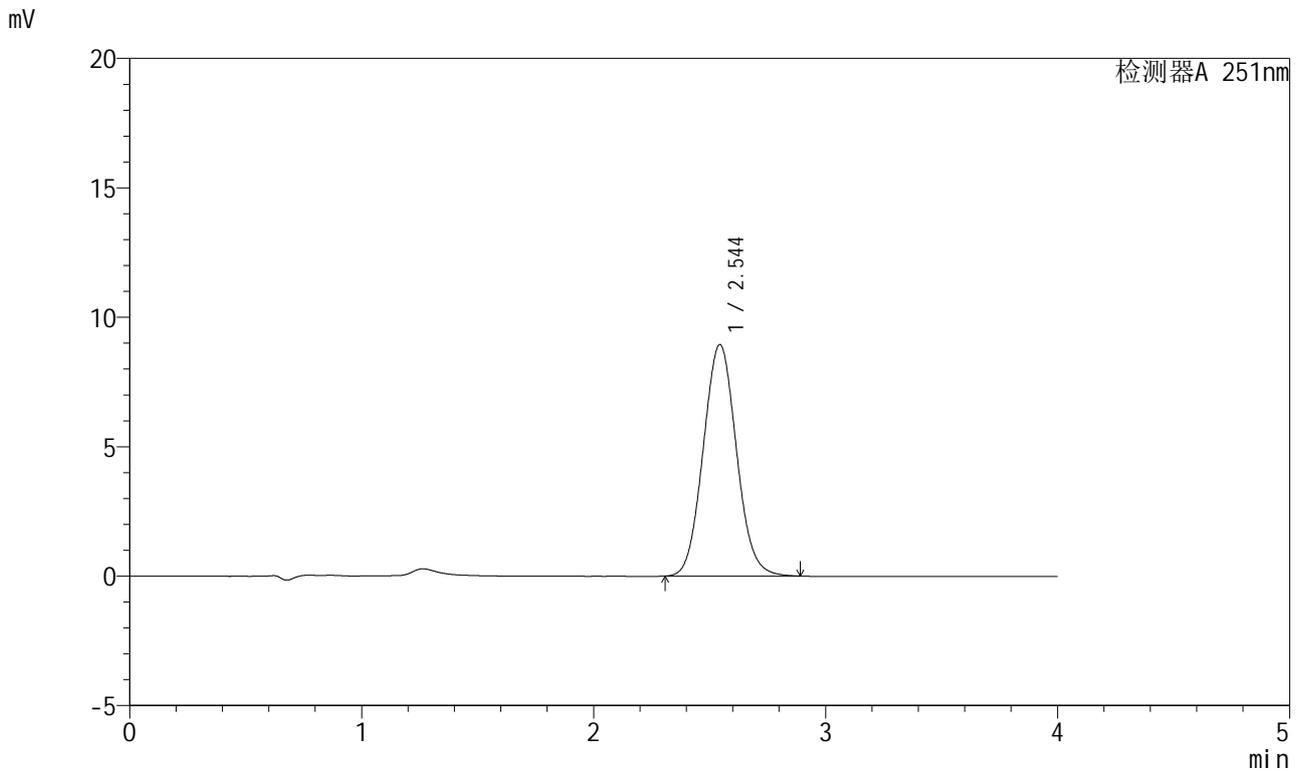

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	88987	100.000	8940	1517	1.067	--
总计		88987	100.000	8940			

图22 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3306-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 11:58:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

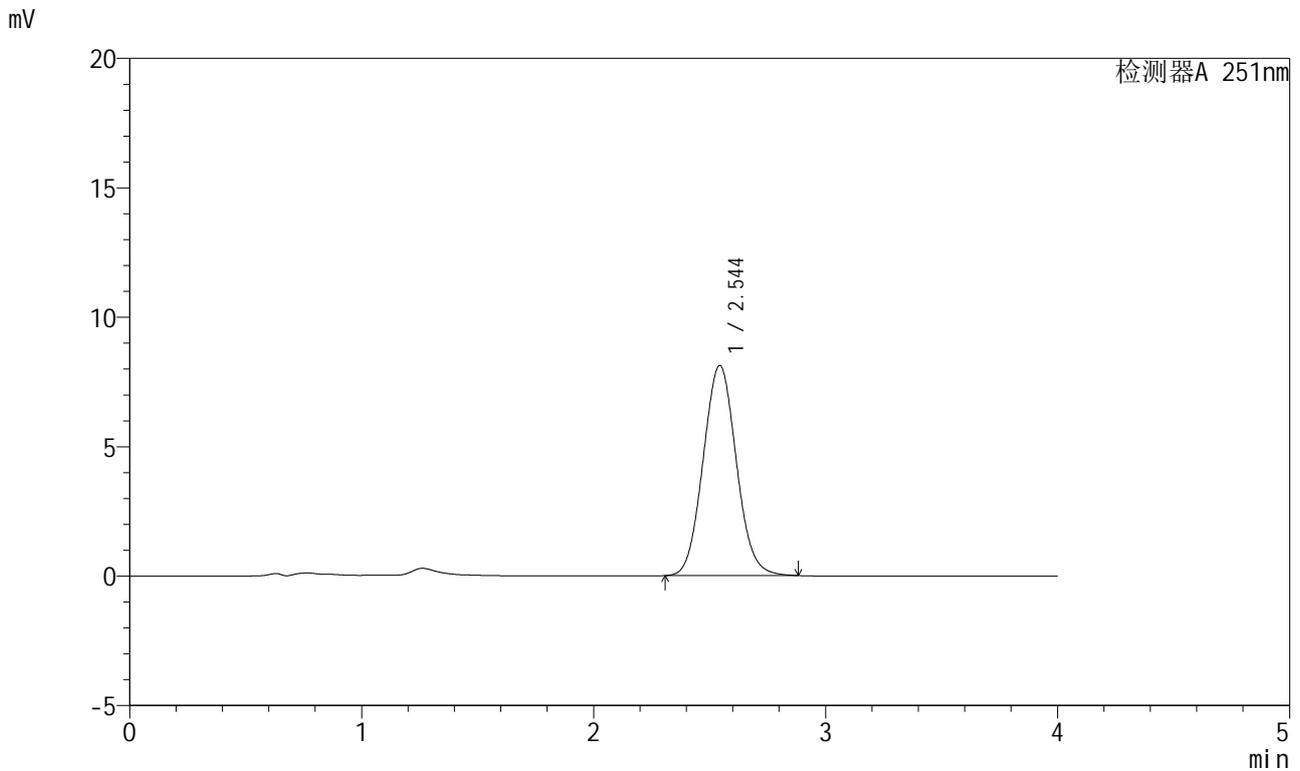

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	80740	100.000	8113	1516	1.067	--
总计		80740	100.000	8113			

图23 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3307-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:03:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

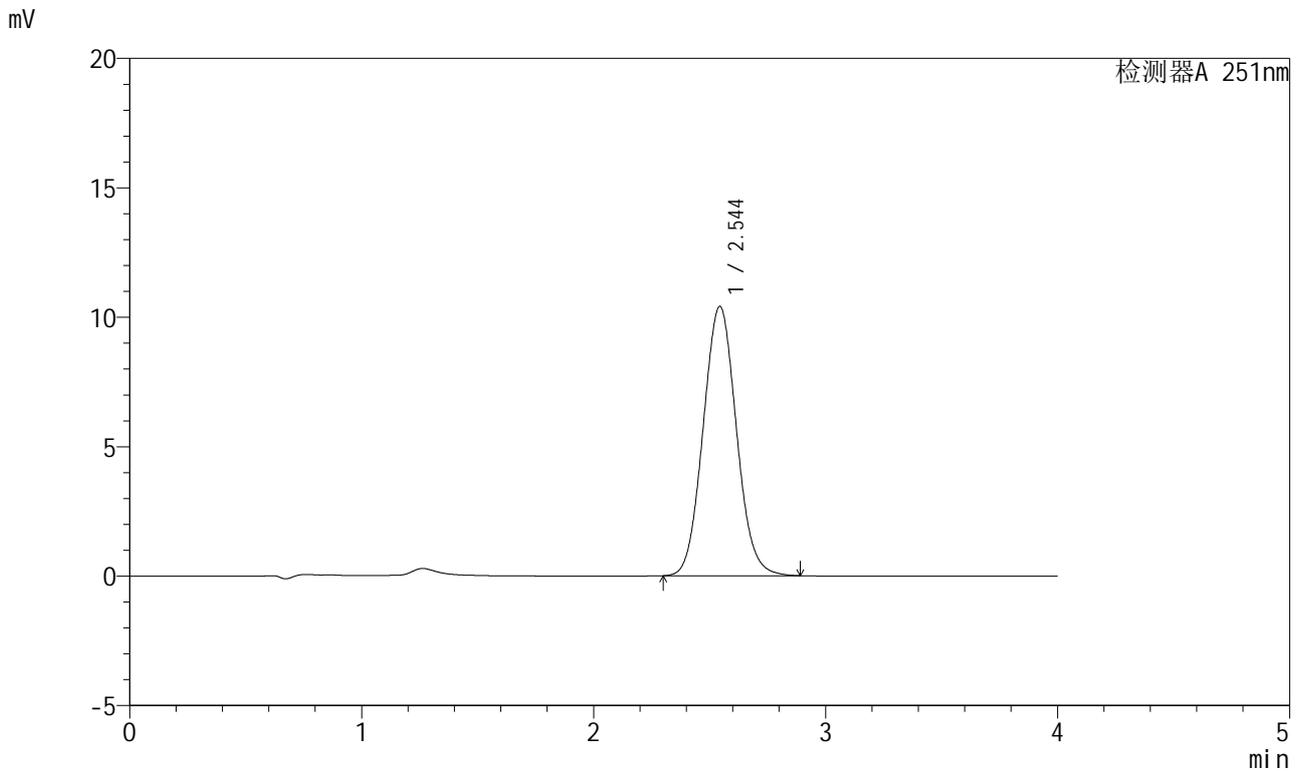

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	103634	100.000	10398	1512	1.067	--
总计		103634	100.000	10398			

图24 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3308-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:07:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:28:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

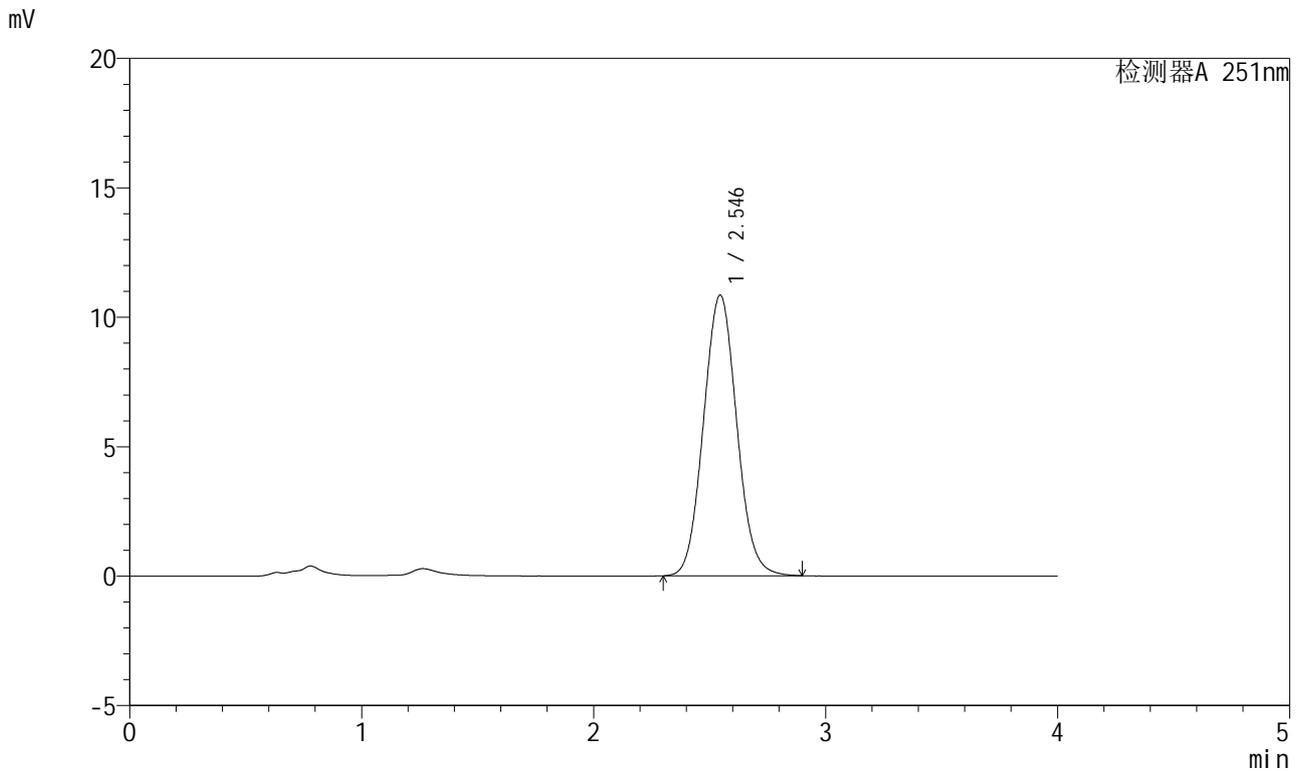

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	107916	100.000	10843	1518	1.066	--
总计		107916	100.000	10843			

图25 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3309-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:11:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

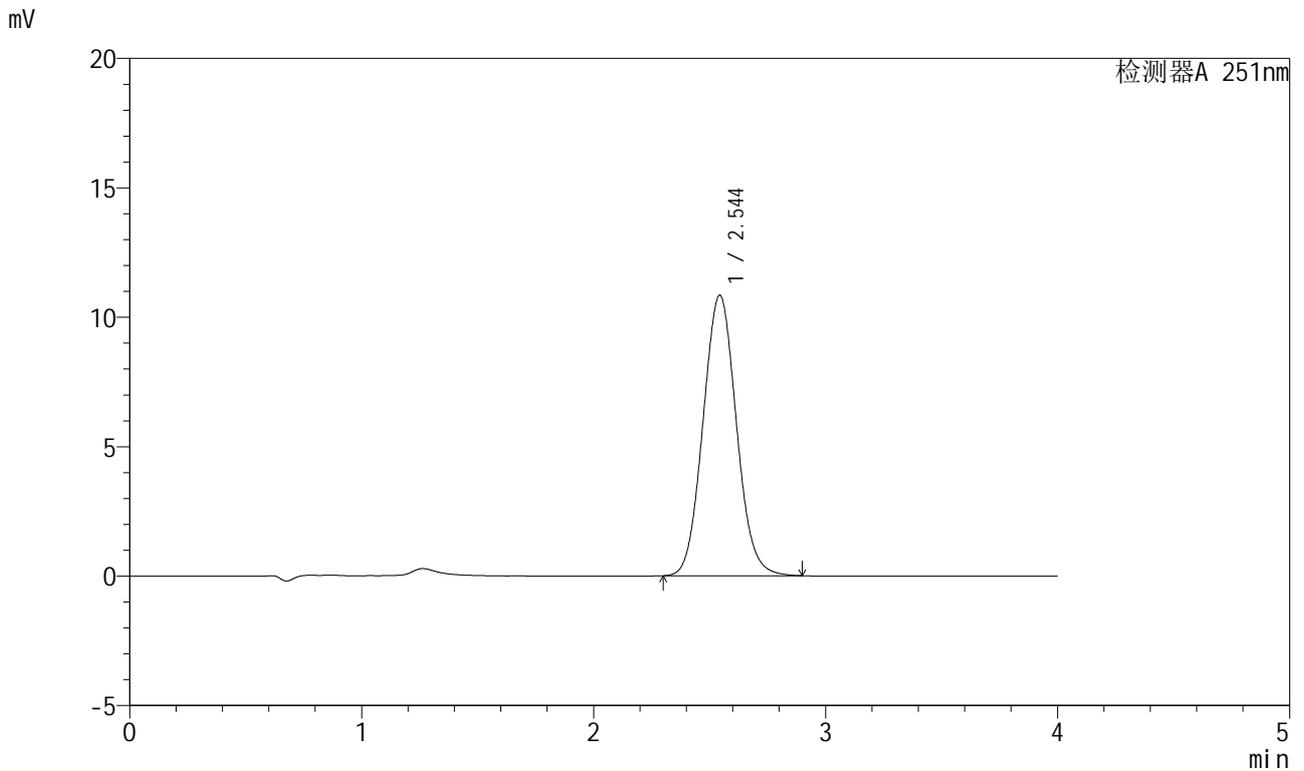

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	108172	100.000	10827	1505	1.068	--
总计		108172	100.000	10827			

图26 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3310-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:16:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

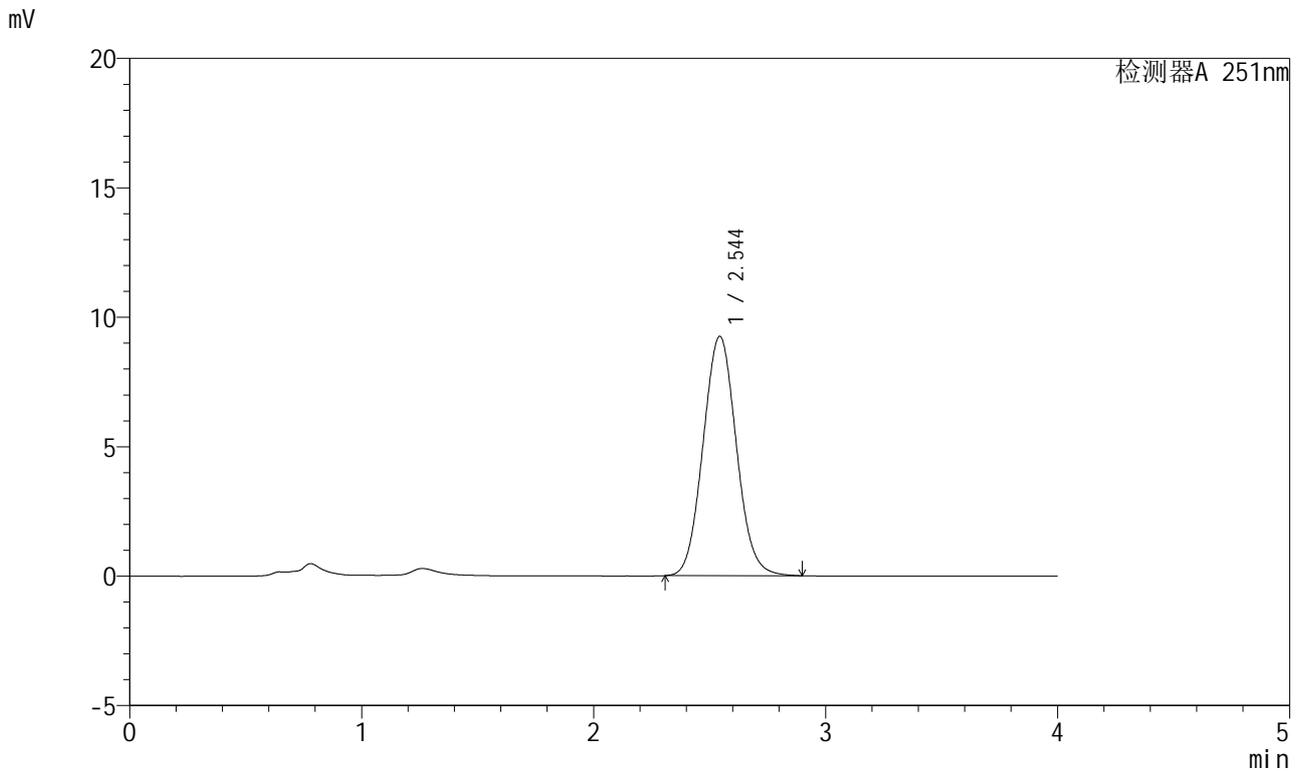

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	92329	100.000	9241	1505	1.067	--
总计		92329	100.000	9241			

图27 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3312-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:25:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

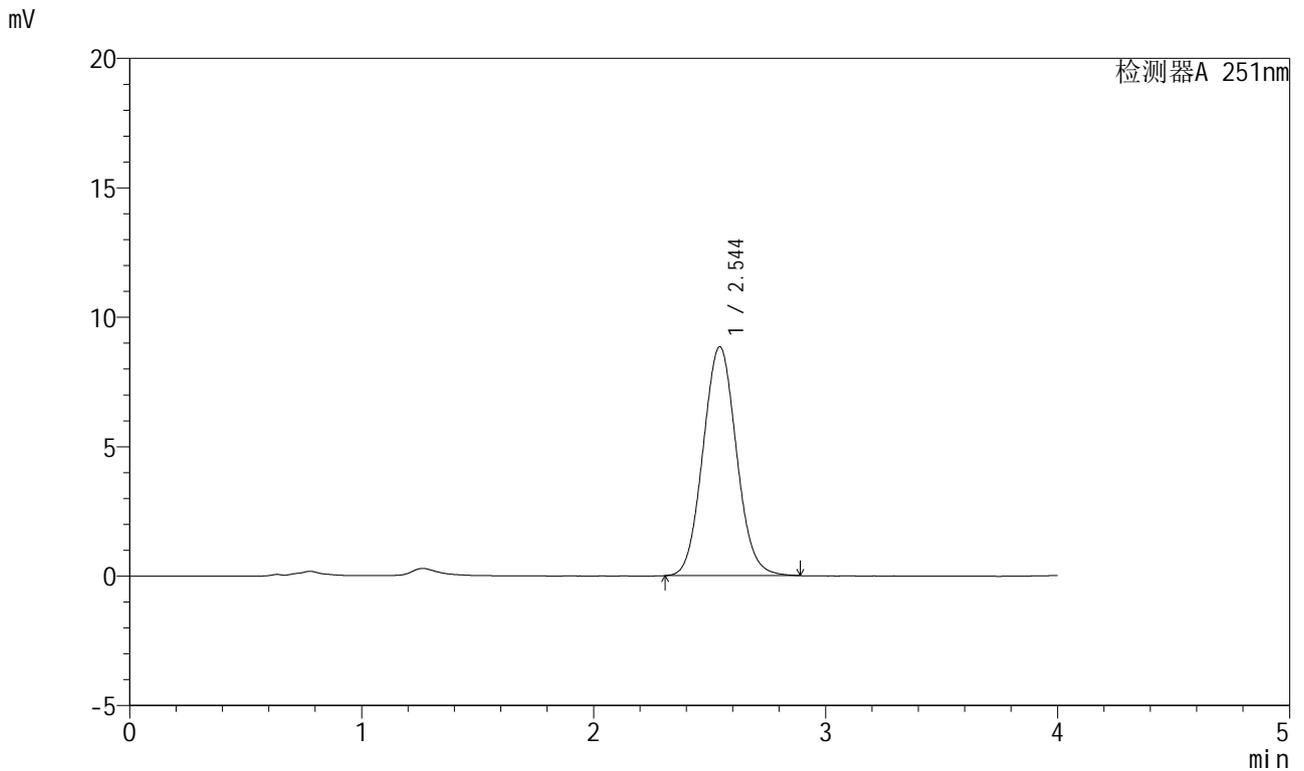

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	88456	100.000	8839	1500	1.066	--
总计		88456	100.000	8839			

图29 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3313-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:29:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

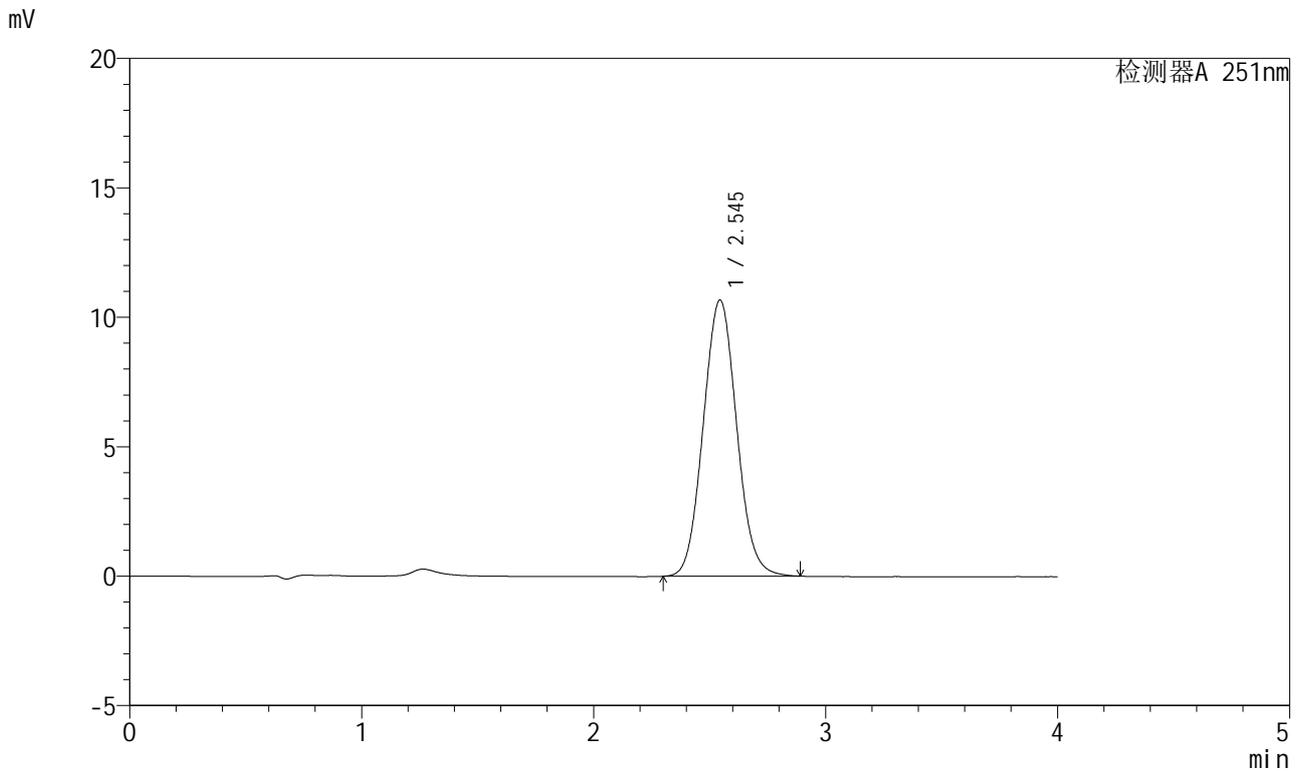

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	106713	100.000	10668	1501	1.066	--
总计		106713	100.000	10668			

图30 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3314-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:33:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

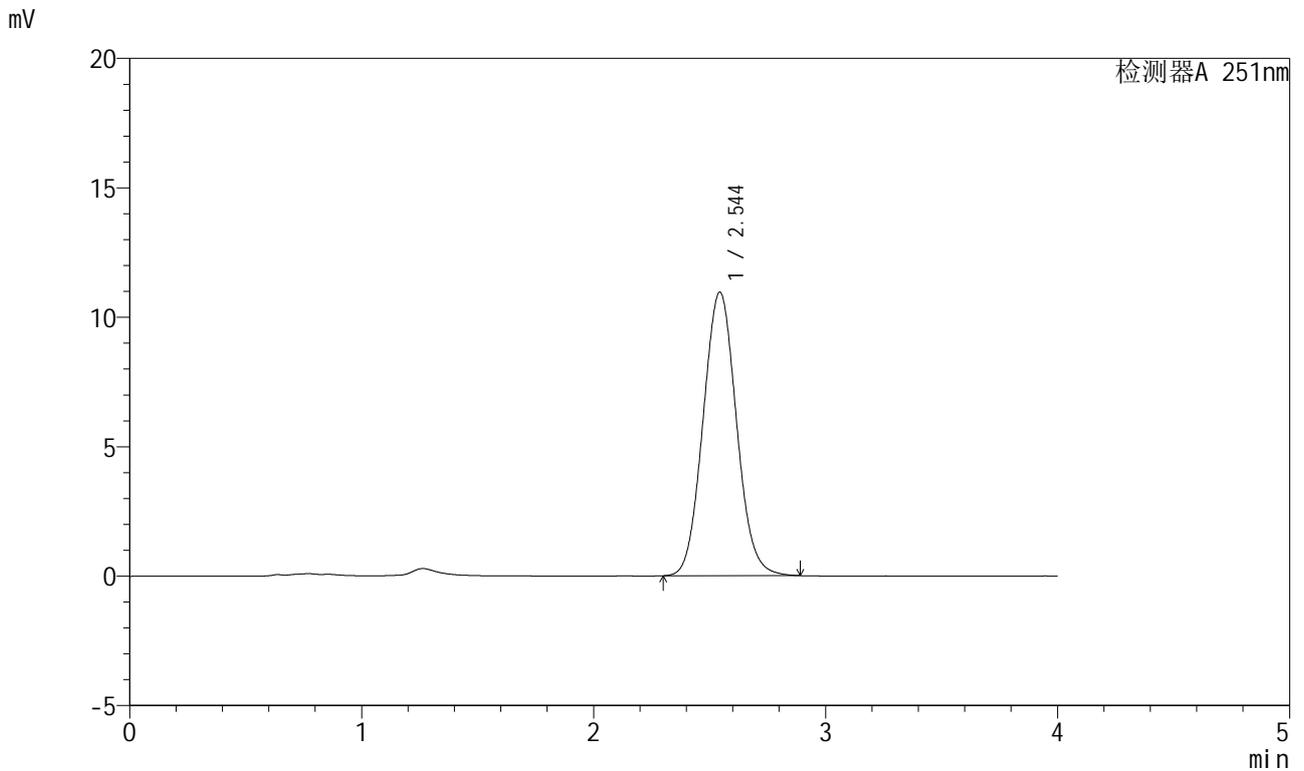

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	109567	100.000	10948	1499	1.066	--
总计		109567	100.000	10948			

图31 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3315-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:38:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

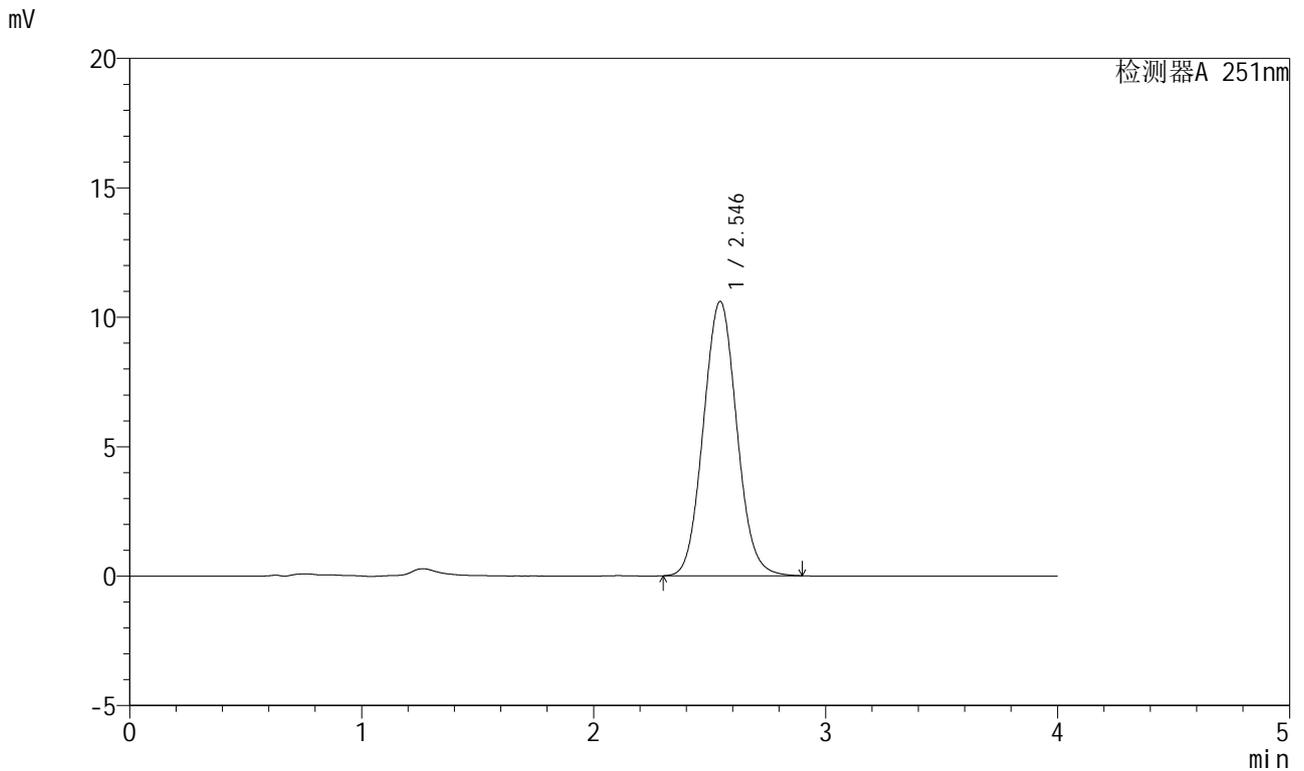

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	105978	100.000	10601	1503	1.065	--
总计		105978	100.000	10601			

图32 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3316-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:42:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

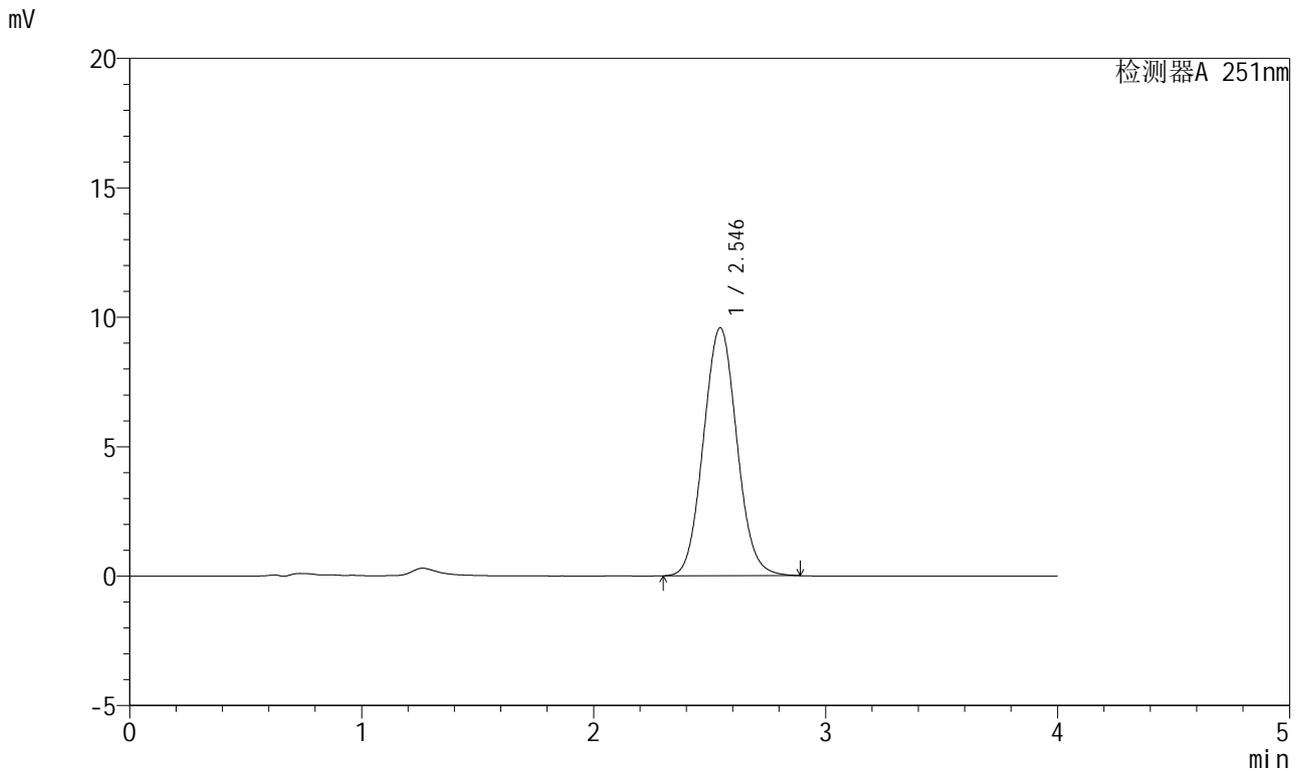

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	95910	100.000	9582	1499	1.065	--
总计		95910	100.000	9582			

图33 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3317-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:46:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

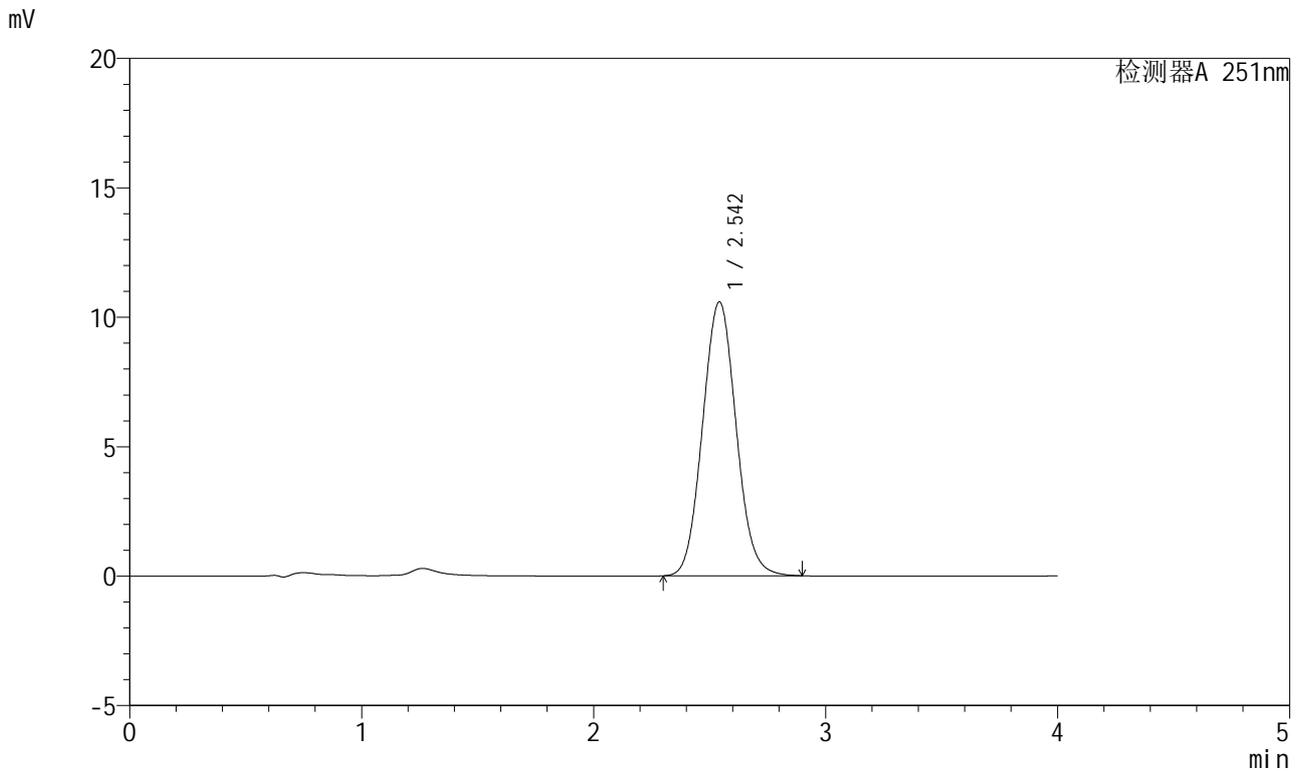

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	106467	100.000	10568	1479	1.070	--
总计		106467	100.000	10568			

图34 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3318-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:51:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

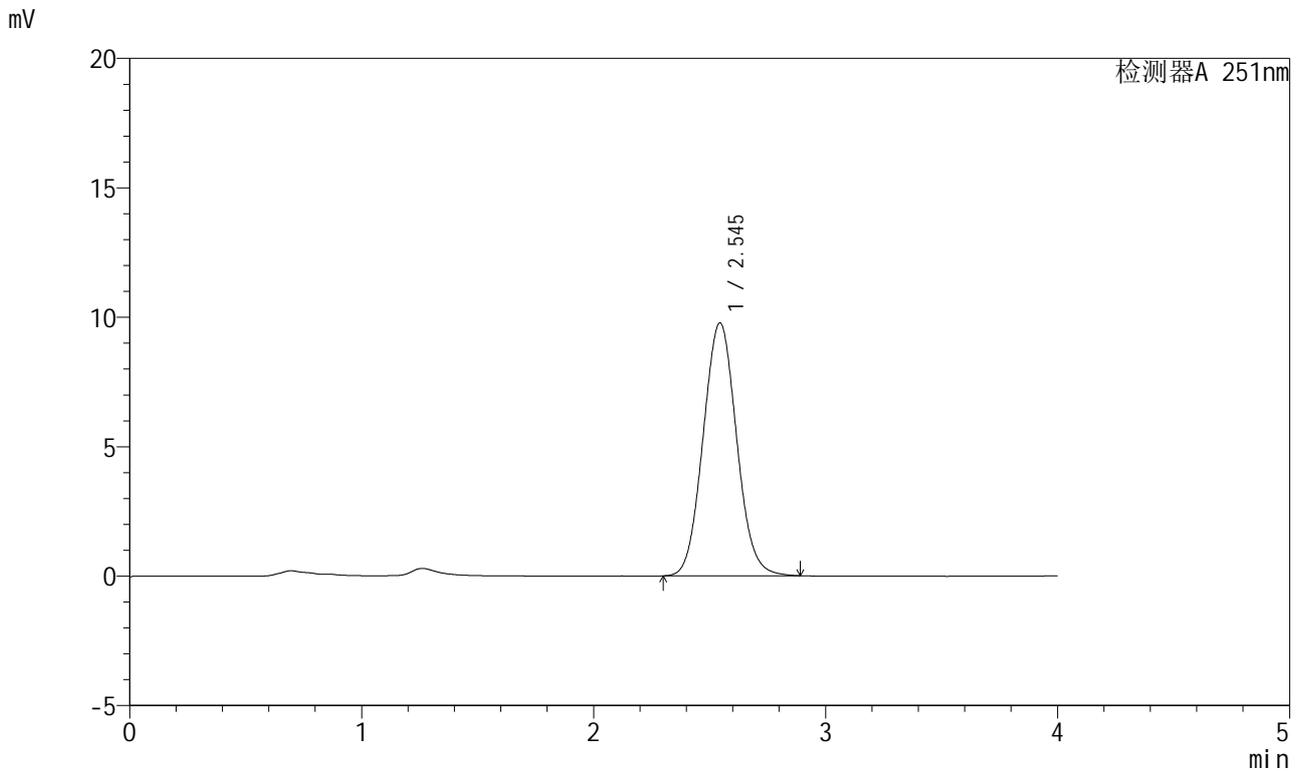

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	98022	100.000	9769	1491	1.065	--
总计		98022	100.000	9769			

图35 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3319-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 12:55:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

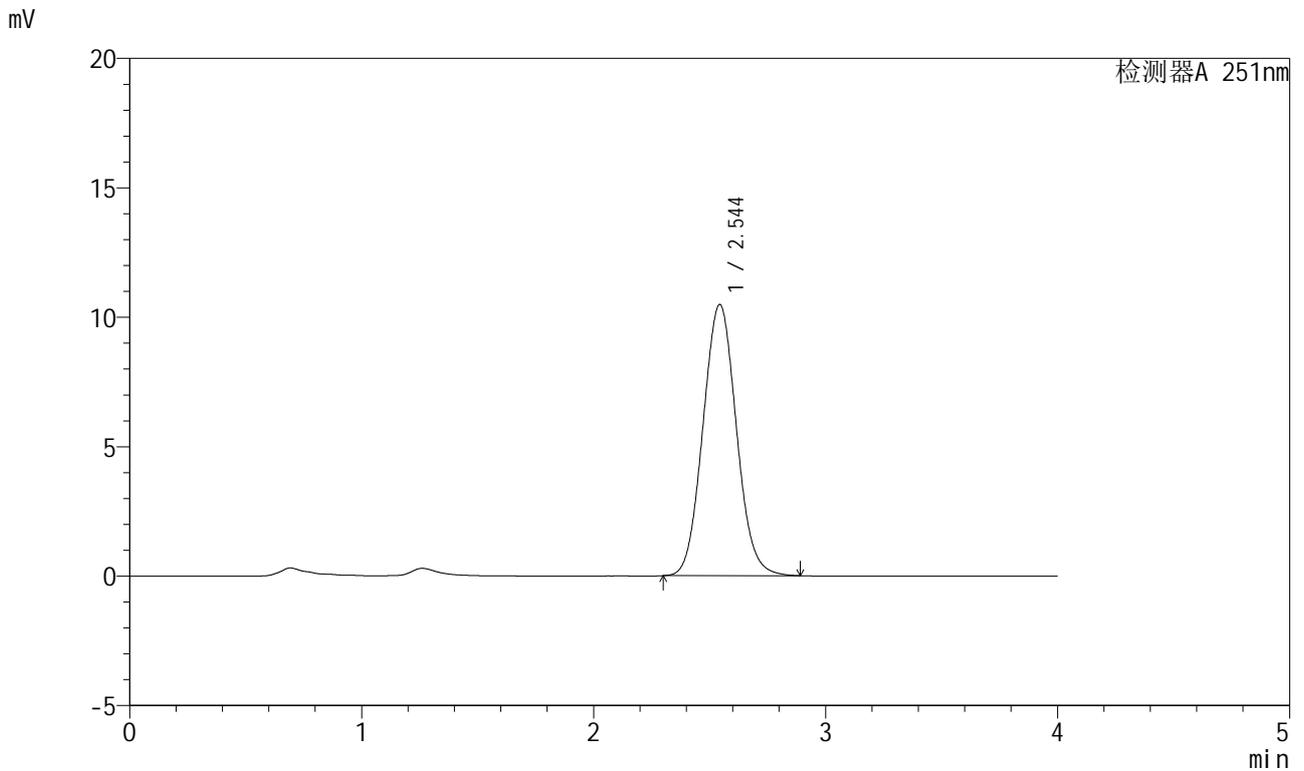

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	104945	100.000	10468	1495	1.066	--
总计		104945	100.000	10468			

图36 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3321-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:04:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

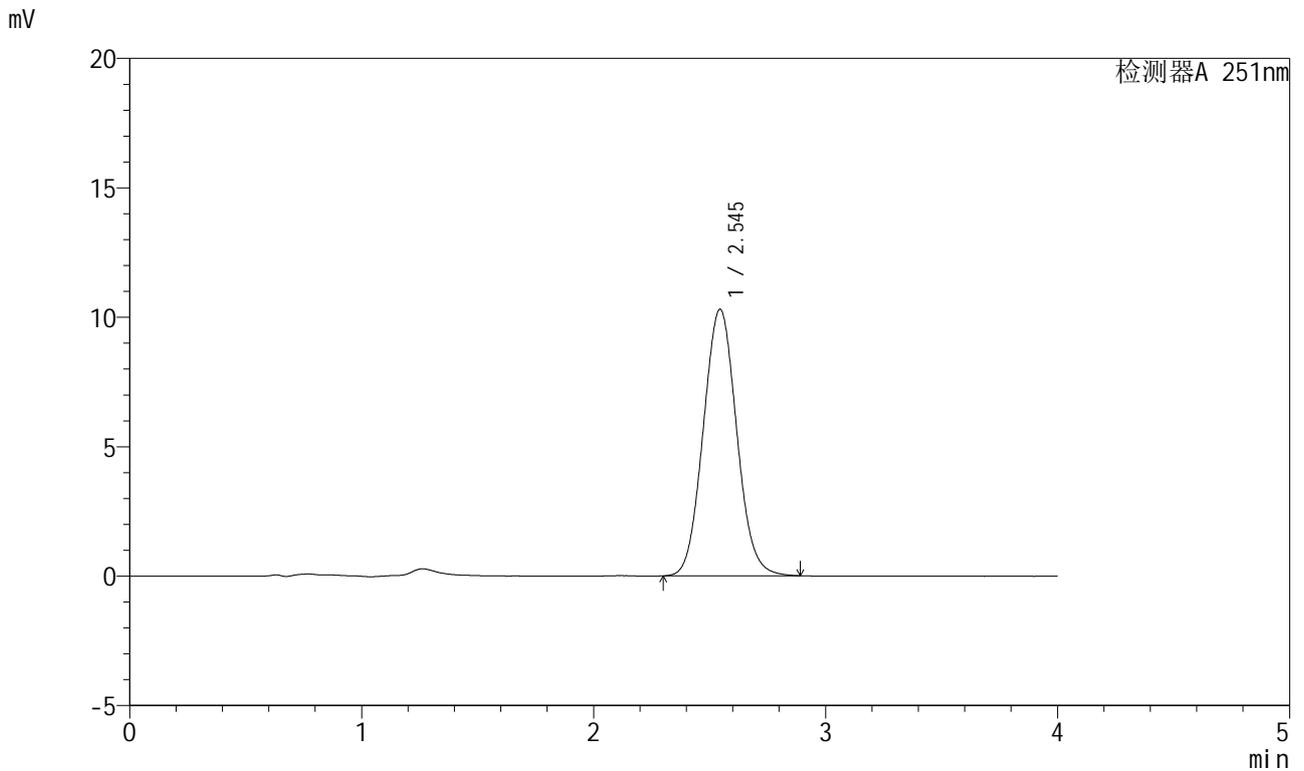

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	103093	100.000	10298	1497	1.065	--
总计		103093	100.000	10298			

图38 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3322-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:08:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

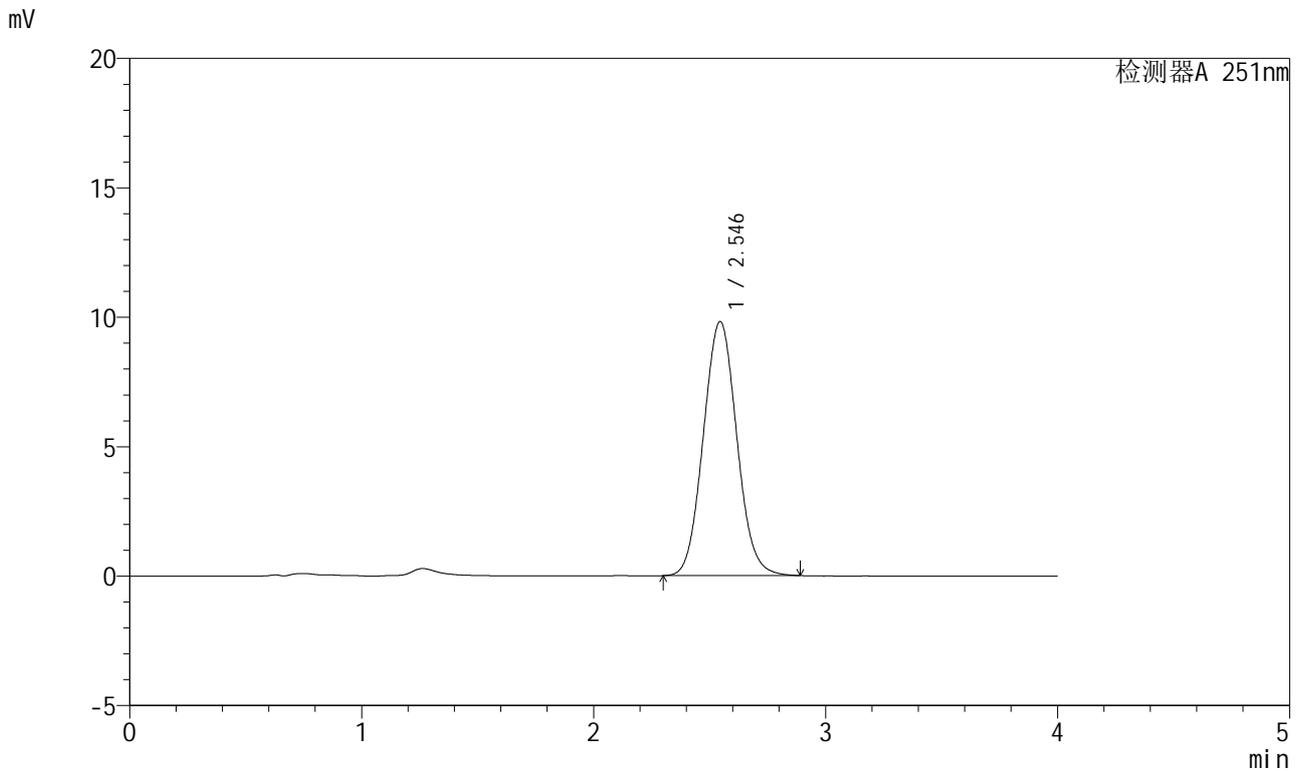

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	98426	100.000	9814	1491	1.064	--
总计		98426	100.000	9814			

图39 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3324-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:17:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

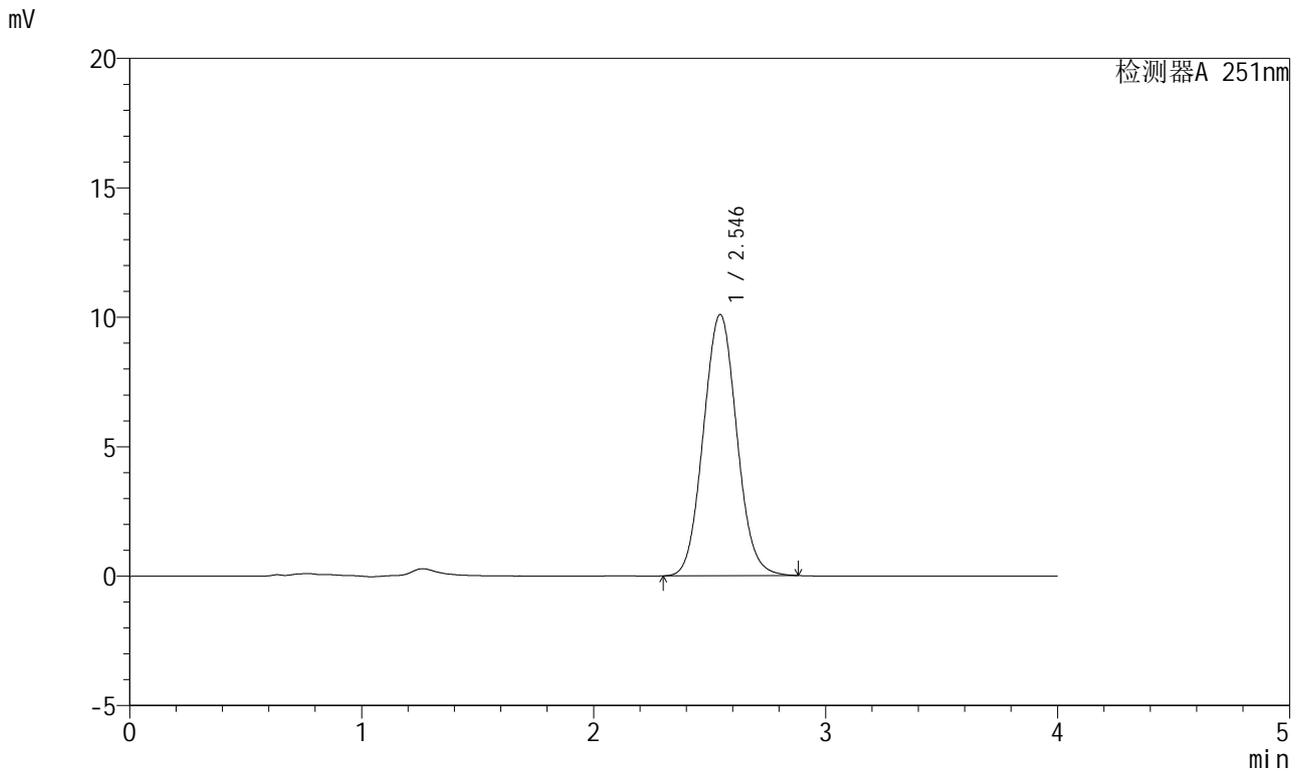

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	100970	100.000	10093	1499	1.063	--
总计		100970	100.000	10093			

图41 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3325-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:21:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

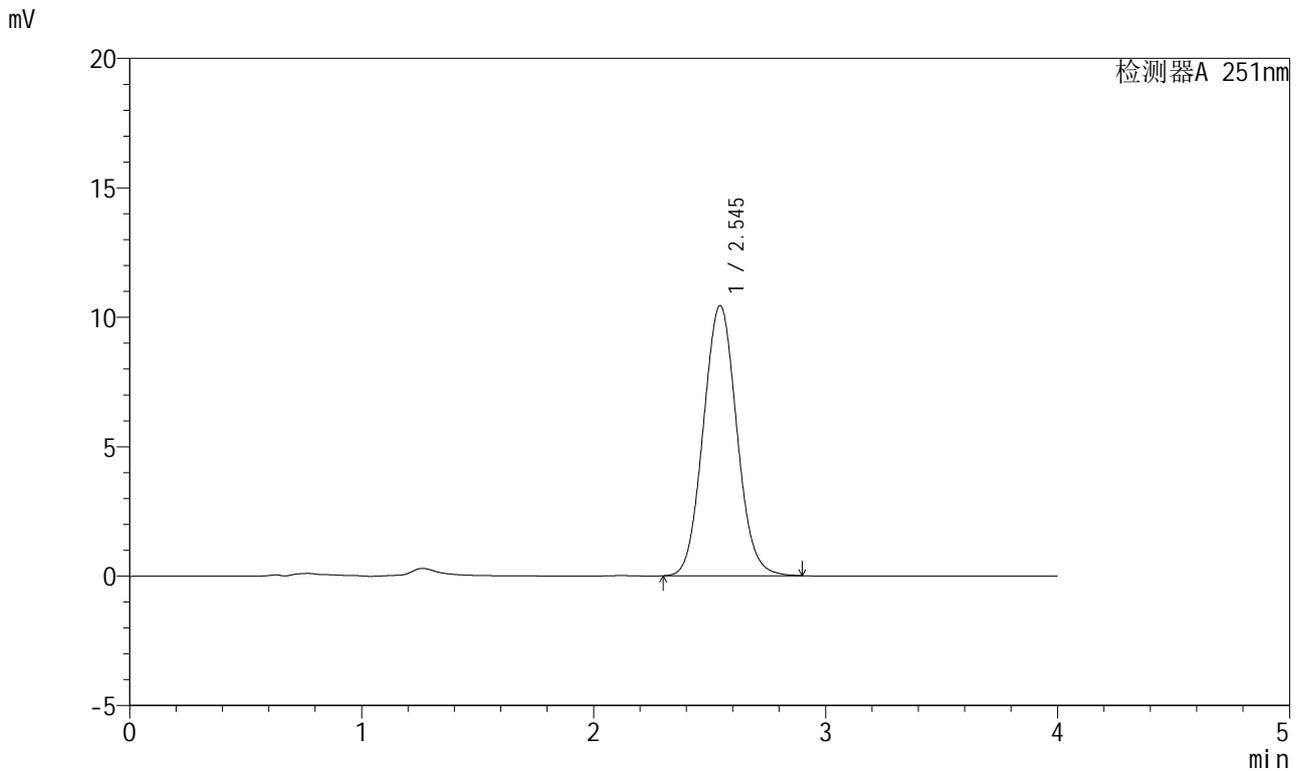

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	104673	100.000	10437	1494	1.064	--
总计		104673	100.000	10437			

图42 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3326-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:26:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

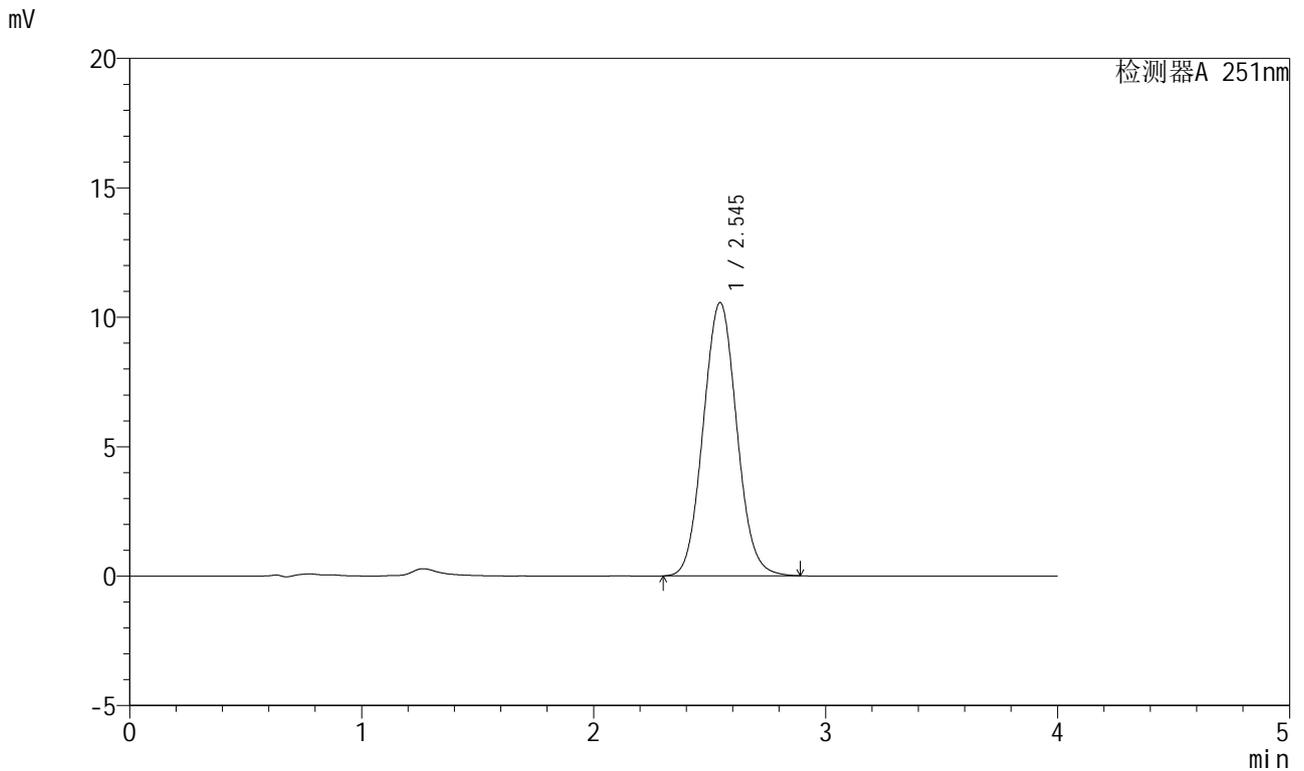

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	106040	100.000	10557	1488	1.064	--
总计		106040	100.000	10557			

图43 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3327-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:30:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

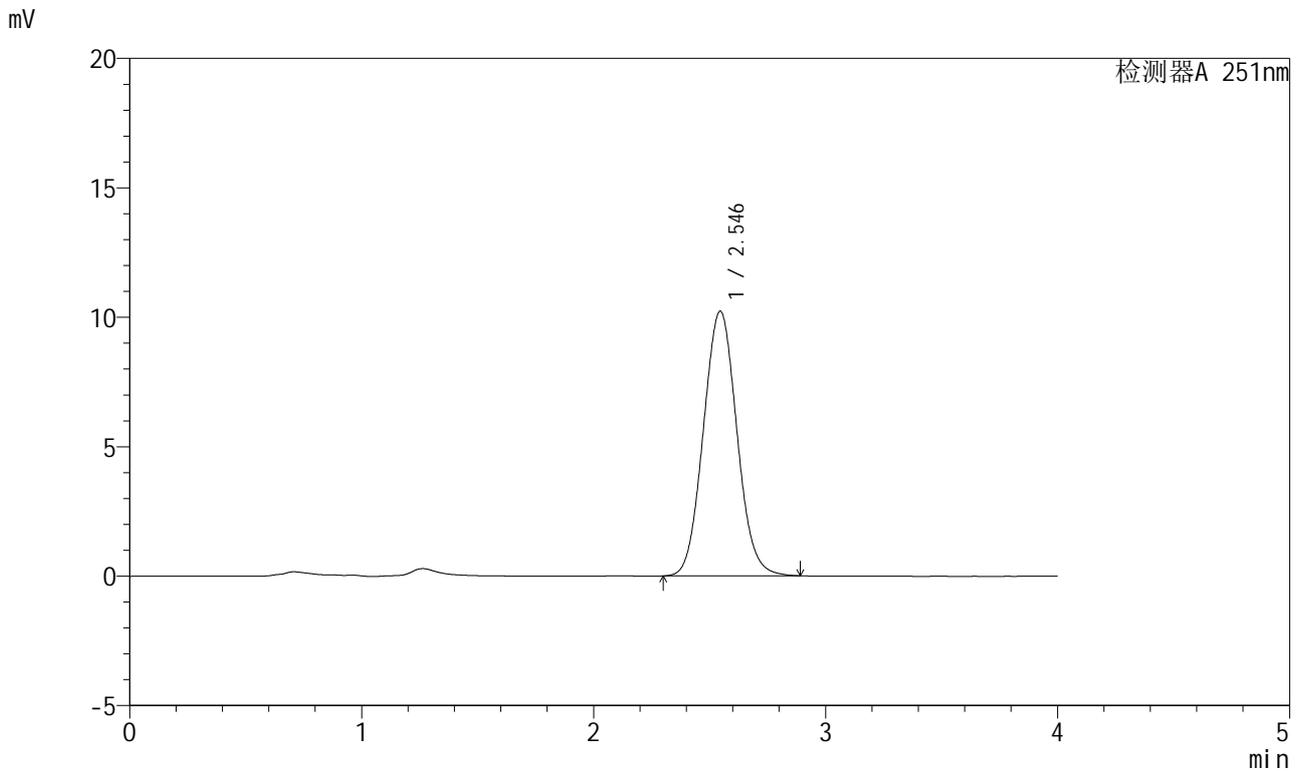

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	102749	100.000	10227	1487	1.064	--
总计		102749	100.000	10227			

图44 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3328-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:35:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

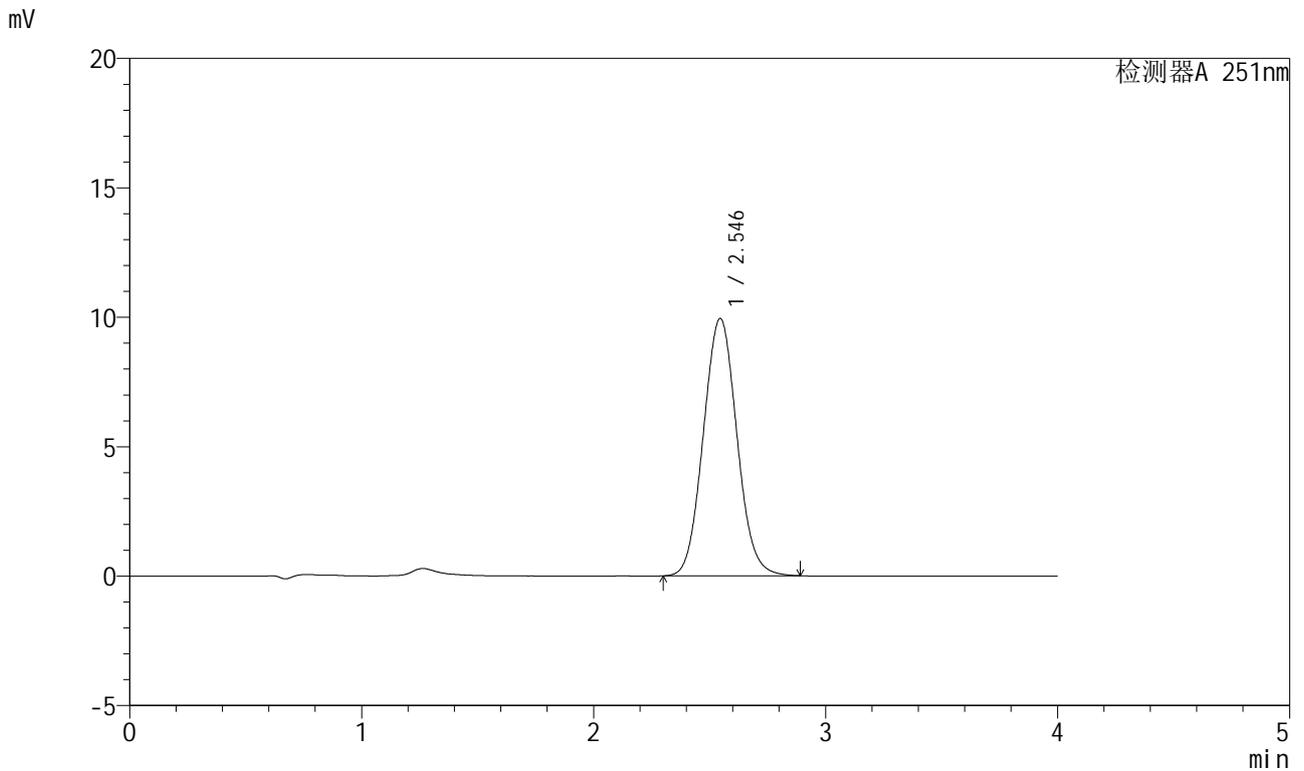

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	100033	100.000	9943	1484	1.064	--
总计		100033	100.000	9943			

图45 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3329-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:39:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

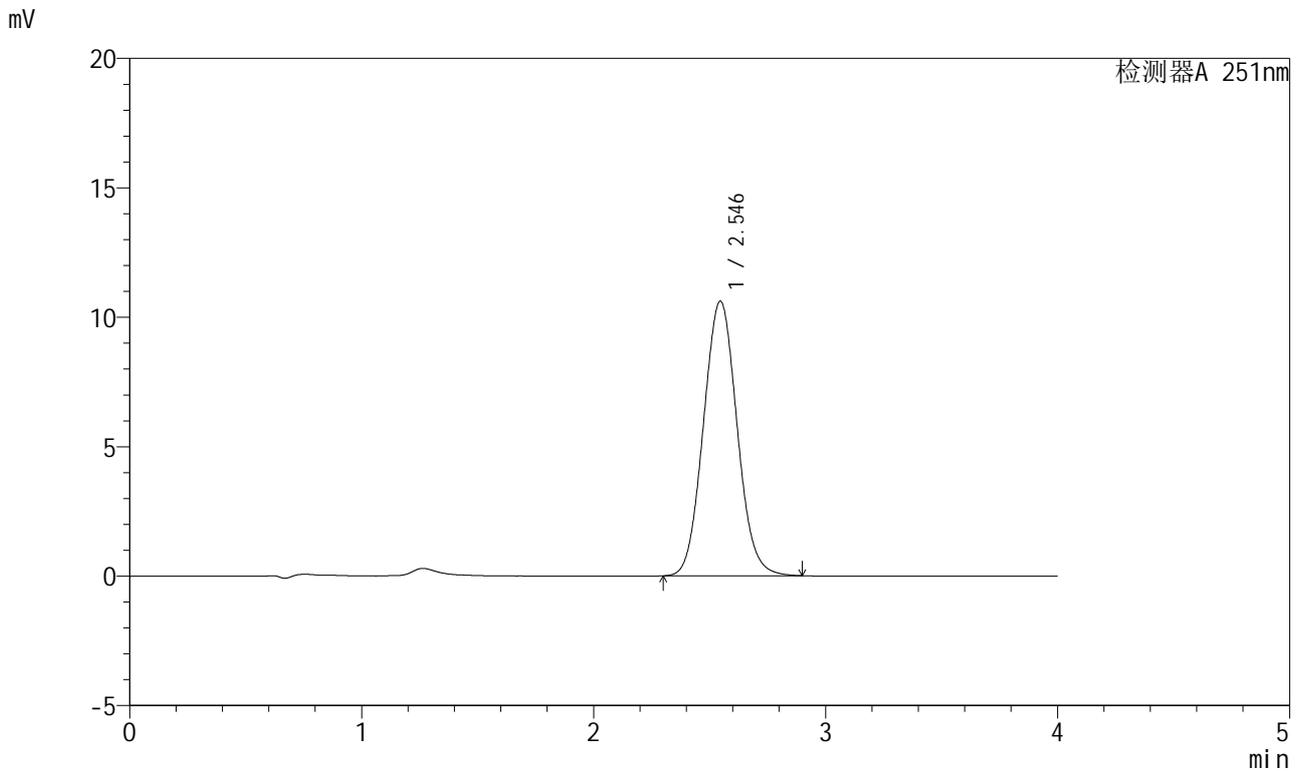

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	106956	100.000	10613	1481	1.065	--
总计		106956	100.000	10613			

图46 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3330-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:43:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

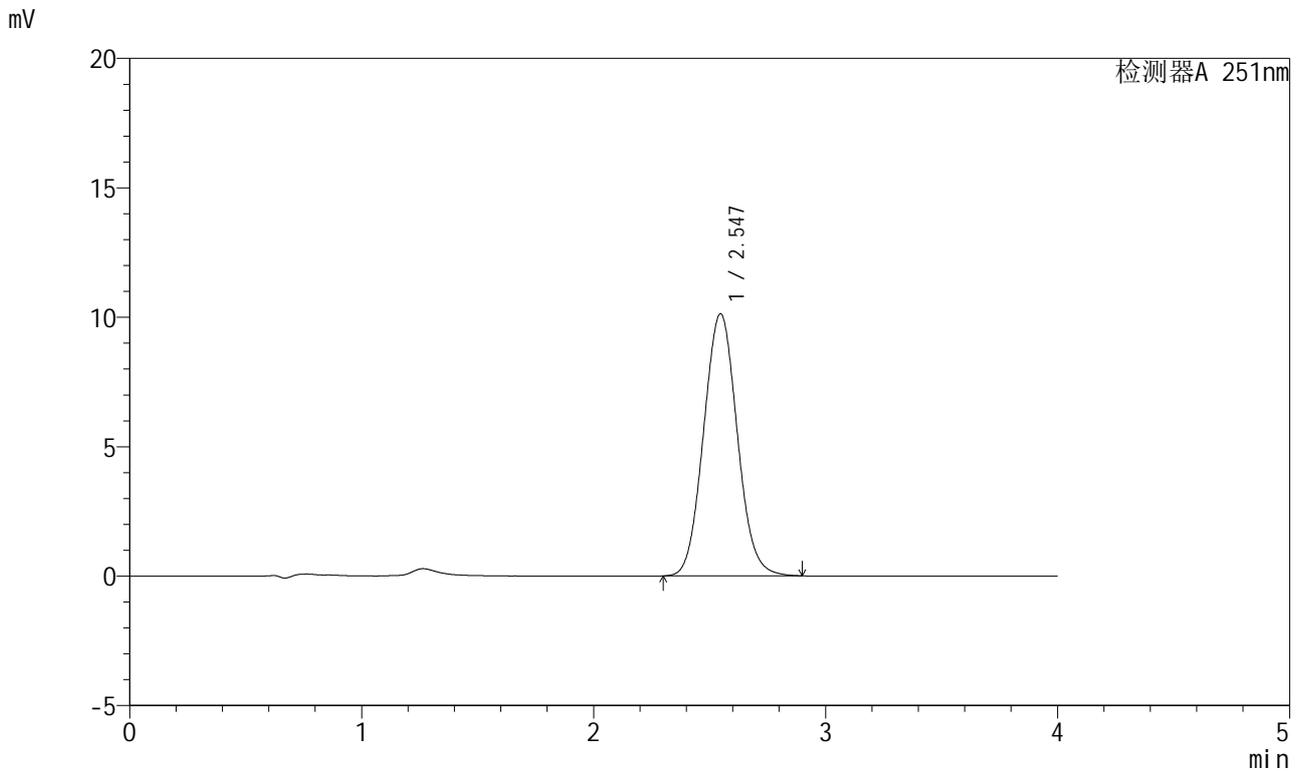

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	102028	100.000	10129	1481	1.065	--
总计		102028	100.000	10129			

图47 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3331-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:48:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

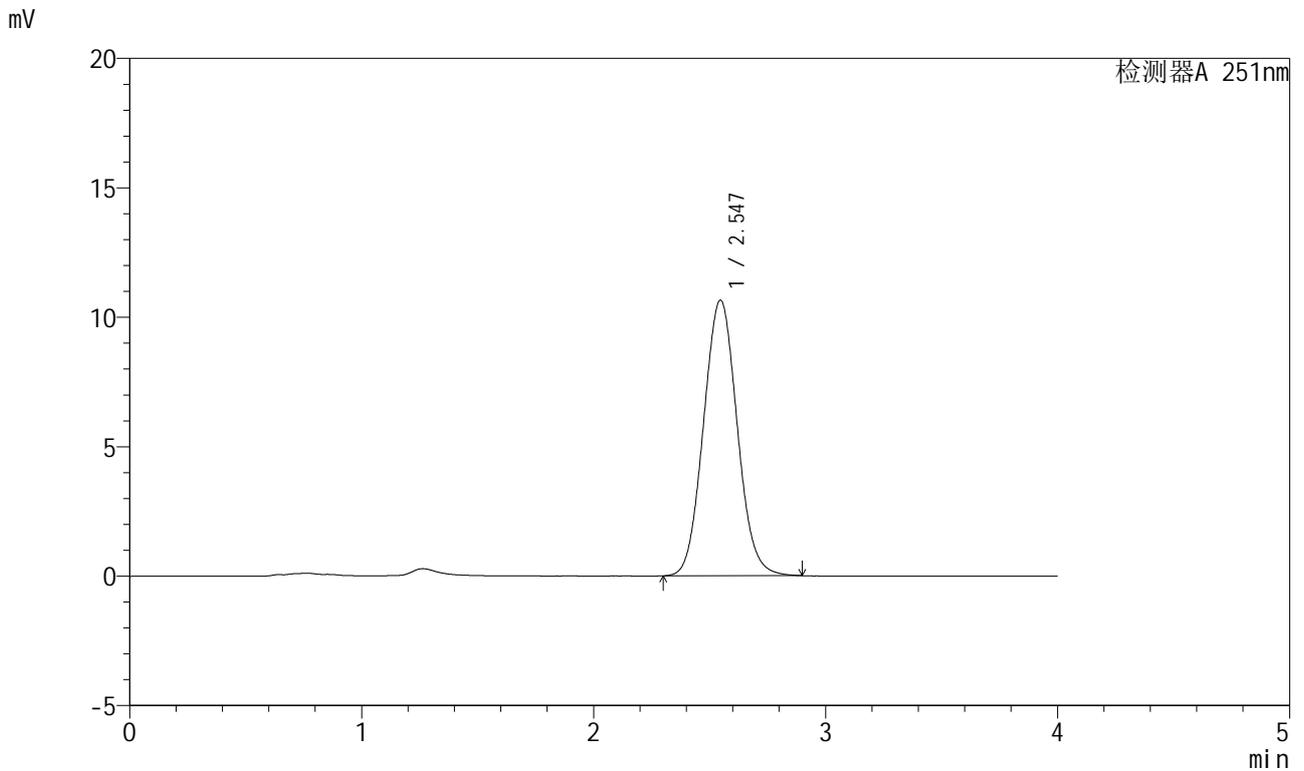

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	107367	100.000	10652	1478	1.064	--
总计		107367	100.000	10652			

图48 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3332-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 13:52:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:29:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

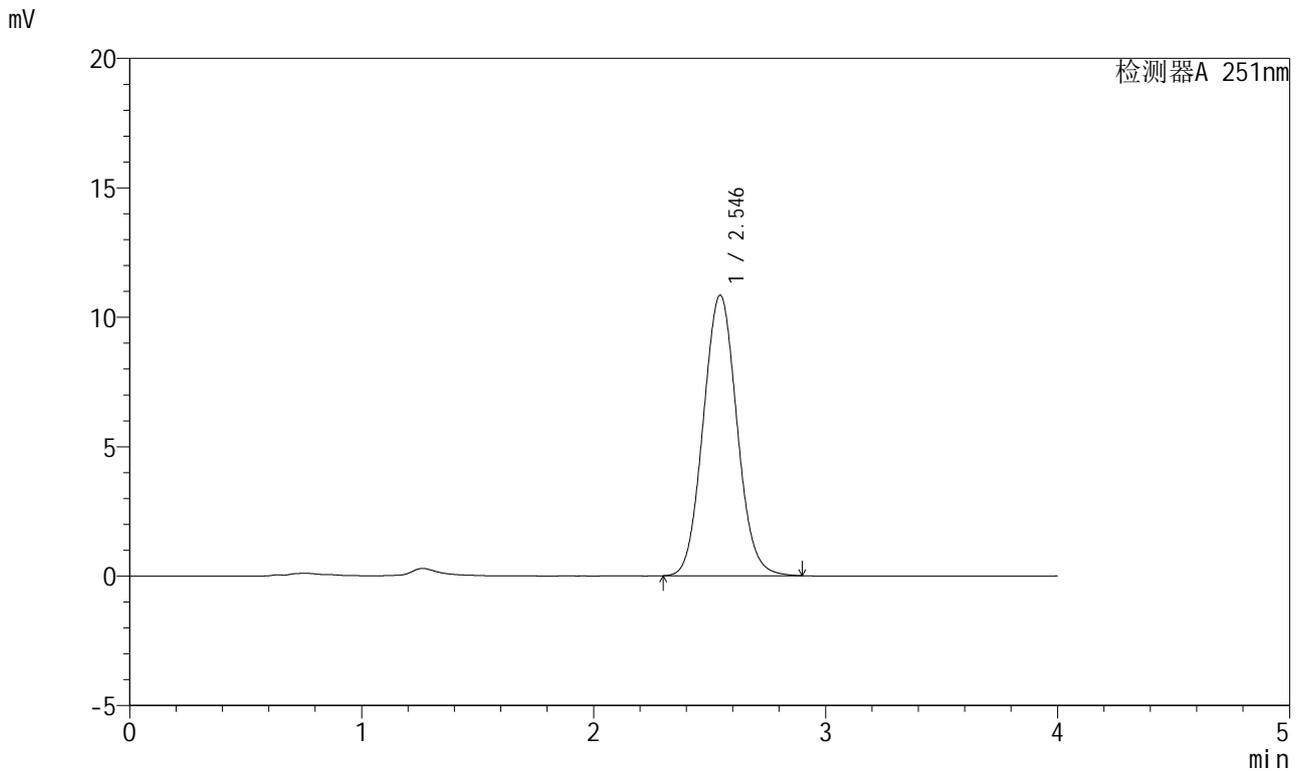

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	109248	100.000	10840	1477	1.064	--
总计		109248	100.000	10840			

图49 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3334-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:01:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

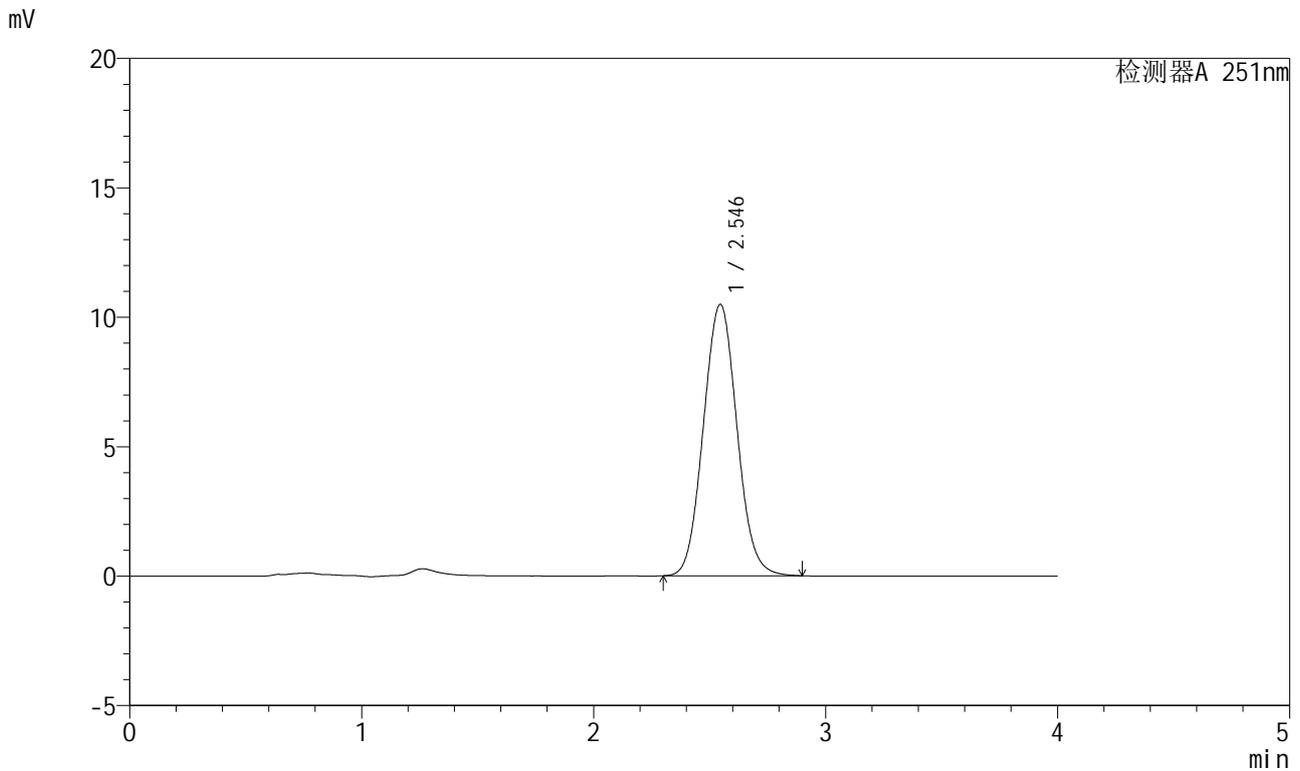

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	105491	100.000	10488	1486	1.063	--
总计		105491	100.000	10488			

图51 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3335-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:05:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

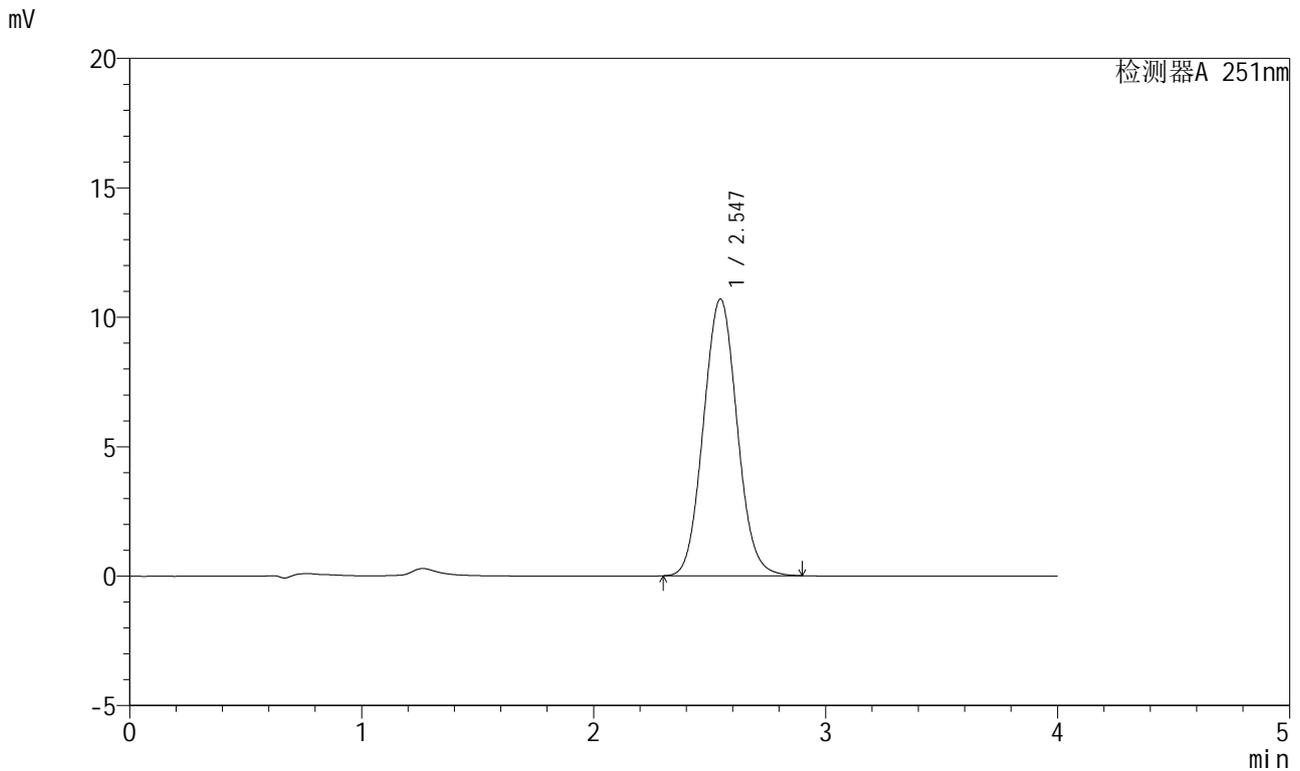

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	107847	100.000	10693	1476	1.064	--
总计		107847	100.000	10693			

图52 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3336-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:10:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

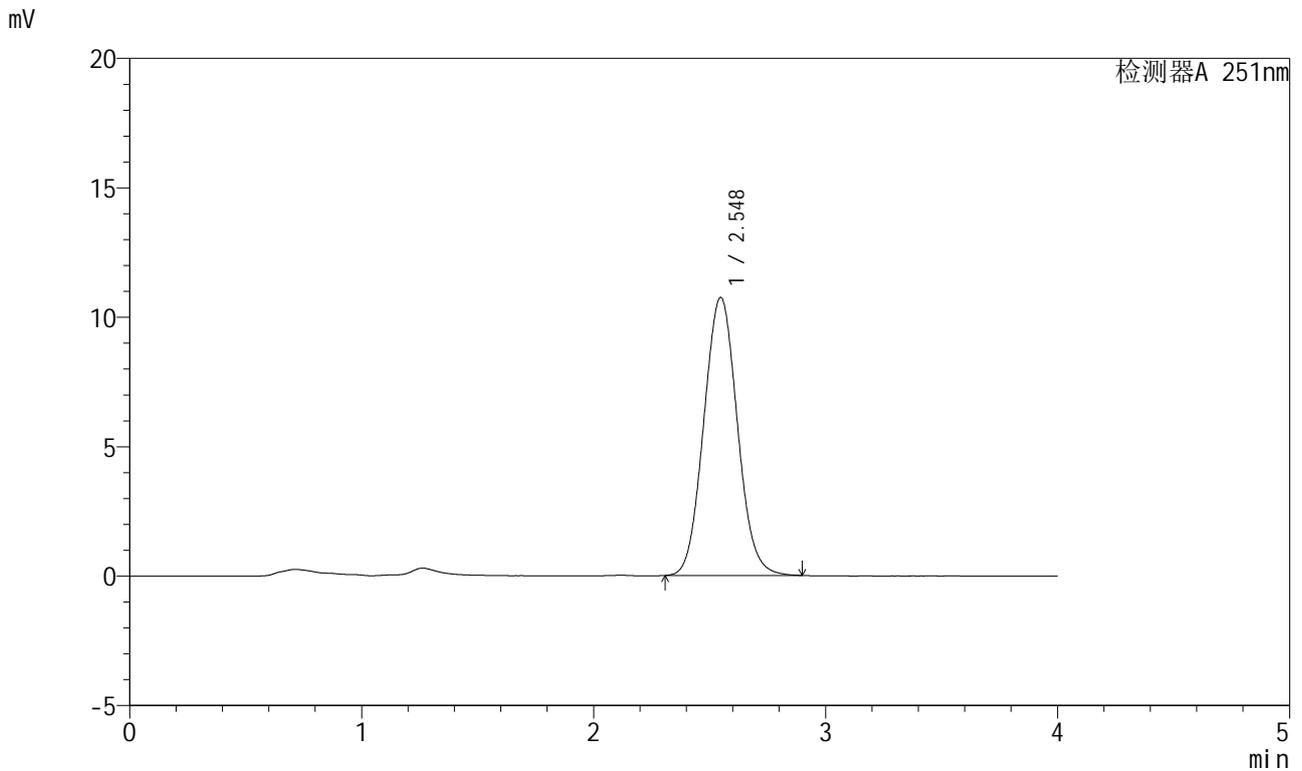

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	108063	100.000	10745	1488	1.064	--
总计		108063	100.000	10745			

图53 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3337-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:14:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

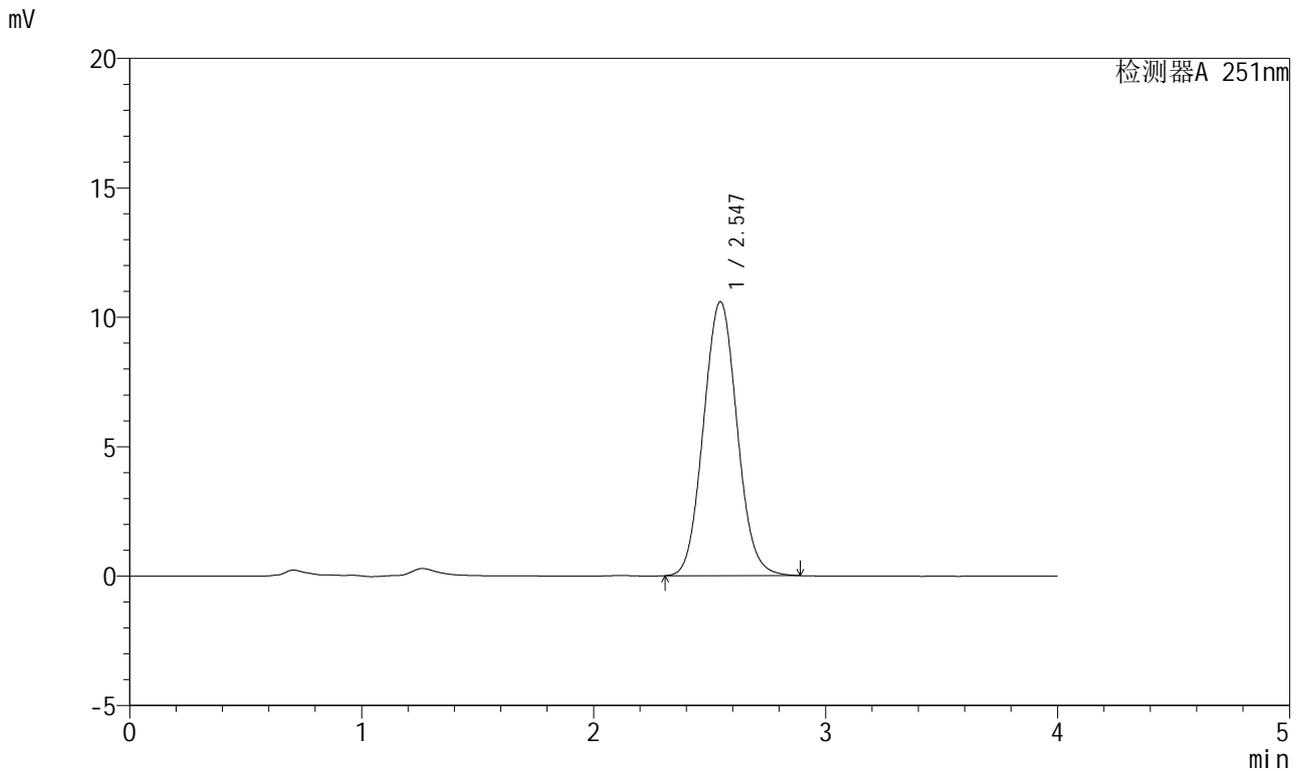

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	106559	100.000	10588	1483	1.065	--
总计		106559	100.000	10588			

图54 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3338-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:18:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

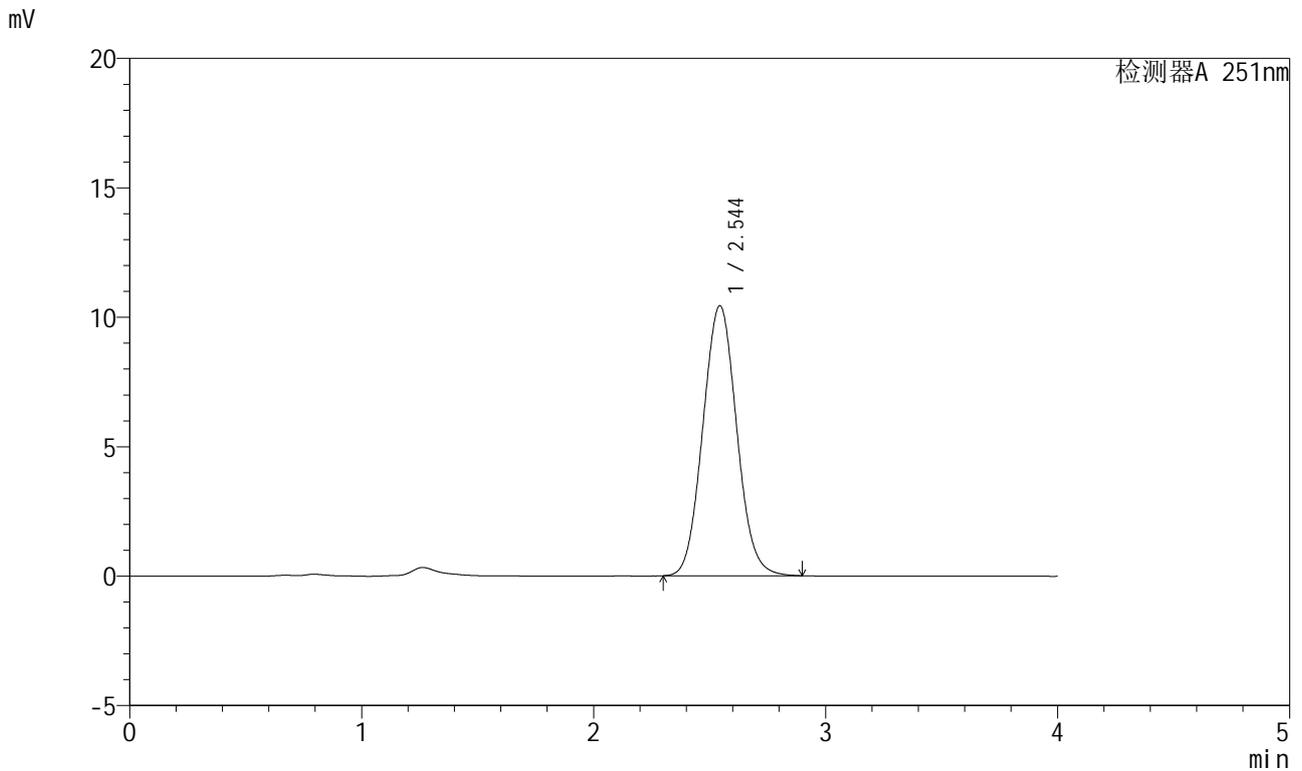

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	105865	100.000	10428	1454	1.064	--
总计		105865	100.000	10428			

图55 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3339-2 - zzp-2023111721p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:23:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

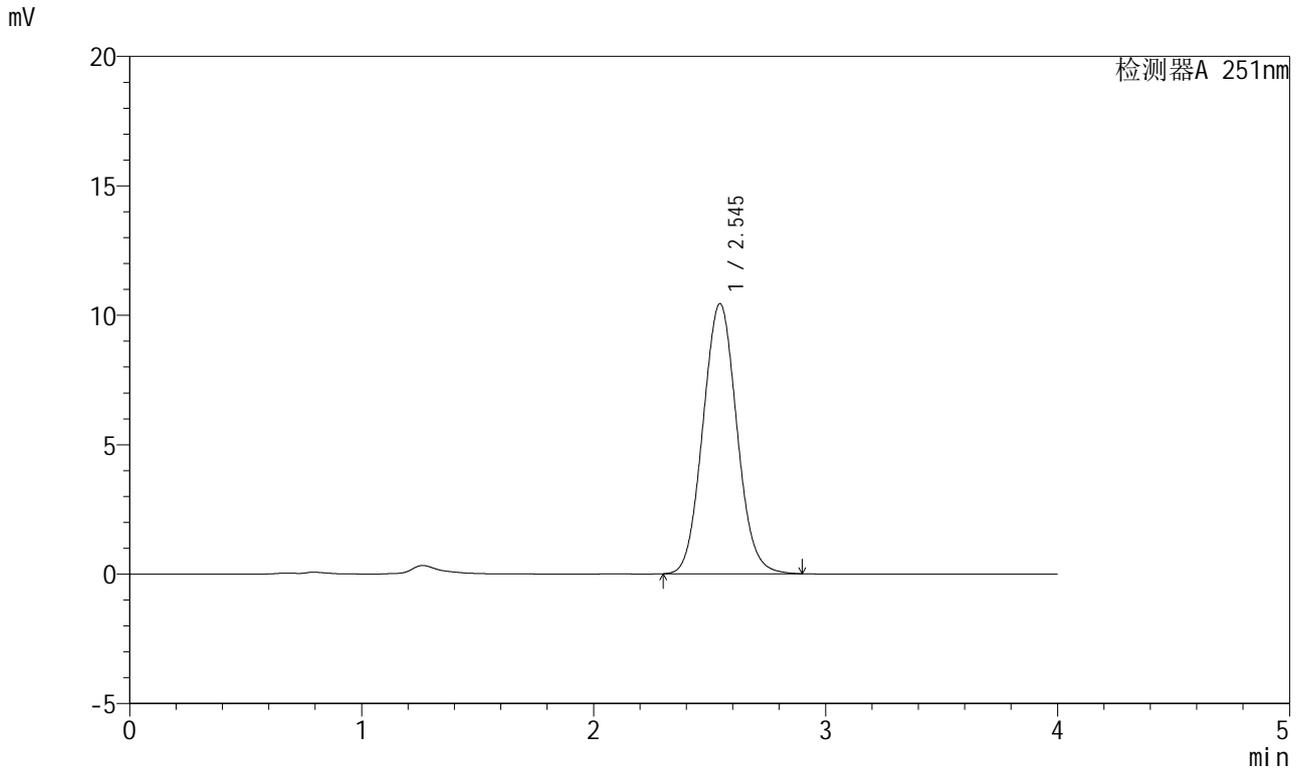

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	105929	100.000	10431	1454	1.065	--
总计		105929	100.000	10431			

图56 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3340-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:27:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

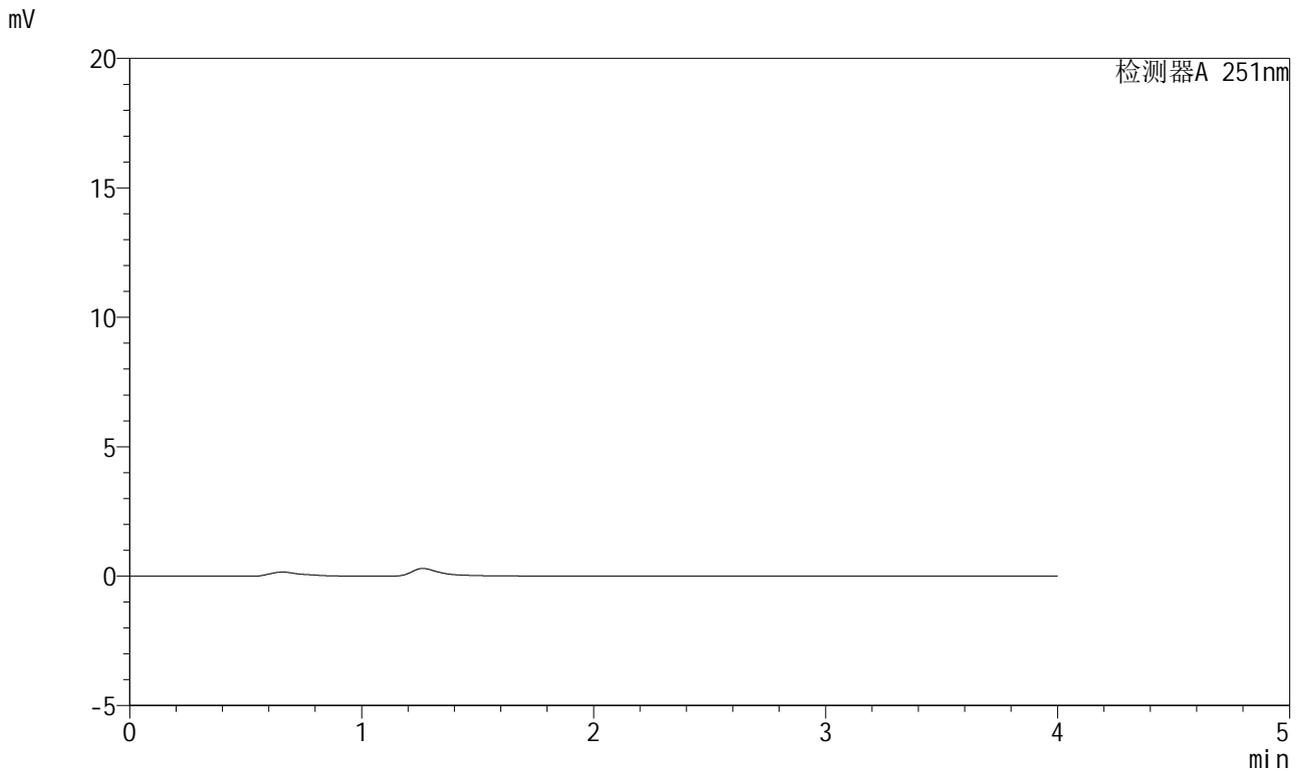

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3341-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:32:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

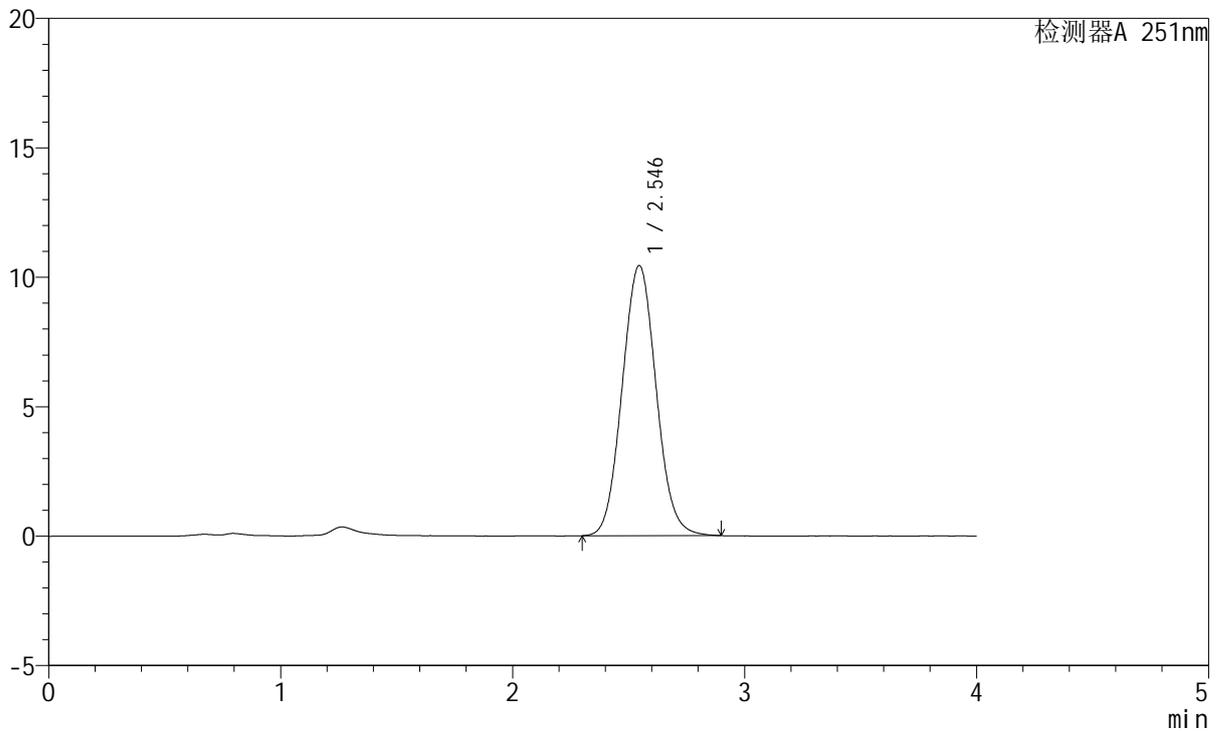

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	106132	100.000	10438	1448	1.064	--
总计		106132	100.000	10438			

图58 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3342-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:36:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

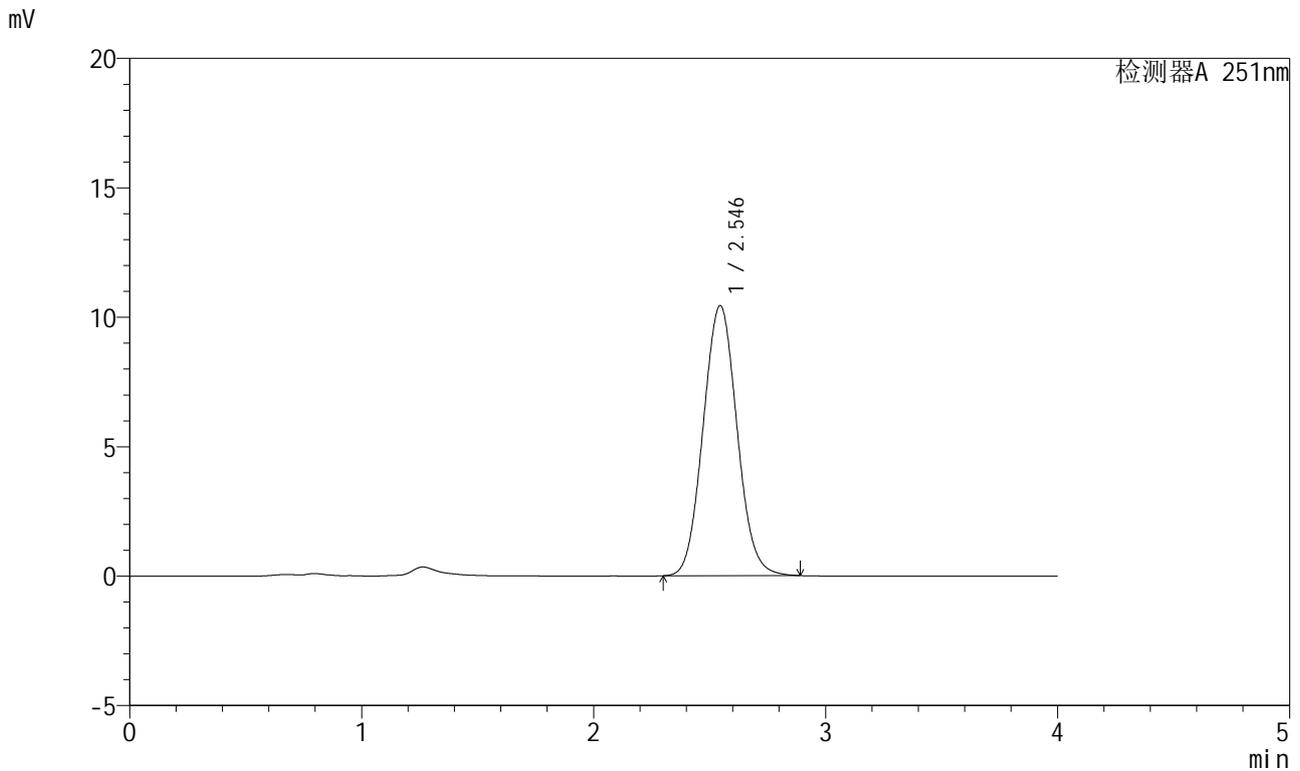

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	106006	100.000	10433	1449	1.063	--
总计		106006	100.000	10433			

图59 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3343-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:40:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

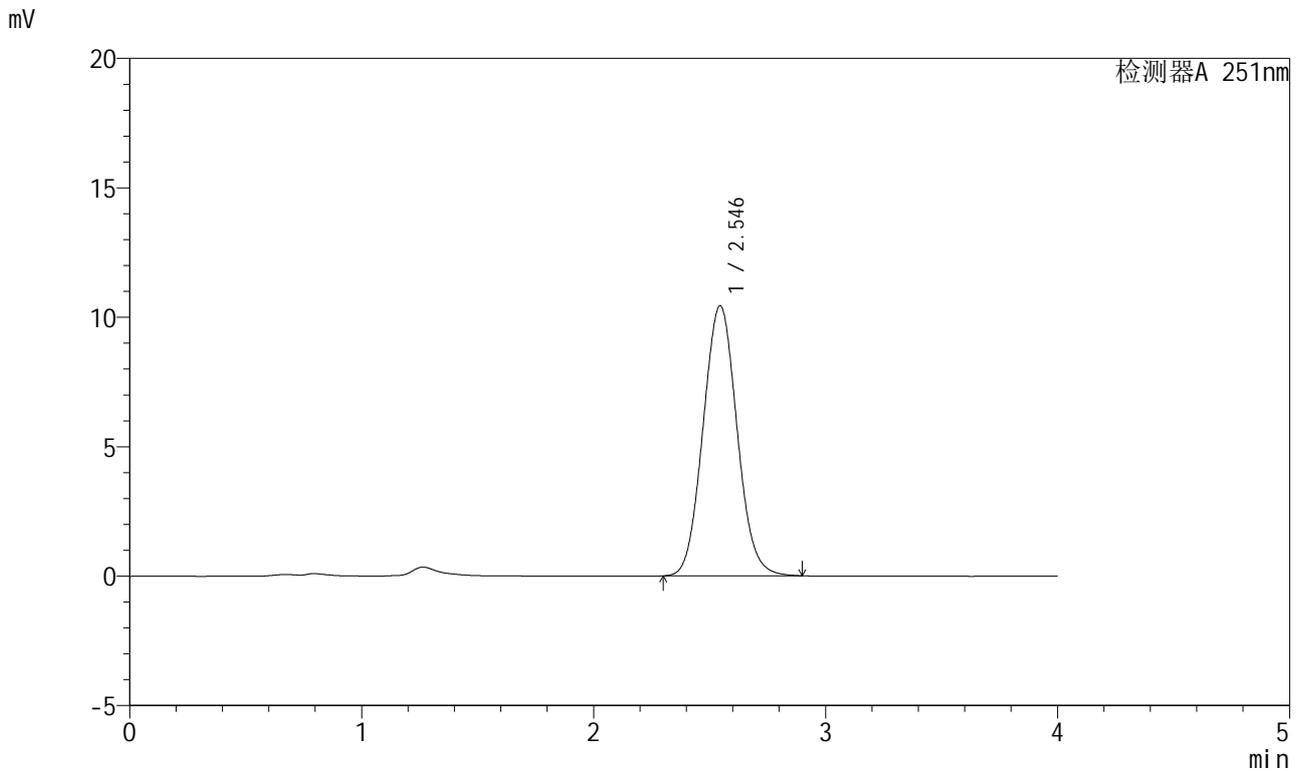

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	106177	100.000	10438	1449	1.063	--
总计		106177	100.000	10438			

图60 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3344-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:45:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

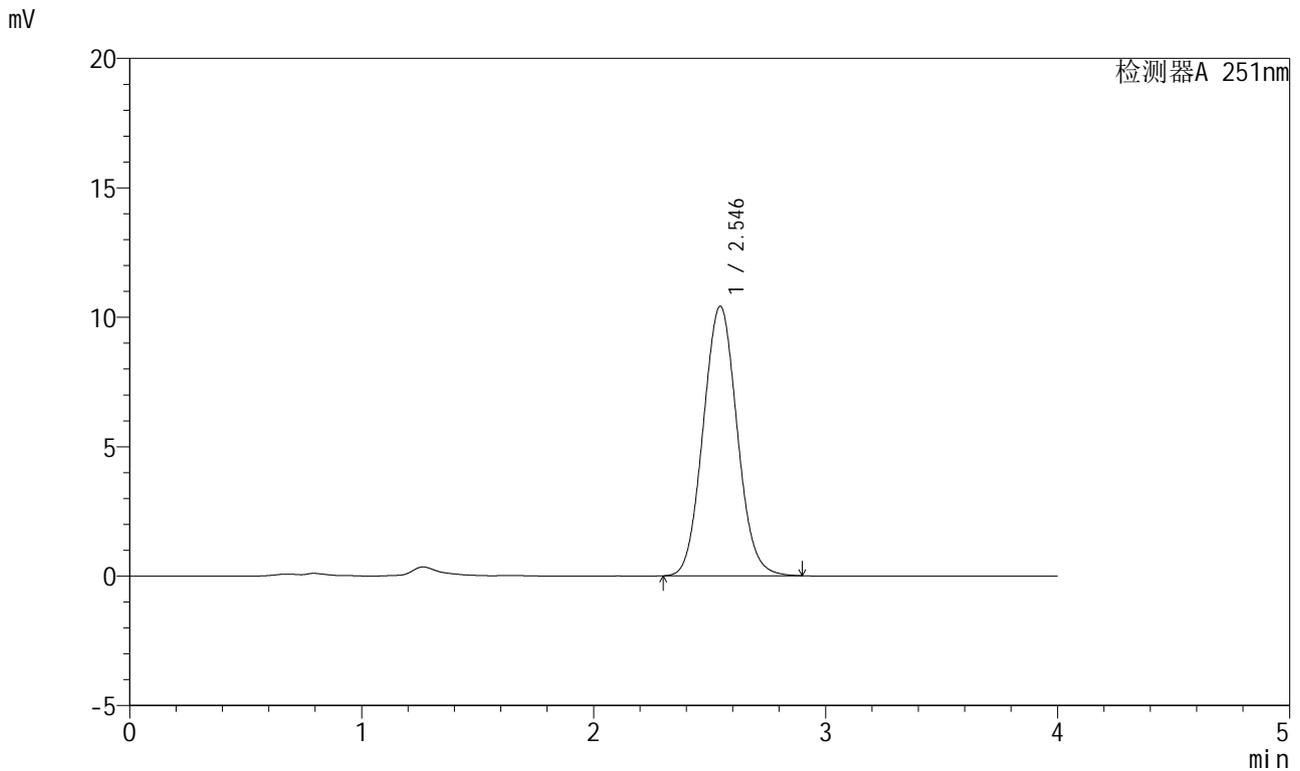

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	105896	100.000	10416	1451	1.063	--
总计		105896	100.000	10416			

图61 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3345-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:49:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

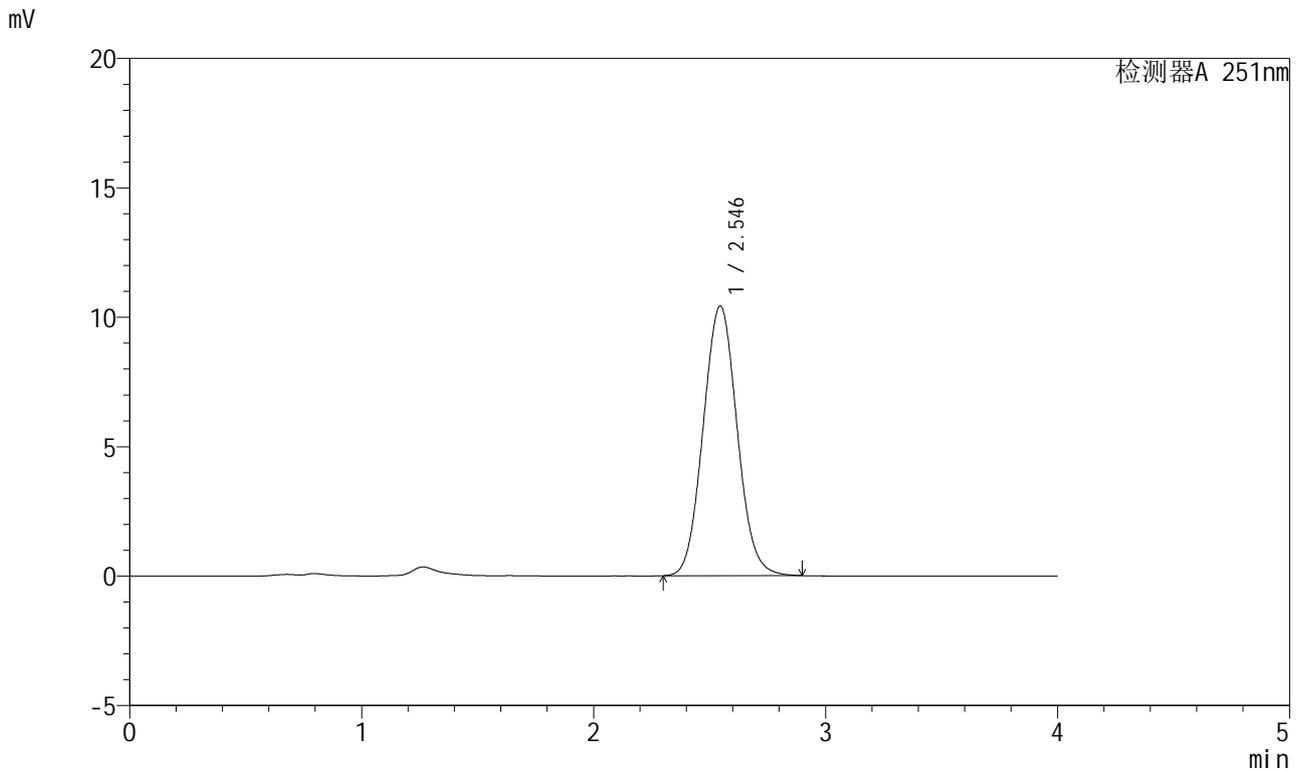

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	106028	100.000	10421	1446	1.064	--
总计		106028	100.000	10421			

图62 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3346-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:54:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

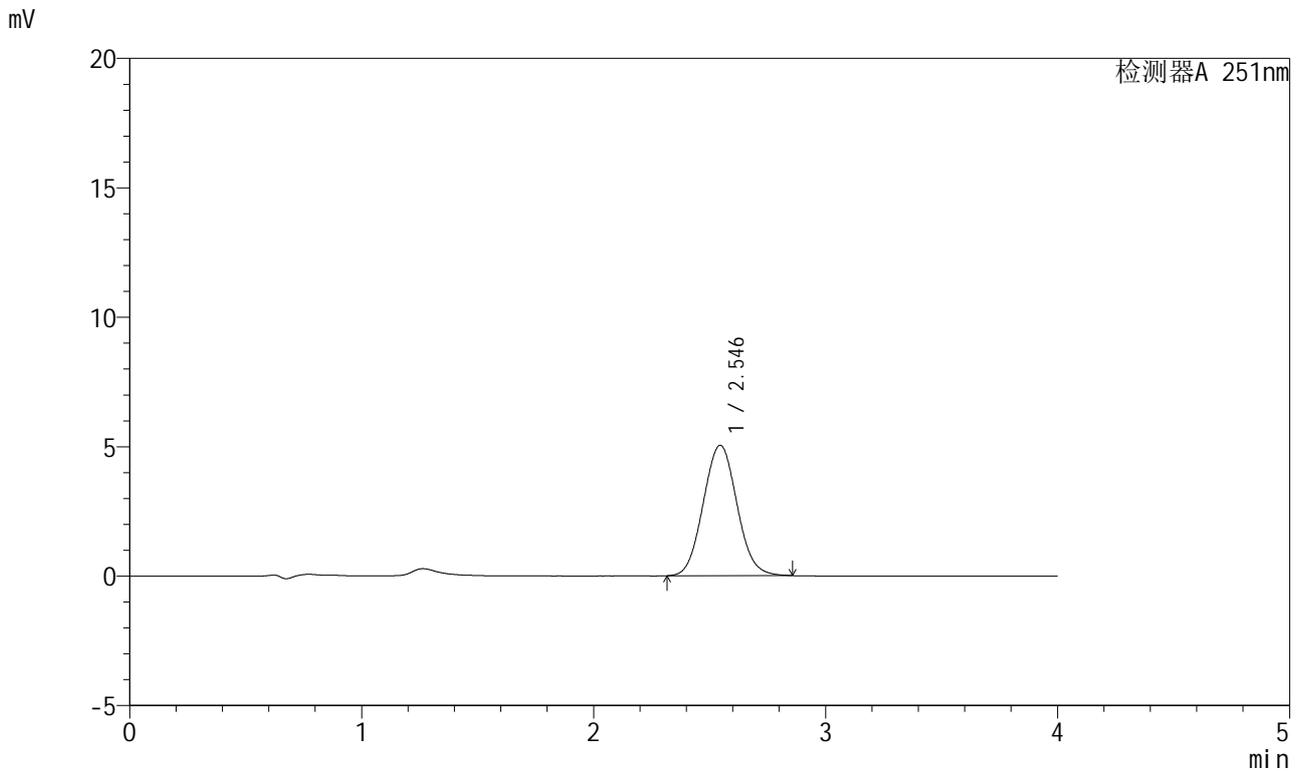

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	50907	100.000	5041	1464	1.060	--
总计		50907	100.000	5041			

图63 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3347-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 14:58:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

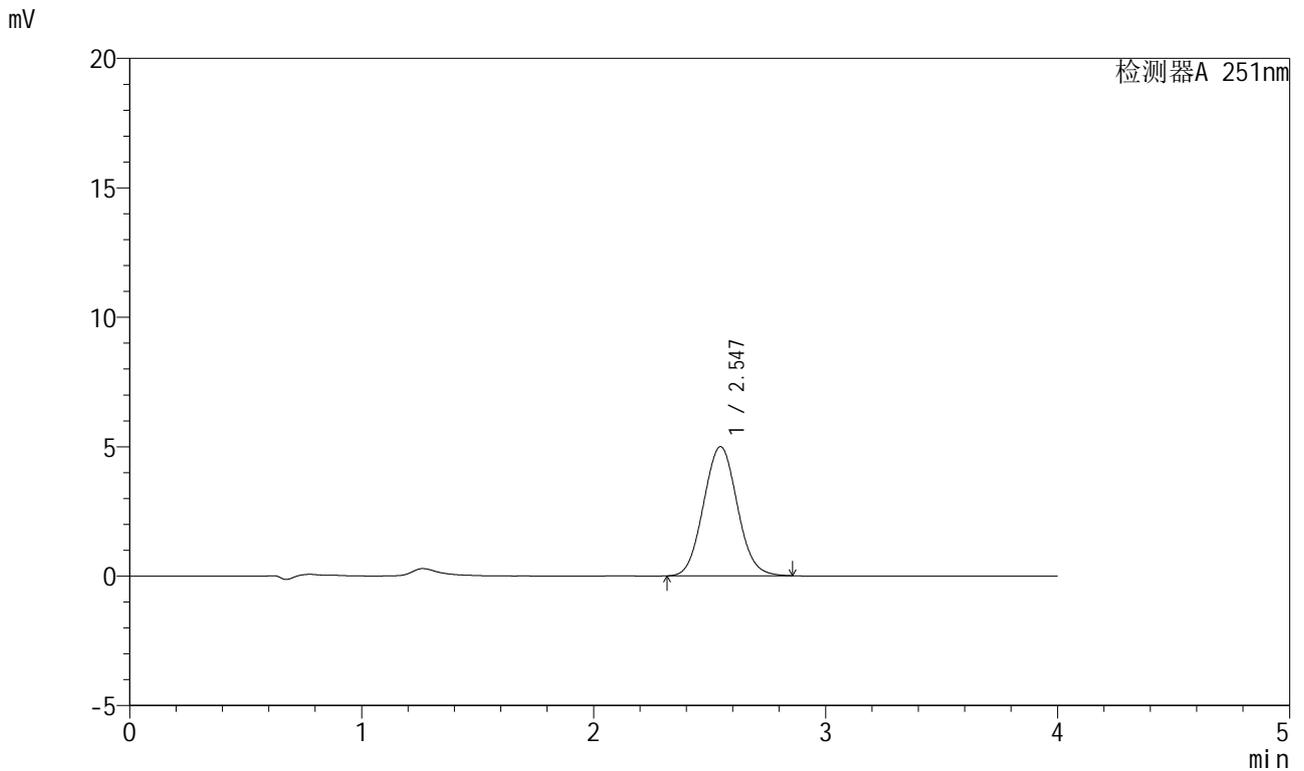

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	50448	100.000	4992	1463	1.061	--
总计		50448	100.000	4992			

图64 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3348-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:03:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

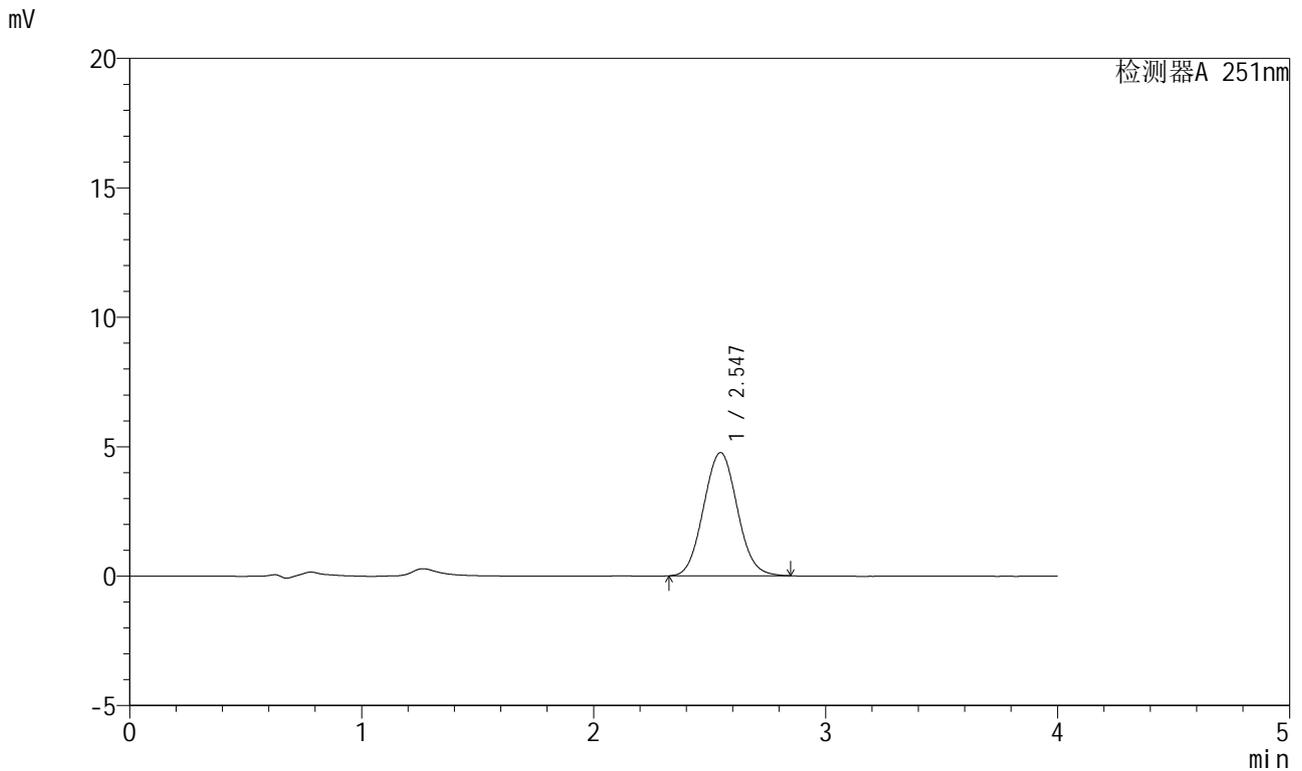

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	48026	100.000	4761	1465	1.059	--
总计		48026	100.000	4761			

图65 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3349-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:07:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

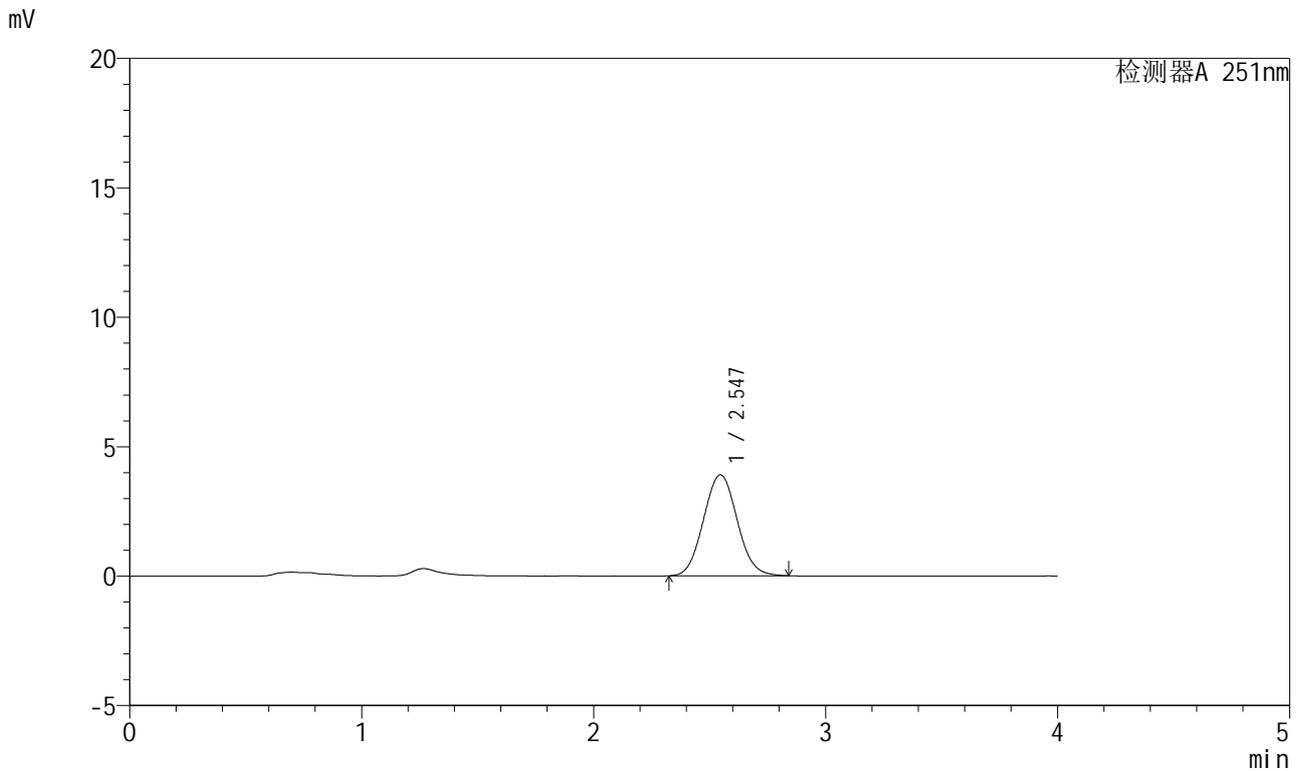

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	39384	100.000	3903	1464	1.059	--
总计		39384	100.000	3903			

图66 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3350-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:11:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

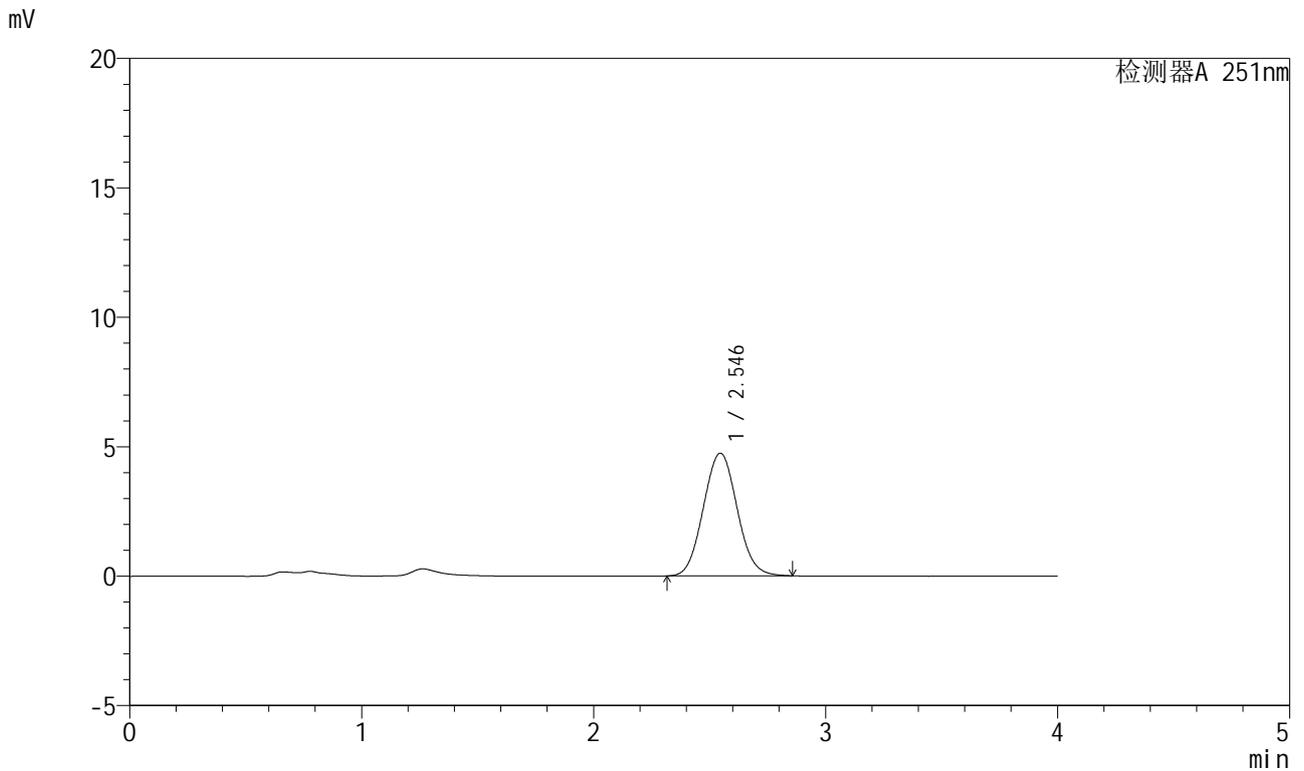

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	47974	100.000	4741	1460	1.060	--
总计		47974	100.000	4741			

图67 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3351-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:16:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

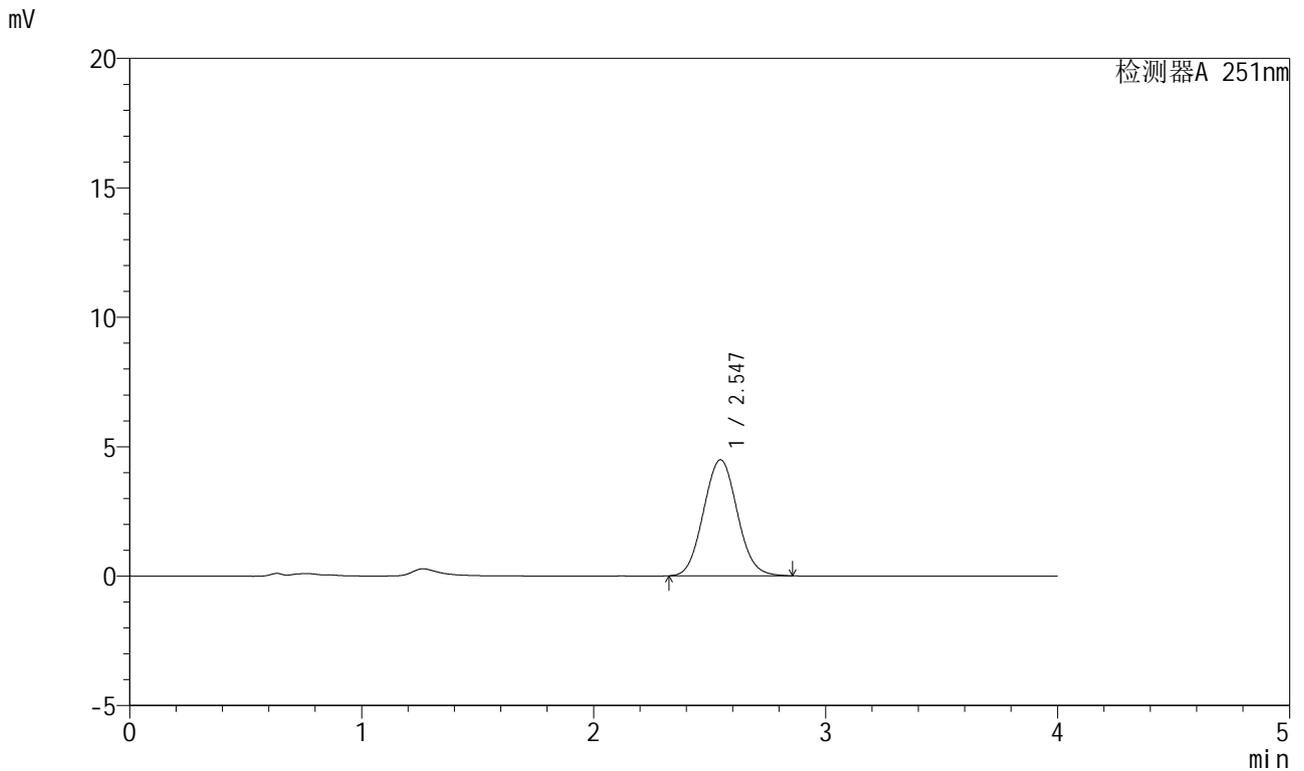

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	45309	100.000	4484	1463	1.062	--
总计		45309	100.000	4484			

图68 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3352-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:20:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

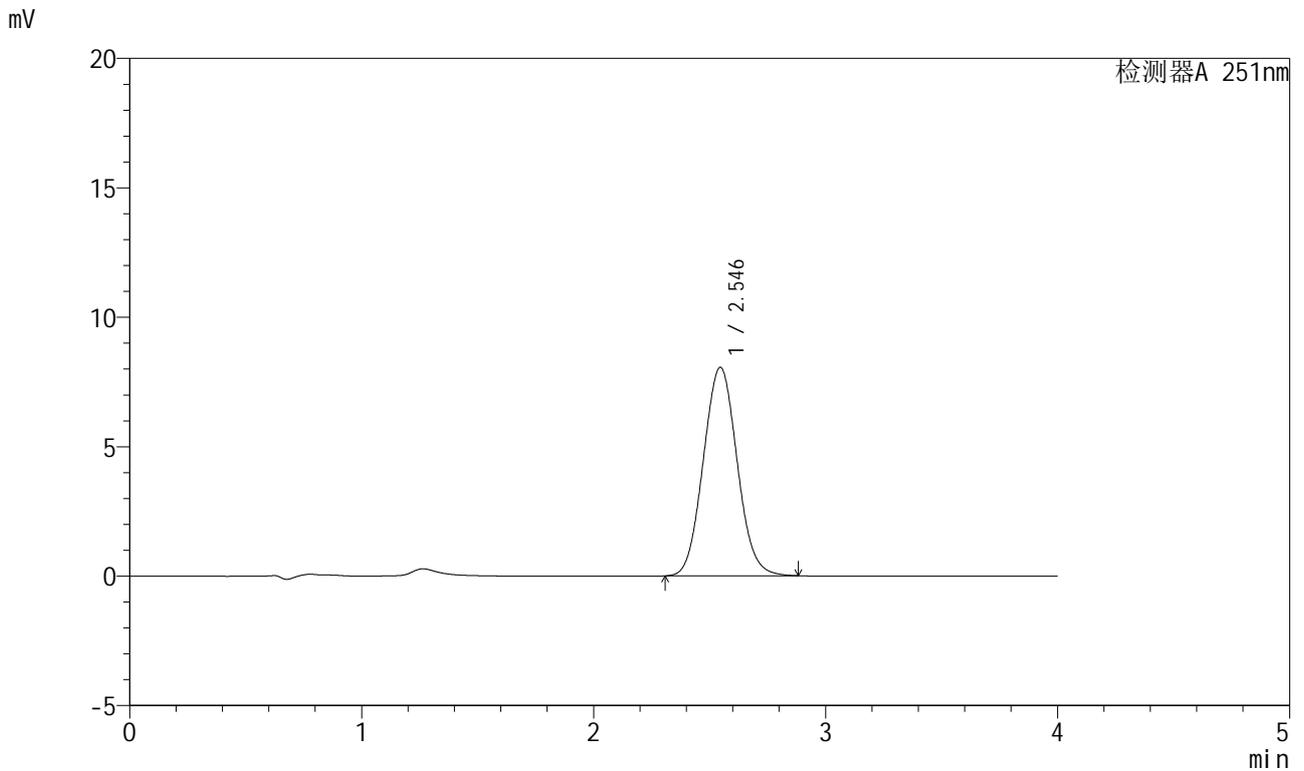

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	81688	100.000	8057	1458	1.063	--
总计		81688	100.000	8057			

图69 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3354-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:29:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

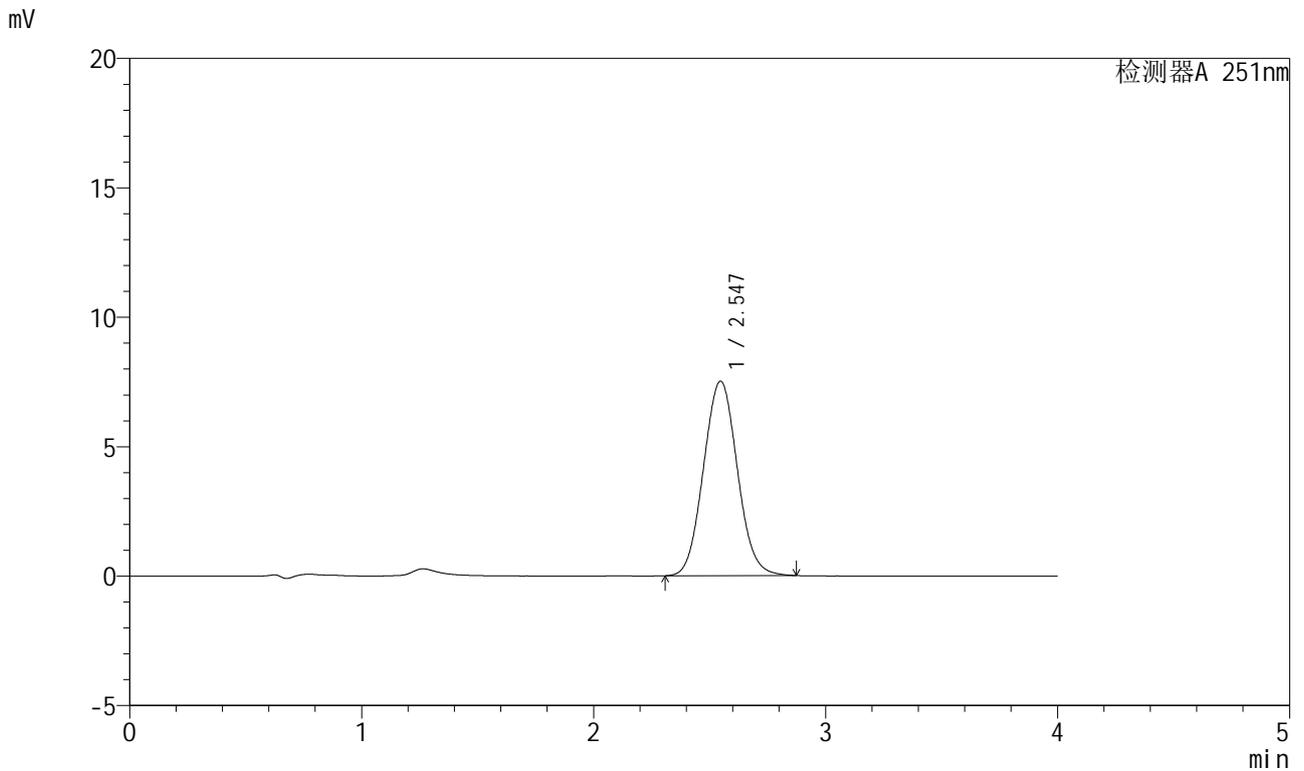

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	76198	100.000	7517	1460	1.062	--
总计		76198	100.000	7517			

图71 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3355-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:33:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

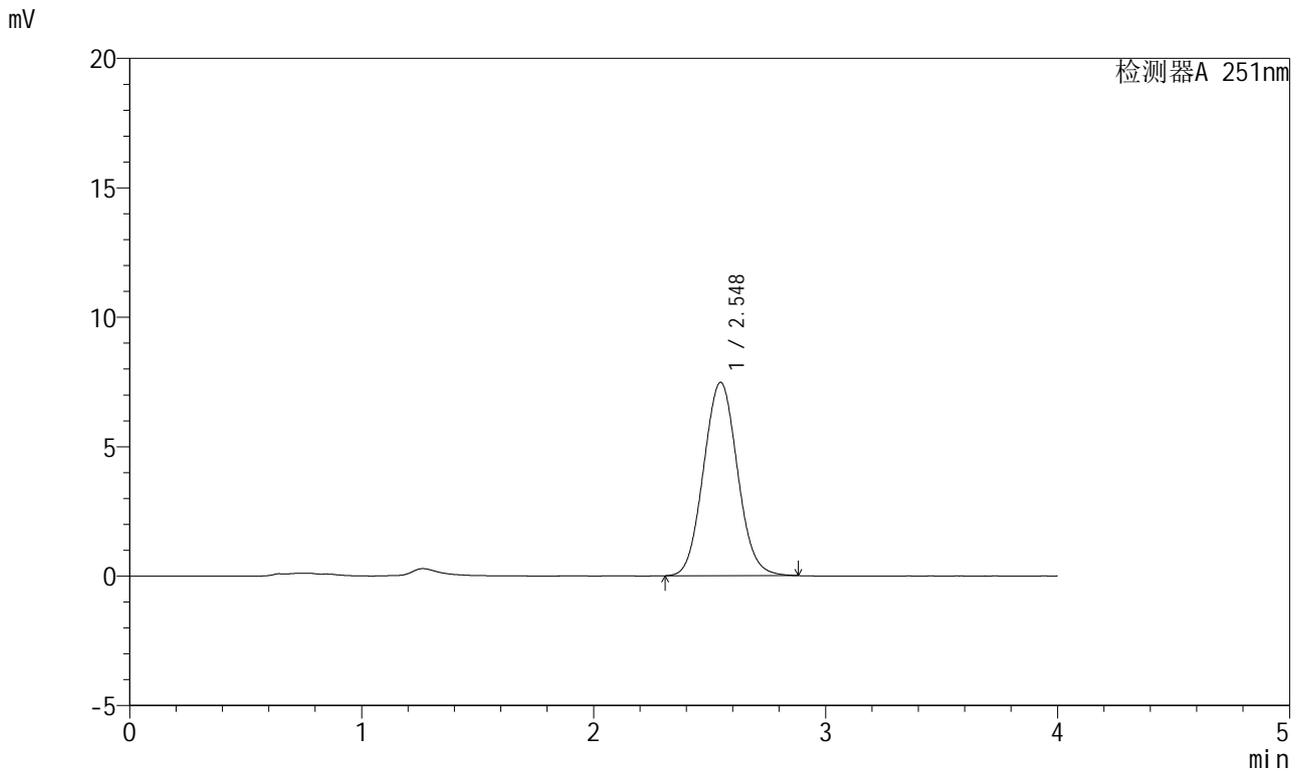

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	75818	100.000	7472	1456	1.062	--
总计		75818	100.000	7472			

图72 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3356-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:38:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:30:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

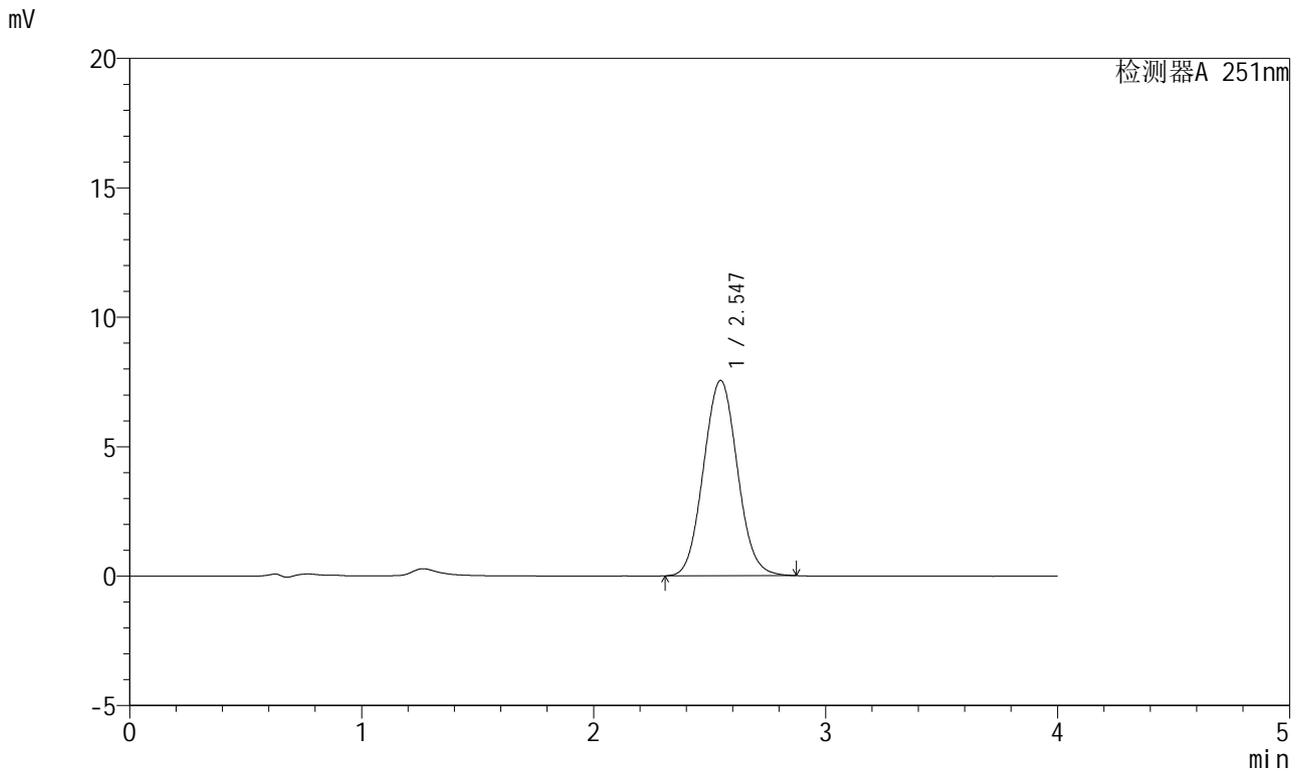

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	76598	100.000	7547	1455	1.061	--
总计		76598	100.000	7547			

图73 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3357-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:42:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

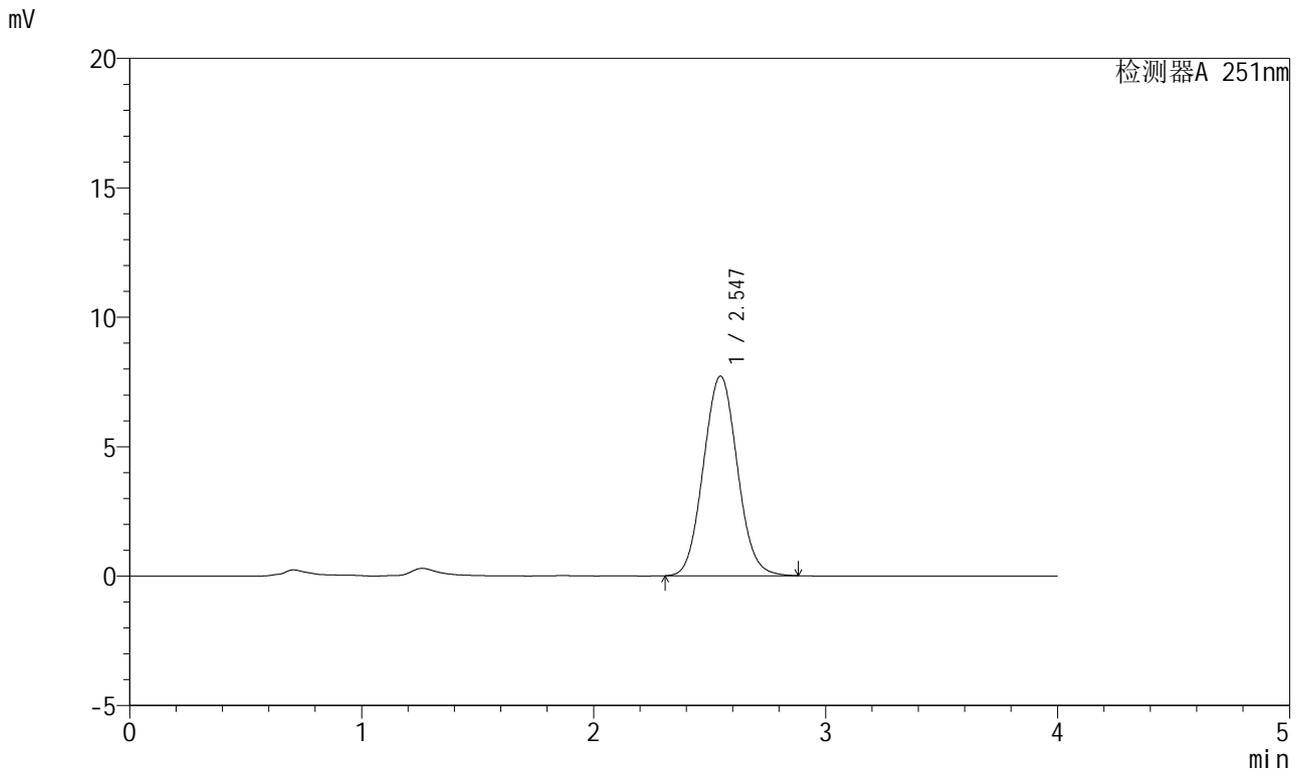

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	78318	100.000	7714	1454	1.061	--
总计		78318	100.000	7714			

图74 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3358-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:47:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

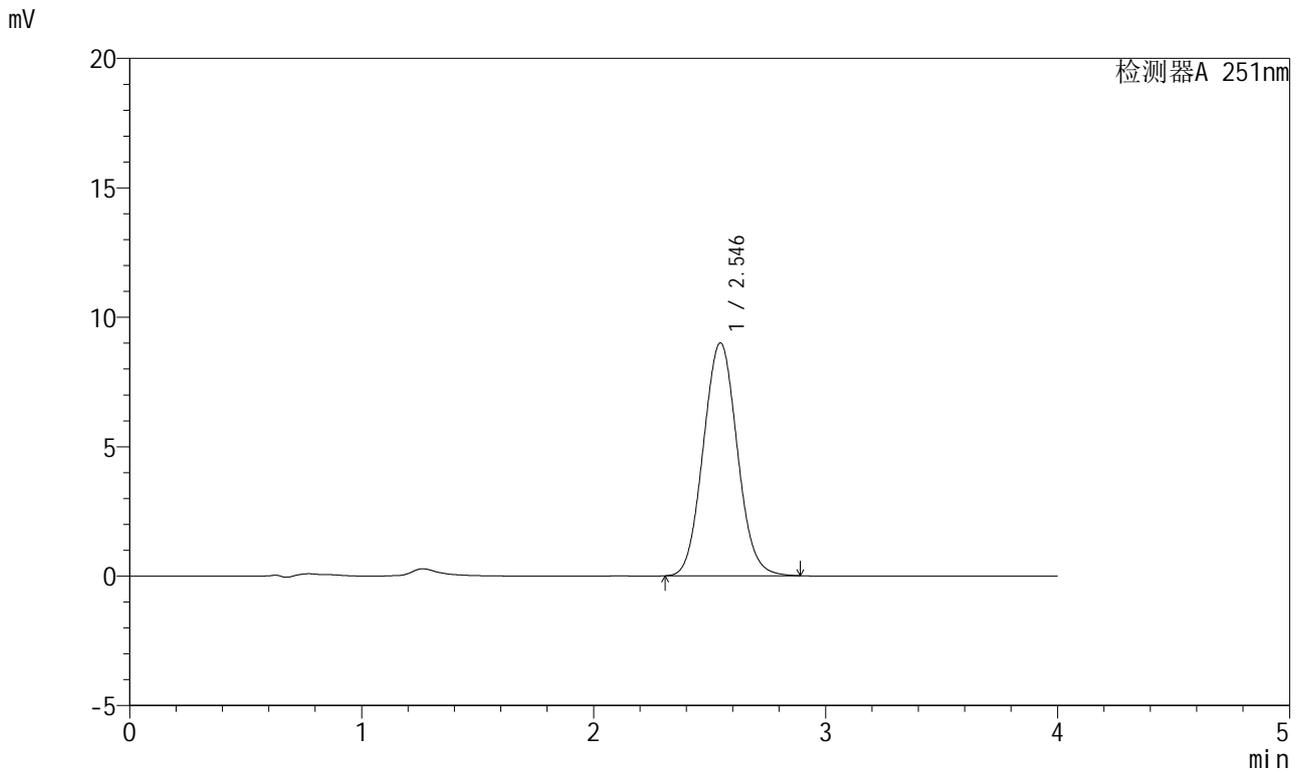

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	91476	100.000	8999	1451	1.063	--
总计		91476	100.000	8999			

图75 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3359-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:51:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

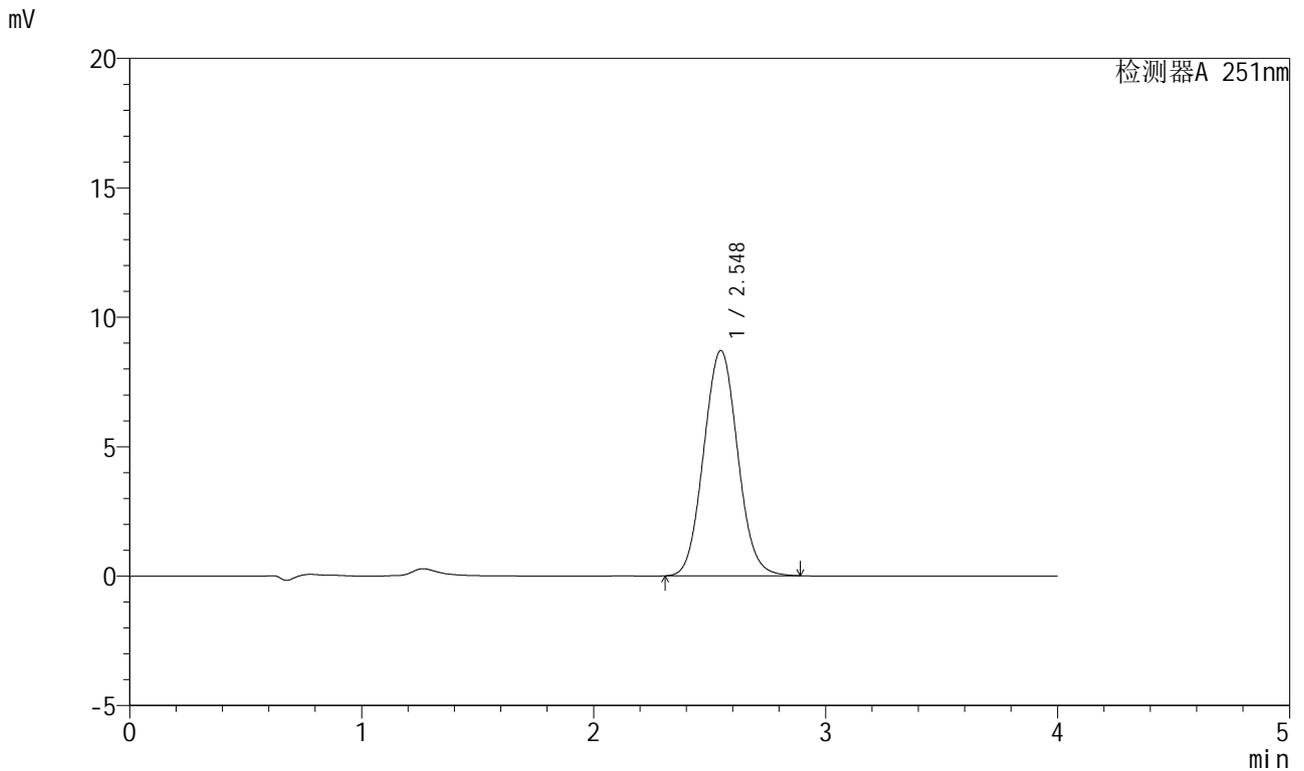

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	88536	100.000	8703	1452	1.062	--
总计		88536	100.000	8703			

图76 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3360-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 15:55:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

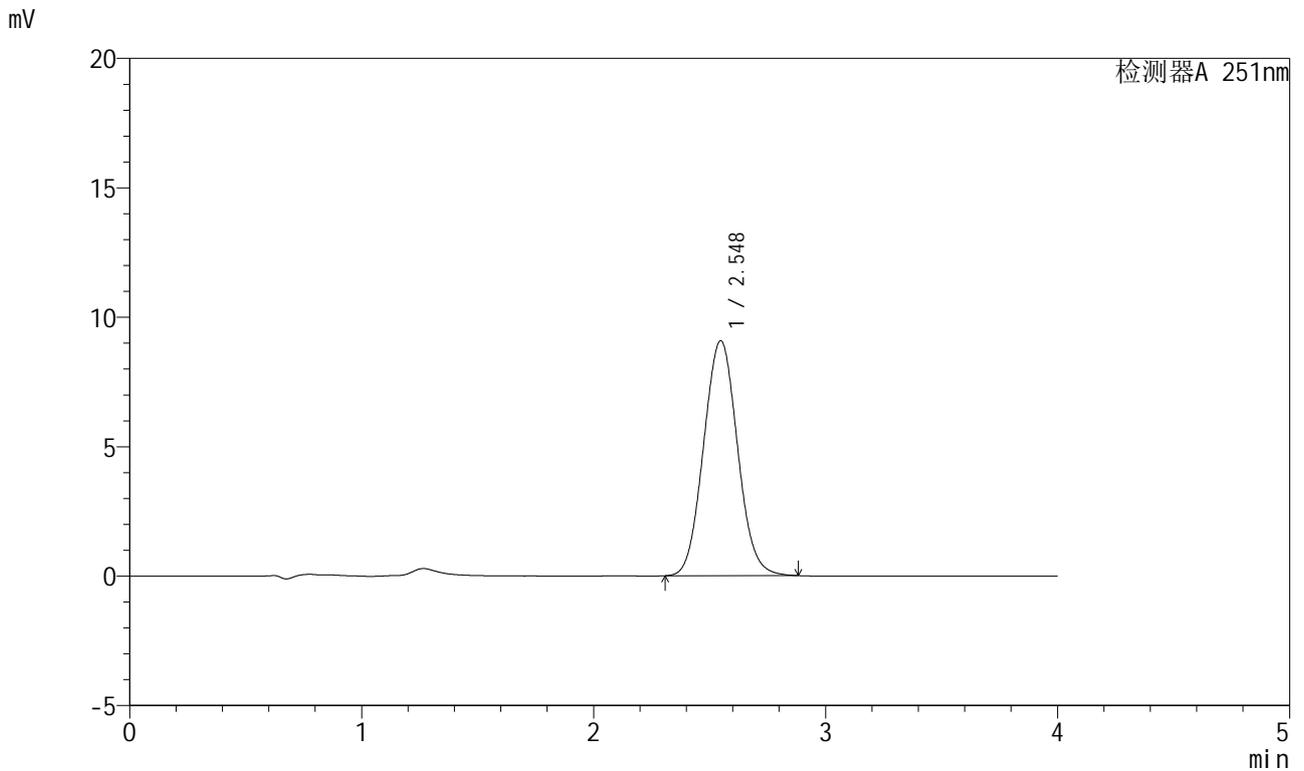

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	92239	100.000	9079	1453	1.060	--
总计		92239	100.000	9079			

图77 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3361-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:00:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

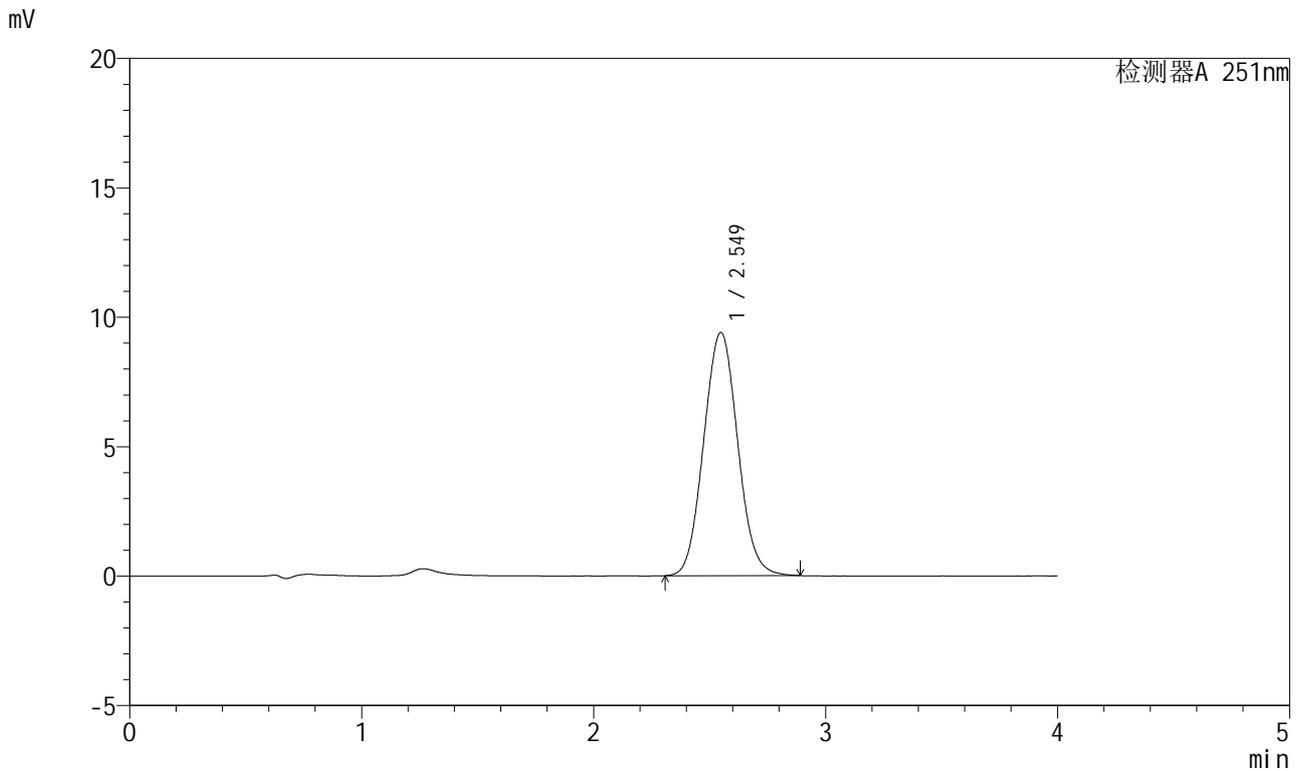

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	95651	100.000	9393	1449	1.062	--
总计		95651	100.000	9393			

图78 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3362-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:04:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

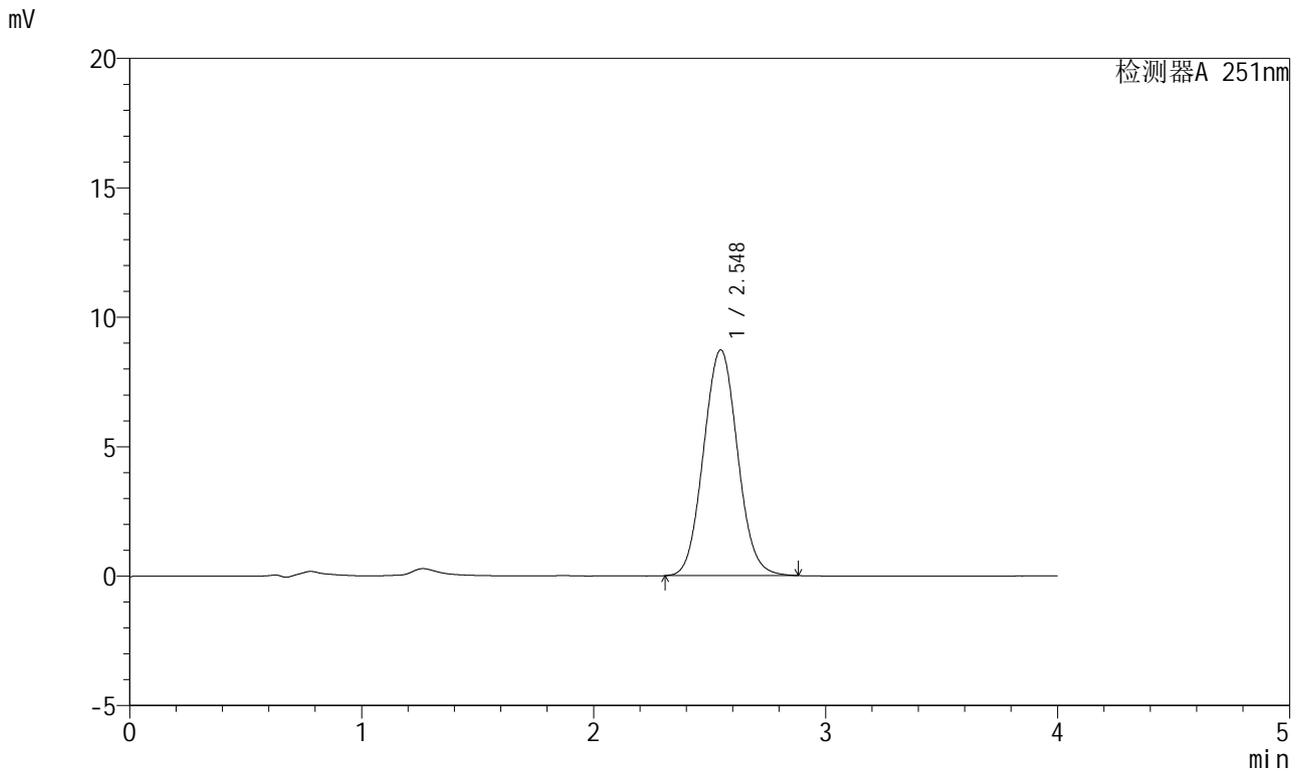

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	88798	100.000	8721	1448	1.059	--
总计		88798	100.000	8721			

图79 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3363-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:09:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

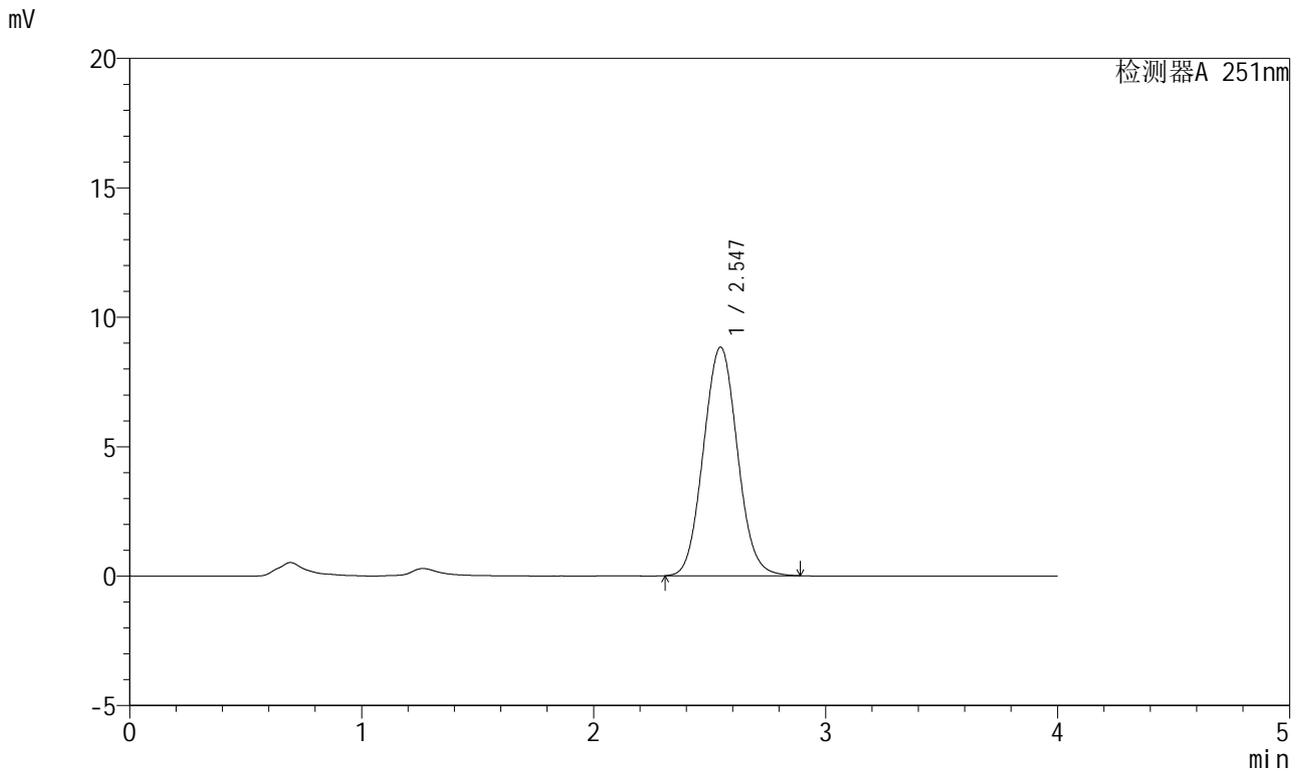

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	89872	100.000	8832	1448	1.062	--
总计		89872	100.000	8832			

图80 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3364-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:13:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

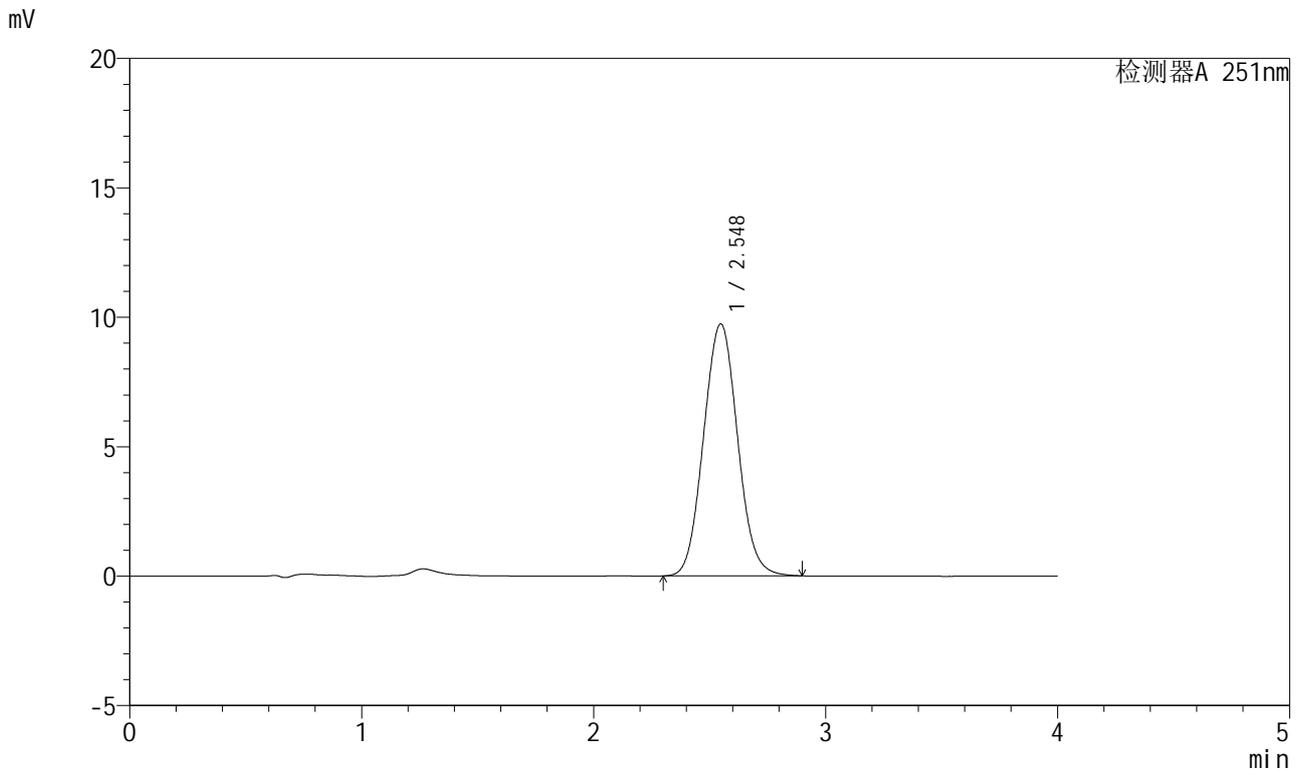

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	99206	100.000	9736	1448	1.062	--
总计		99206	100.000	9736			

图81 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3365-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:17:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

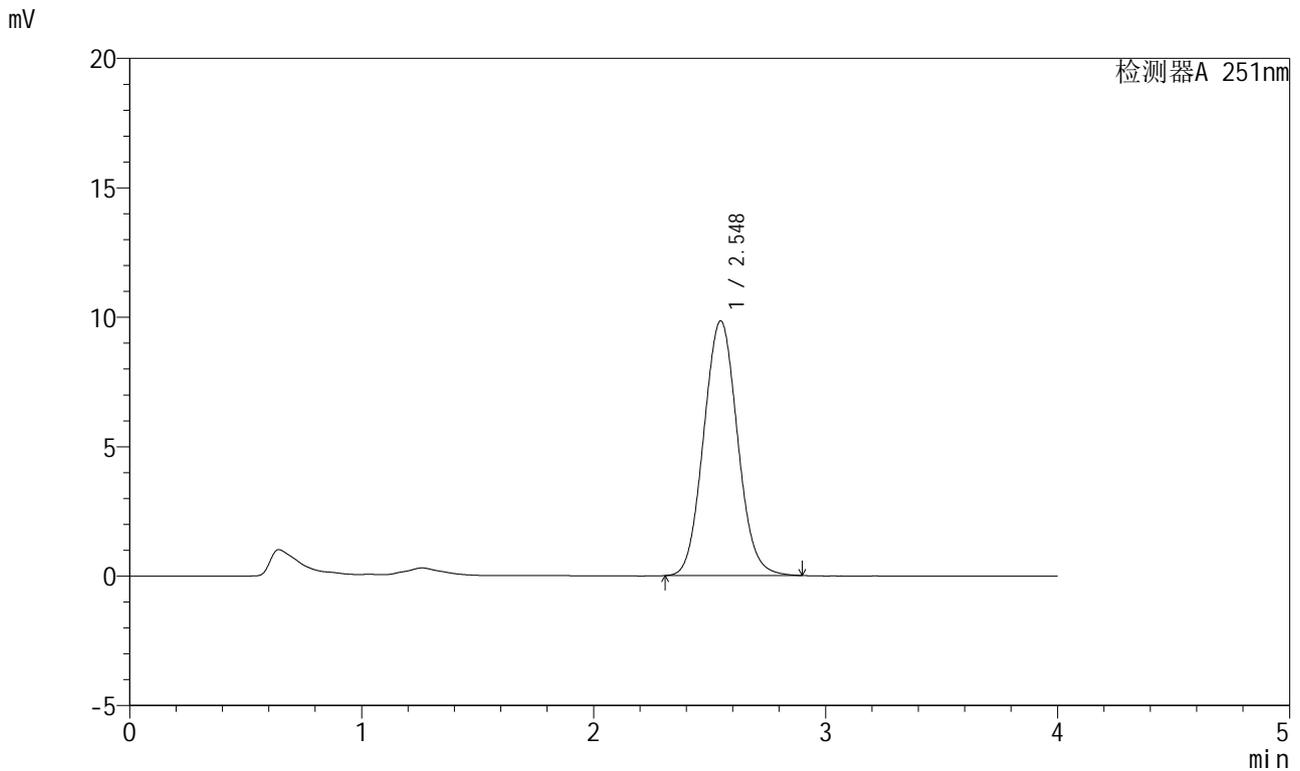

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	99617	100.000	9838	1469	1.066	--
总计		99617	100.000	9838			

图82 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3366-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:22:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

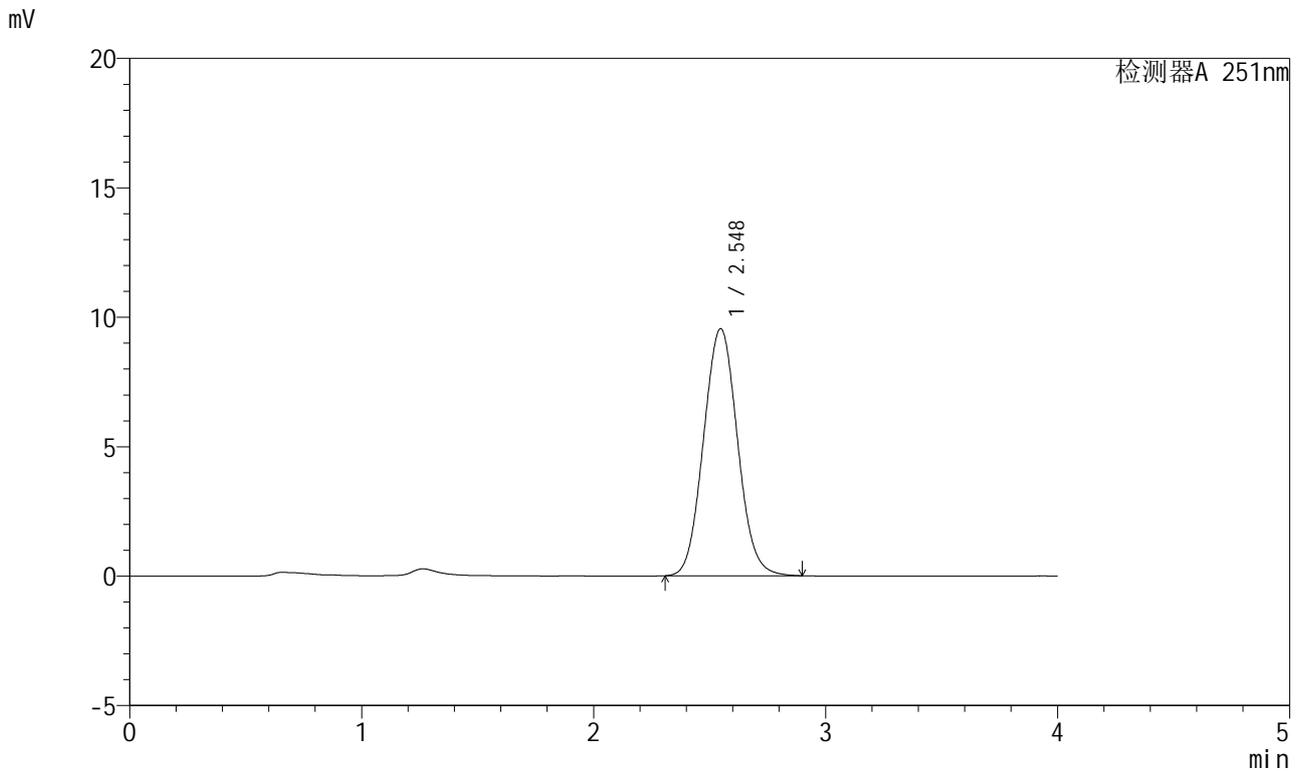

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	97266	100.000	9548	1449	1.064	--
总计		97266	100.000	9548			

图83 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3367-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:26:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

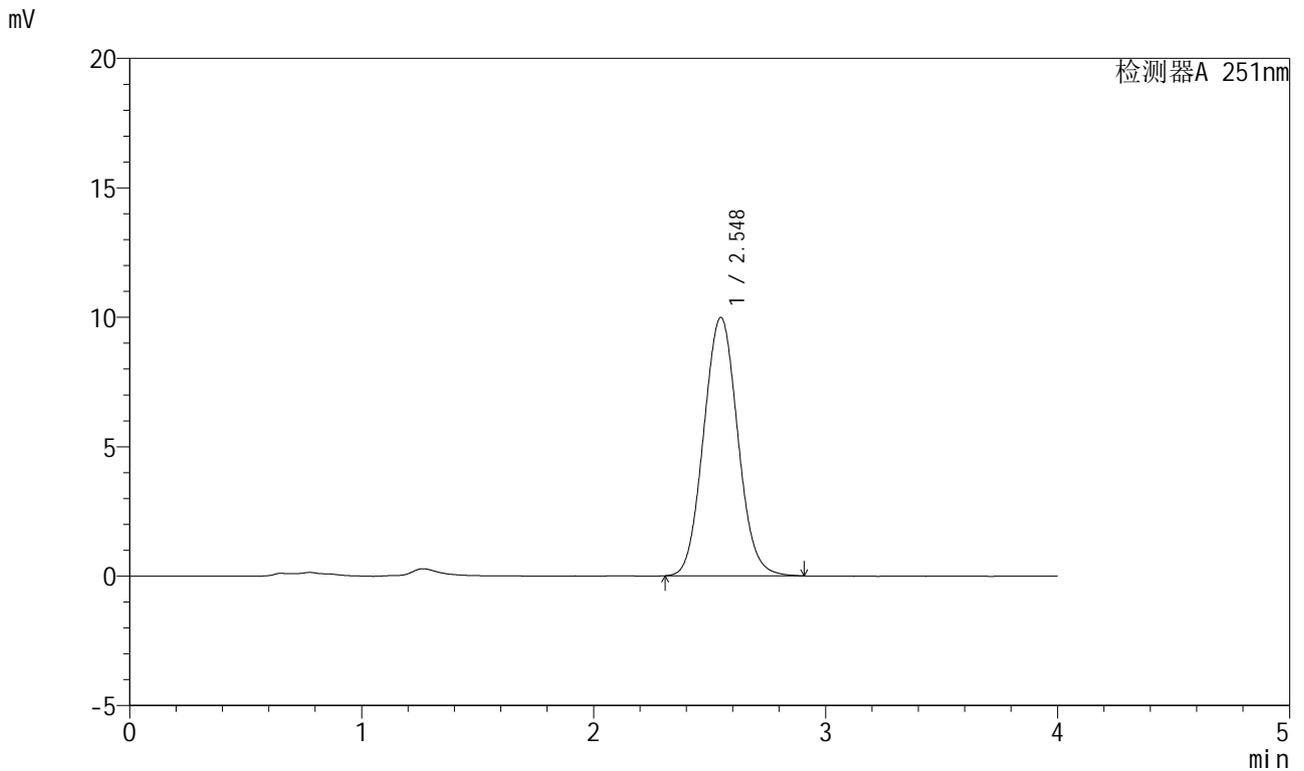

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	101853	100.000	9980	1444	1.064	--
总计		101853	100.000	9980			

图84 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3368-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:31:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

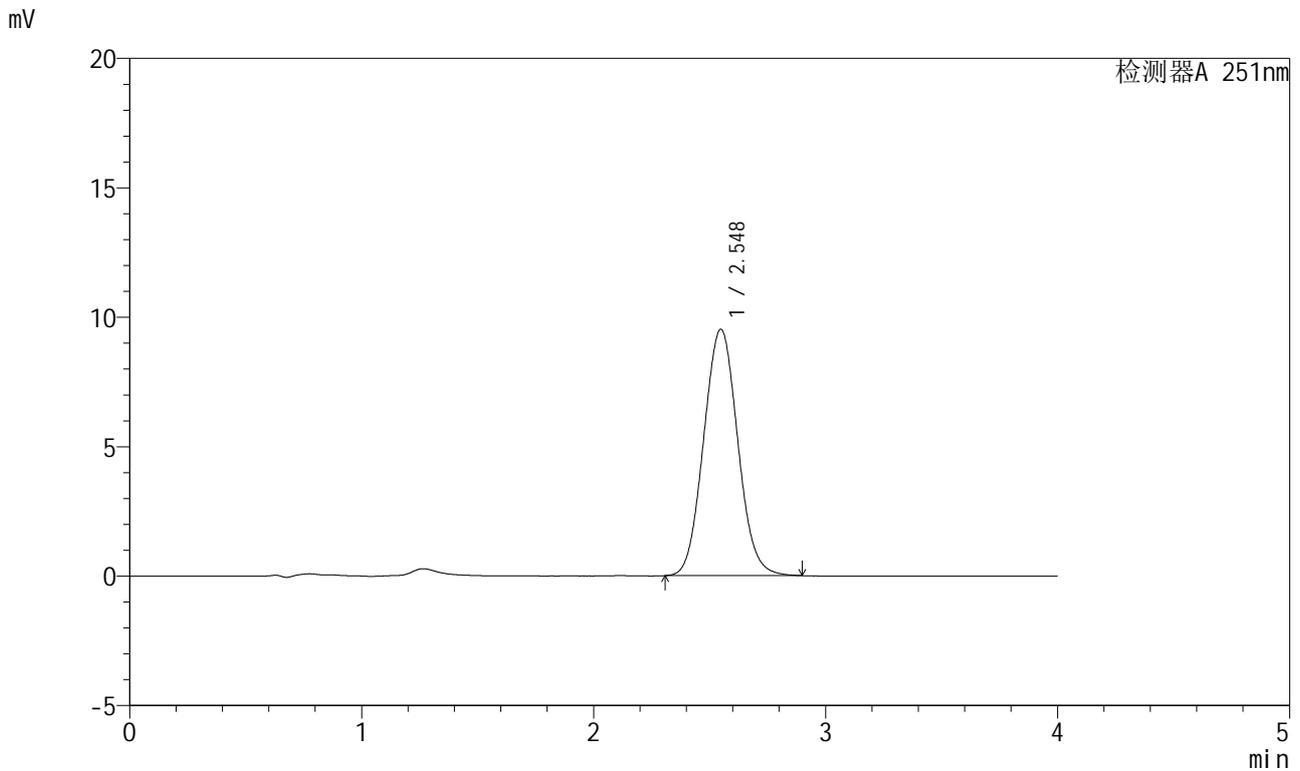

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	97158	100.000	9518	1444	1.063	--
总计		97158	100.000	9518			

图85 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3369-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:35:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

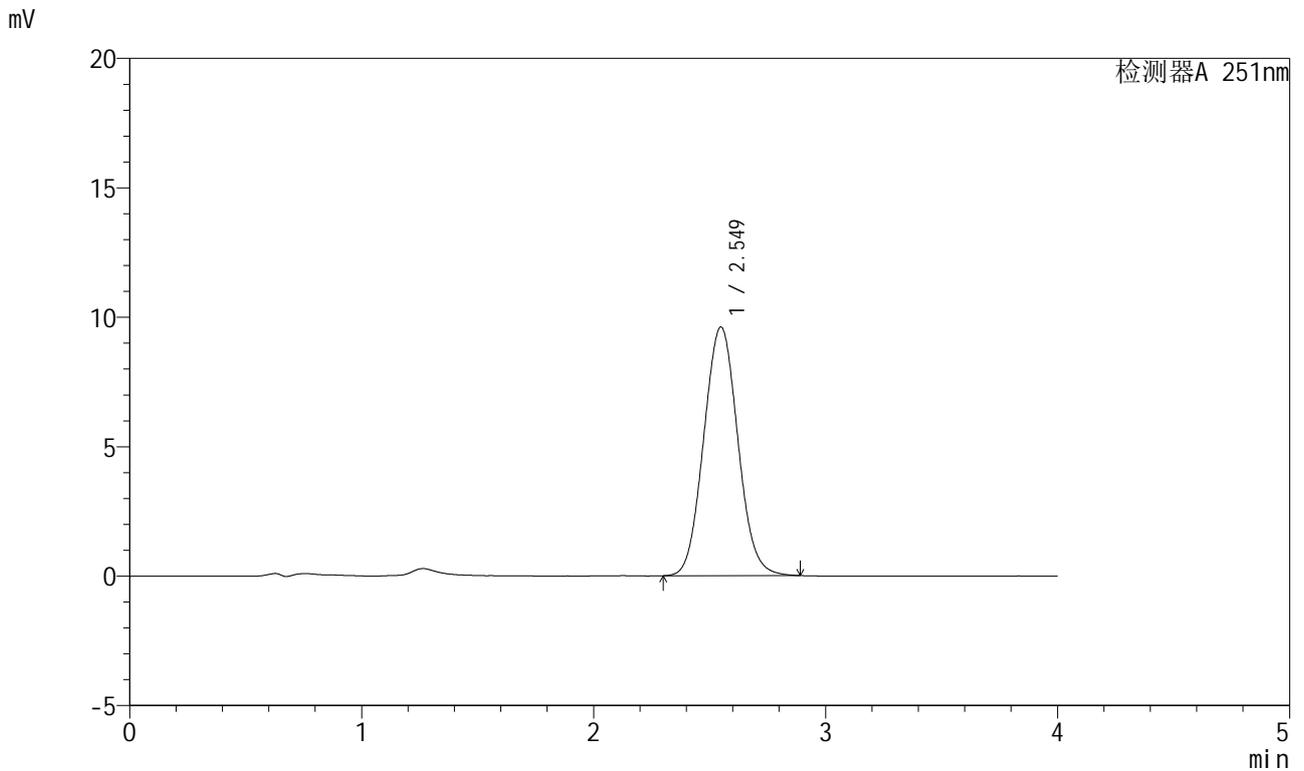

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	98124	100.000	9603	1441	1.062	--
总计		98124	100.000	9603			

图86 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3370-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:39:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

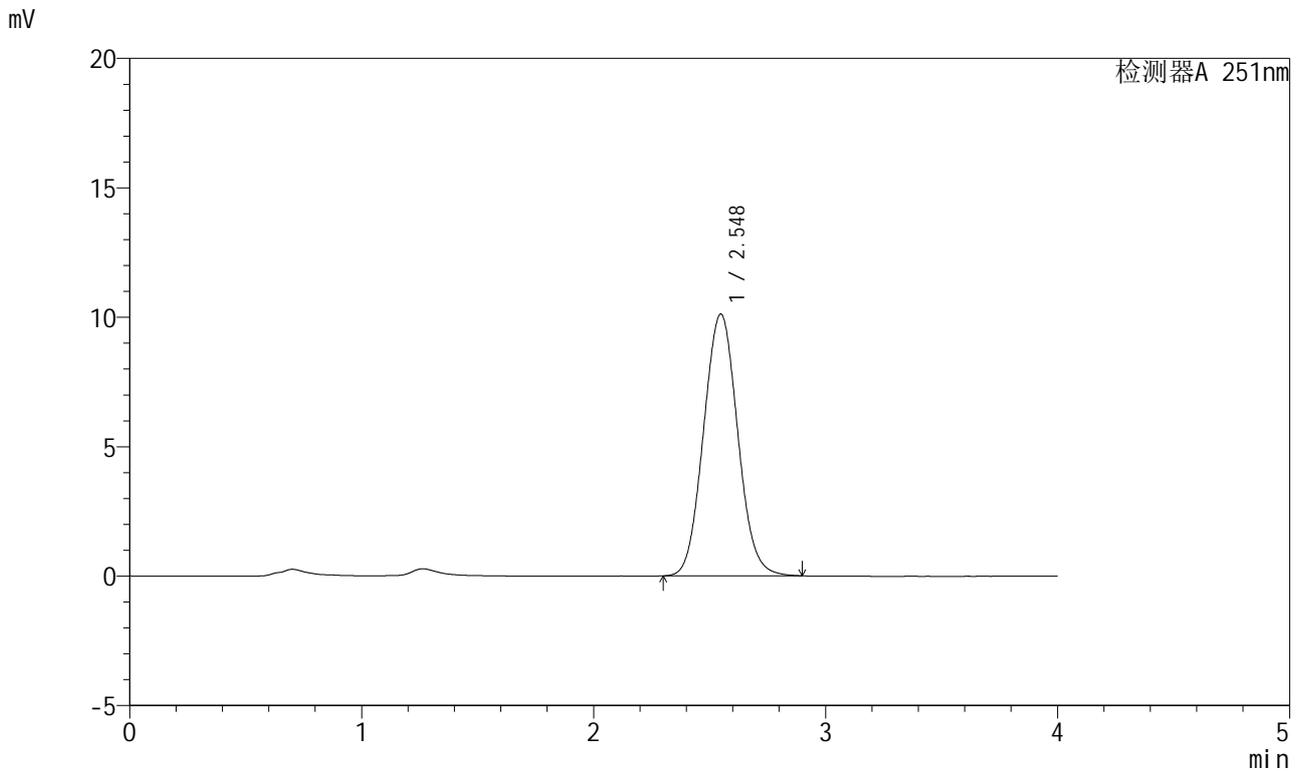

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	103436	100.000	10112	1437	1.061	--
总计		103436	100.000	10112			

图87 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3371-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:44:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

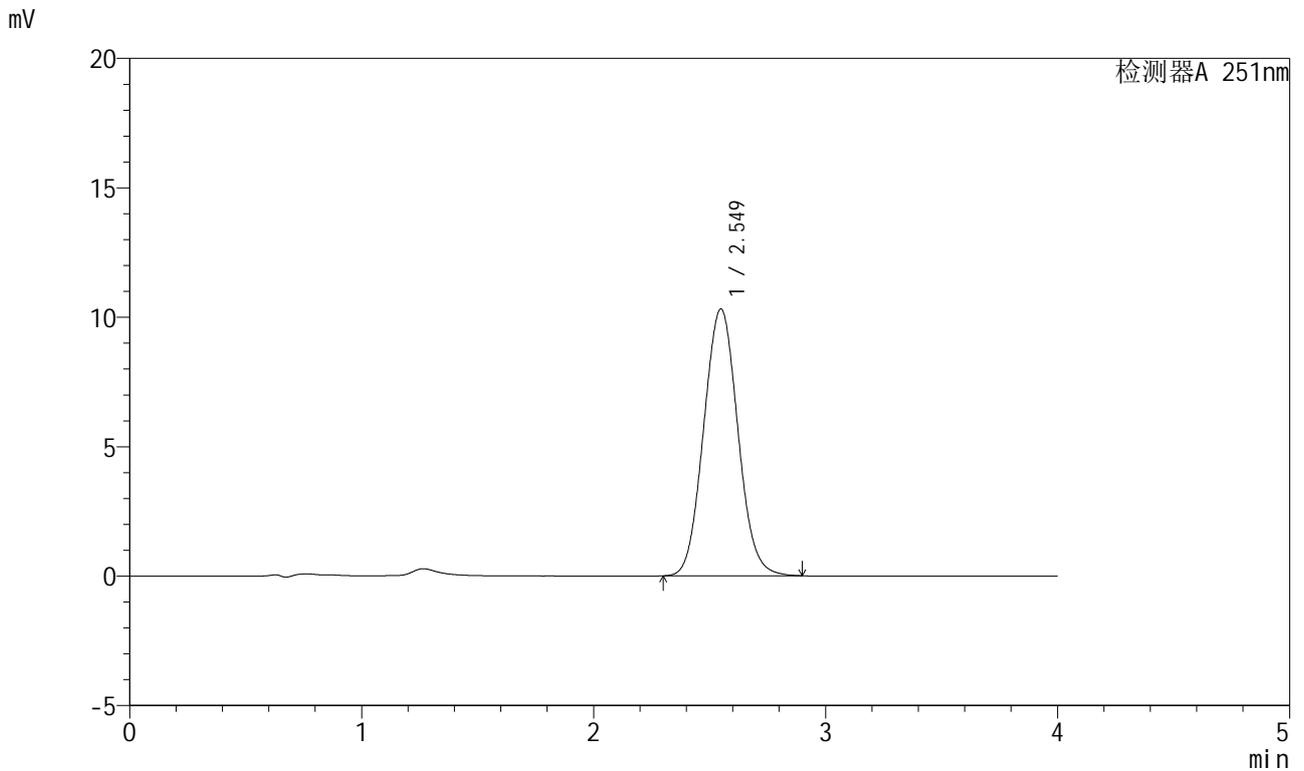

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105585	100.000	10307	1434	1.062	--
总计		105585	100.000	10307			

图88 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3372-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:48:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

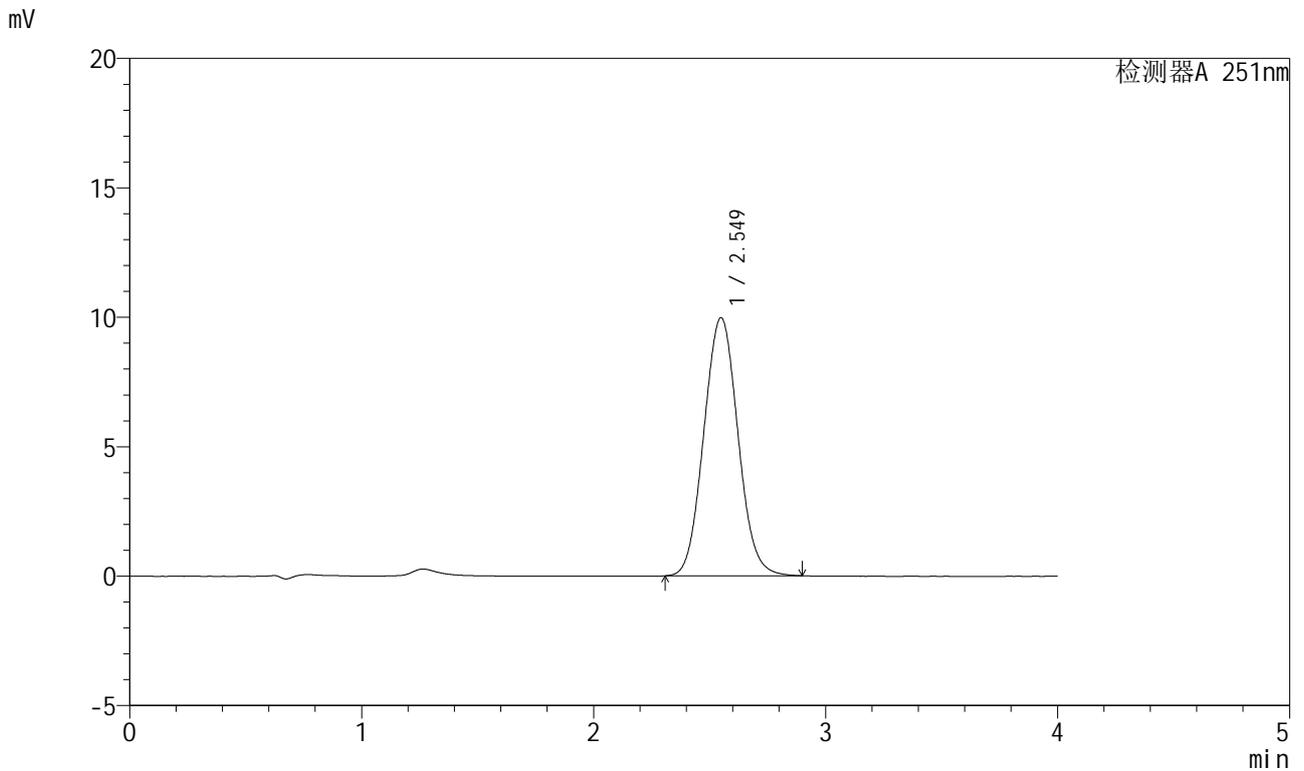

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	102014	100.000	9965	1438	1.061	--
总计		102014	100.000	9965			

图89 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3373-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:53:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

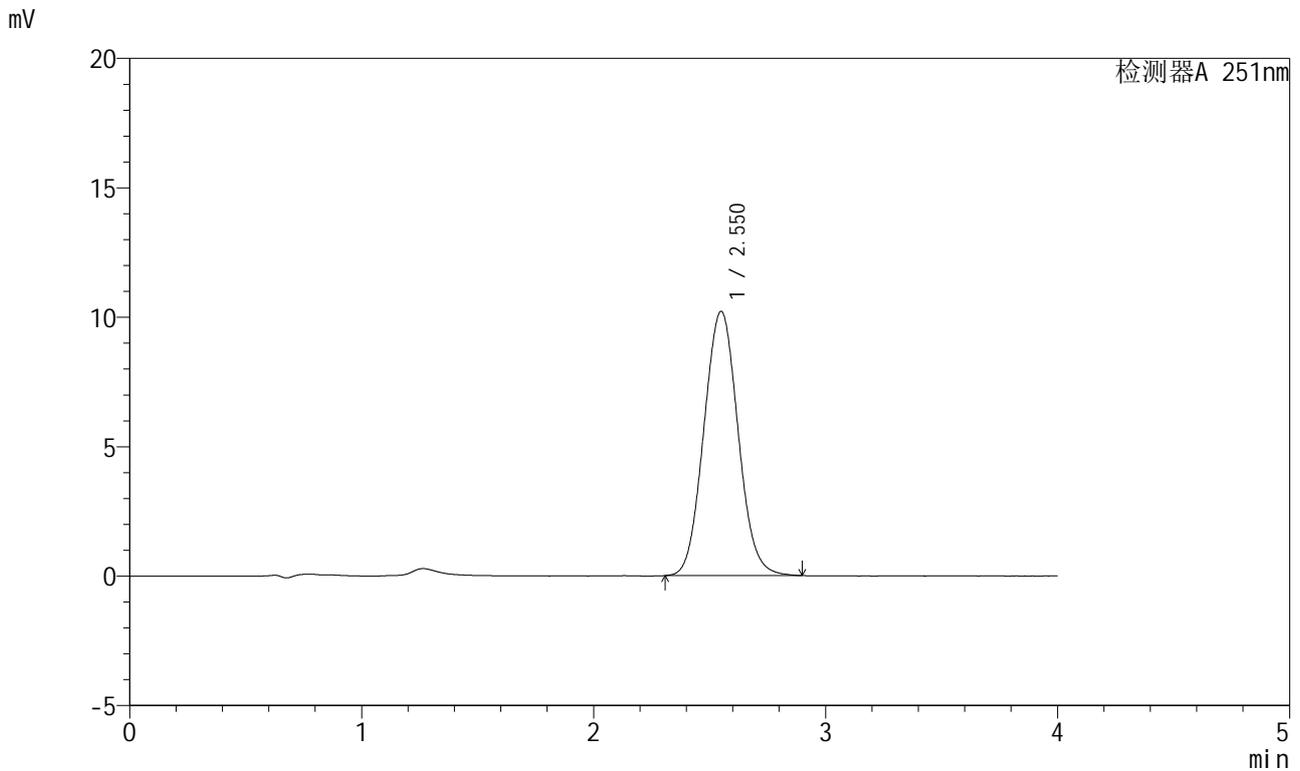

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	104532	100.000	10201	1436	1.062	--
总计		104532	100.000	10201			

图90 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3374-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 16:57:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

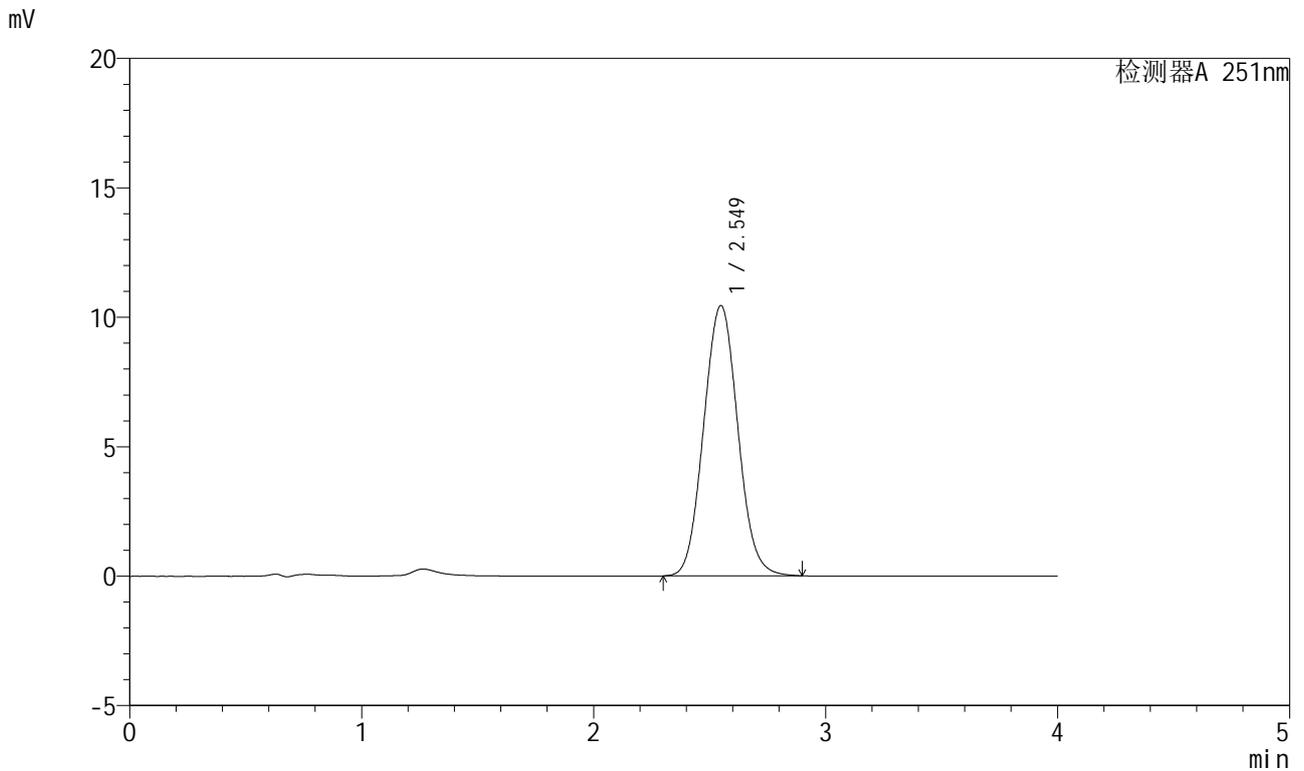

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106940	100.000	10442	1437	1.063	--
总计		106940	100.000	10442			

图91 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3375-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:01:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

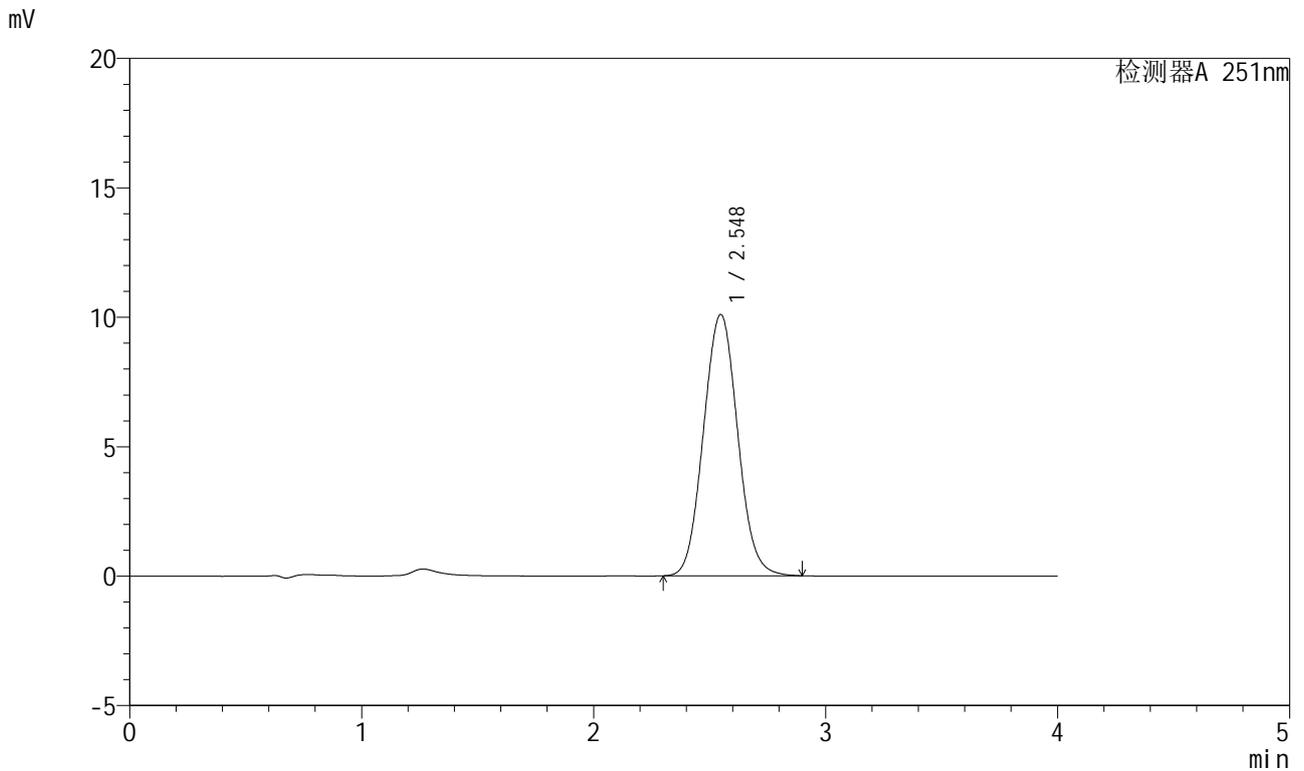

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	103356	100.000	10096	1434	1.062	--
总计		103356	100.000	10096			

图92 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3376-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:06:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

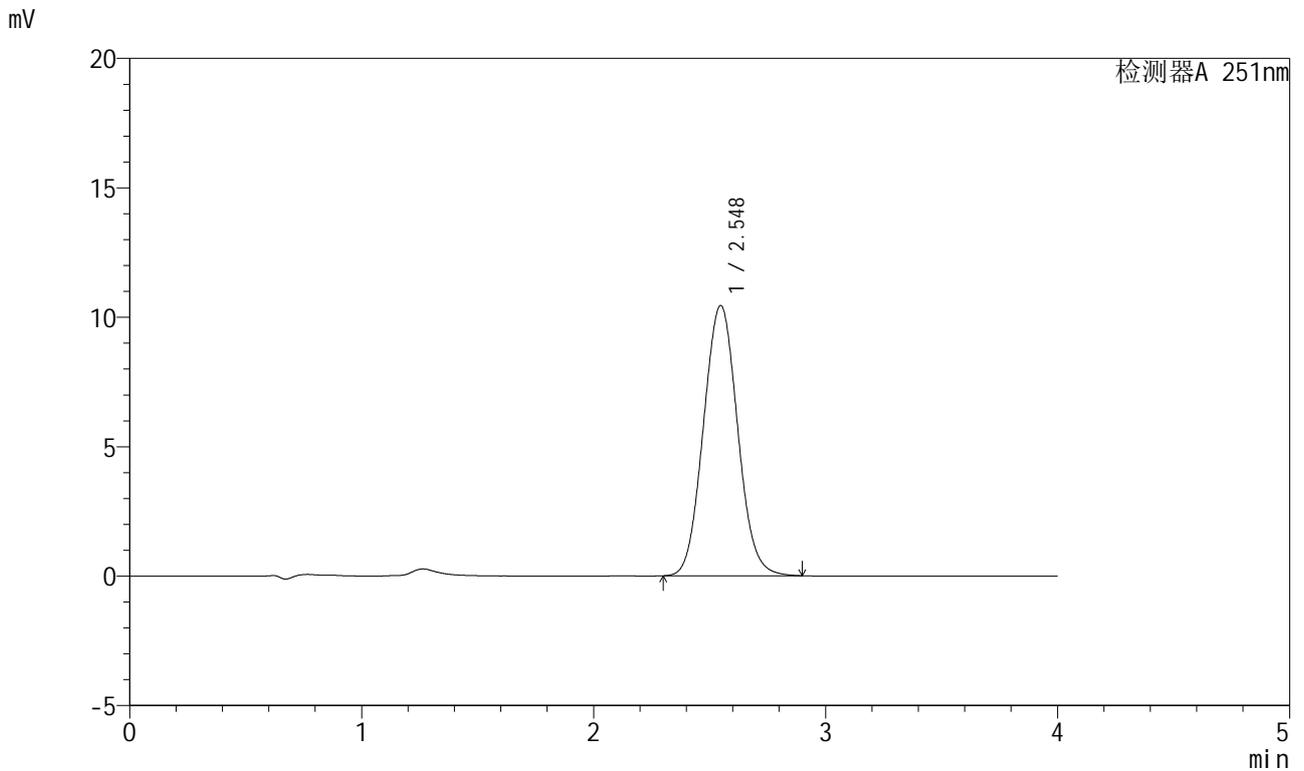

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	106988	100.000	10443	1432	1.062	--
总计		106988	100.000	10443			

图93 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3377-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:10:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

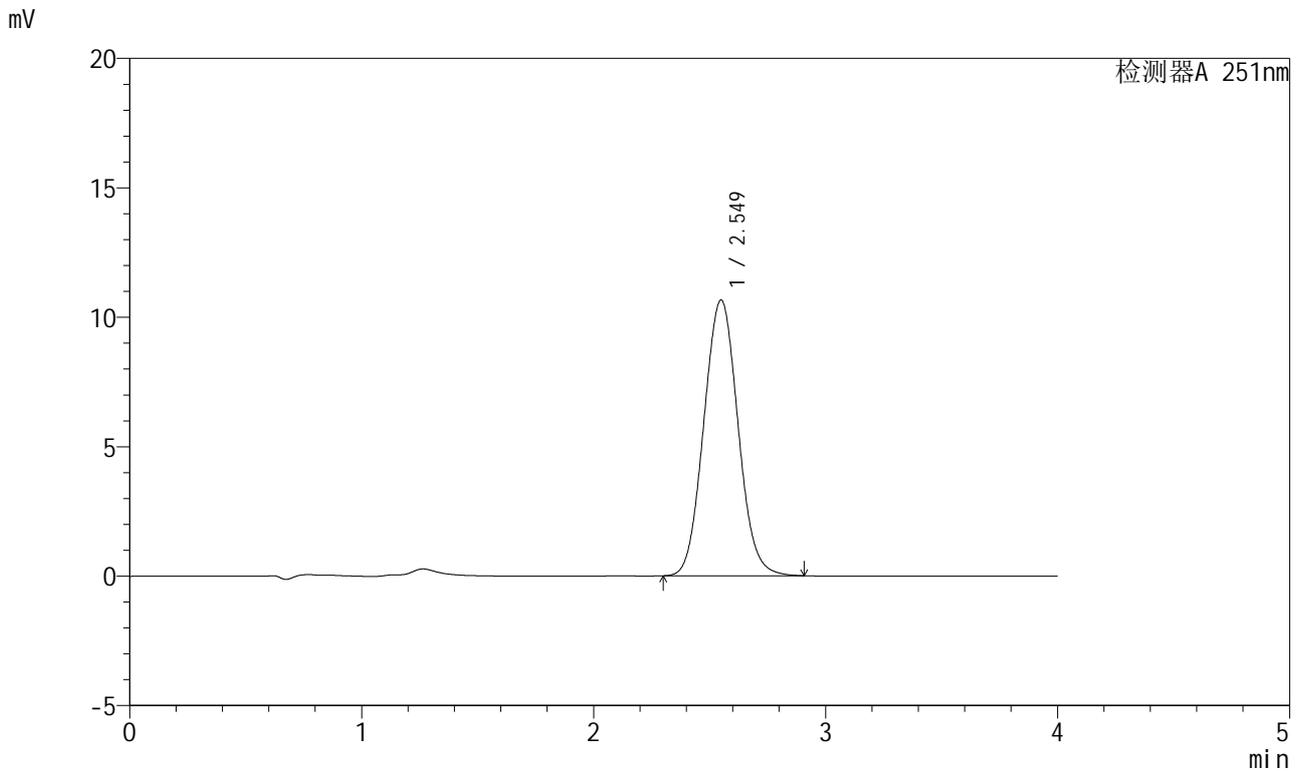

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	109131	100.000	10646	1436	1.063	--
总计		109131	100.000	10646			

图94 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3379-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:19:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

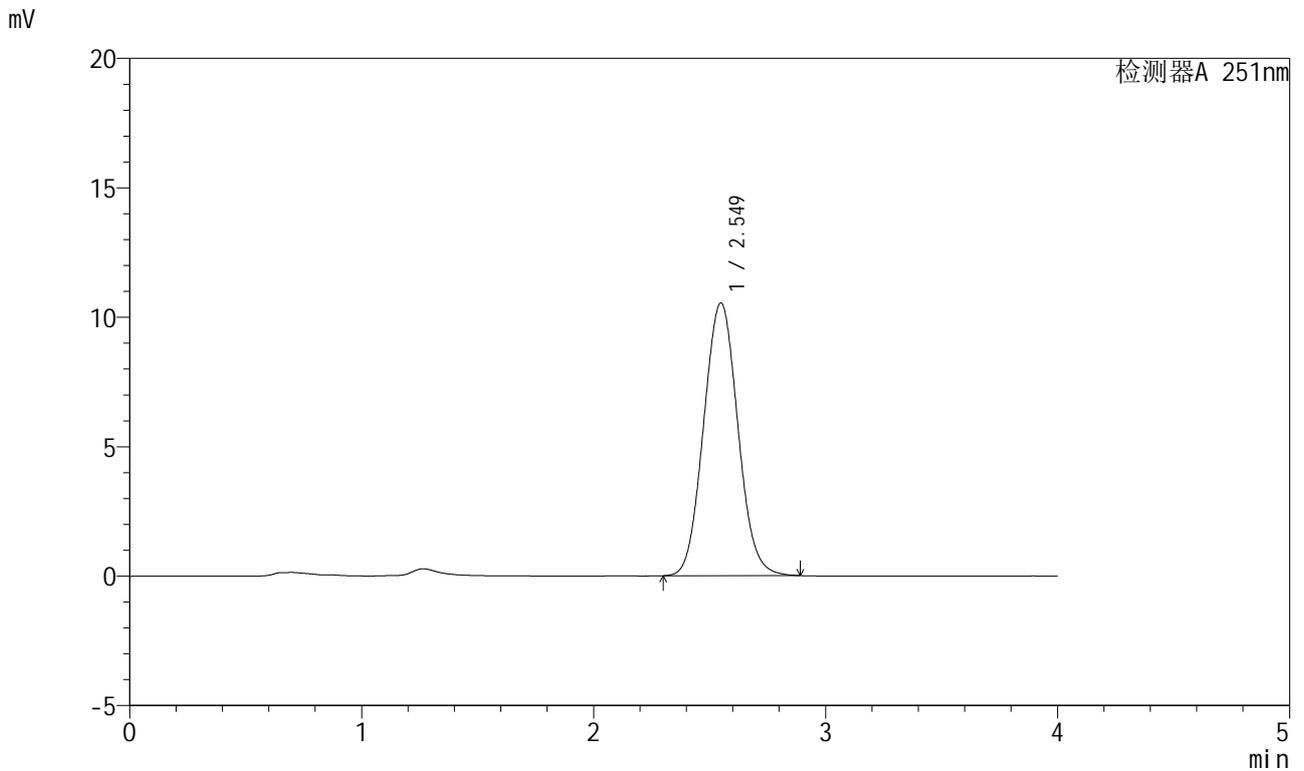

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	108037	100.000	10533	1430	1.062	--
总计		108037	100.000	10533			

图96 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3380-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:23:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

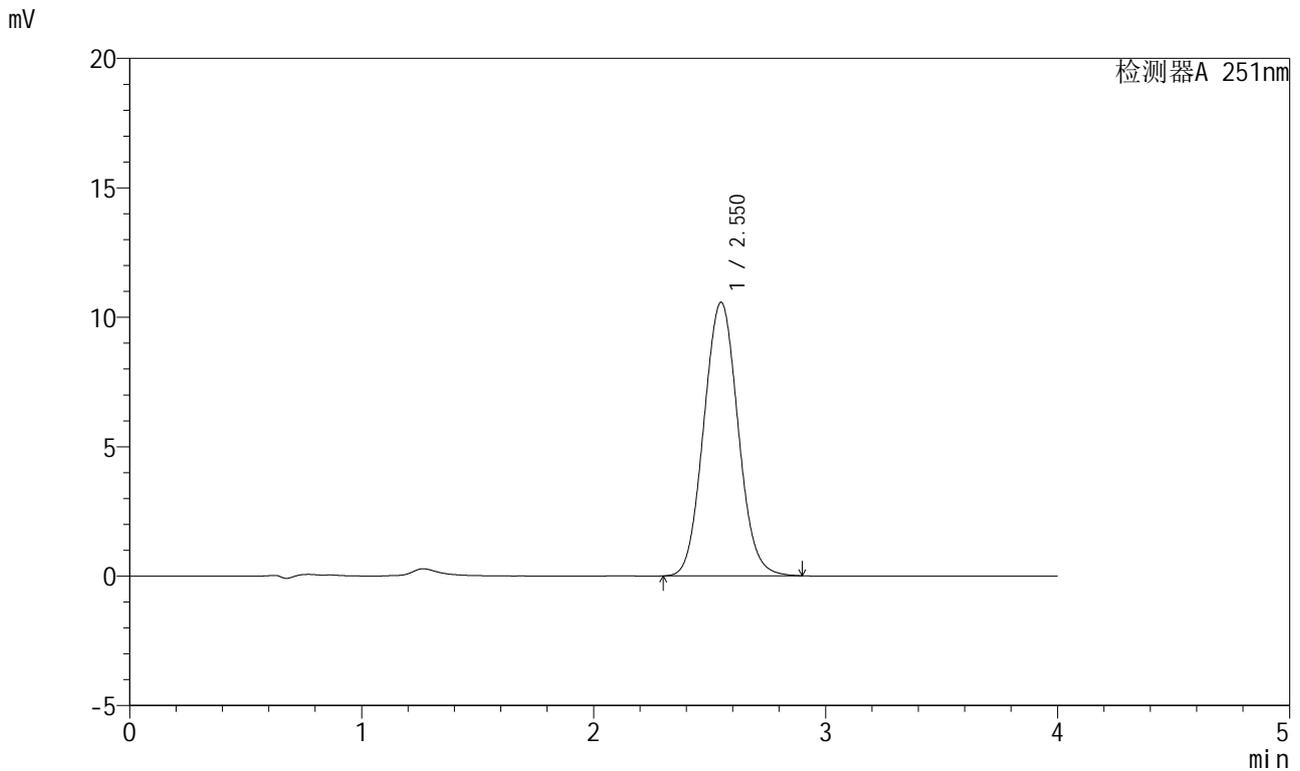

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	108467	100.000	10562	1431	1.061	--
总计		108467	100.000	10562			

图97 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3381-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:28:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:31:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

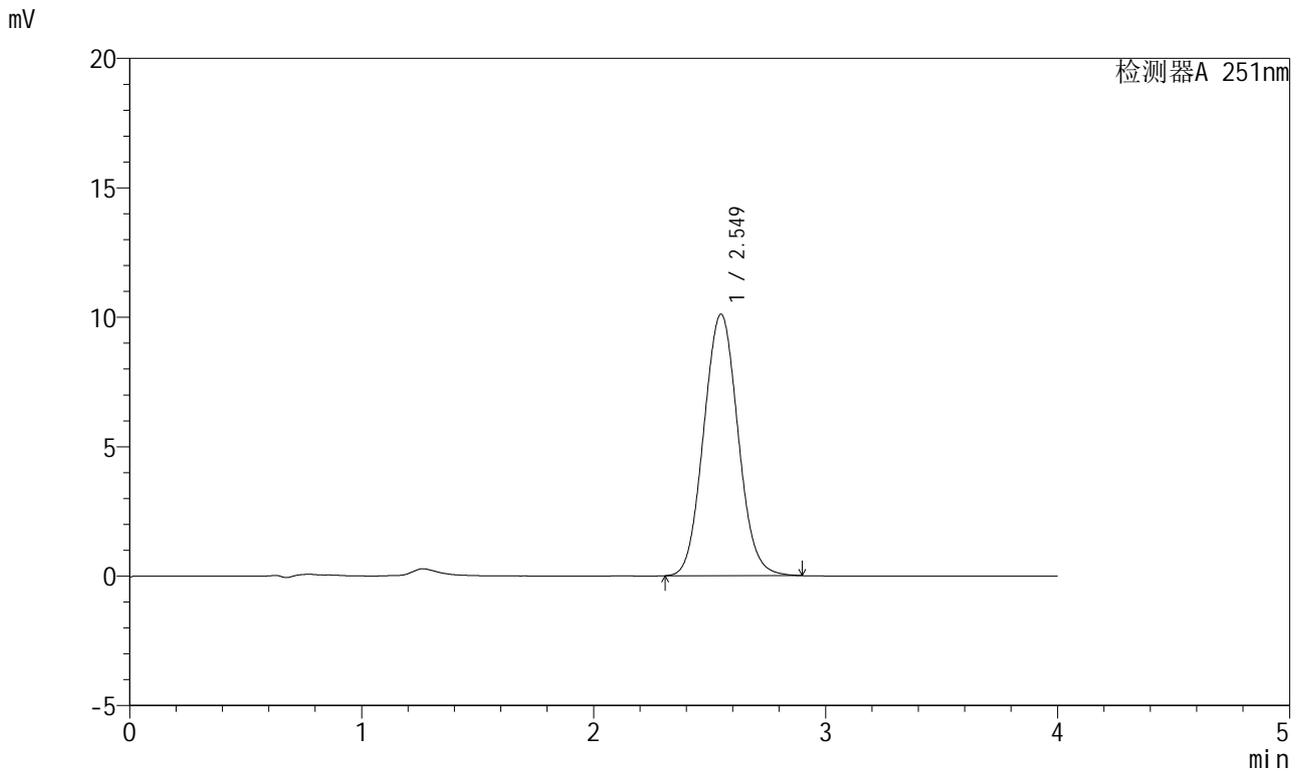

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	103660	100.000	10096	1428	1.062	--
总计		103660	100.000	10096			

图98 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3382-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:32:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

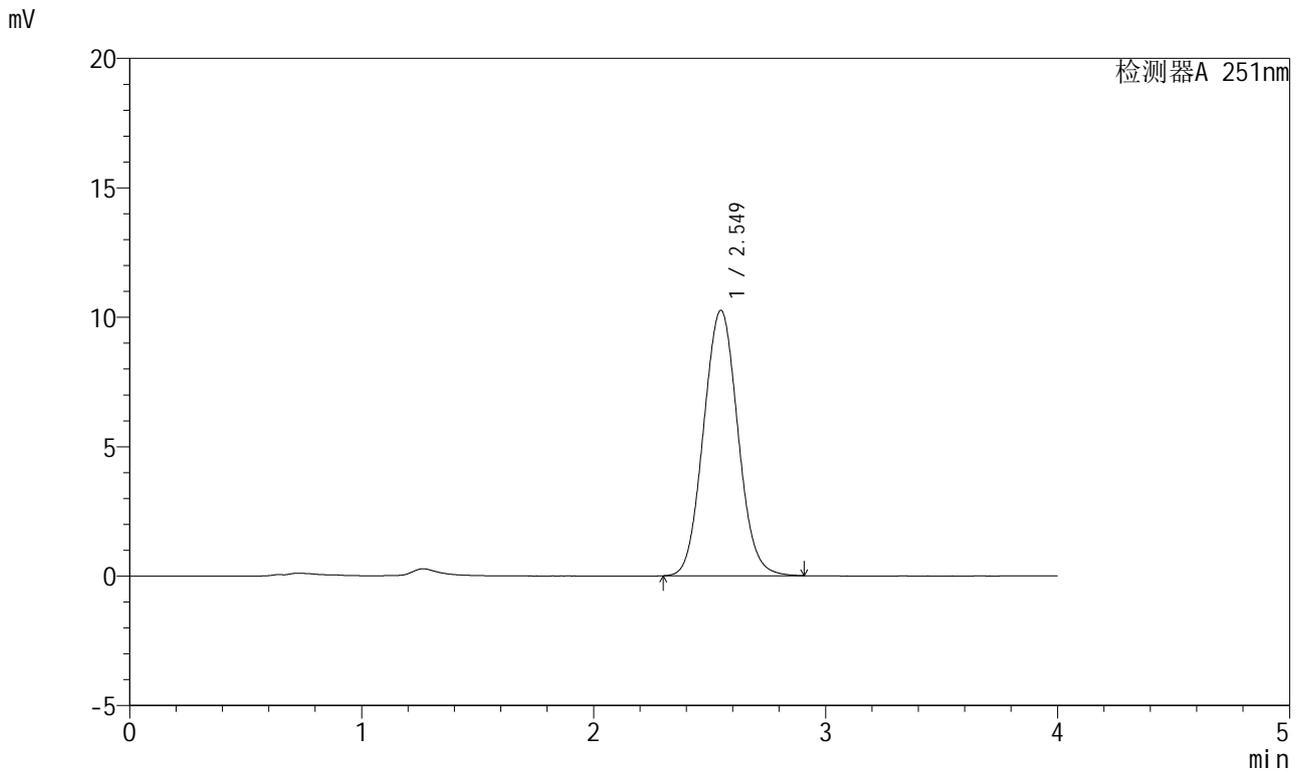

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105352	100.000	10253	1427	1.060	--
总计		105352	100.000	10253			

图99 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3383-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:37:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

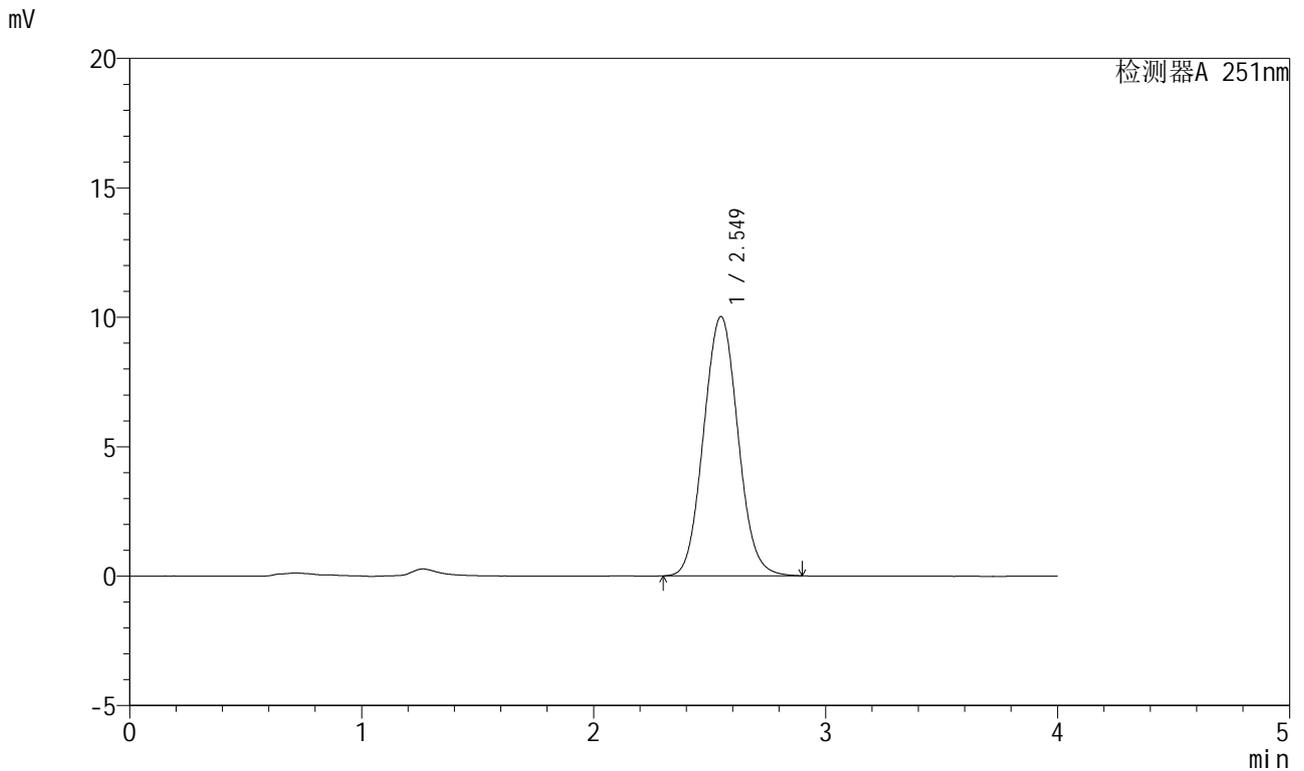

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	102942	100.000	10013	1427	1.061	--
总计		102942	100.000	10013			

图100 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3384-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:41:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

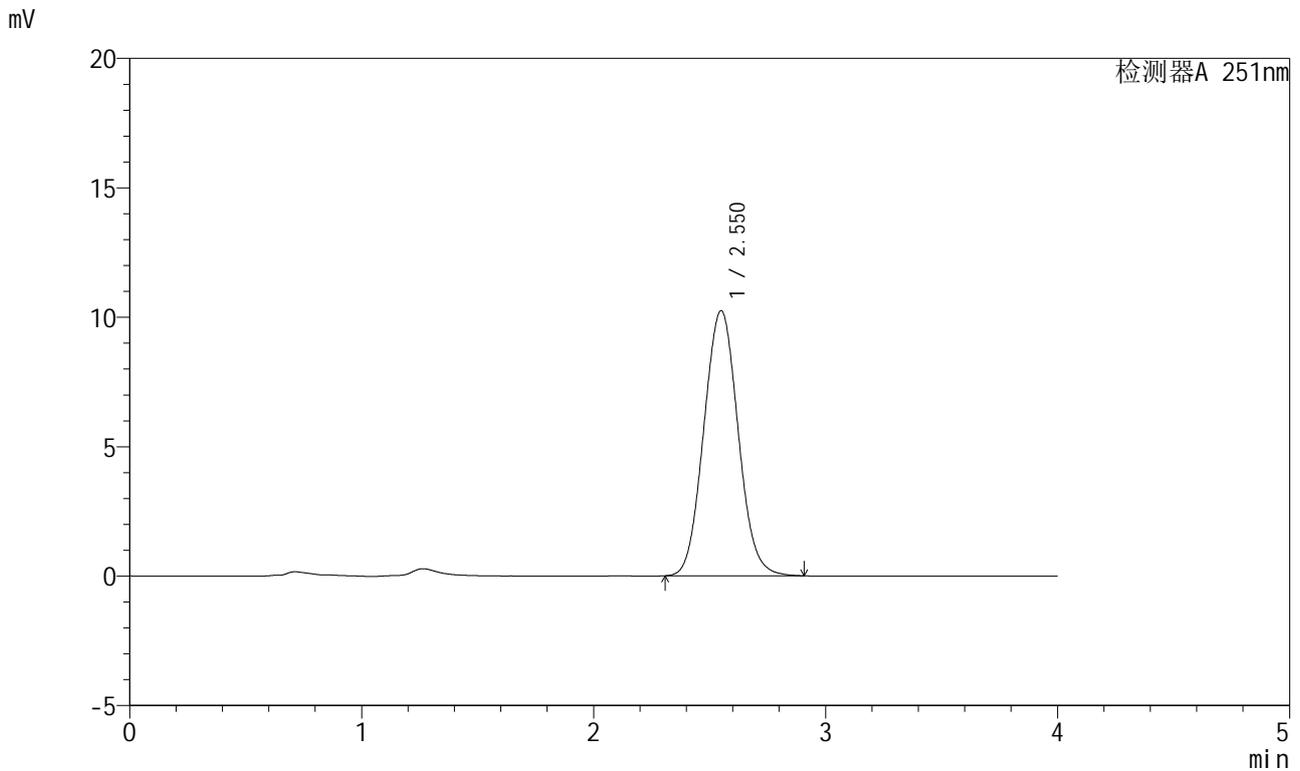

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	105233	100.000	10235	1428	1.062	--
总计		105233	100.000	10235			

图101 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3385-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:45:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

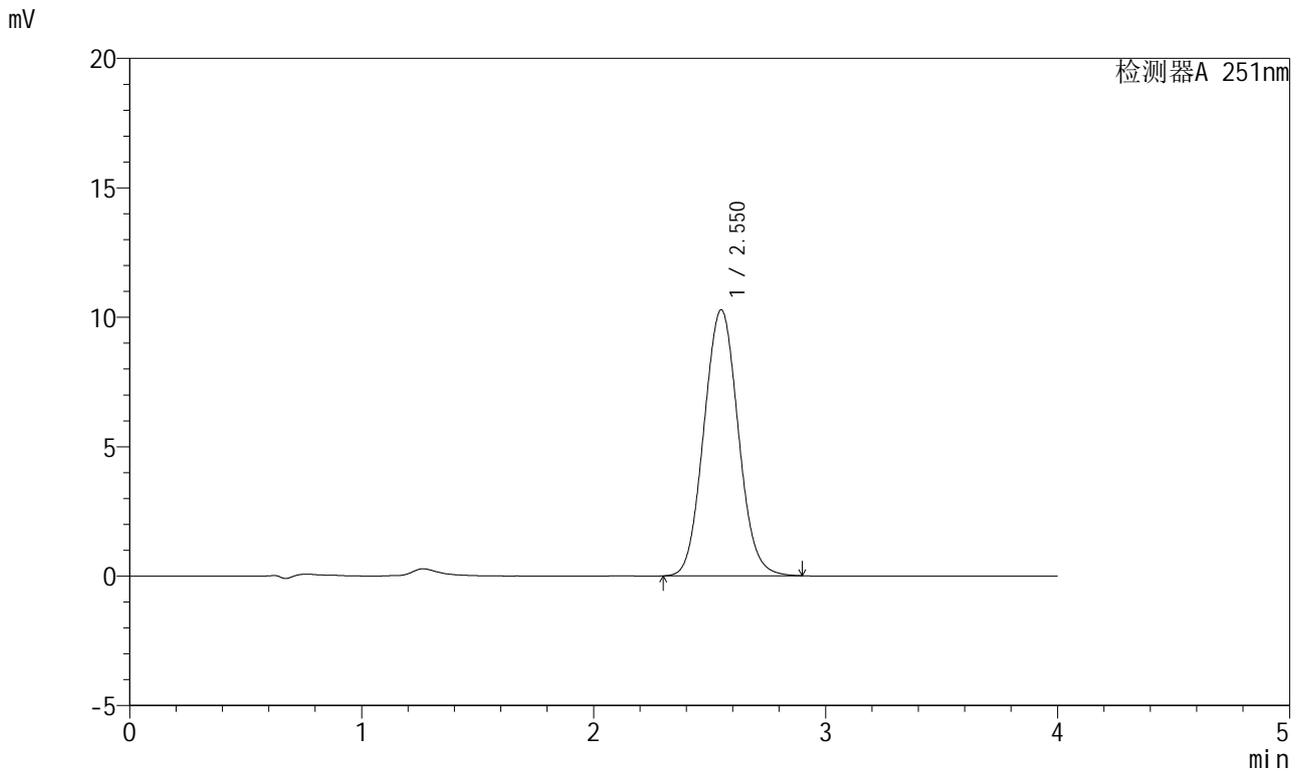

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	105656	100.000	10265	1424	1.061	--
总计		105656	100.000	10265			

图102 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3386-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:50:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

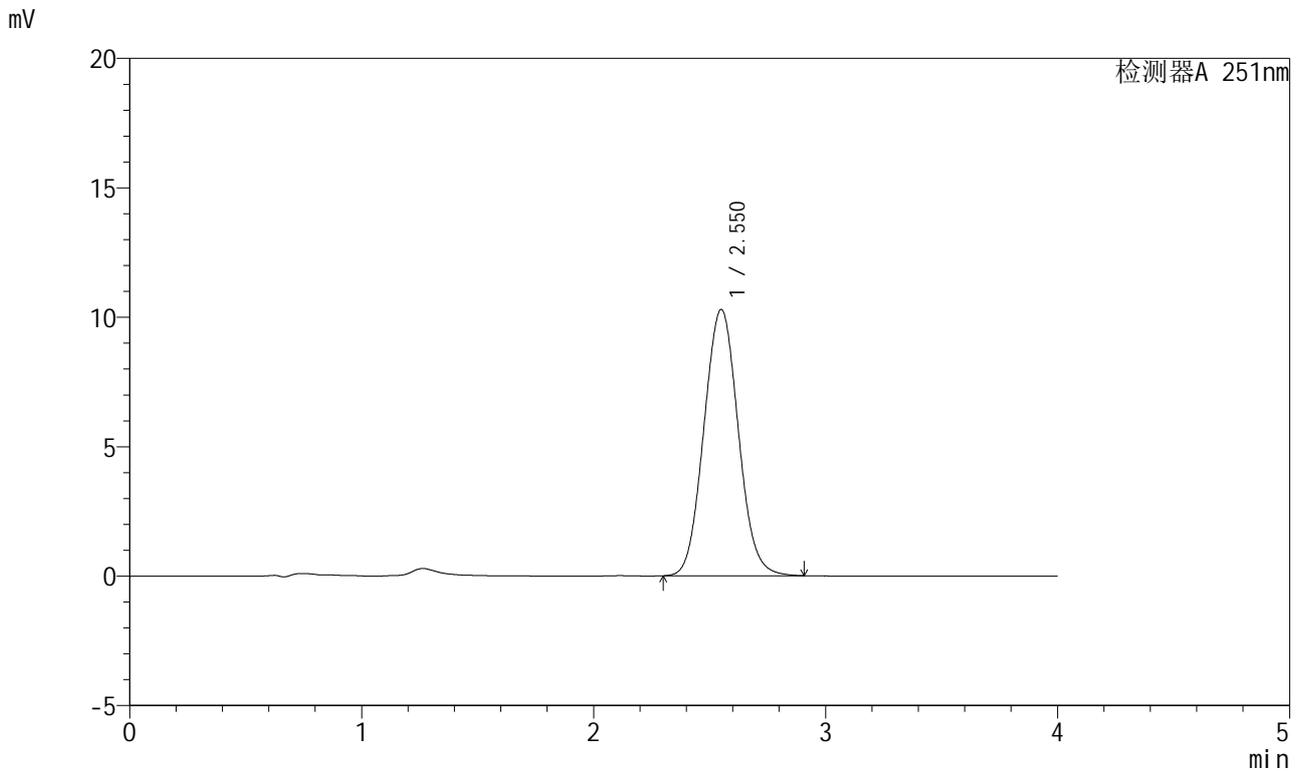

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	105902	100.000	10277	1424	1.061	--
总计		105902	100.000	10277			

图103 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3387-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:54:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

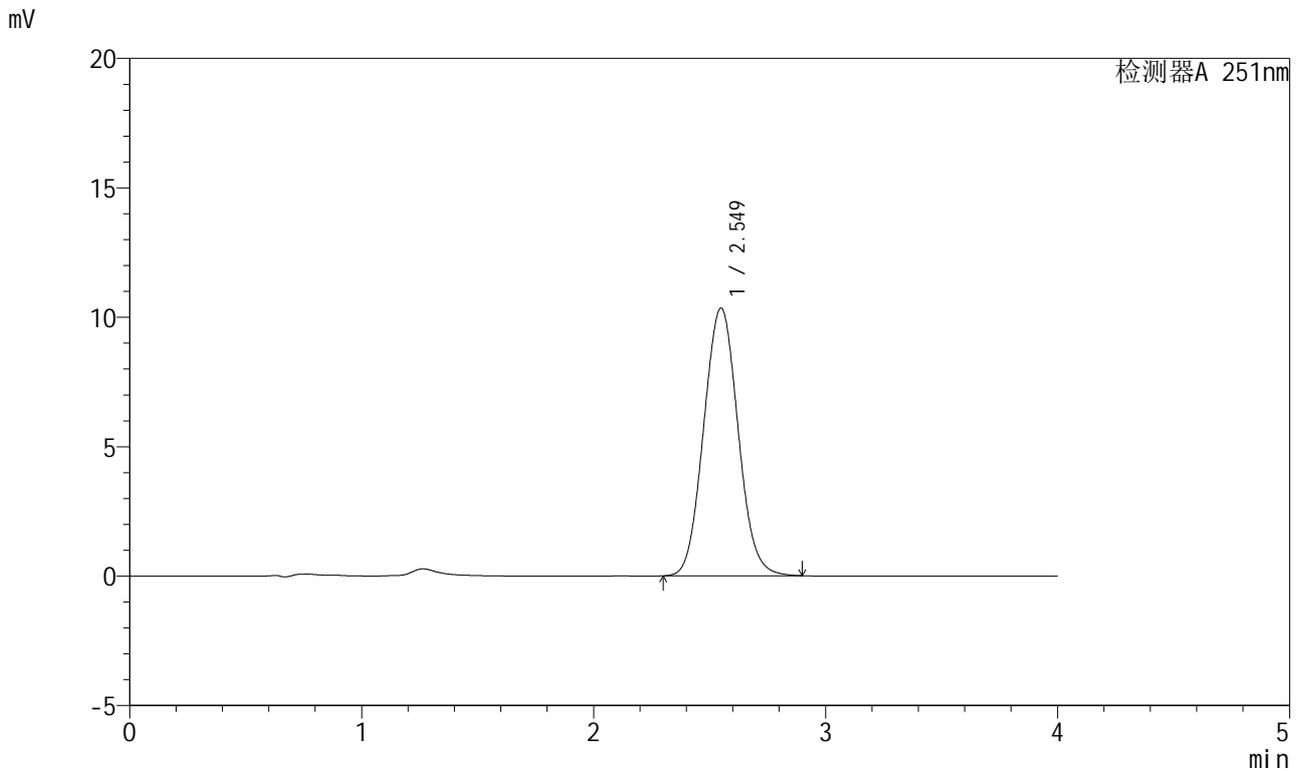

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106450	100.000	10338	1423	1.061	--
总计		106450	100.000	10338			

图104 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3388-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 17:59:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

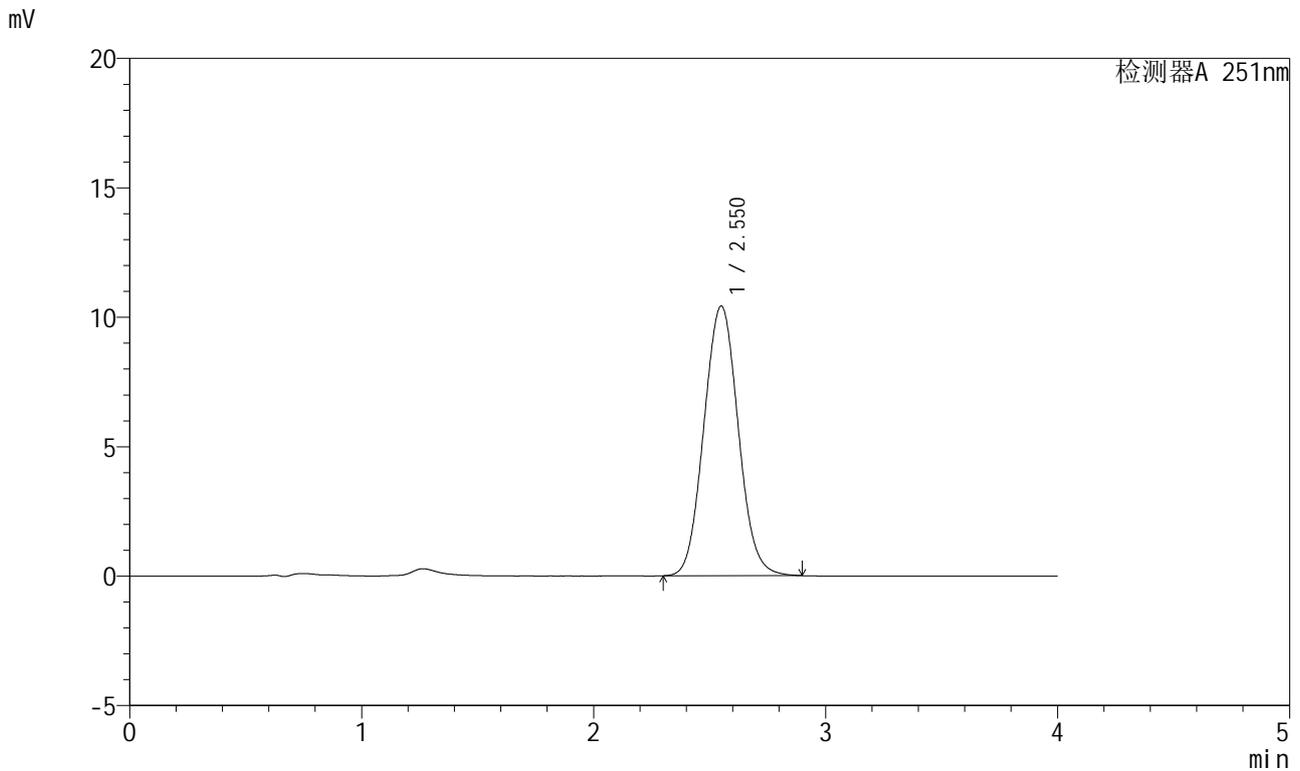

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	107264	100.000	10407	1422	1.061	--
总计		107264	100.000	10407			

图105 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3389-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:03:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

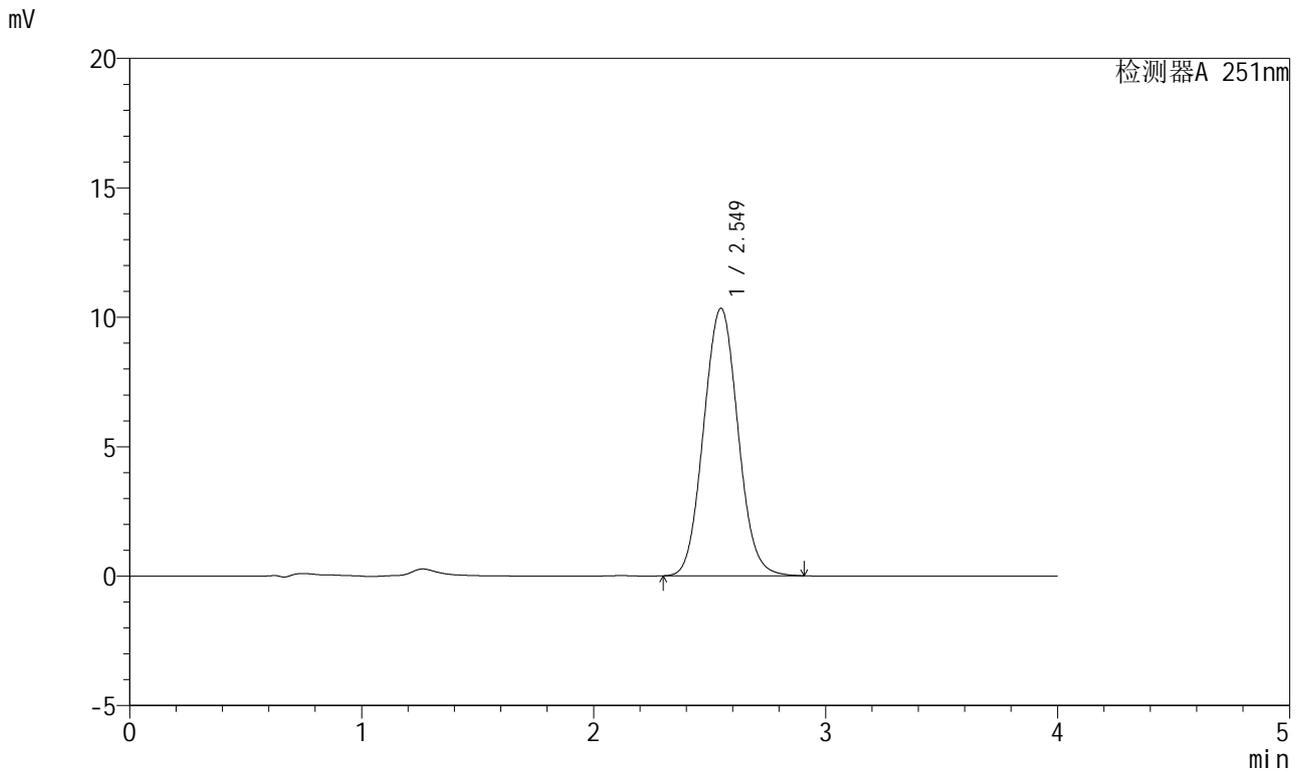

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106222	100.000	10331	1426	1.060	--
总计		106222	100.000	10331			

图106 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3390-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:07:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

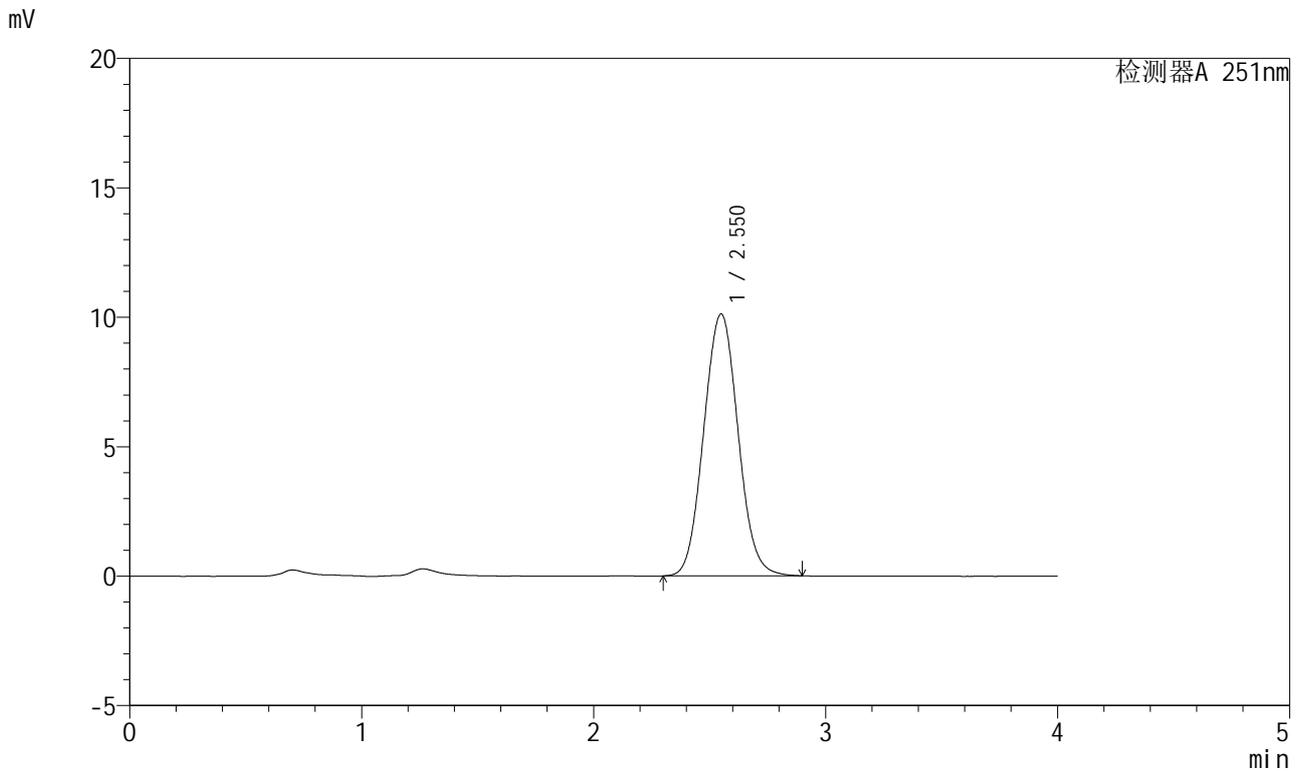

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	104034	100.000	10112	1427	1.059	--
总计		104034	100.000	10112			

图107 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3391-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:12:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

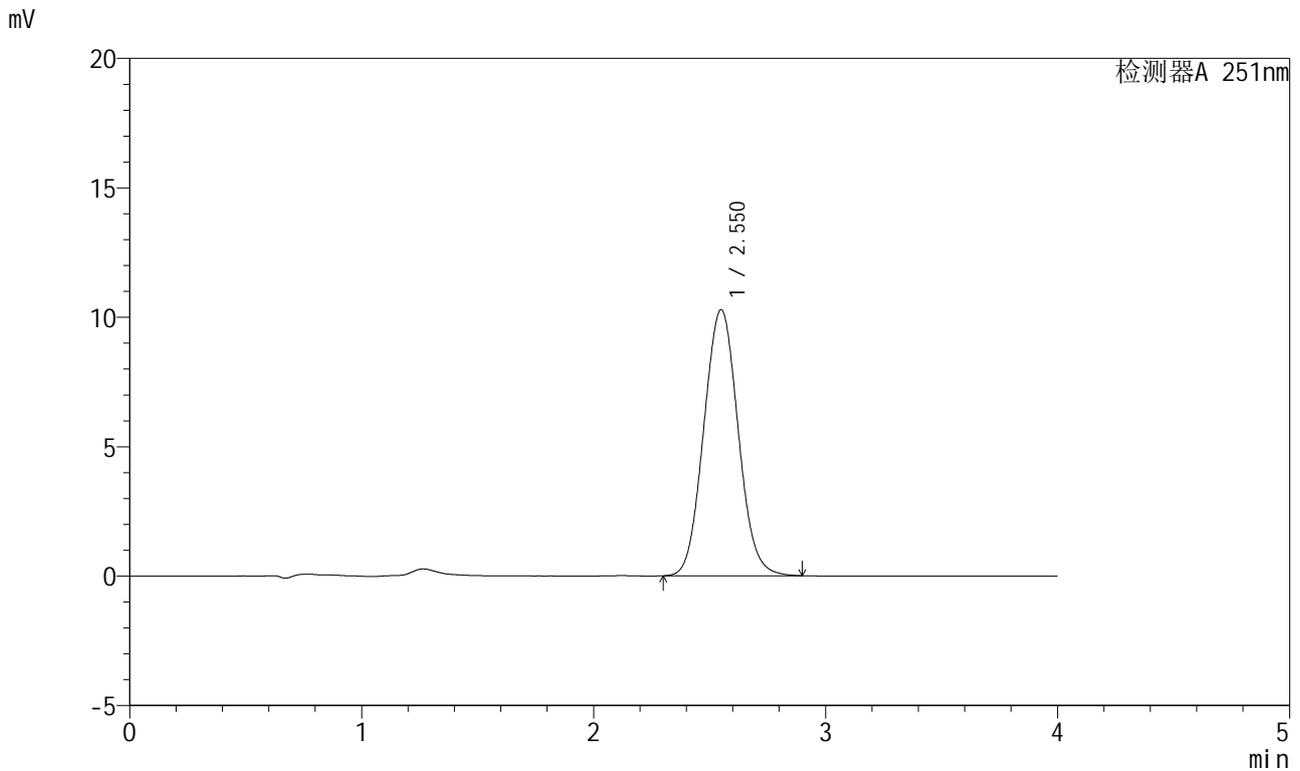

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	105798	100.000	10272	1423	1.061	--
总计		105798	100.000	10272			

图108 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3392-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:16:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

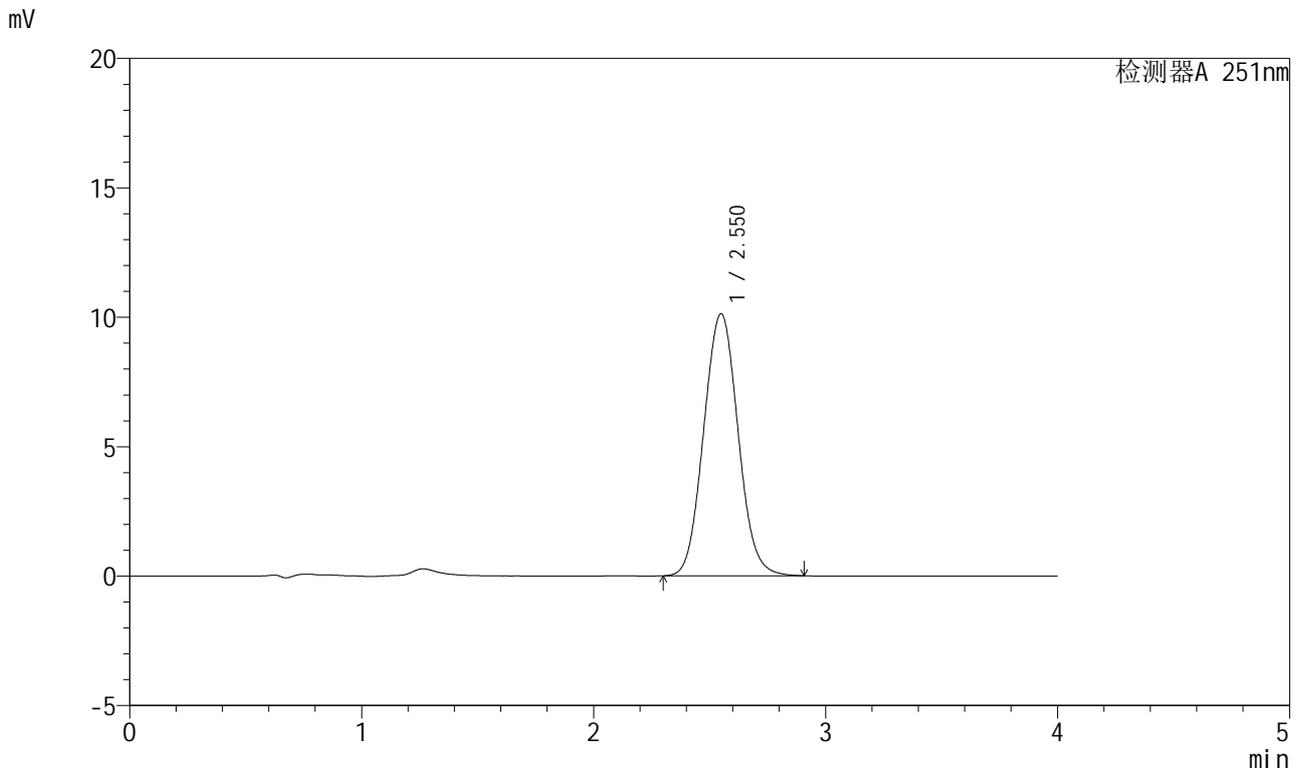

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	104252	100.000	10114	1422	1.061	--
总计		104252	100.000	10114			

图109 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3393-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:21:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

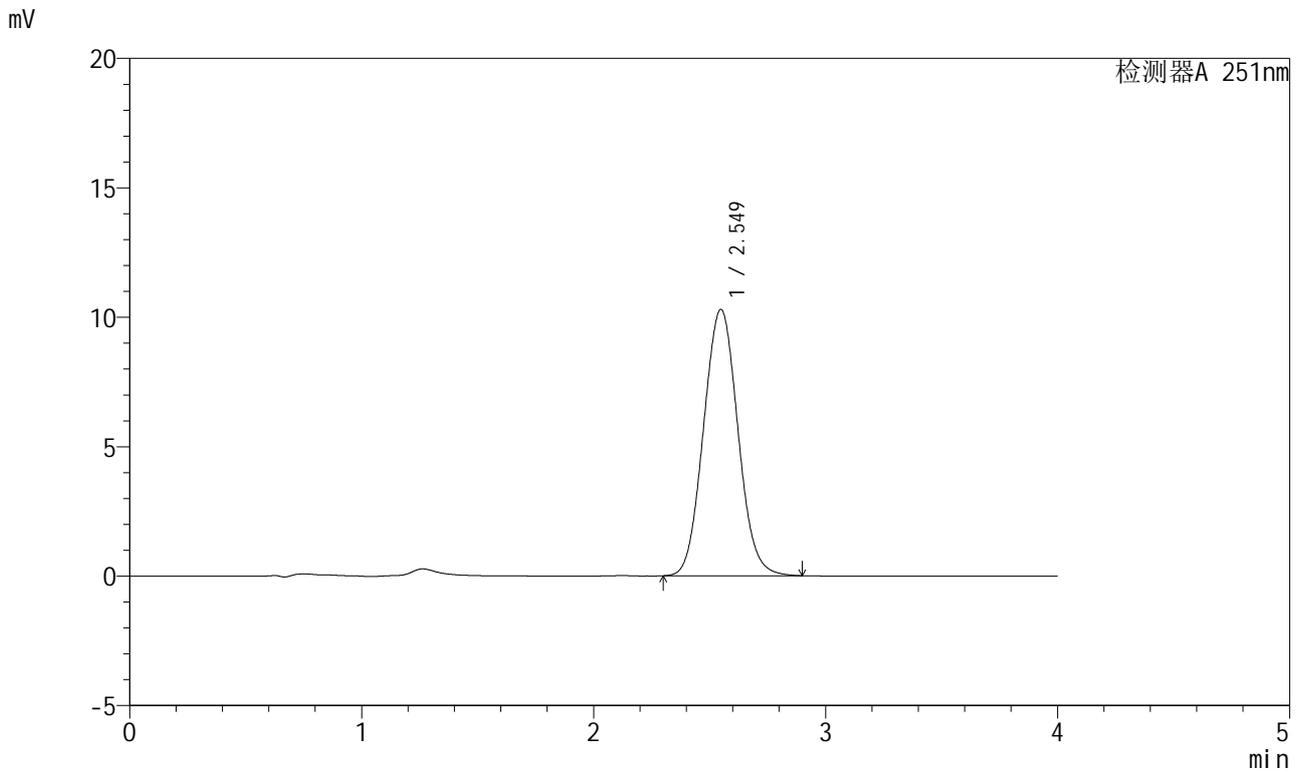

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105947	100.000	10289	1423	1.062	--
总计		105947	100.000	10289			

图110 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3394-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:25:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

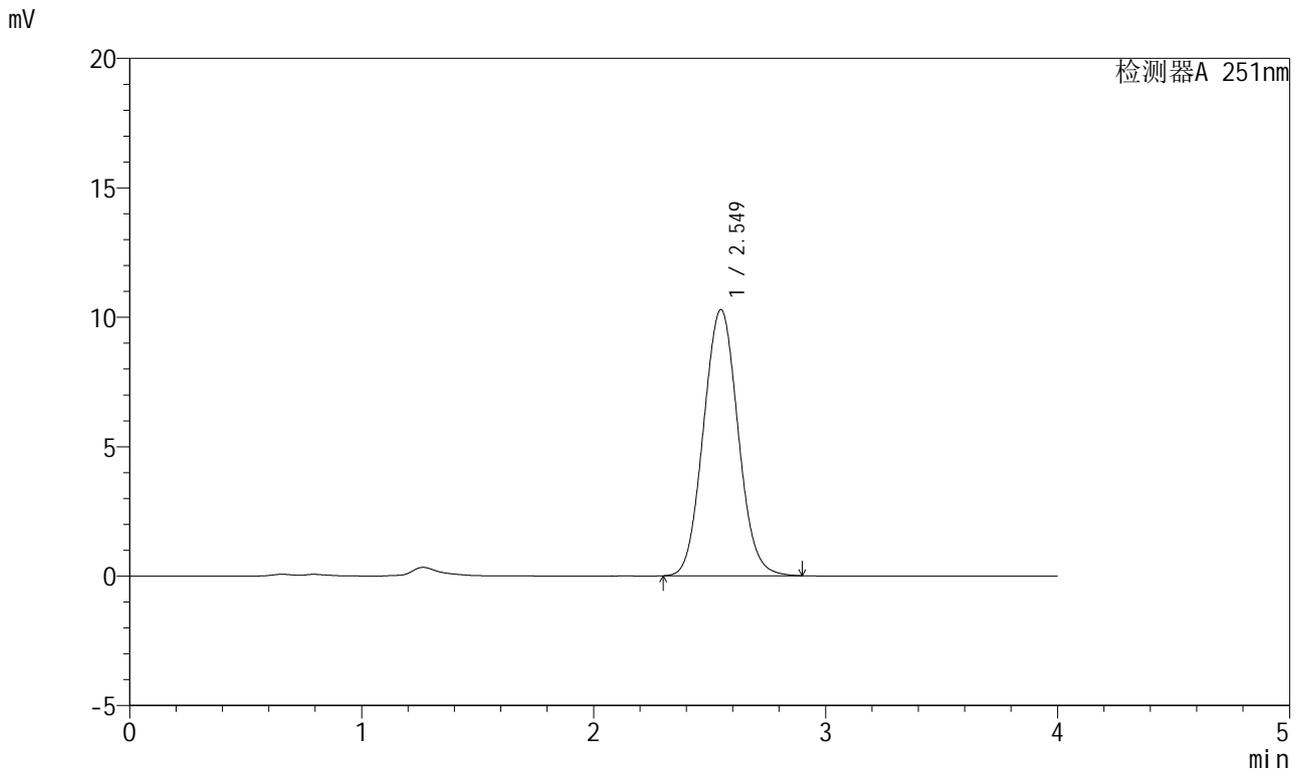

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106537	100.000	10282	1400	1.061	--
总计		106537	100.000	10282			

图111 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3395-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:29:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

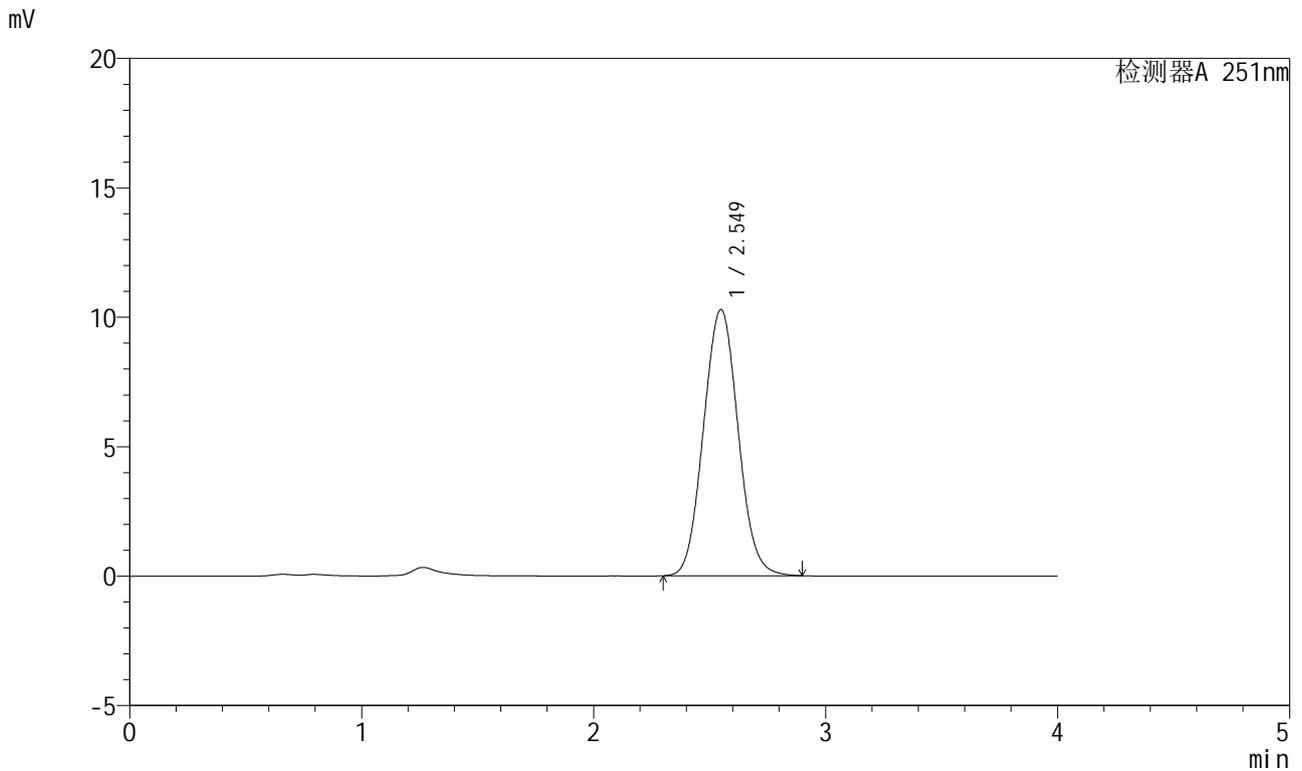

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106594	100.000	10280	1398	1.061	--
总计		106594	100.000	10280			

图112 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3396-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:34:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

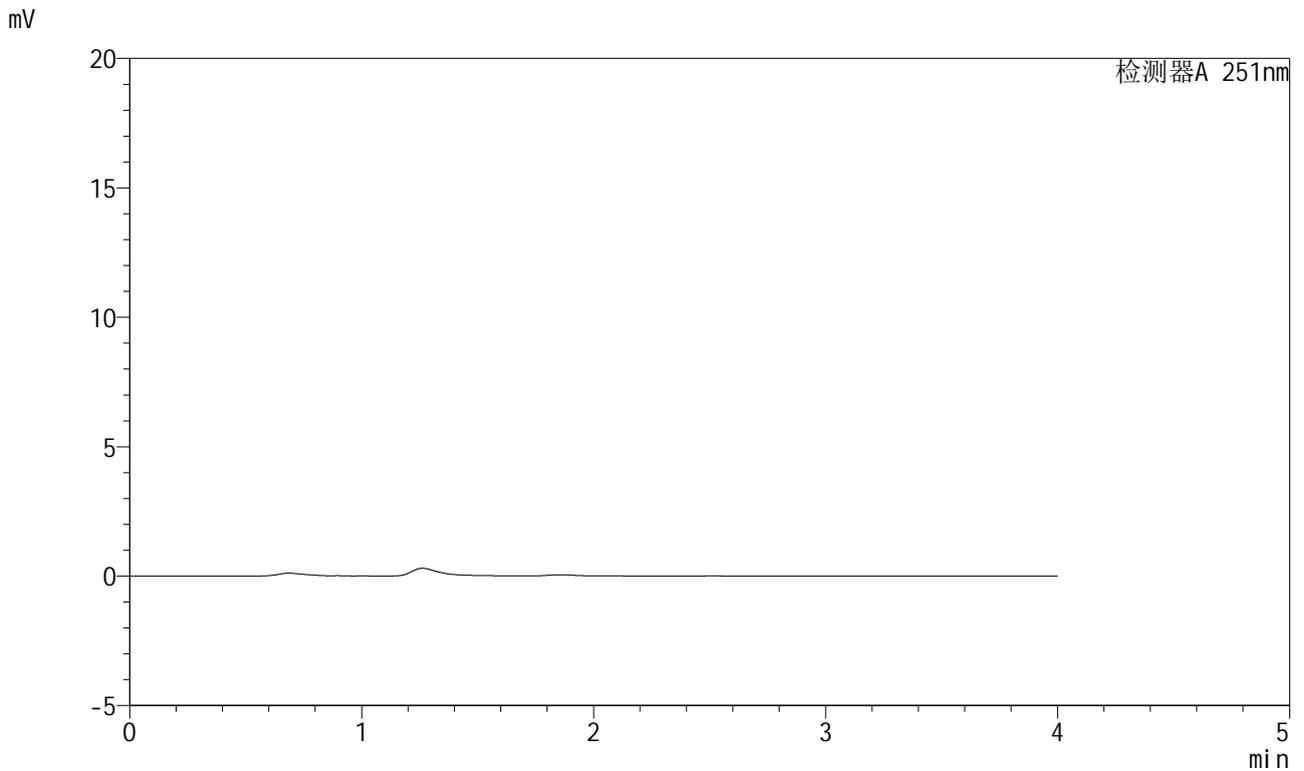

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3397-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:38:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

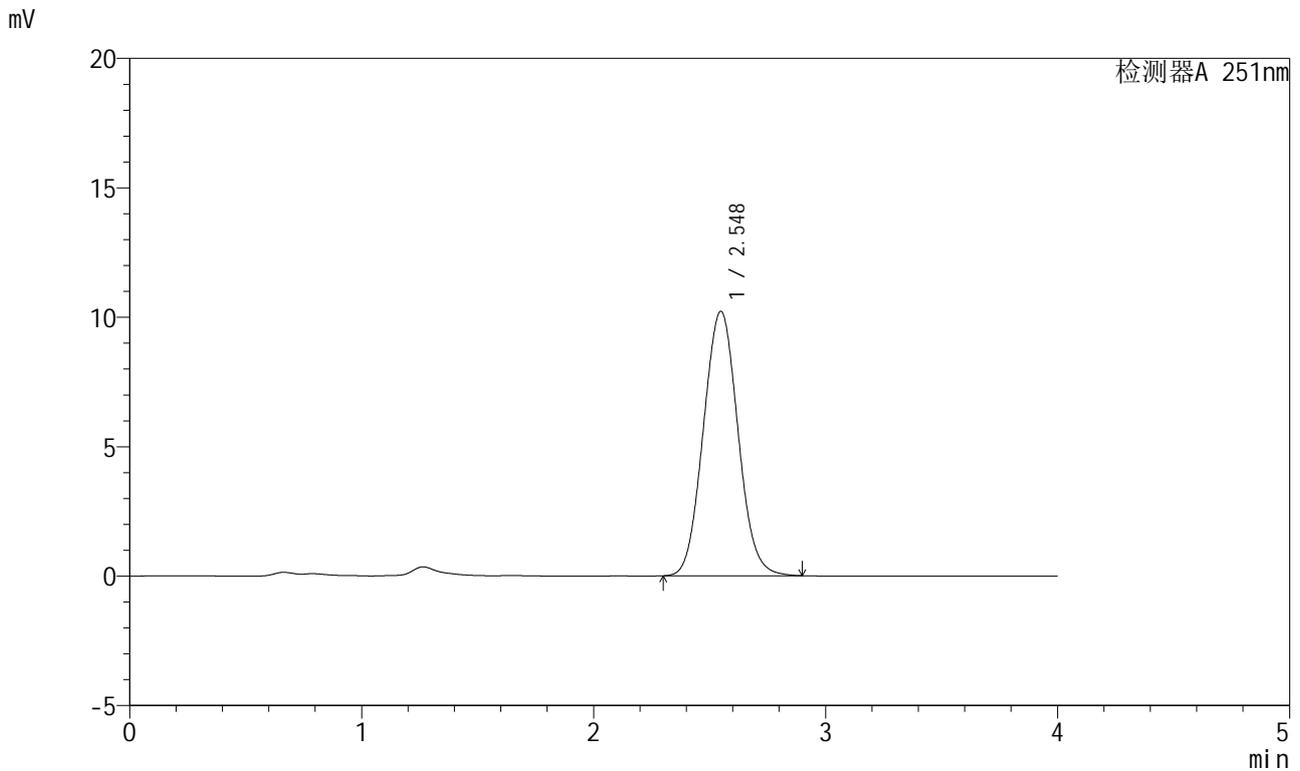

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	105892	100.000	10216	1395	1.060	--
总计		105892	100.000	10216			

图114 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3398-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:43:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

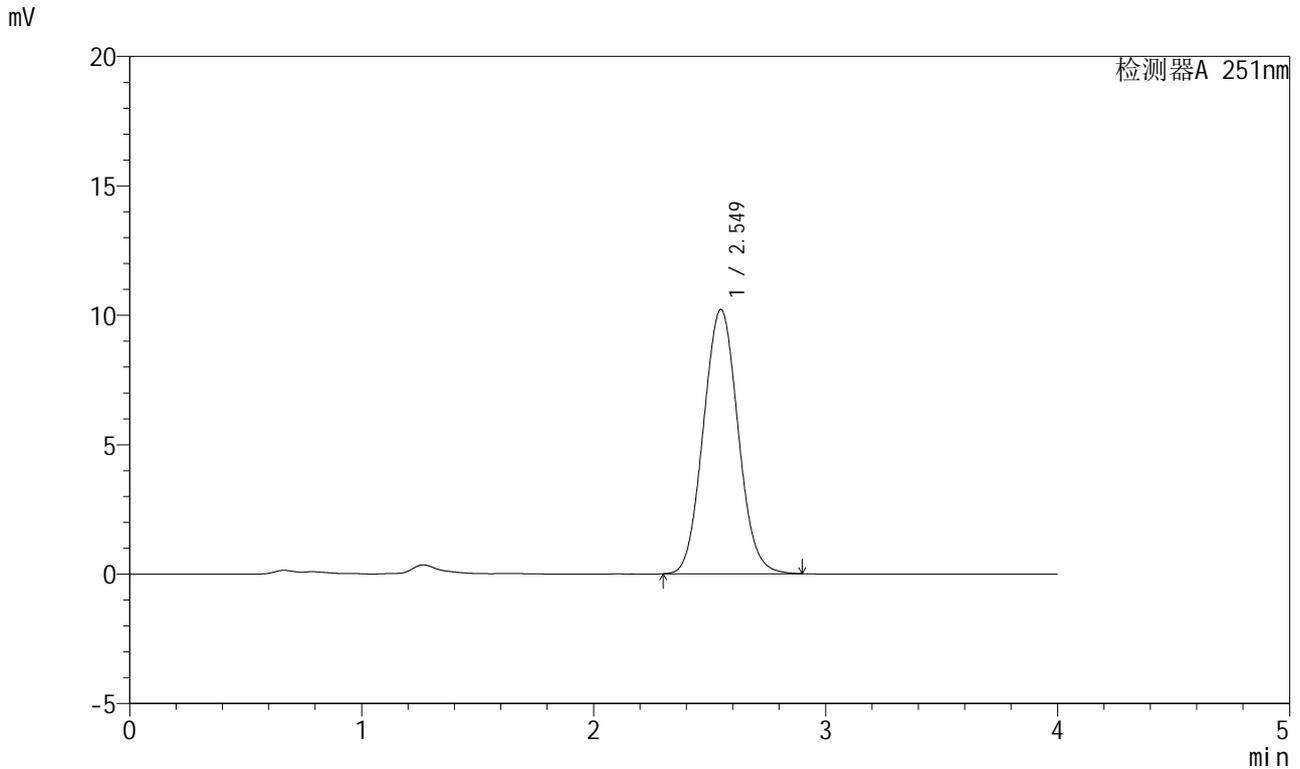

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105948	100.000	10208	1394	1.060	--
总计		105948	100.000	10208			

图115 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3399-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:47:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

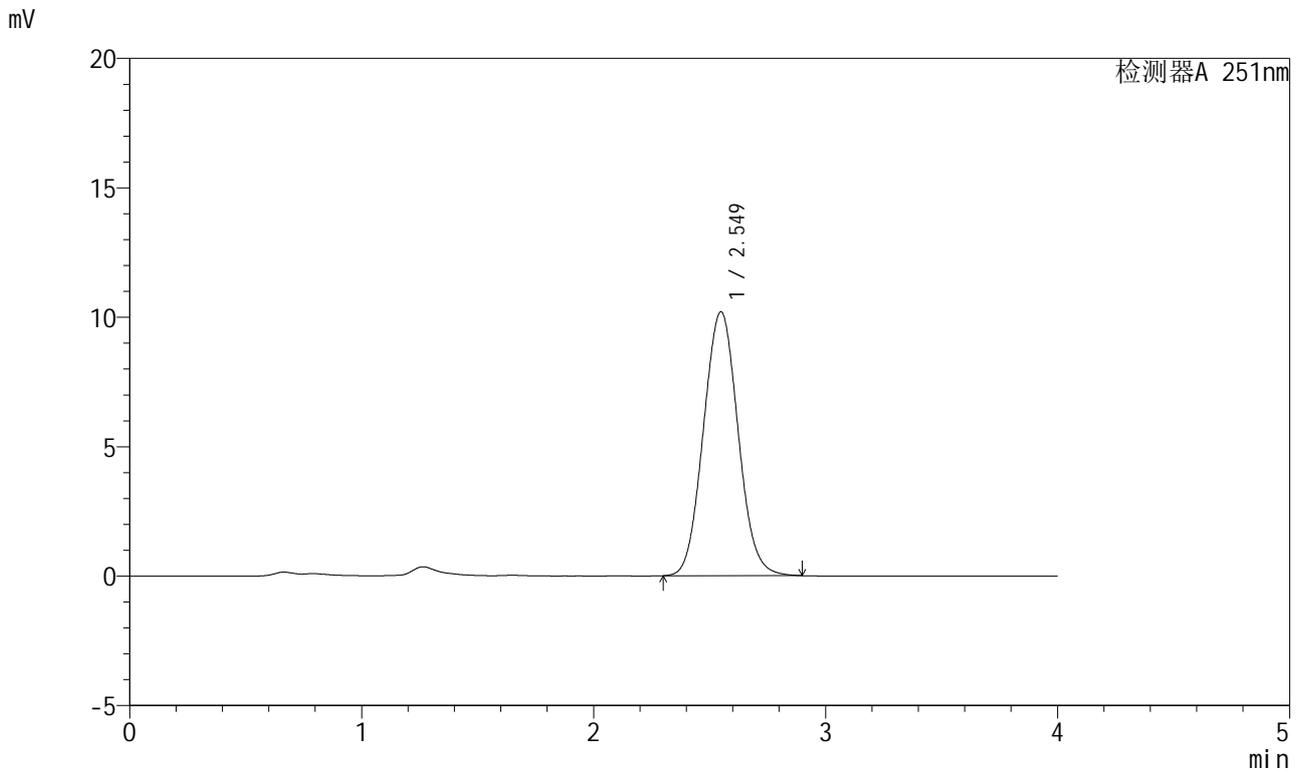

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105815	100.000	10190	1394	1.060	--
总计		105815	100.000	10190			

图116 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3400-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:51:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

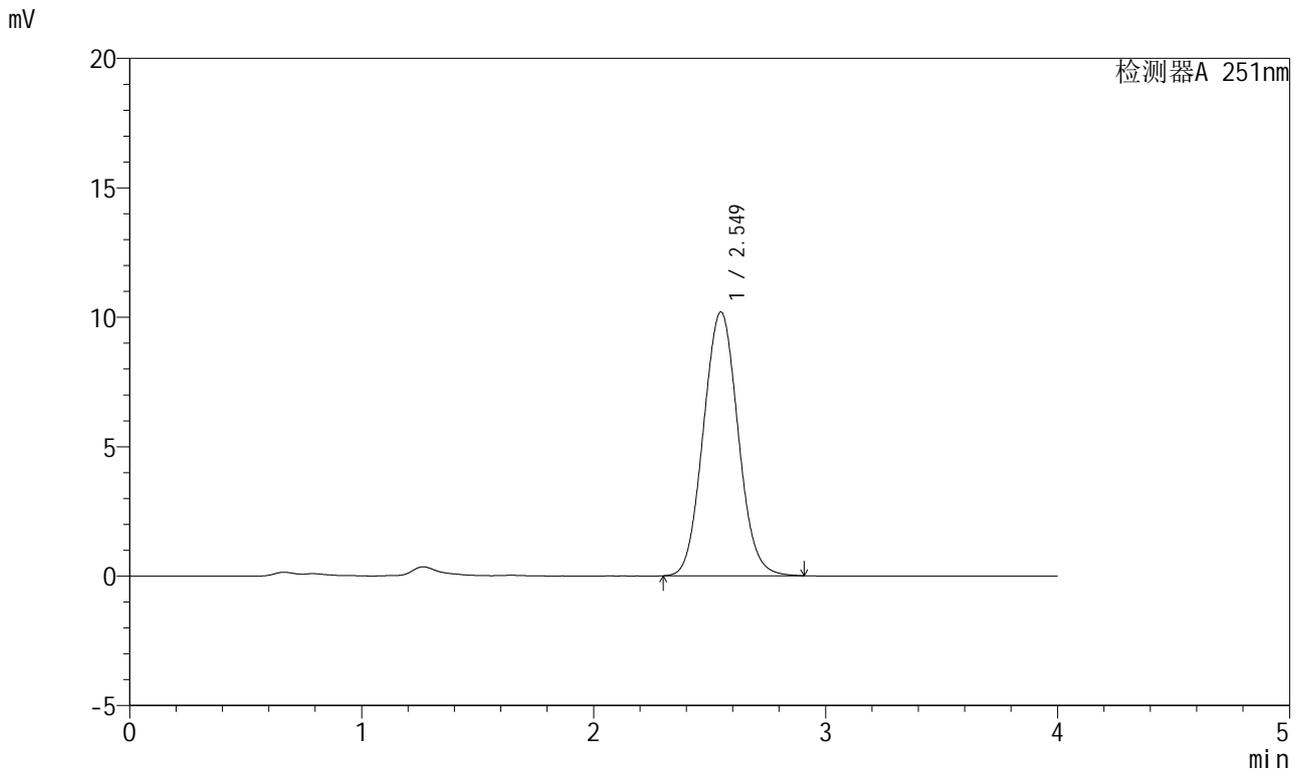

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105879	100.000	10191	1392	1.061	--
总计		105879	100.000	10191			

图117 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3401-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 18:56:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

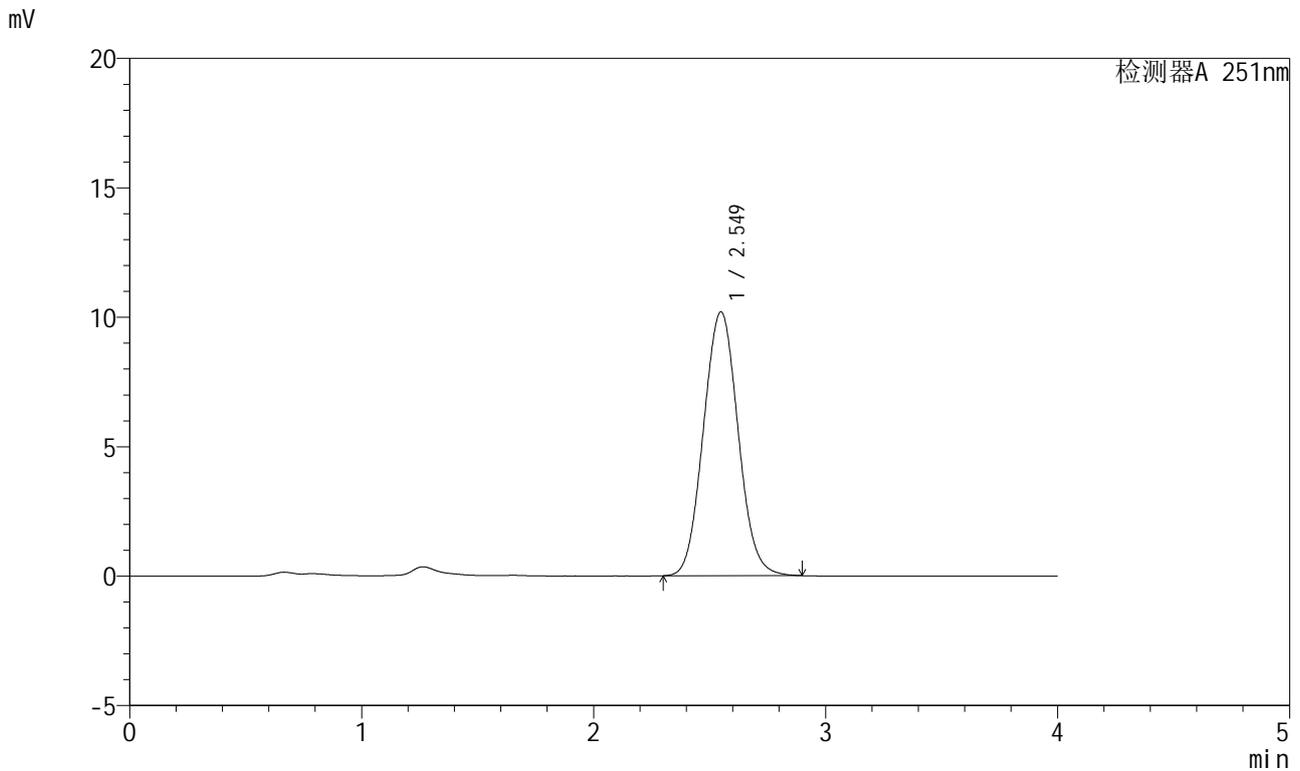

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105856	100.000	10187	1391	1.059	--
总计		105856	100.000	10187			

图118 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3402-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:00:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

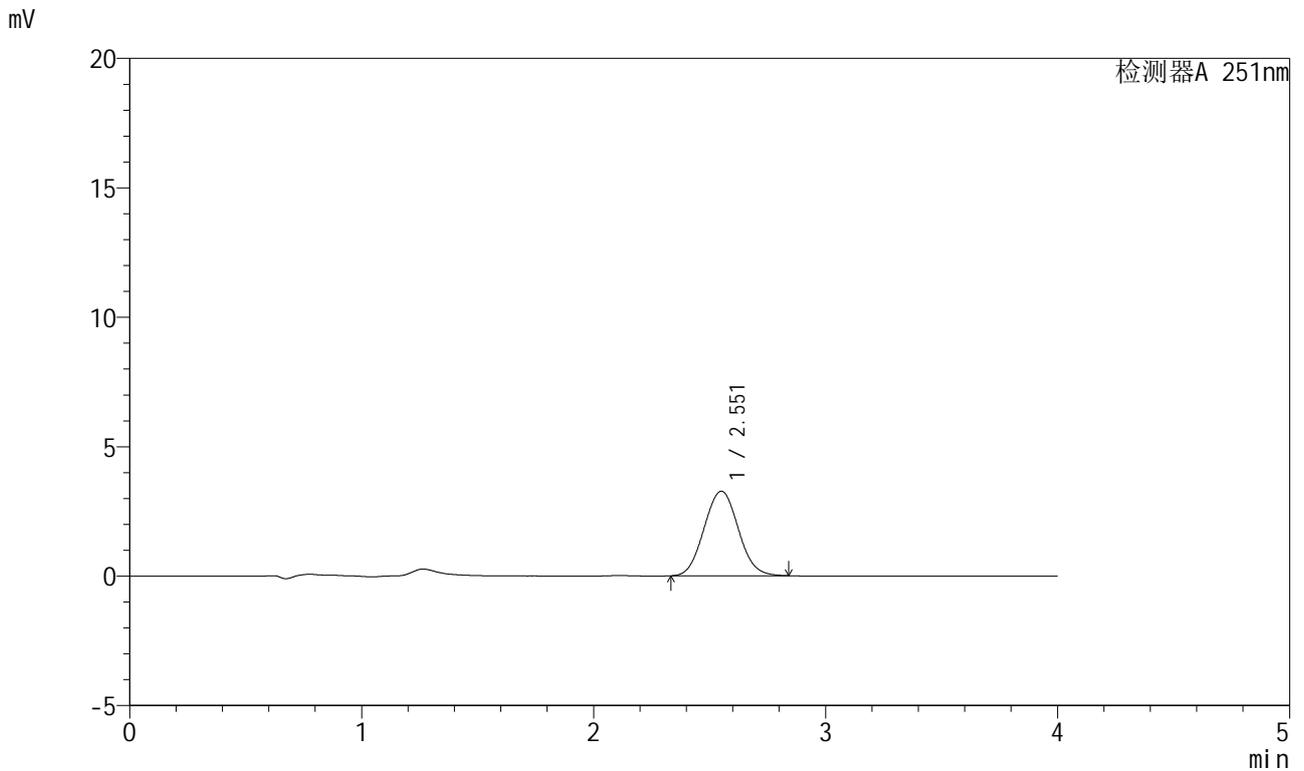

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	33493	100.000	3264	1421	1.056	--
总计		33493	100.000	3264			

图119 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3403-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:05:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

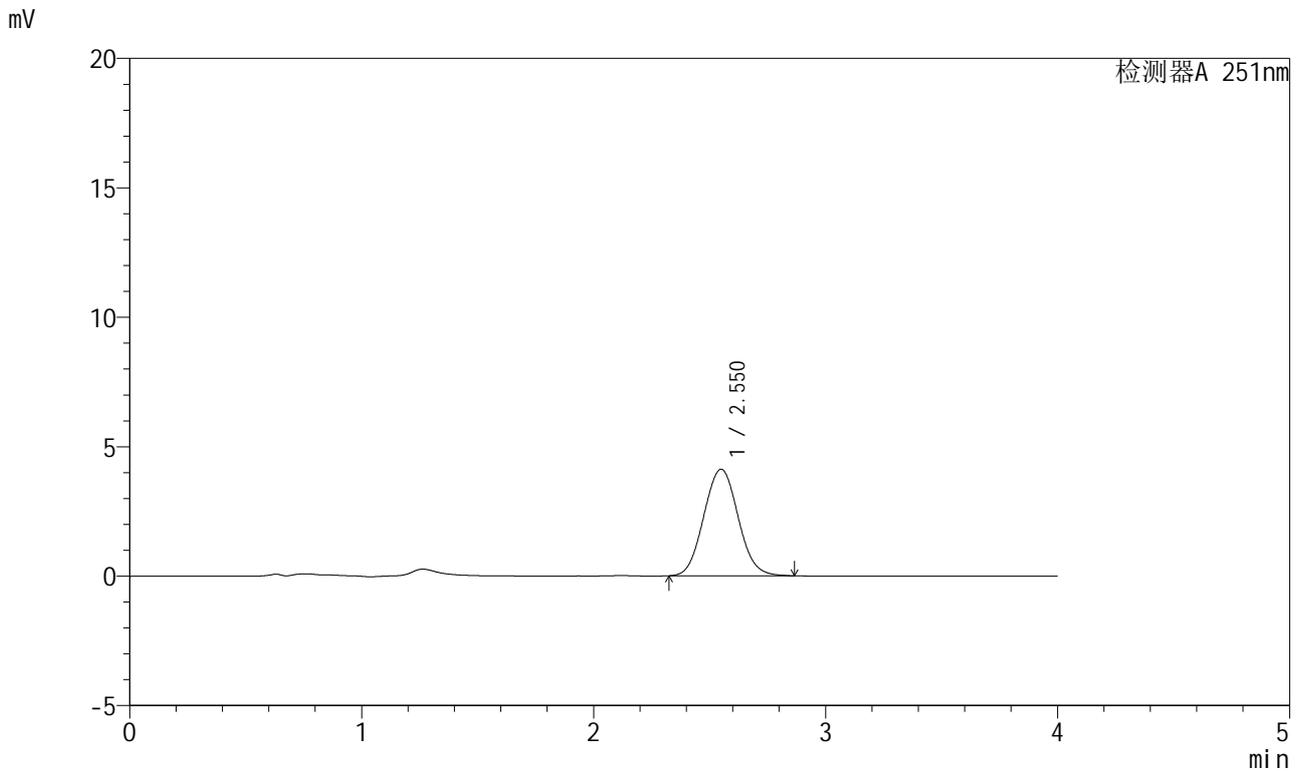

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	42418	100.000	4117	1420	1.059	--
总计		42418	100.000	4117			

图120 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3404-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:09:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

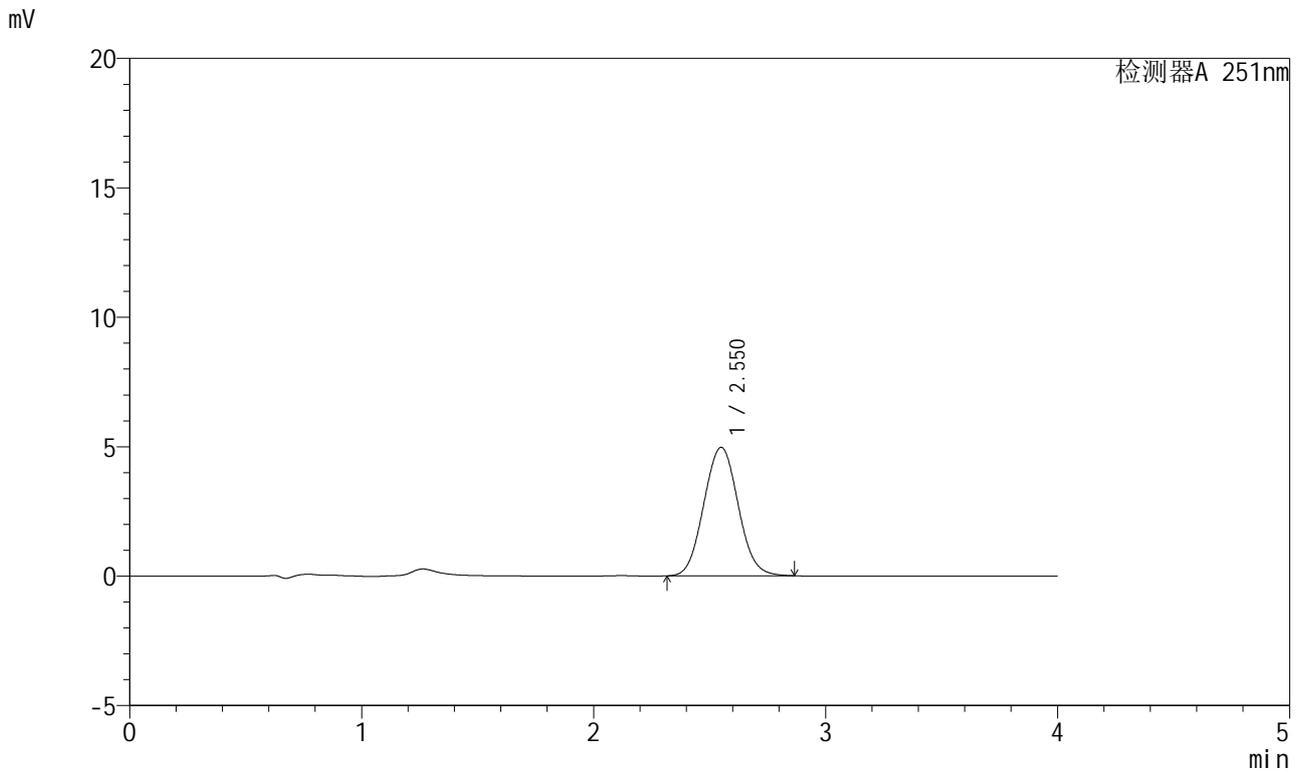

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	51074	100.000	4957	1416	1.056	--
总计		51074	100.000	4957			

图121 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3405-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:13:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:32:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

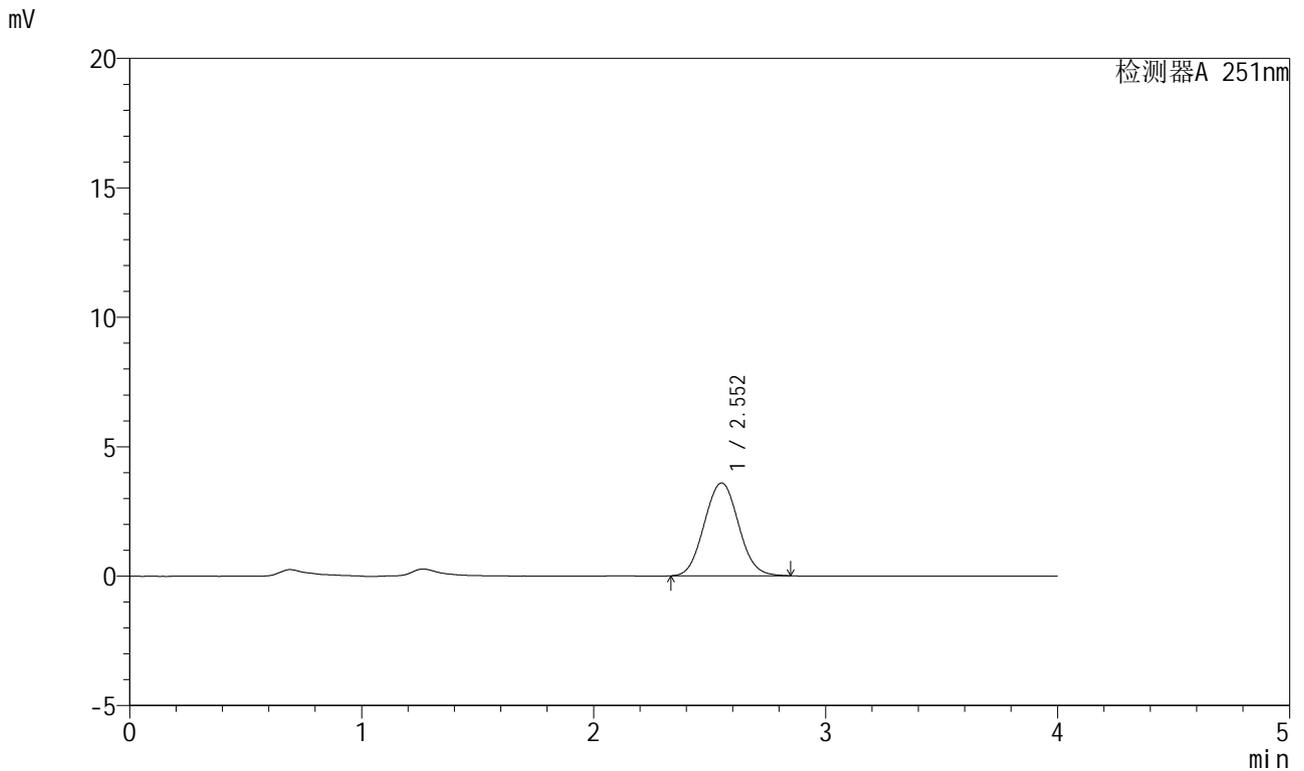

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	36848	100.000	3587	1422	1.053	--
总计		36848	100.000	3587			

图122 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3406-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:18:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

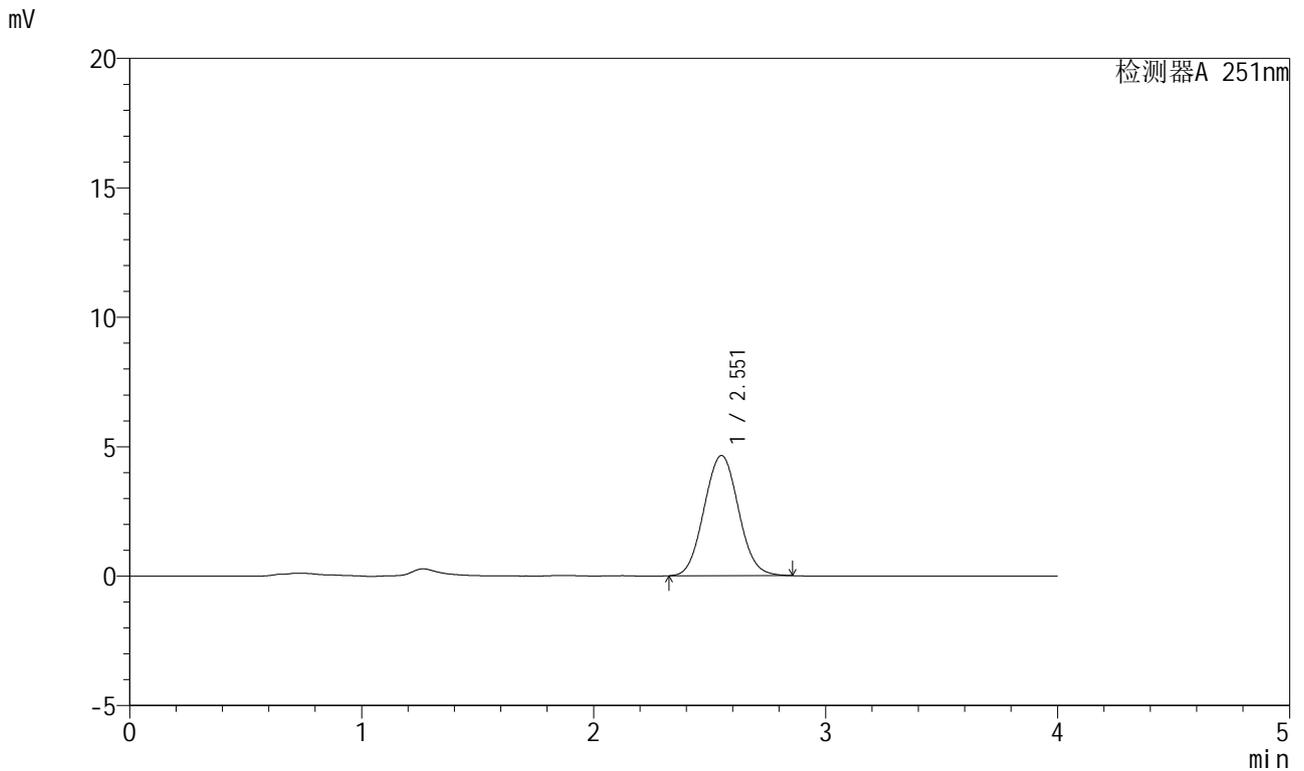

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	47826	100.000	4640	1419	1.052	--
总计		47826	100.000	4640			

图123 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3407-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:22:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

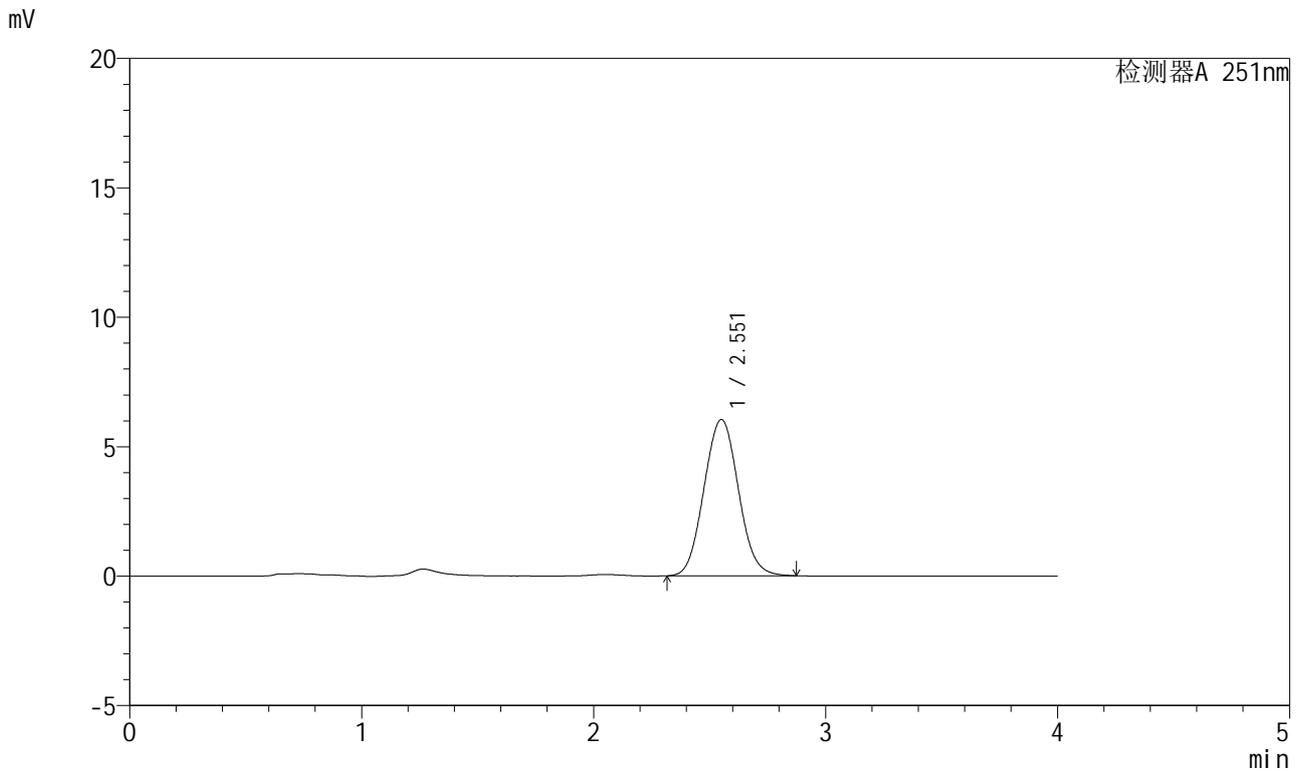

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	62323	100.000	6029	1414	1.058	--
总计		62323	100.000	6029			

图124 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3408-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:26:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

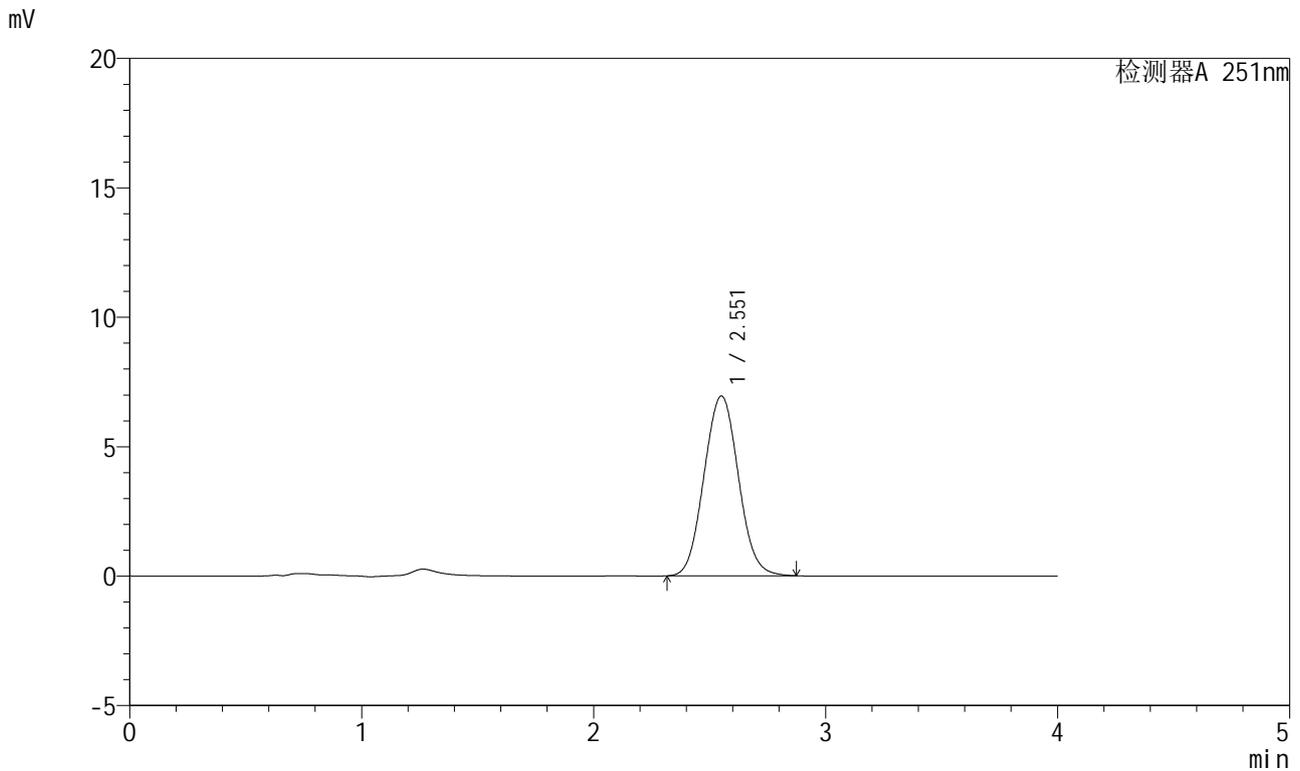

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	71528	100.000	6934	1417	1.056	--
总计		71528	100.000	6934			

图125 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3409-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:31:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

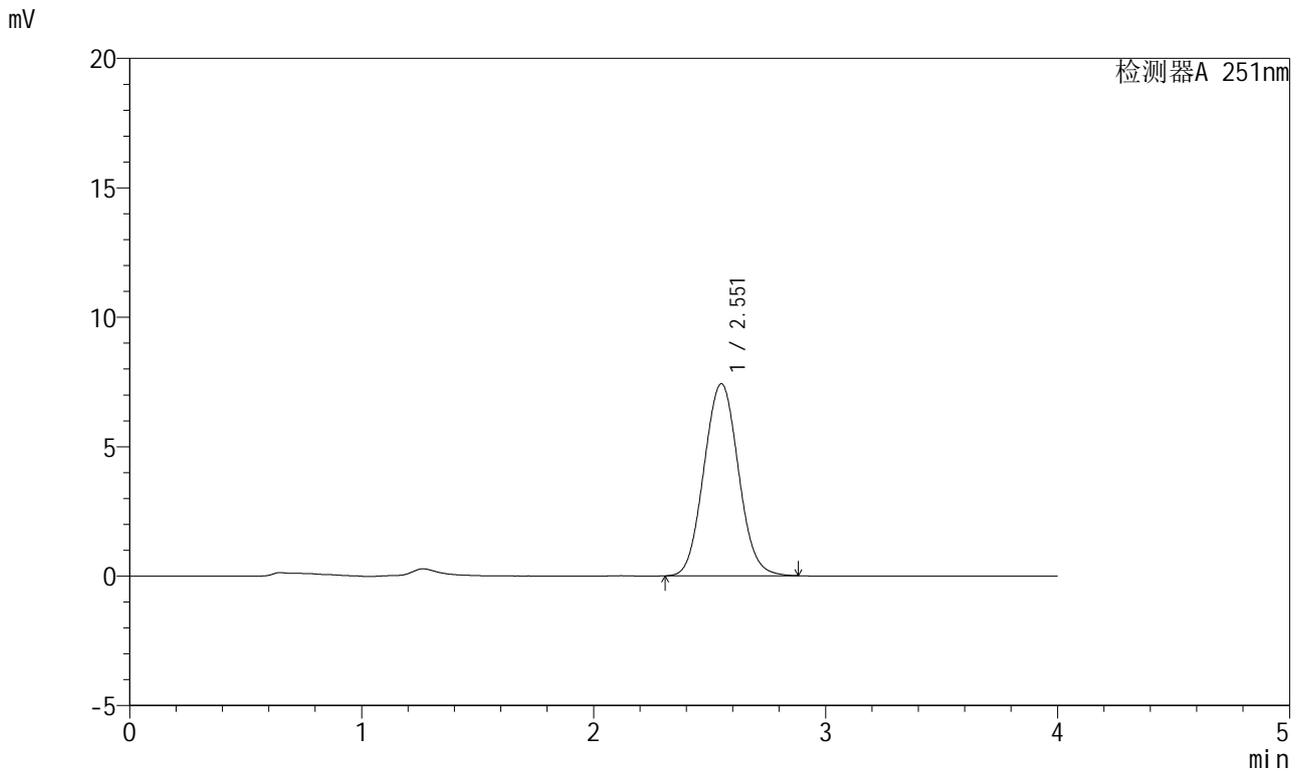

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	76666	100.000	7412	1413	1.058	--
总计		76666	100.000	7412			

图126 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3410-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:35:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

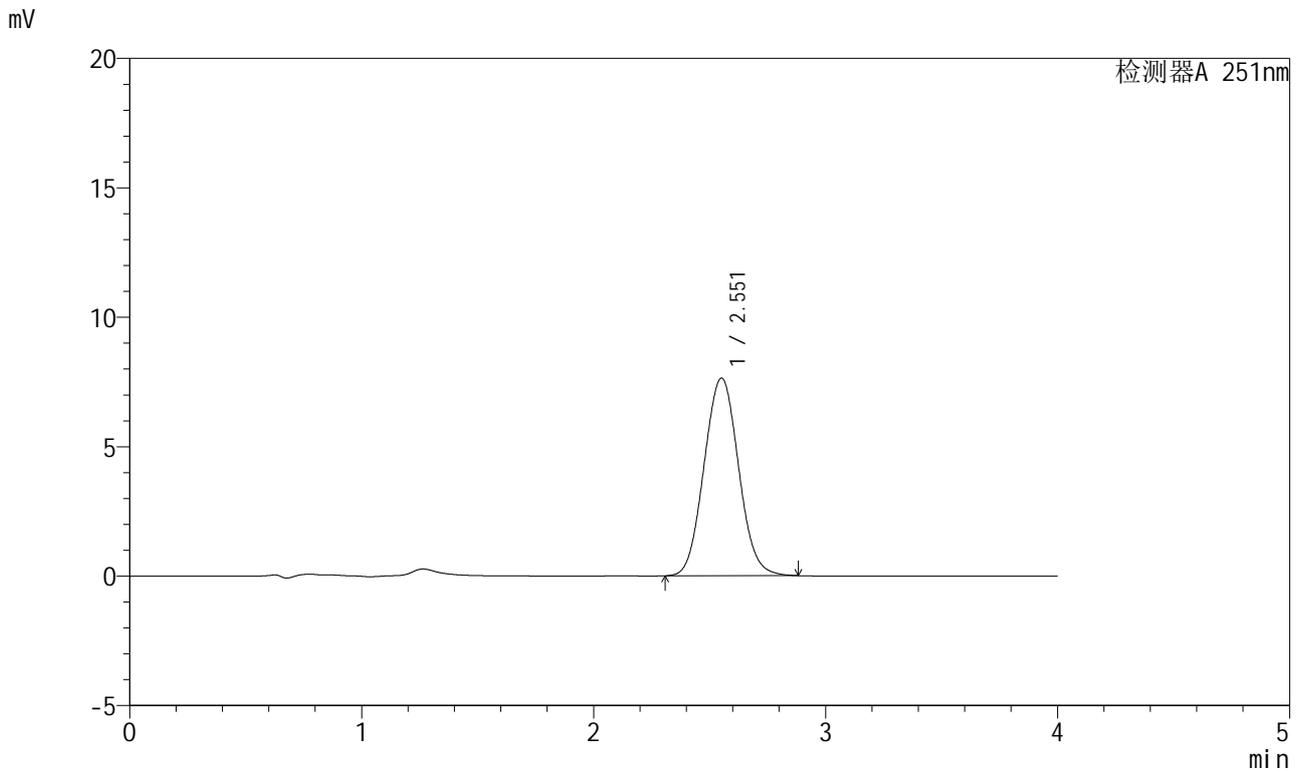

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	78900	100.000	7628	1416	1.057	--
总计		78900	100.000	7628			

图127 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3411-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:40:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

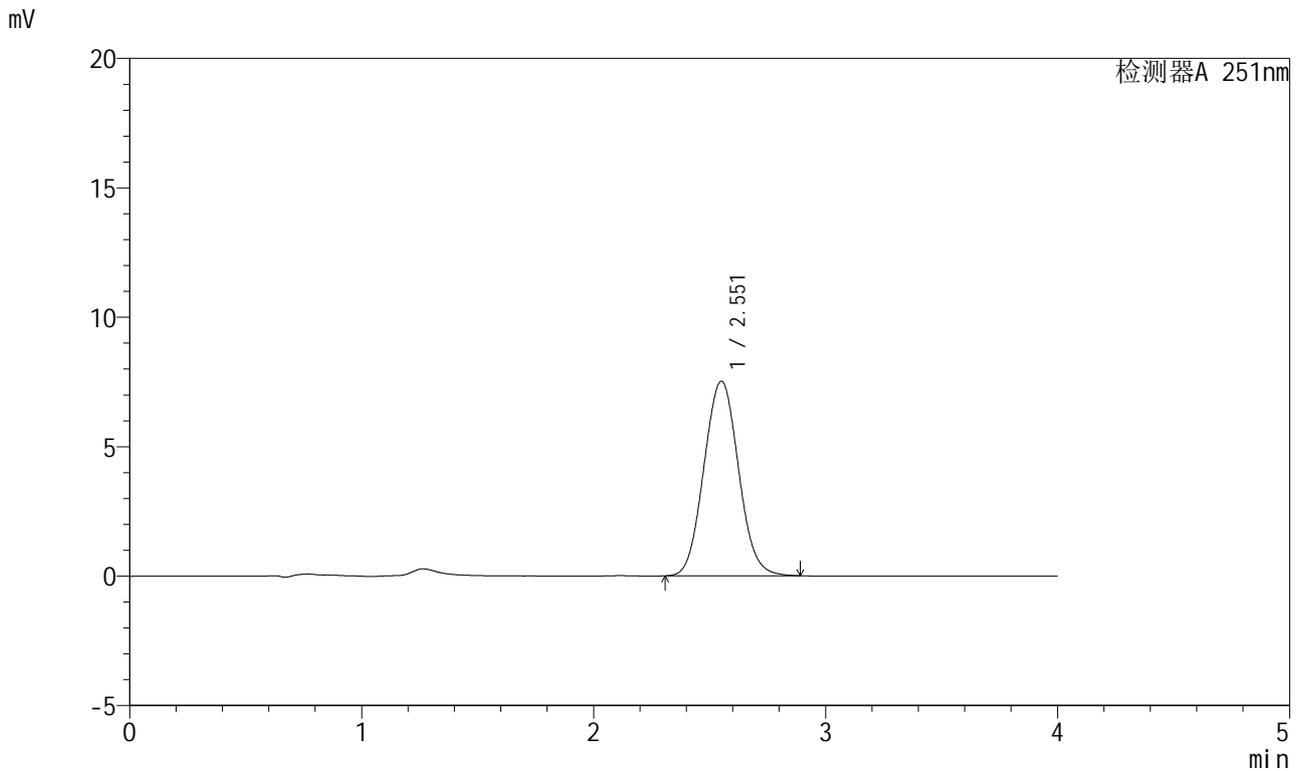

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	77907	100.000	7511	1404	1.059	--
总计		77907	100.000	7511			

图128 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3412-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:44:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

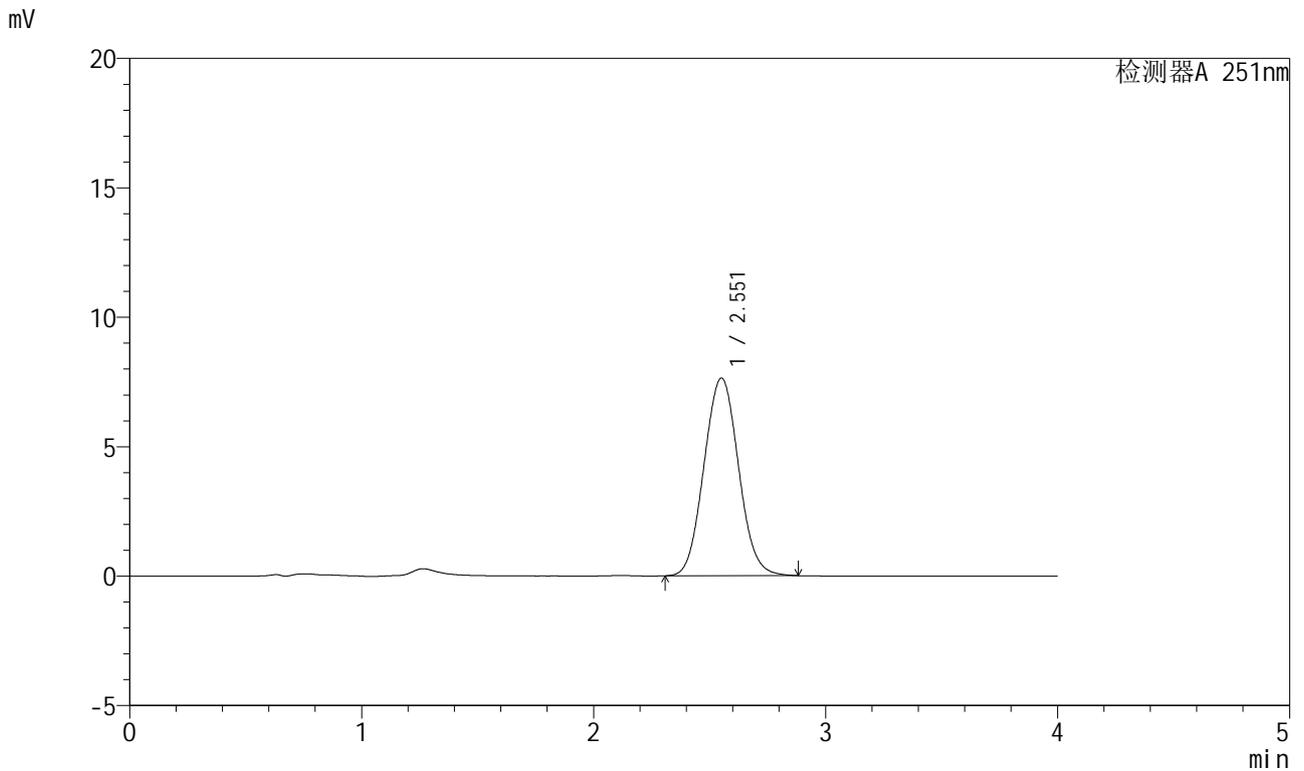

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	79029	100.000	7626	1407	1.059	--
总计		79029	100.000	7626			

图129 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3413-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:48:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

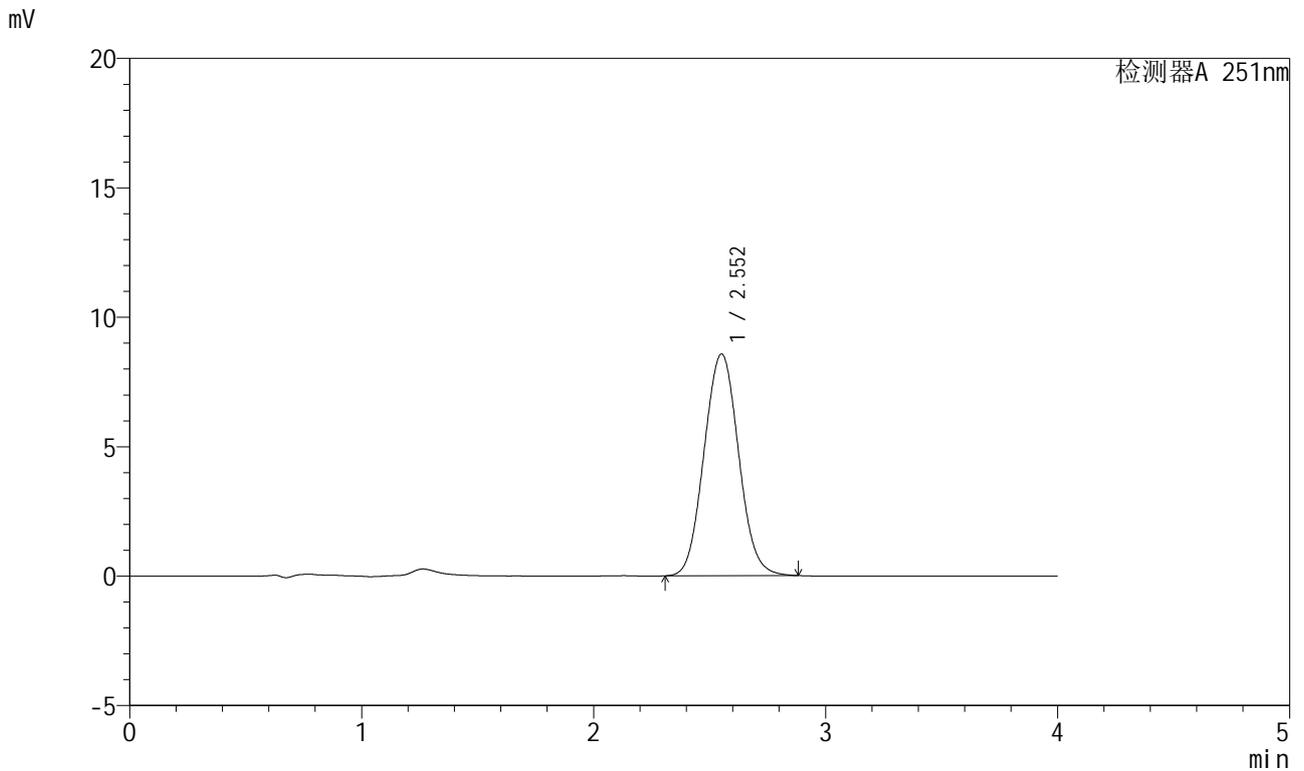

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	88685	100.000	8558	1407	1.058	--
总计		88685	100.000	8558			

图130 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3414-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:53:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

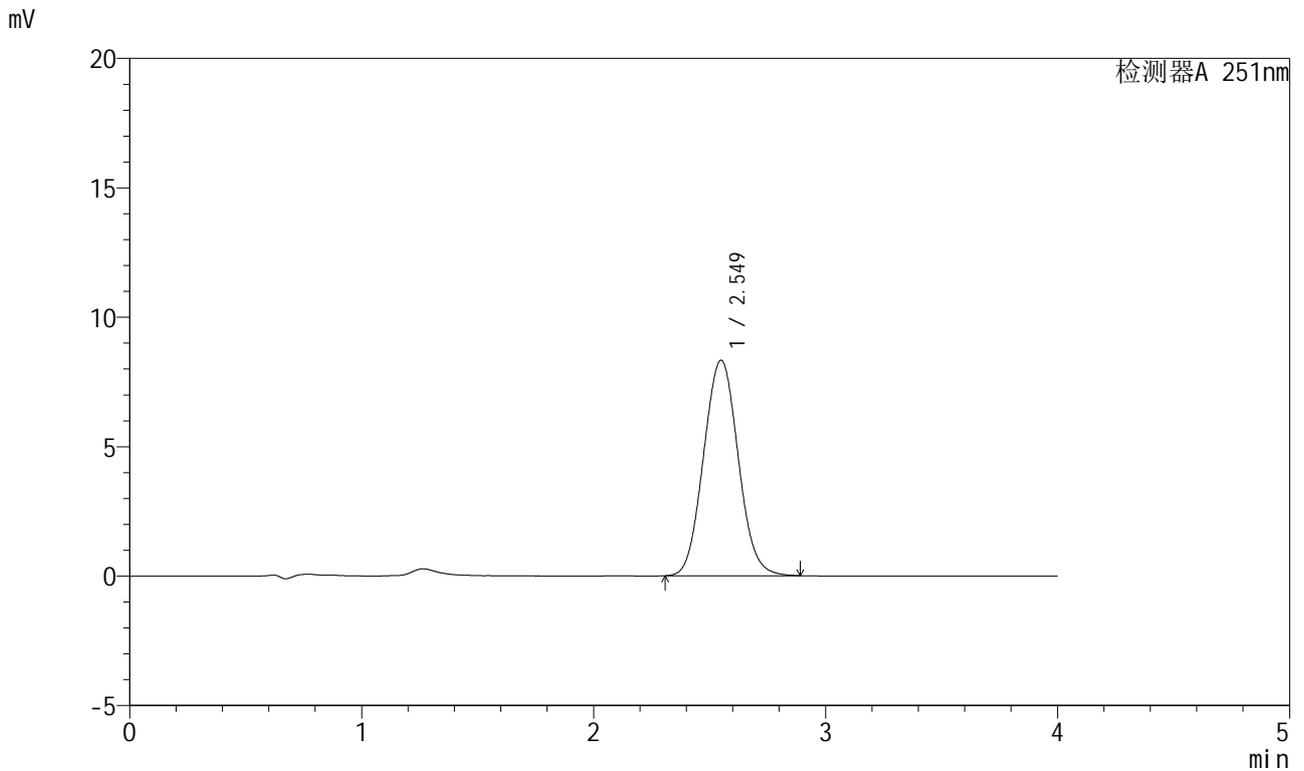

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	86364	100.000	8323	1399	1.061	--
总计		86364	100.000	8323			

图131 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3415-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 19:57:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

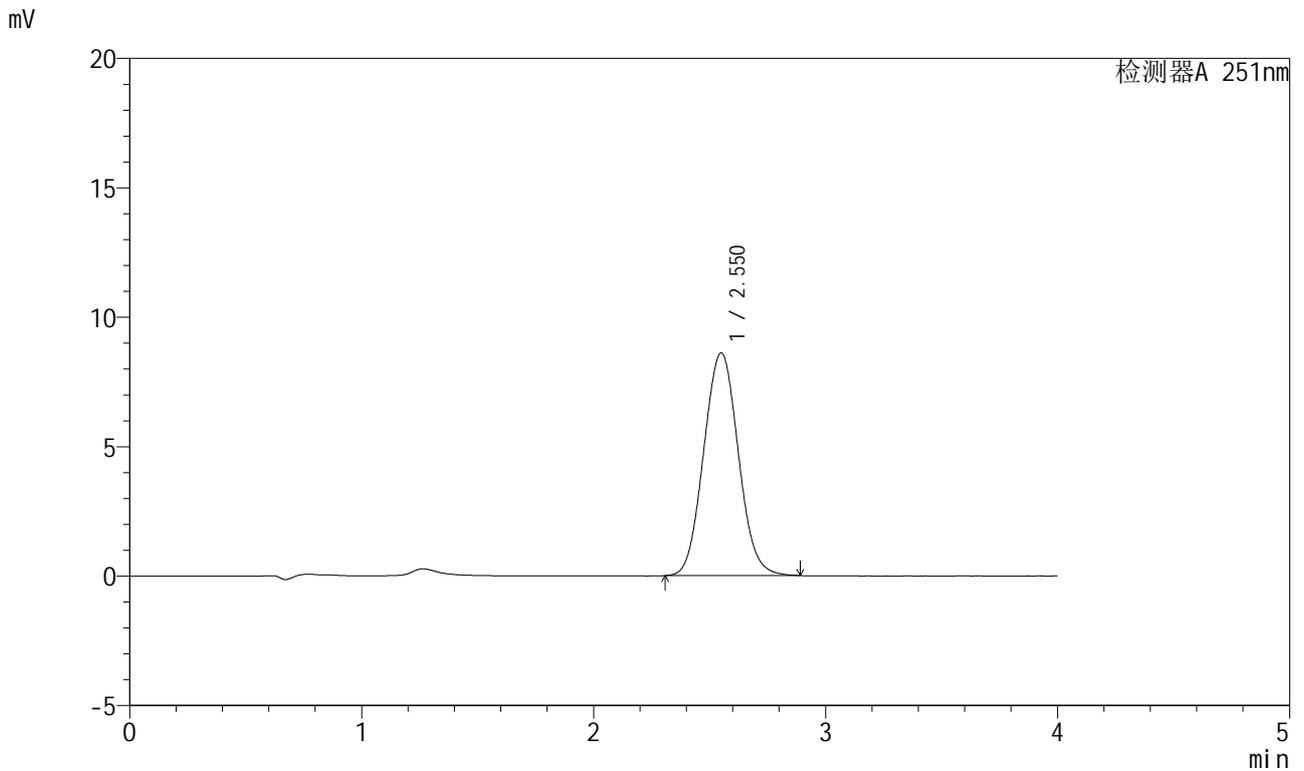

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	89226	100.000	8593	1399	1.059	--
总计		89226	100.000	8593			

图132 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3416-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:01:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

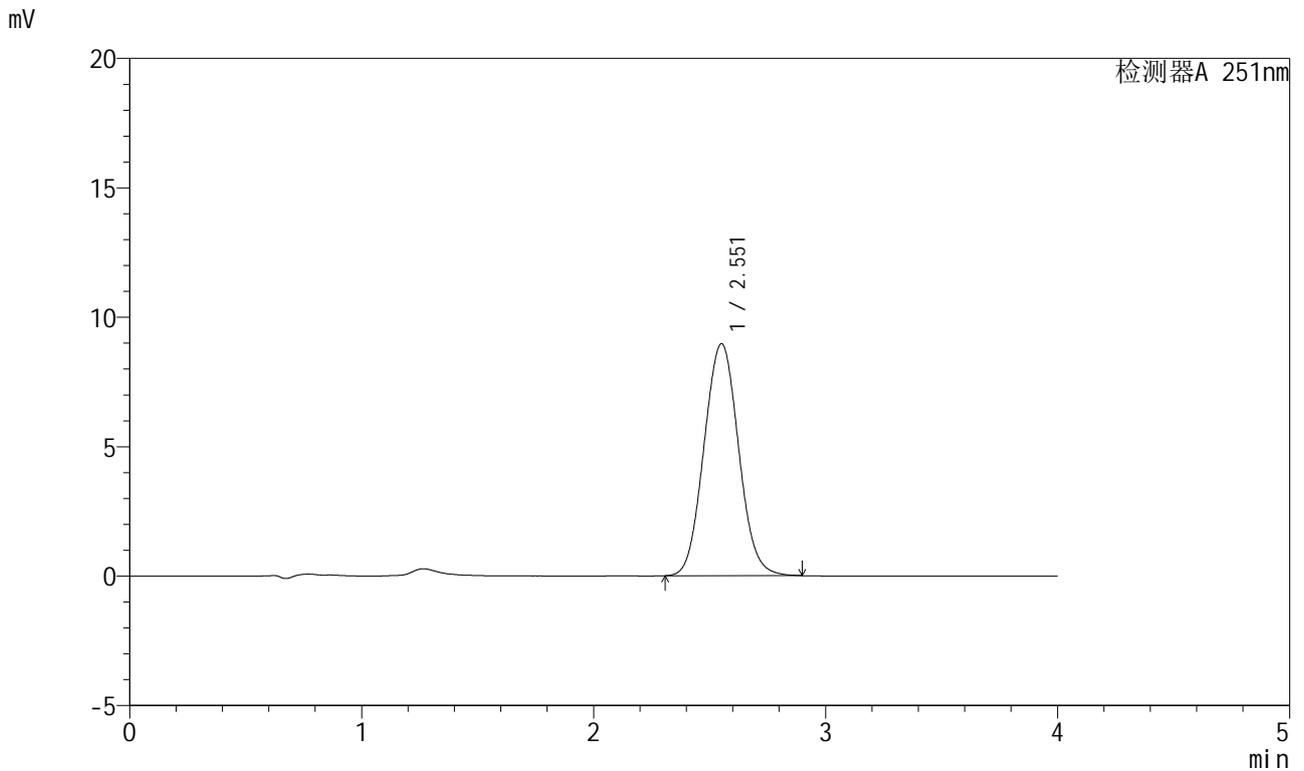

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	92836	100.000	8951	1406	1.058	--
总计		92836	100.000	8951			

图133 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3417-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:06:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

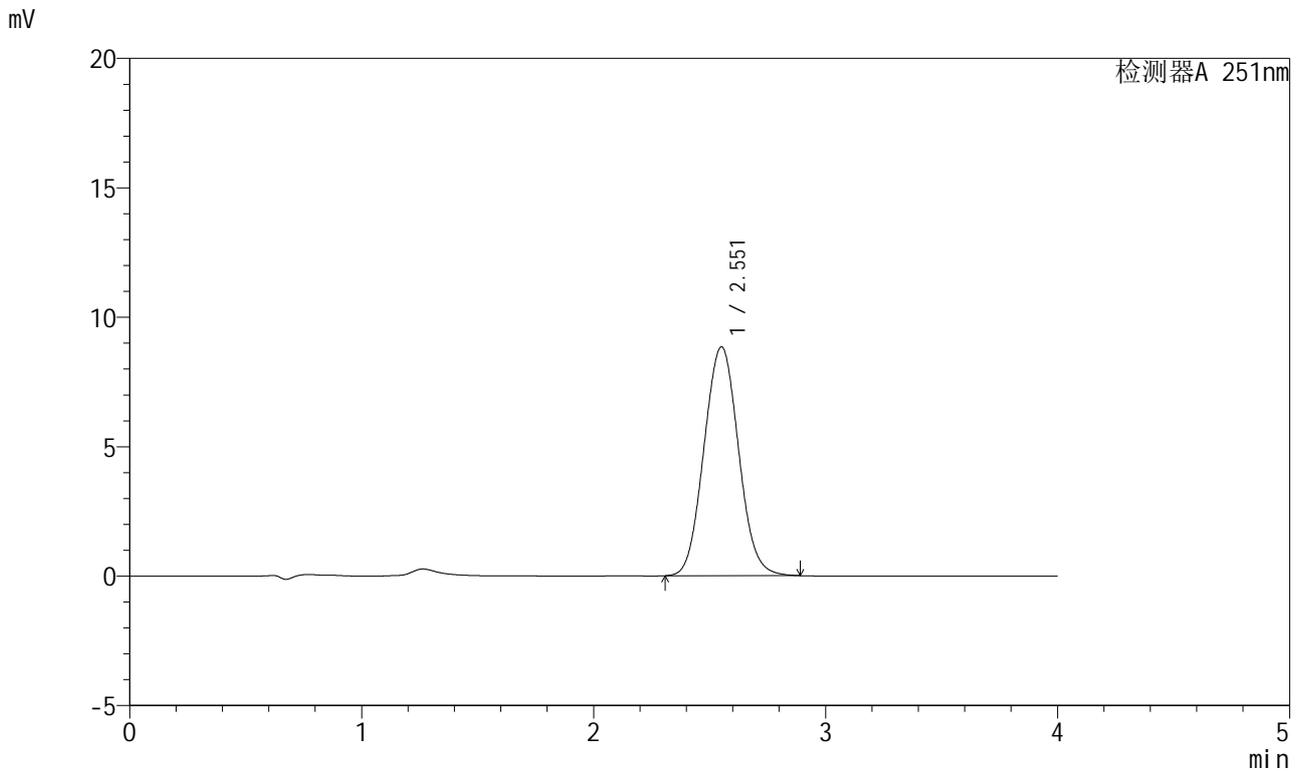

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	91593	100.000	8829	1403	1.057	--
总计		91593	100.000	8829			

图134 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3418-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:10:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

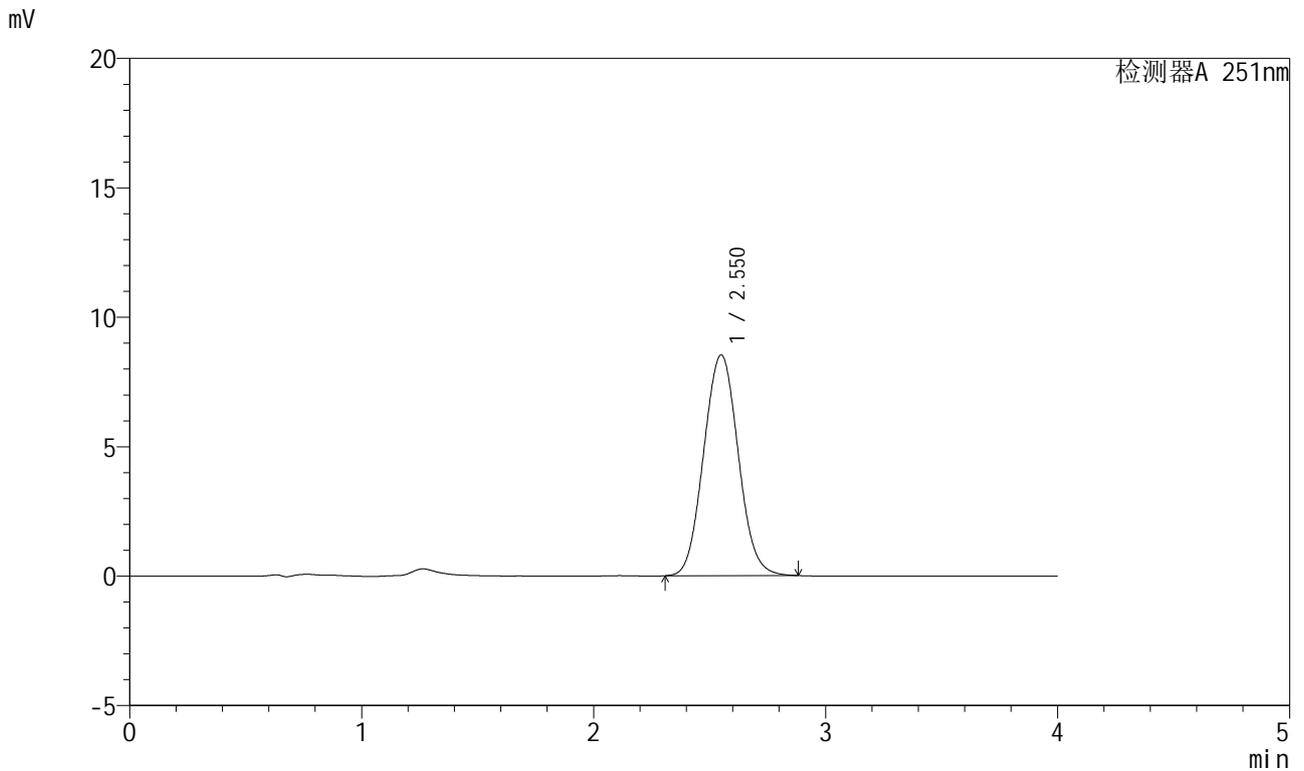

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	88361	100.000	8521	1402	1.058	--
总计		88361	100.000	8521			


图135 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3419-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:15:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

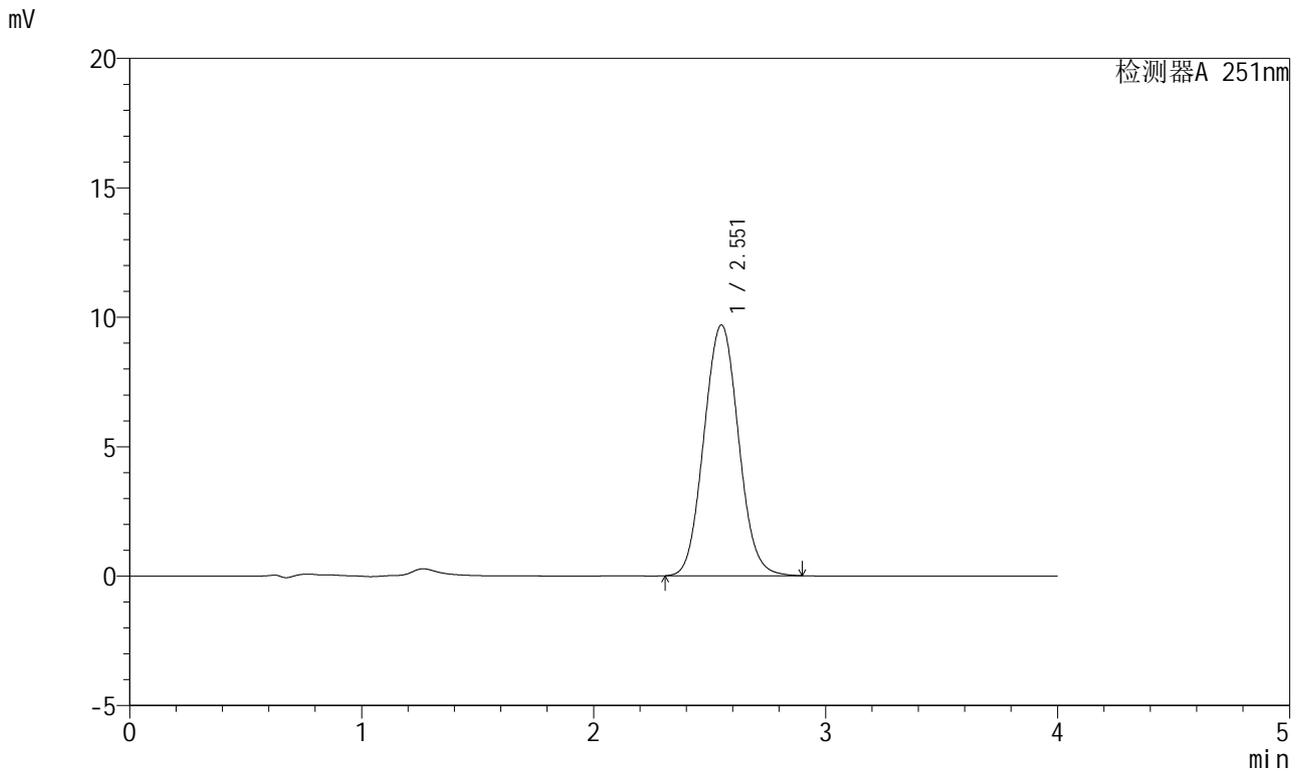

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	100272	100.000	9675	1409	1.059	--
总计		100272	100.000	9675			

图136 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3420-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:19:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

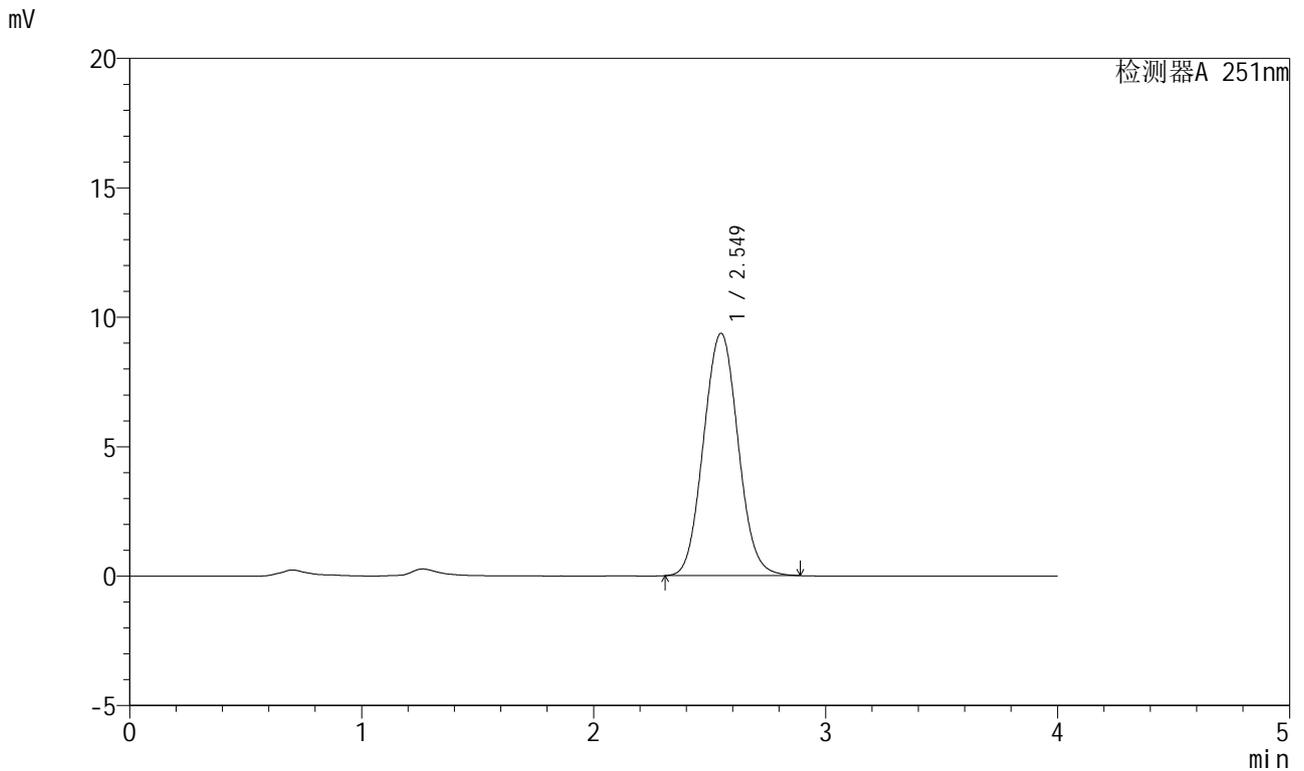

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	96966	100.000	9359	1405	1.059	--
总计		96966	100.000	9359			


图137 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3421-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:23:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

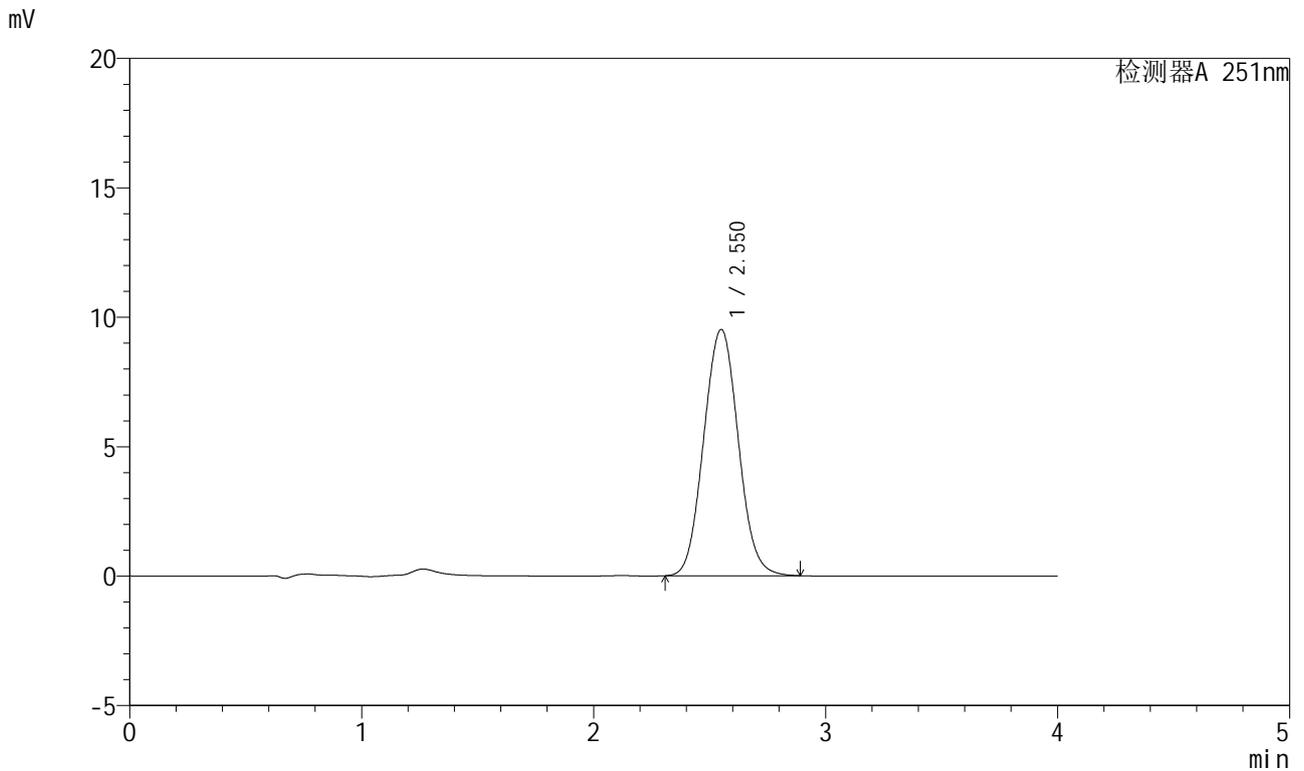

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	98474	100.000	9505	1407	1.058	--
总计		98474	100.000	9505			


图138 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3422-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:28:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

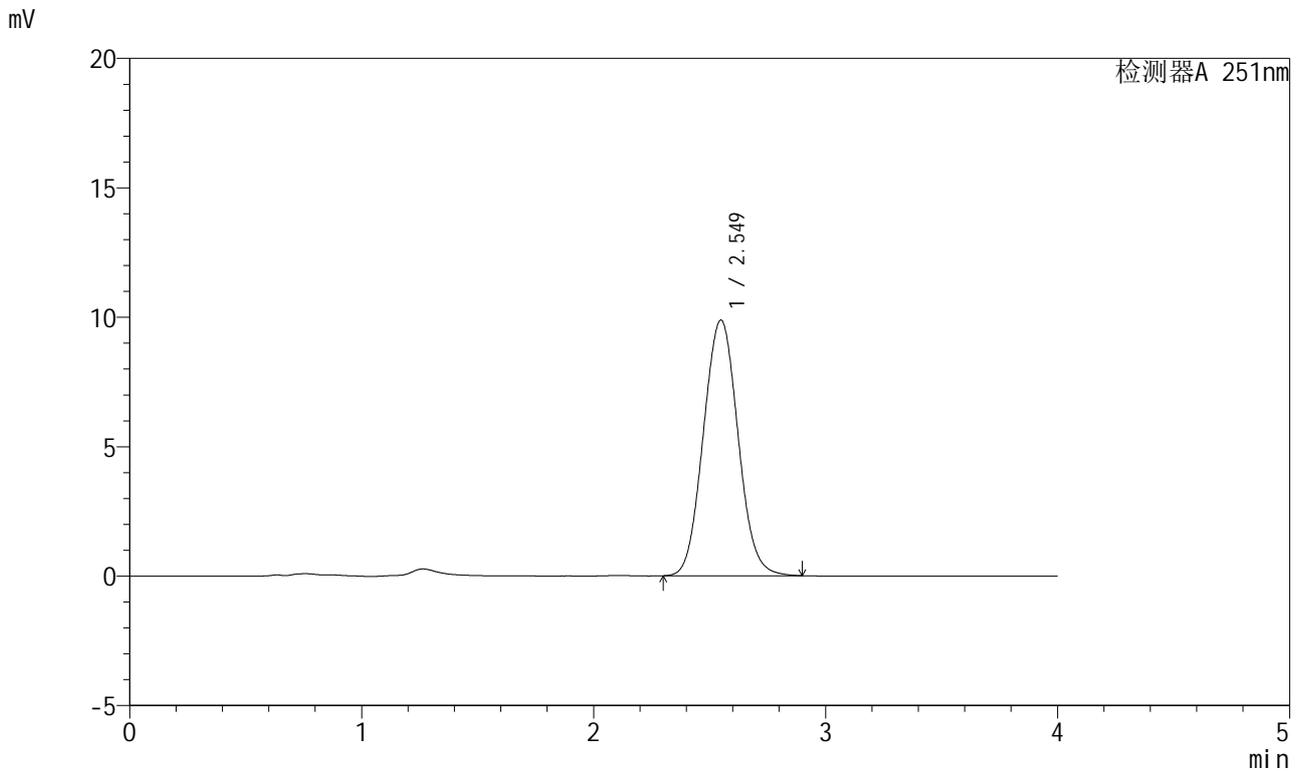

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	102453	100.000	9874	1401	1.058	--
总计		102453	100.000	9874			

图139 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3423-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:32:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

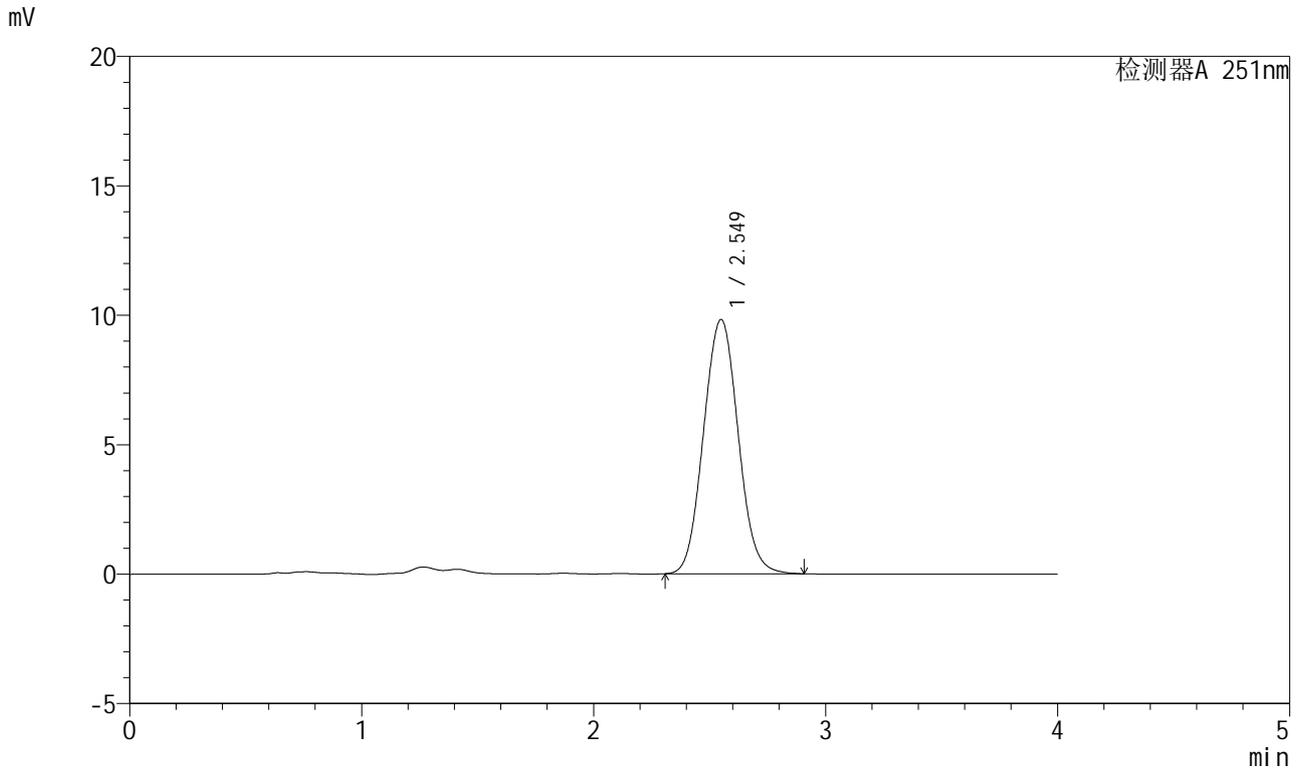

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	101849	100.000	9817	1404	1.059	--
总计		101849	100.000	9817			

图140 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3424-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:36:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

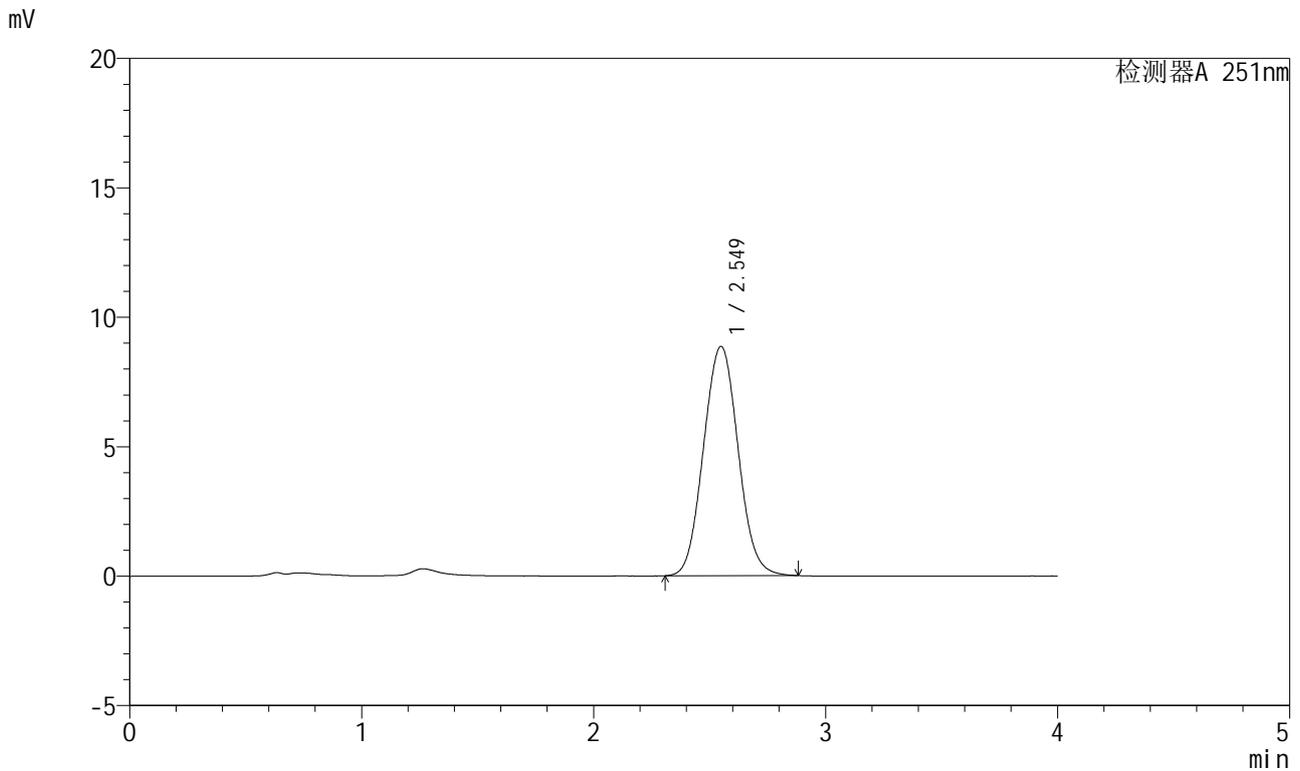

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	91873	100.000	8857	1398	1.059	--
总计		91873	100.000	8857			

图141 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3425-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:41:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

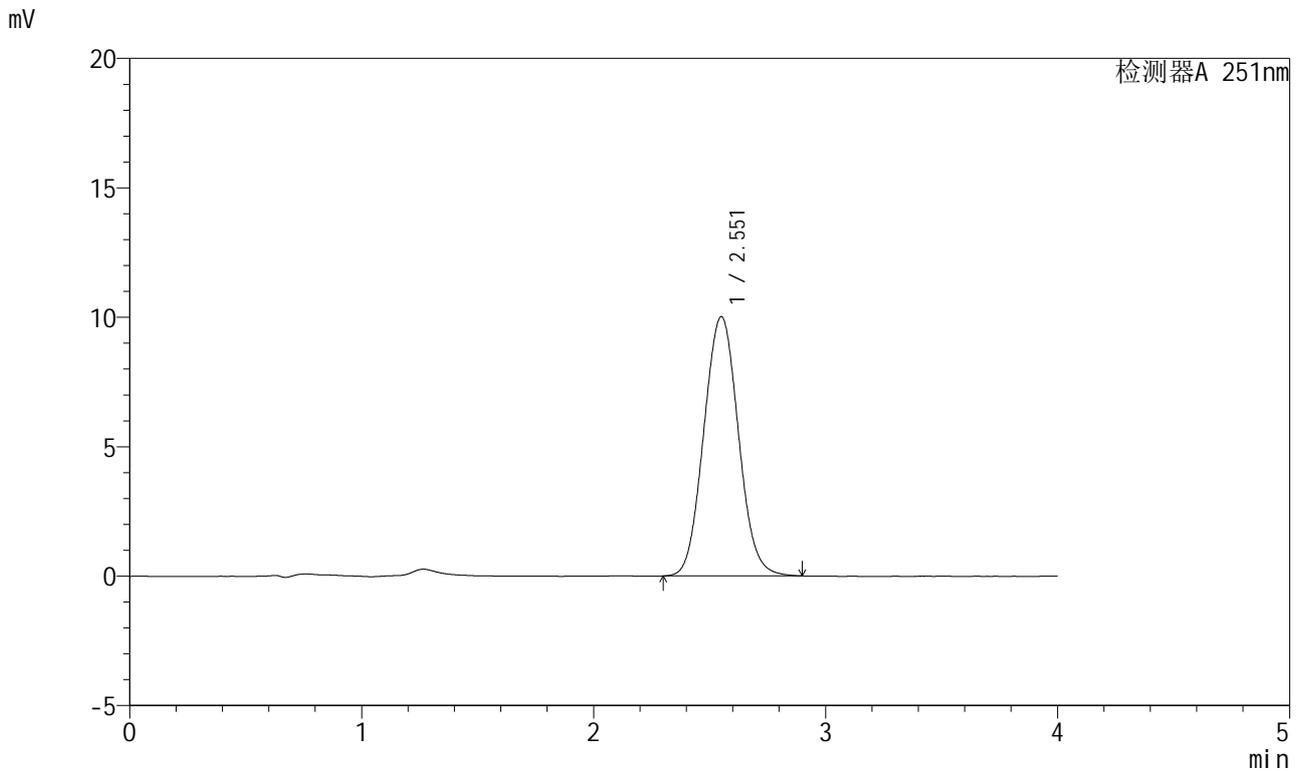

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	103887	100.000	10005	1403	1.058	--
总计		103887	100.000	10005			

图142 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3426-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:45:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

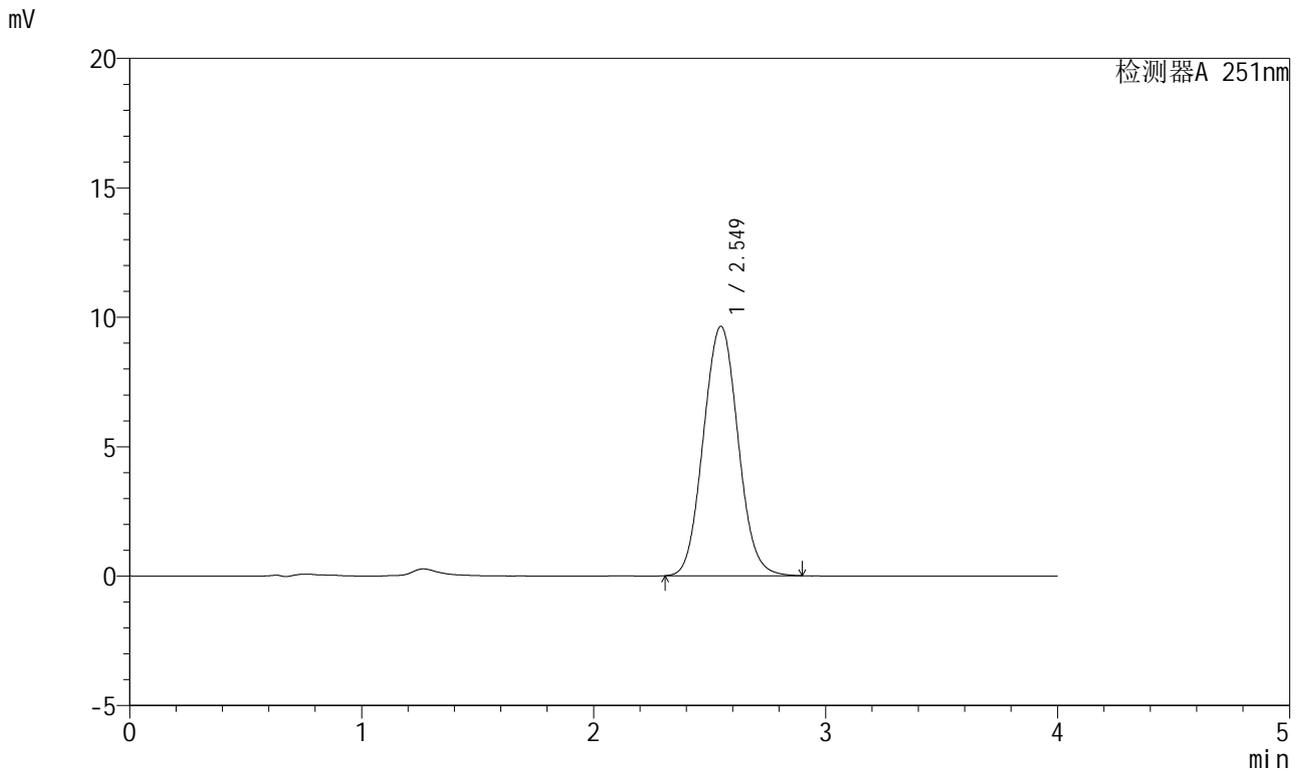

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	99978	100.000	9633	1399	1.059	--
总计		99978	100.000	9633			

图143 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3427-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:50:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

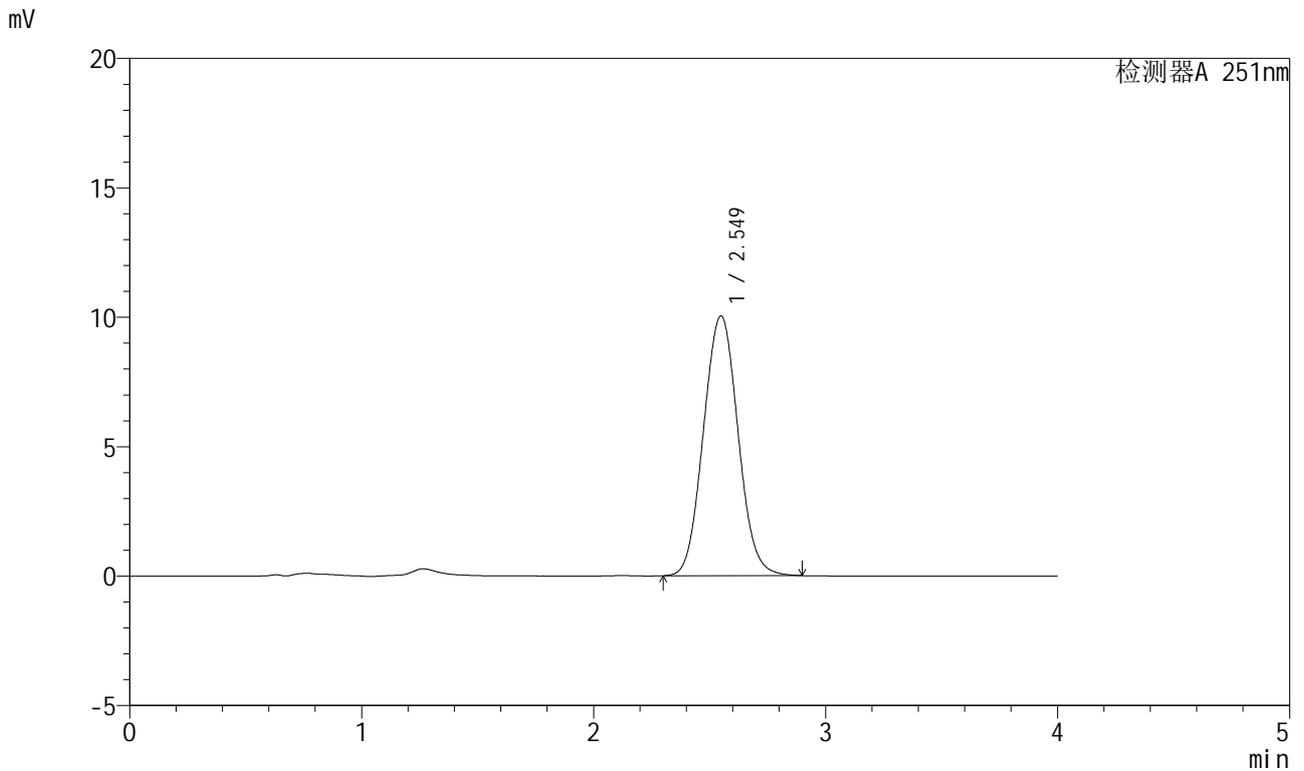

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	104047	100.000	10031	1401	1.058	--
总计		104047	100.000	10031			

图144 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3428-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:54:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

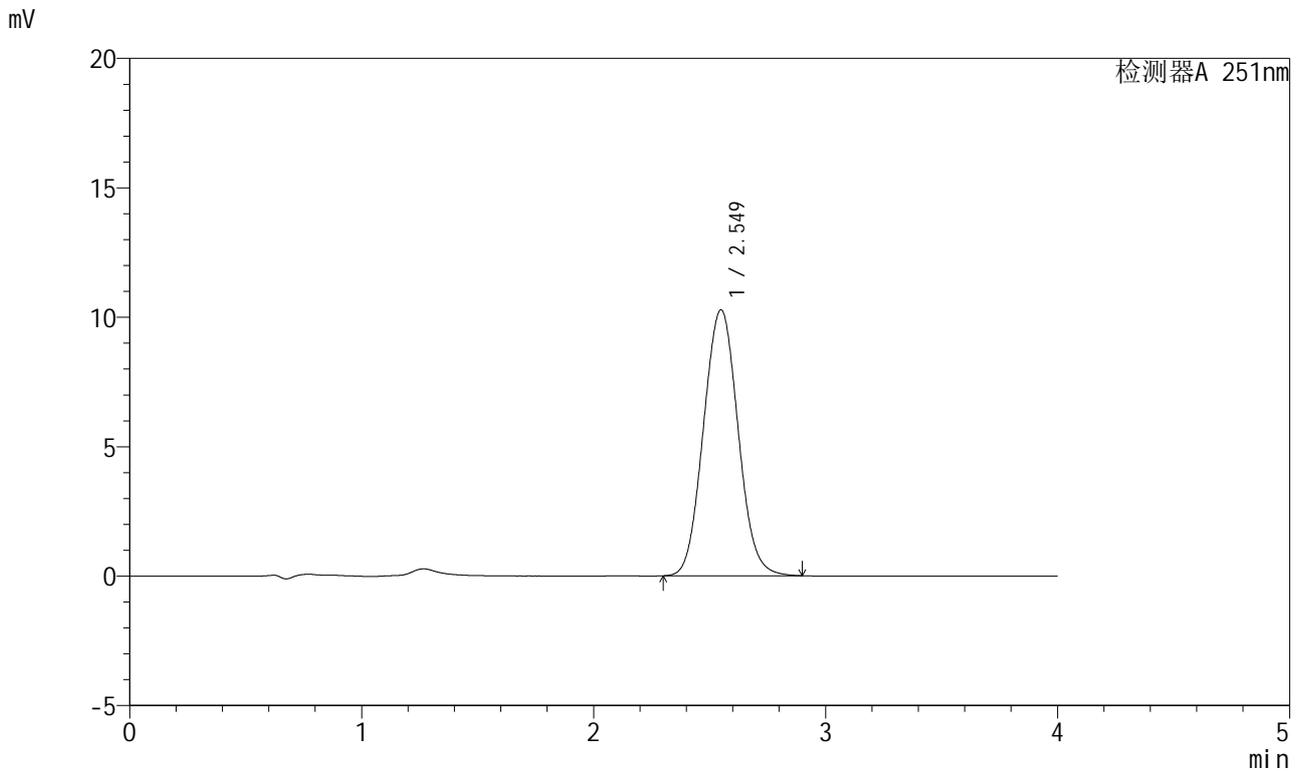

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106565	100.000	10270	1401	1.058	--
总计		106565	100.000	10270			

图145 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3429-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 20:58:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:33:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

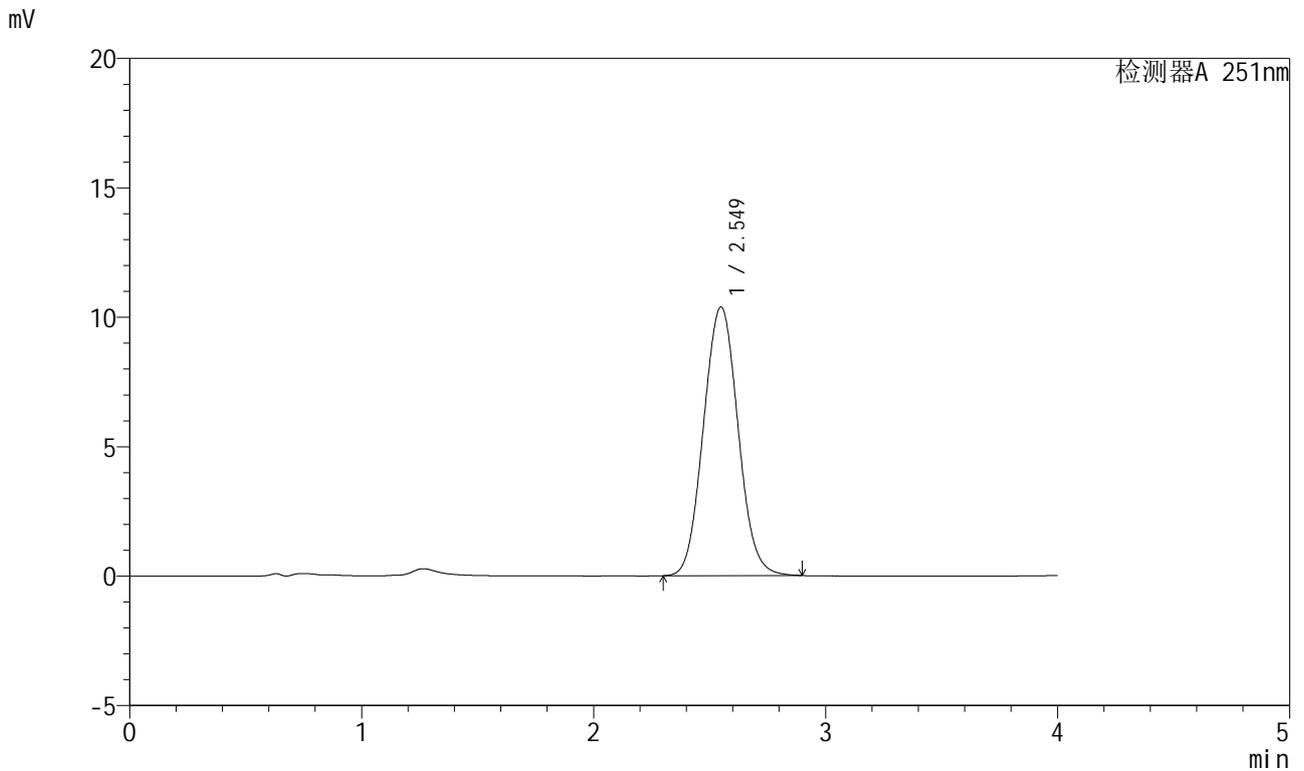

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	107585	100.000	10375	1401	1.058	--
总计		107585	100.000	10375			

图146 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3430-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:03:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

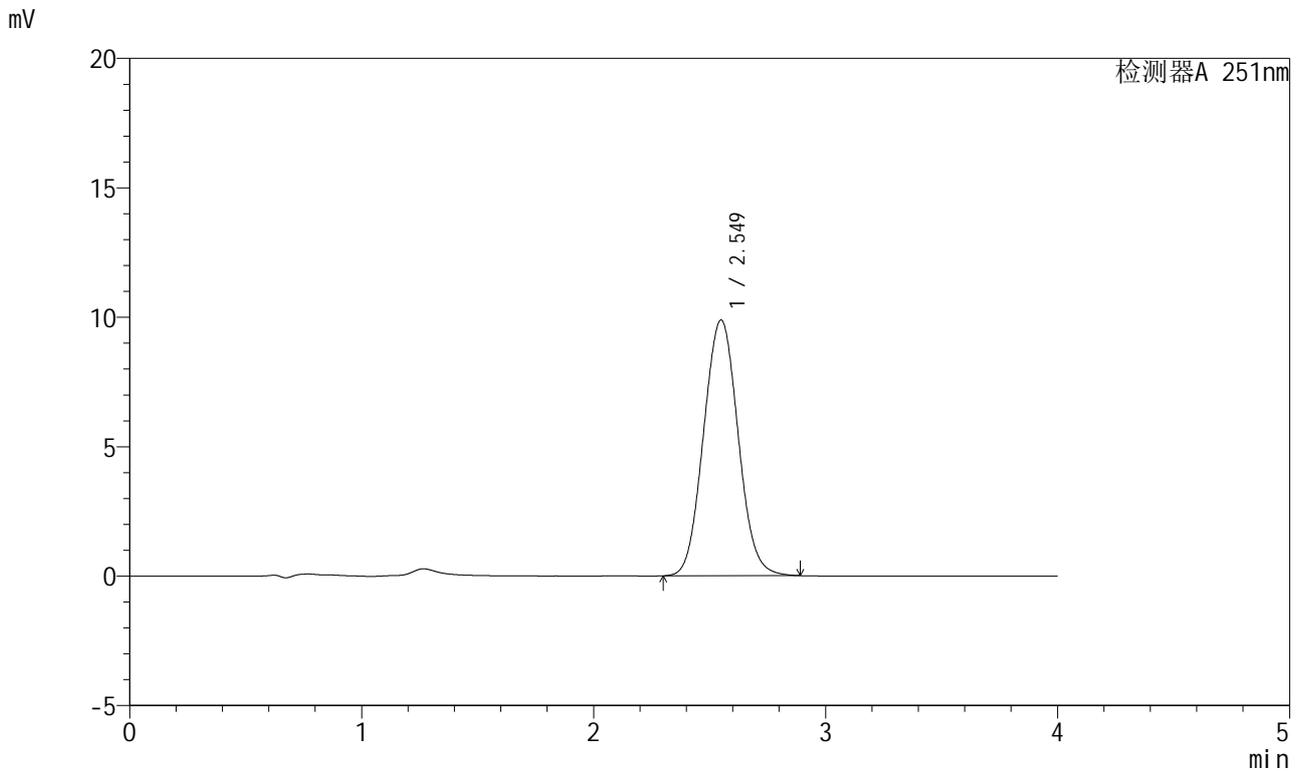

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	102261	100.000	9874	1407	1.056	--
总计		102261	100.000	9874			

图147 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3431-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:07:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

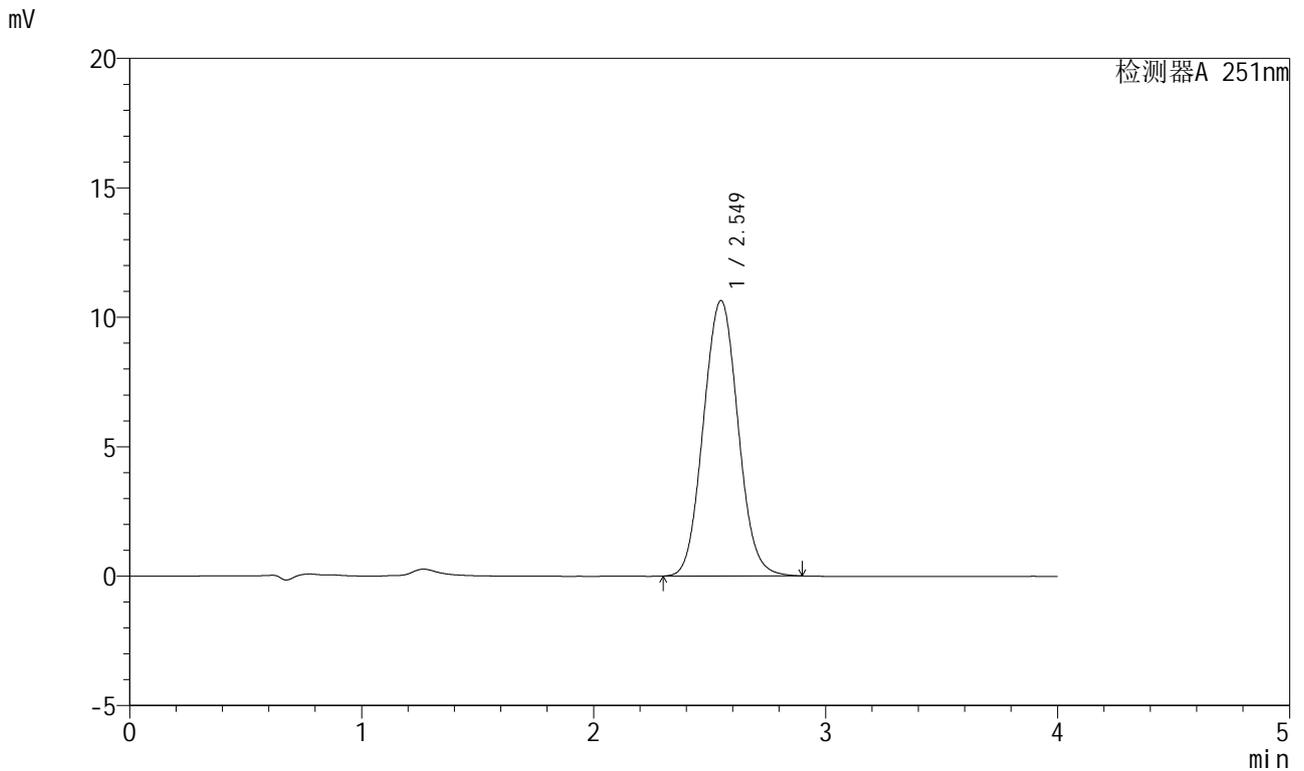

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	110360	100.000	10637	1399	1.058	--
总计		110360	100.000	10637			

图148 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3432-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:11:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

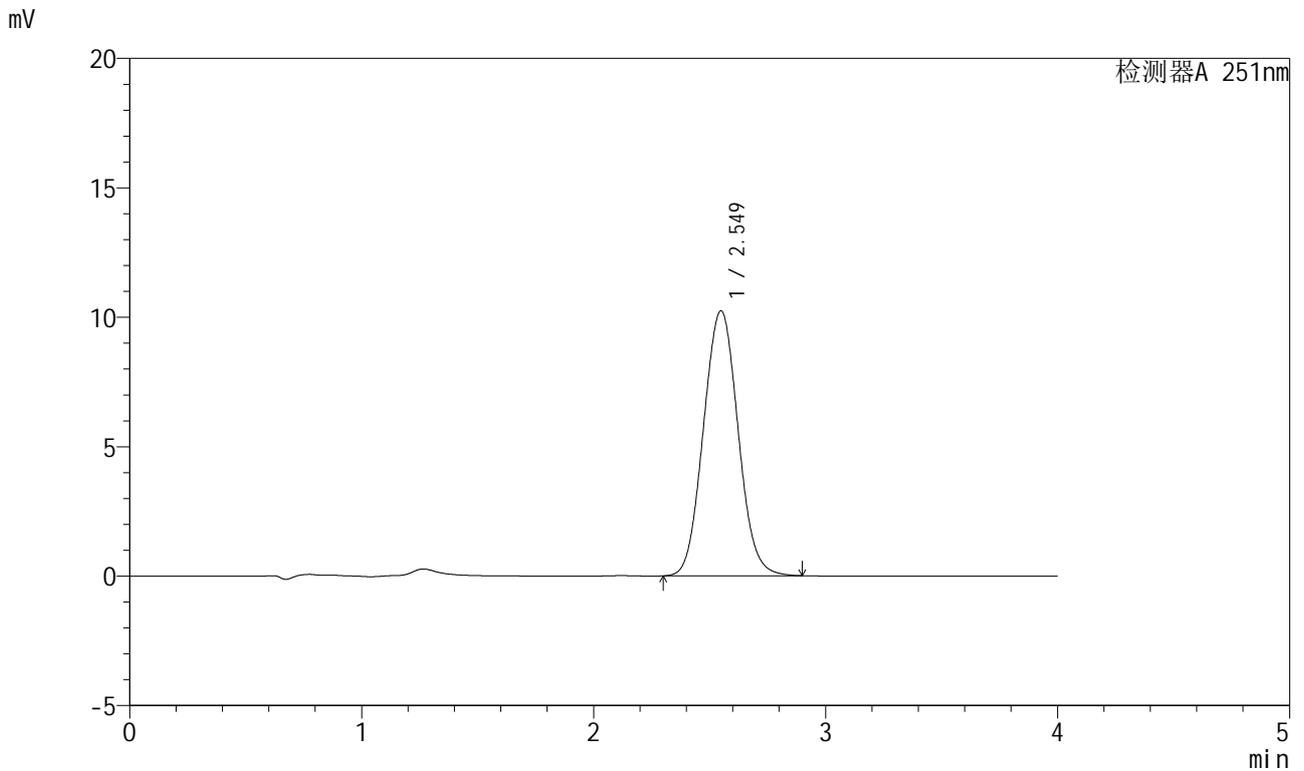

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106205	100.000	10236	1402	1.057	--
总计		106205	100.000	10236			

图149 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3433-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:16:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

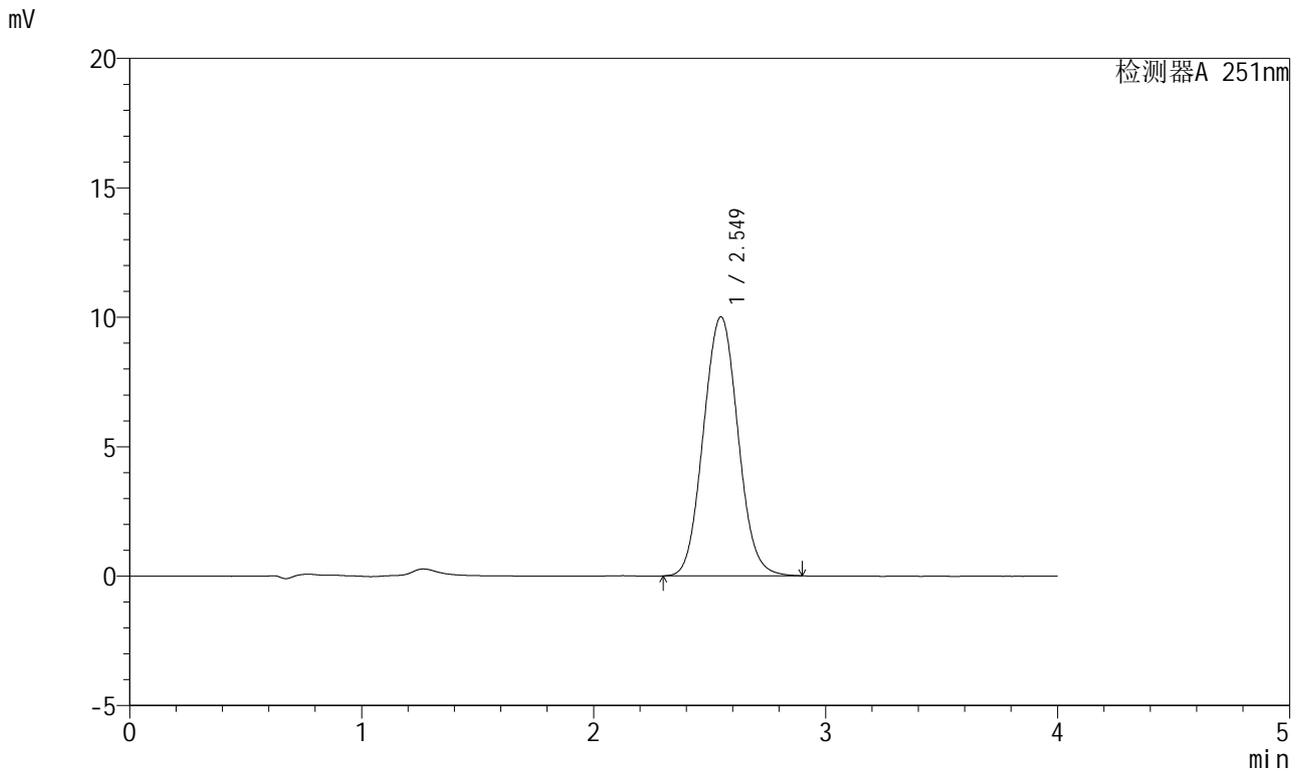

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	103682	100.000	10005	1405	1.058	--
总计		103682	100.000	10005			

图150 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3434-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:20:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

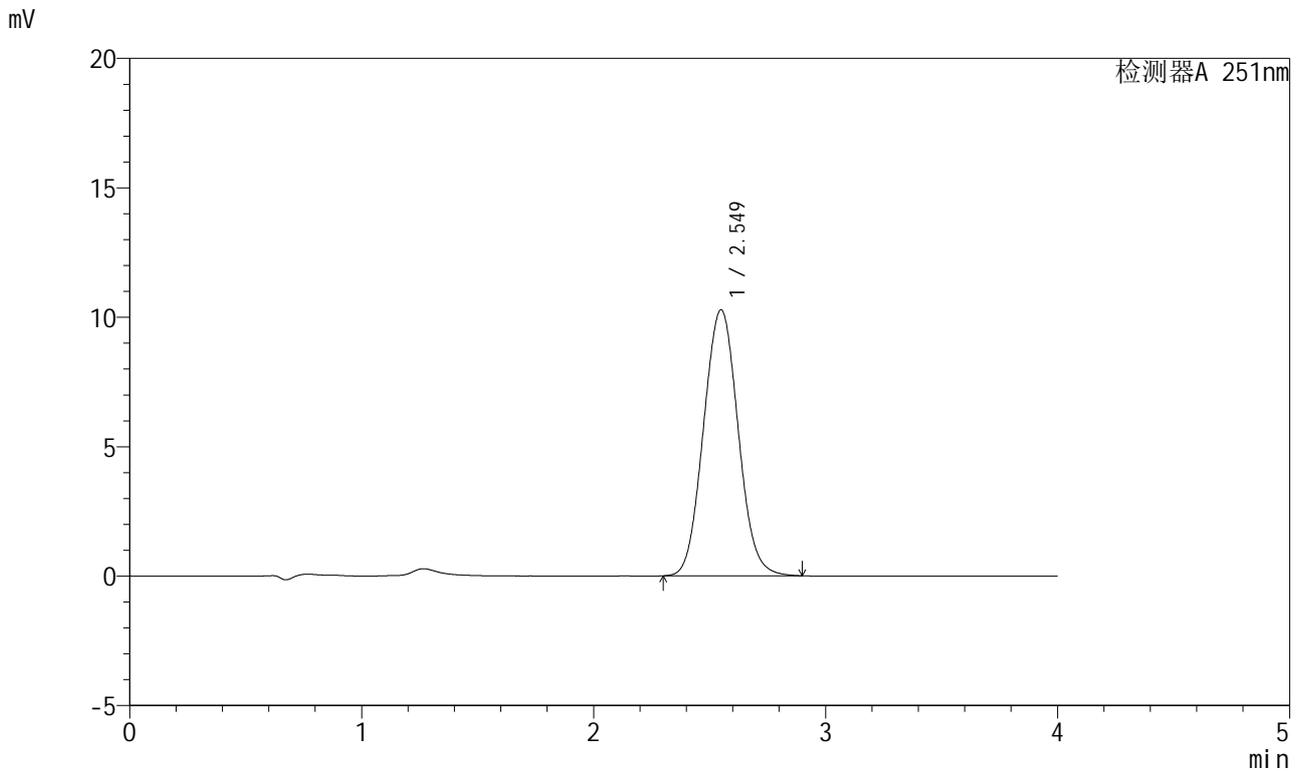

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106617	100.000	10270	1400	1.057	--
总计		106617	100.000	10270			

图151 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3435-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:24:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

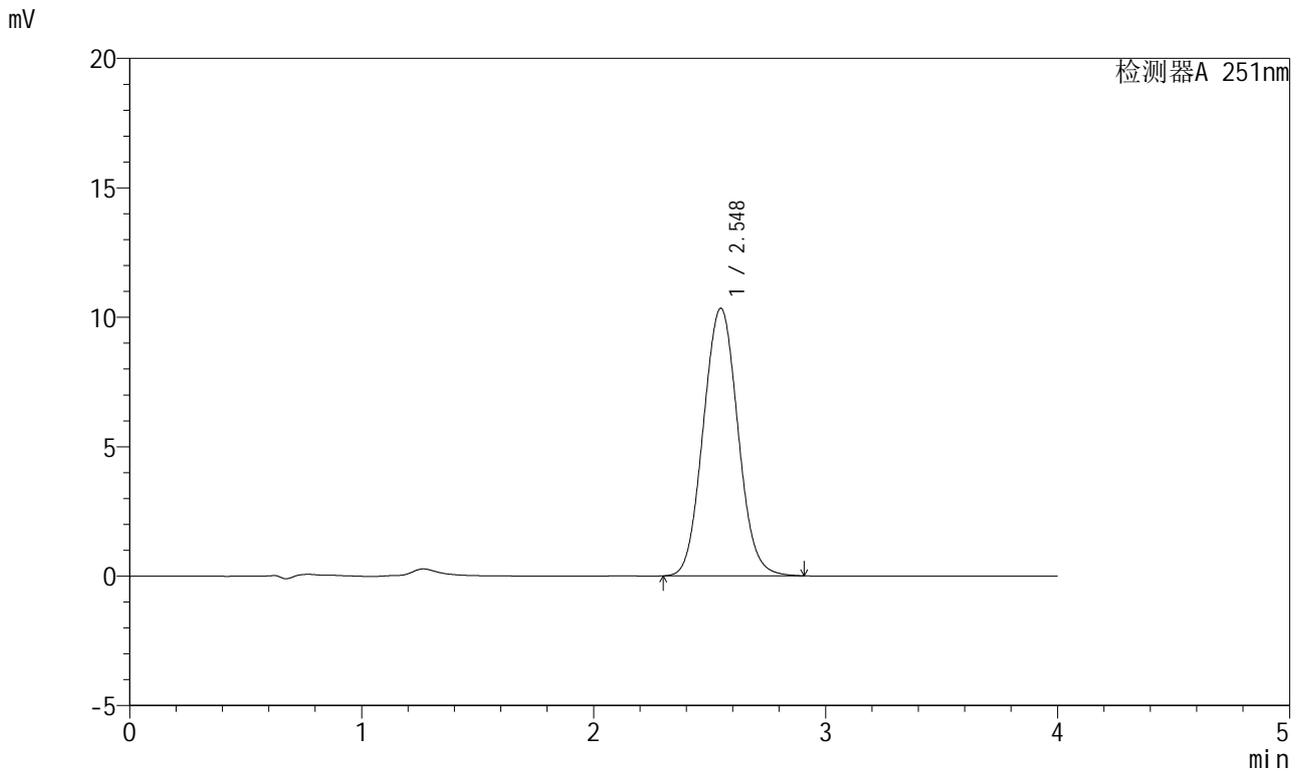

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	107203	100.000	10335	1401	1.059	--
总计		107203	100.000	10335			

图152 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3436-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:29:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

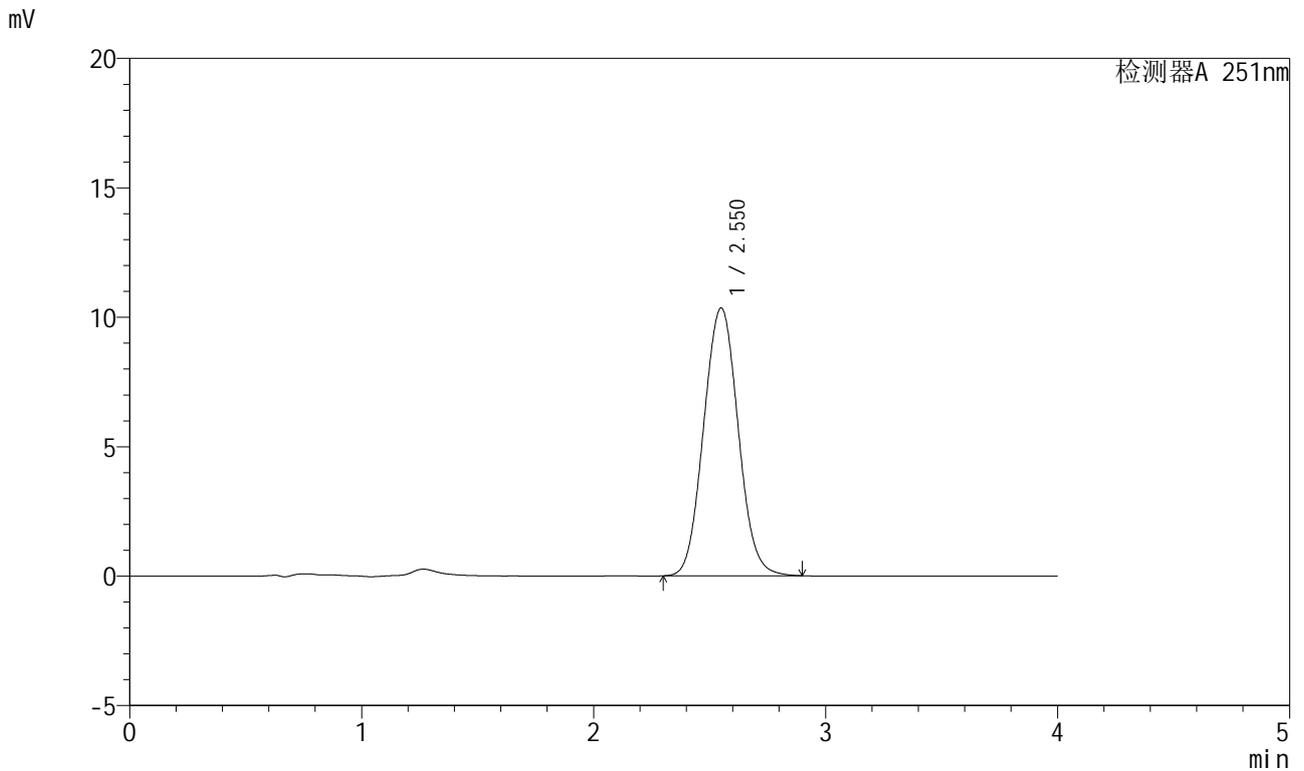

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	106990	100.000	10337	1411	1.056	--
总计		106990	100.000	10337			

图153 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3437-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:33:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

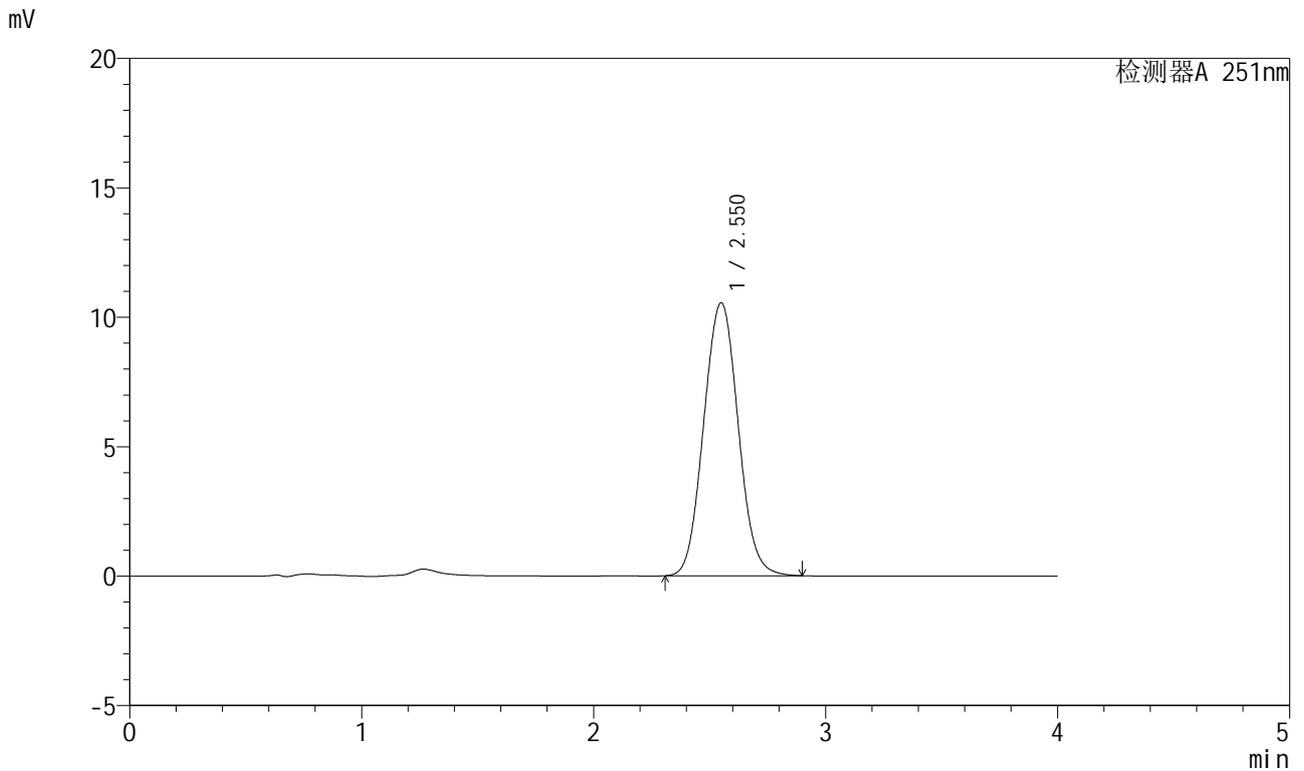

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	108978	100.000	10537	1414	1.057	--
总计		108978	100.000	10537			

图154 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3438-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:38:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

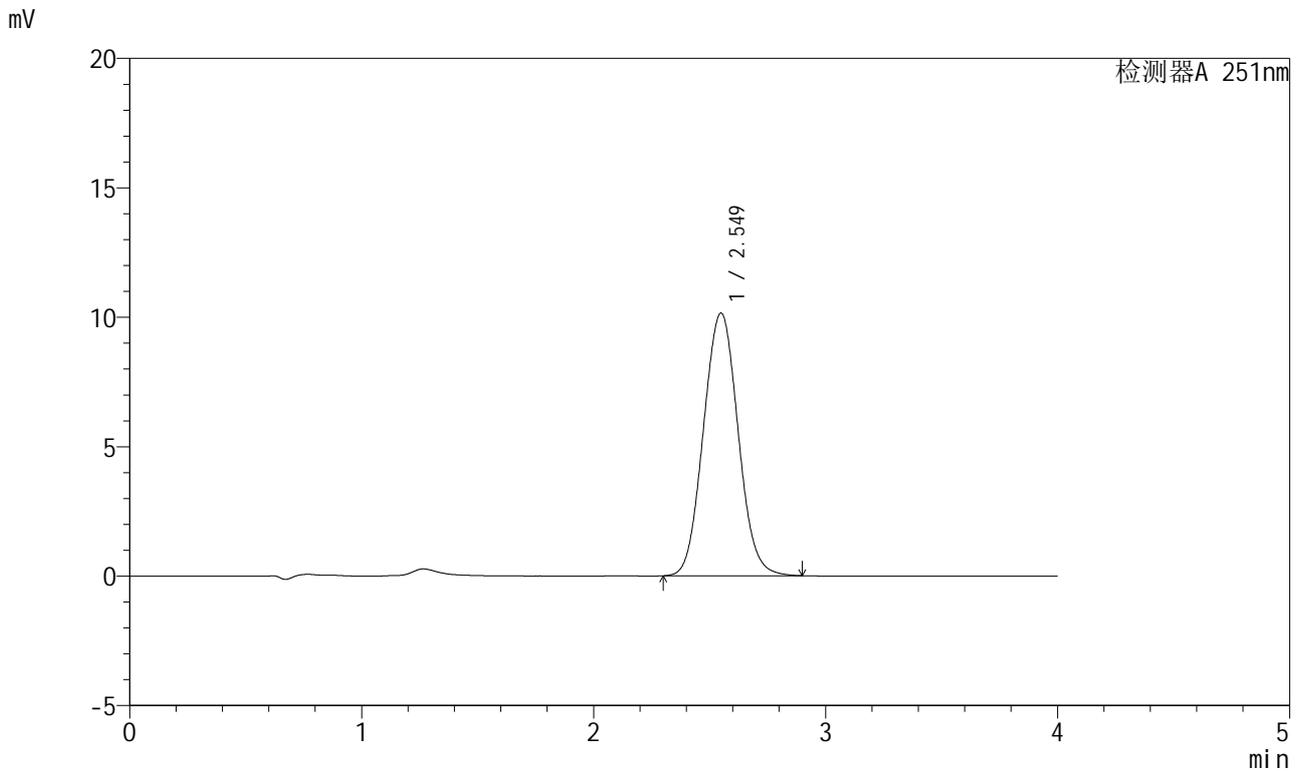

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105313	100.000	10143	1398	1.058	--
总计		105313	100.000	10143			

图155 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3439-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:42:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

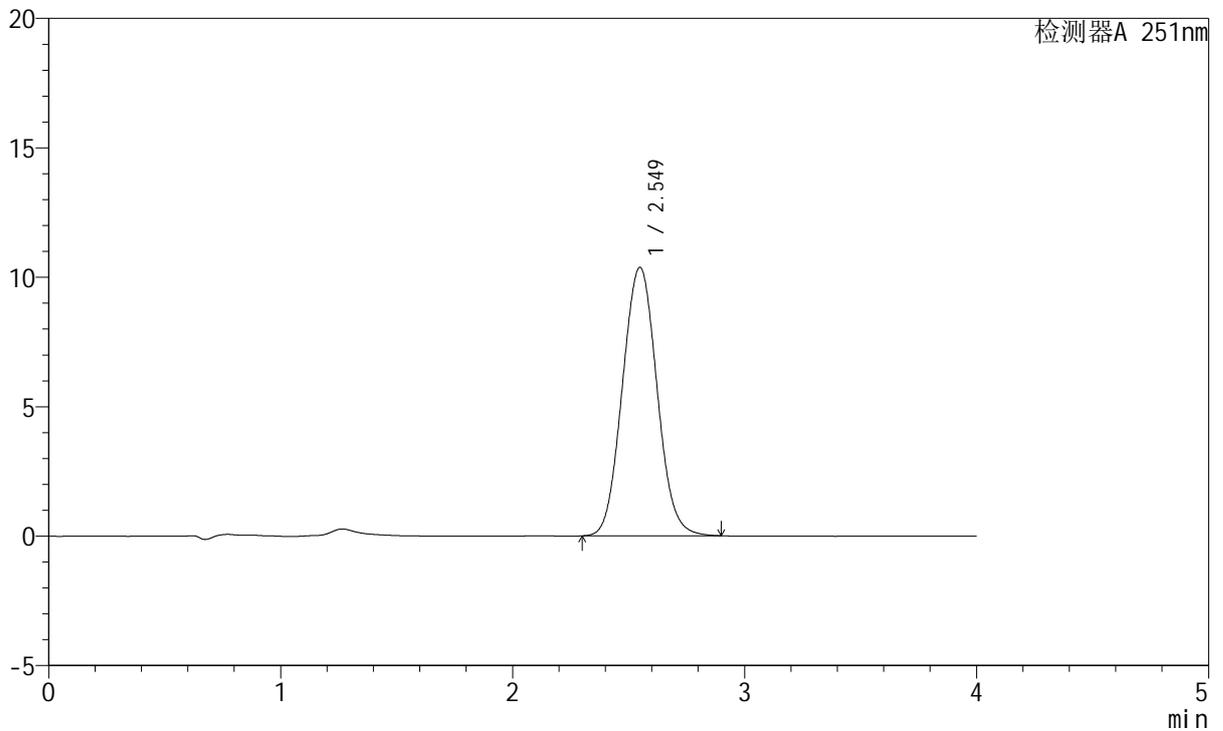

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	107505	100.000	10370	1403	1.057	--
总计		107505	100.000	10370			

图156 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3440-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:46:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

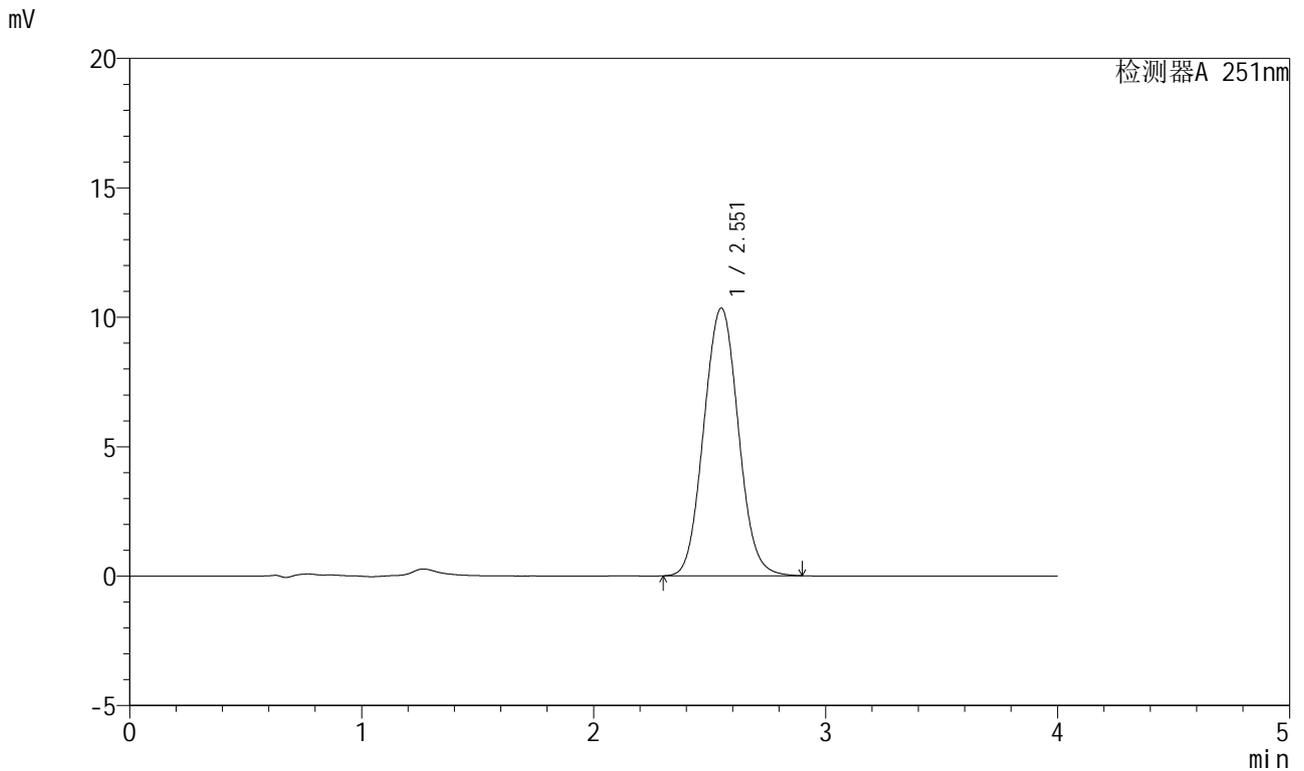

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	106984	100.000	10328	1411	1.057	--
总计		106984	100.000	10328			

图157 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3441-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:51:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

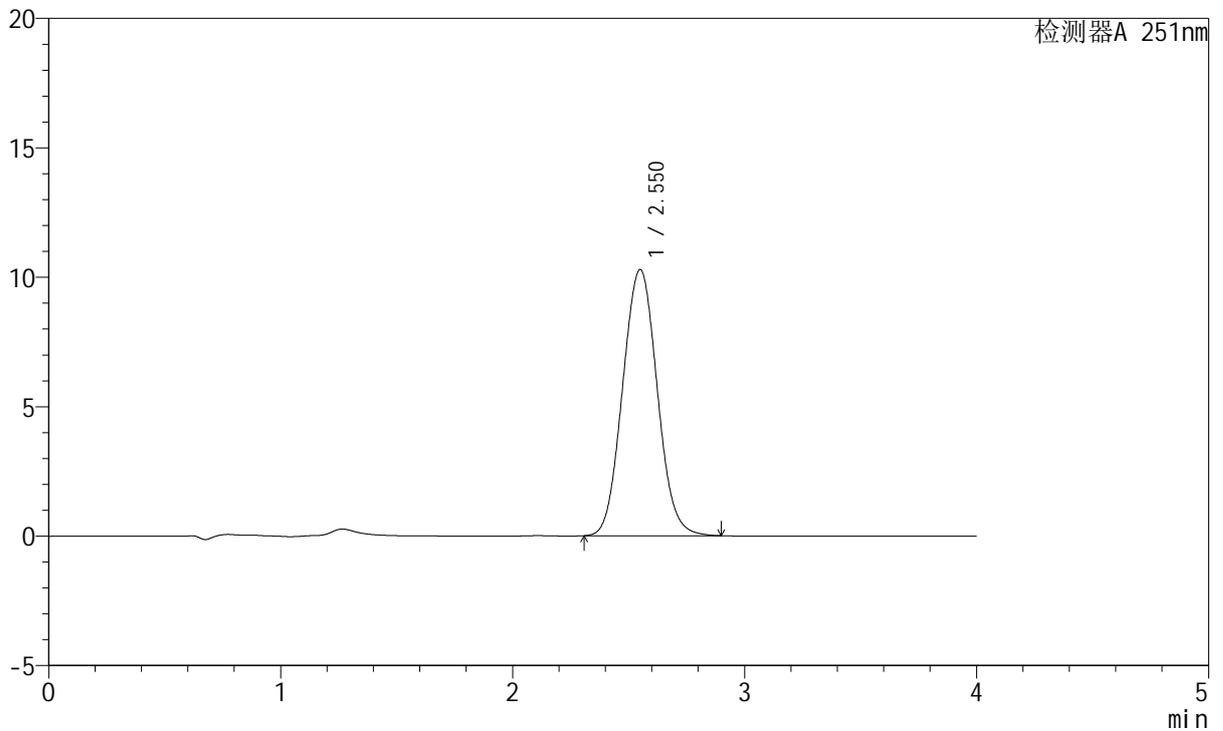

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	106563	100.000	10273	1403	1.058	--
总计		106563	100.000	10273			

图158 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3443-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 21:59:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

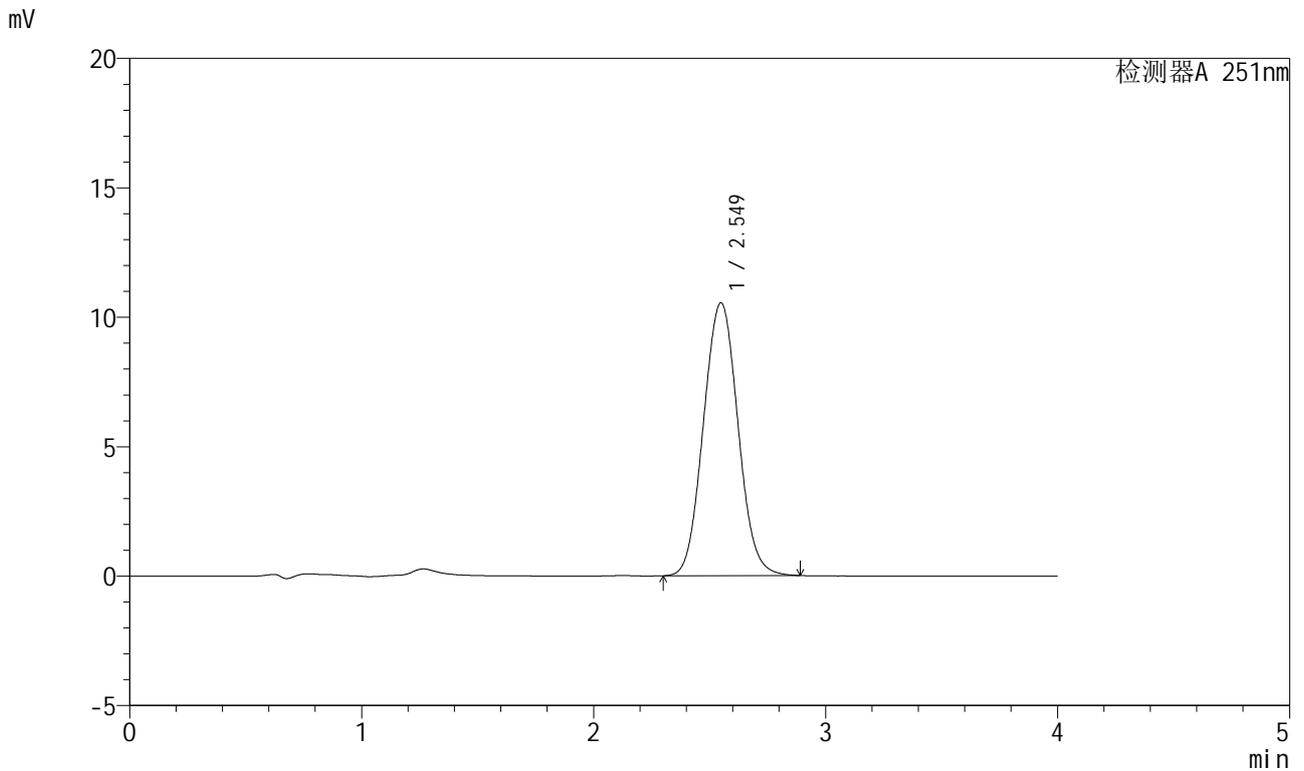

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	109257	100.000	10542	1402	1.057	--
总计		109257	100.000	10542			

图160 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3444-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:04:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

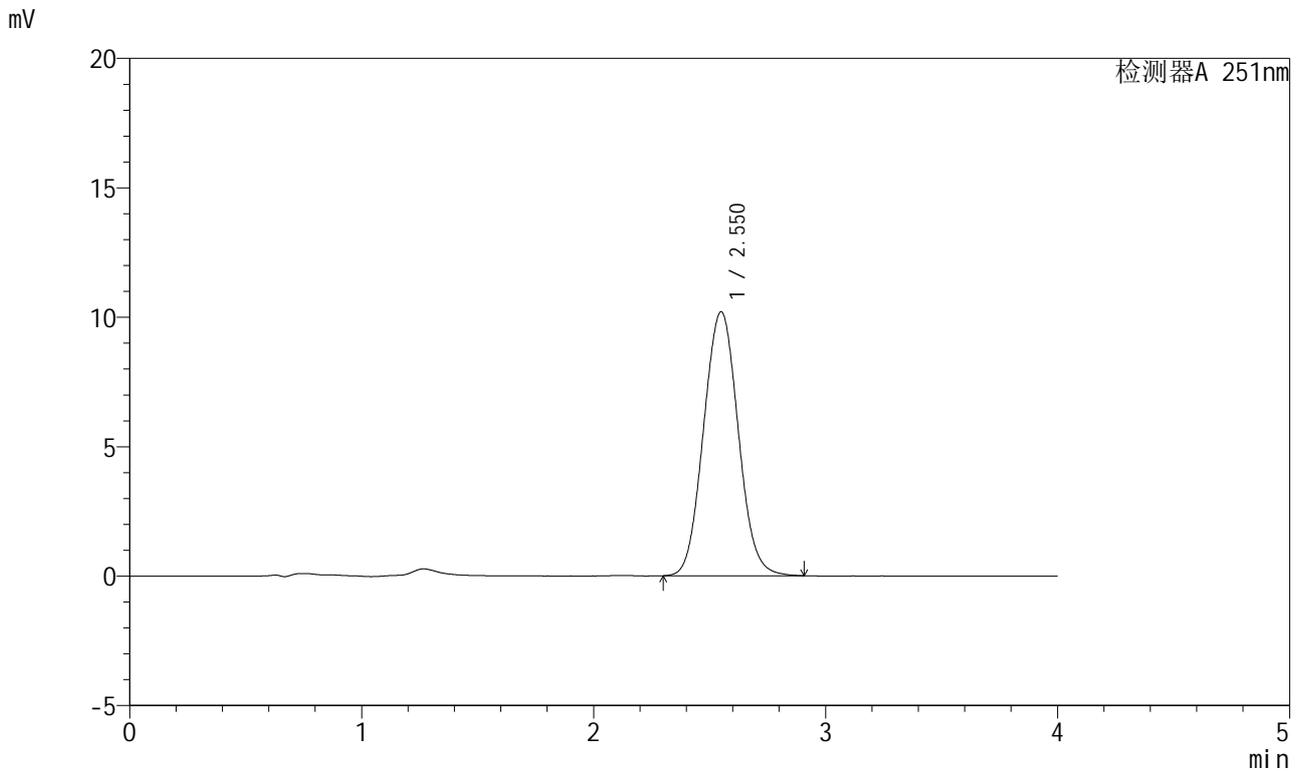

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	105782	100.000	10187	1402	1.057	--
总计		105782	100.000	10187			

图161 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3445-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:08:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

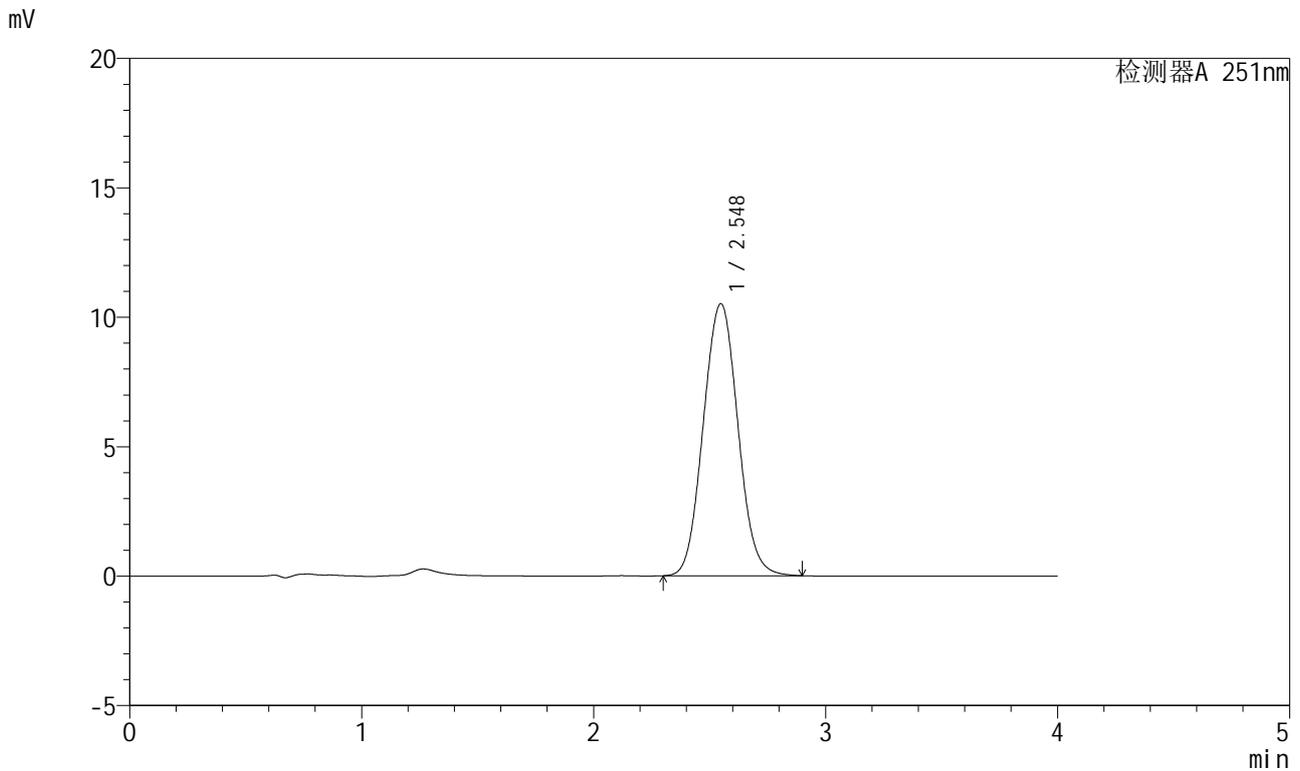

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	109111	100.000	10509	1396	1.058	--
总计		109111	100.000	10509			

图162 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3446-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:13:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

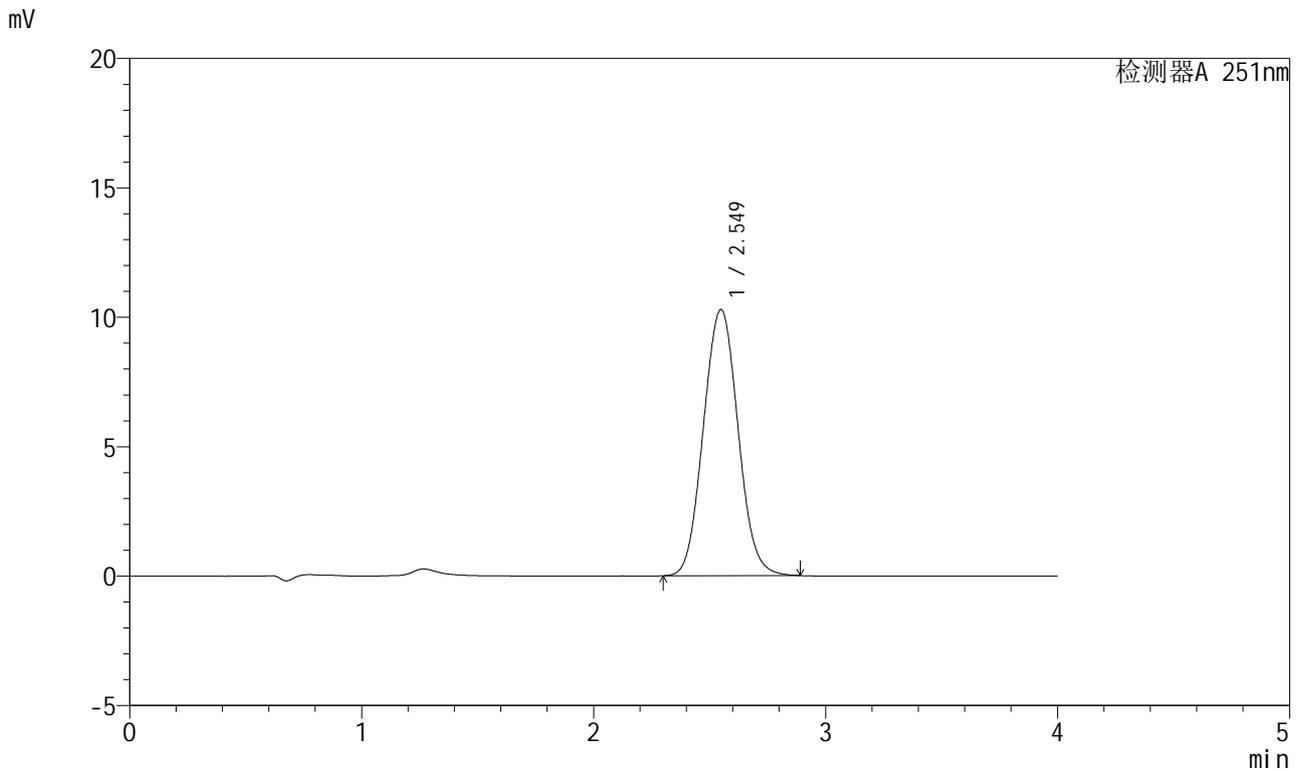

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106768	100.000	10281	1397	1.057	--
总计		106768	100.000	10281			

图163 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3447-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:17:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

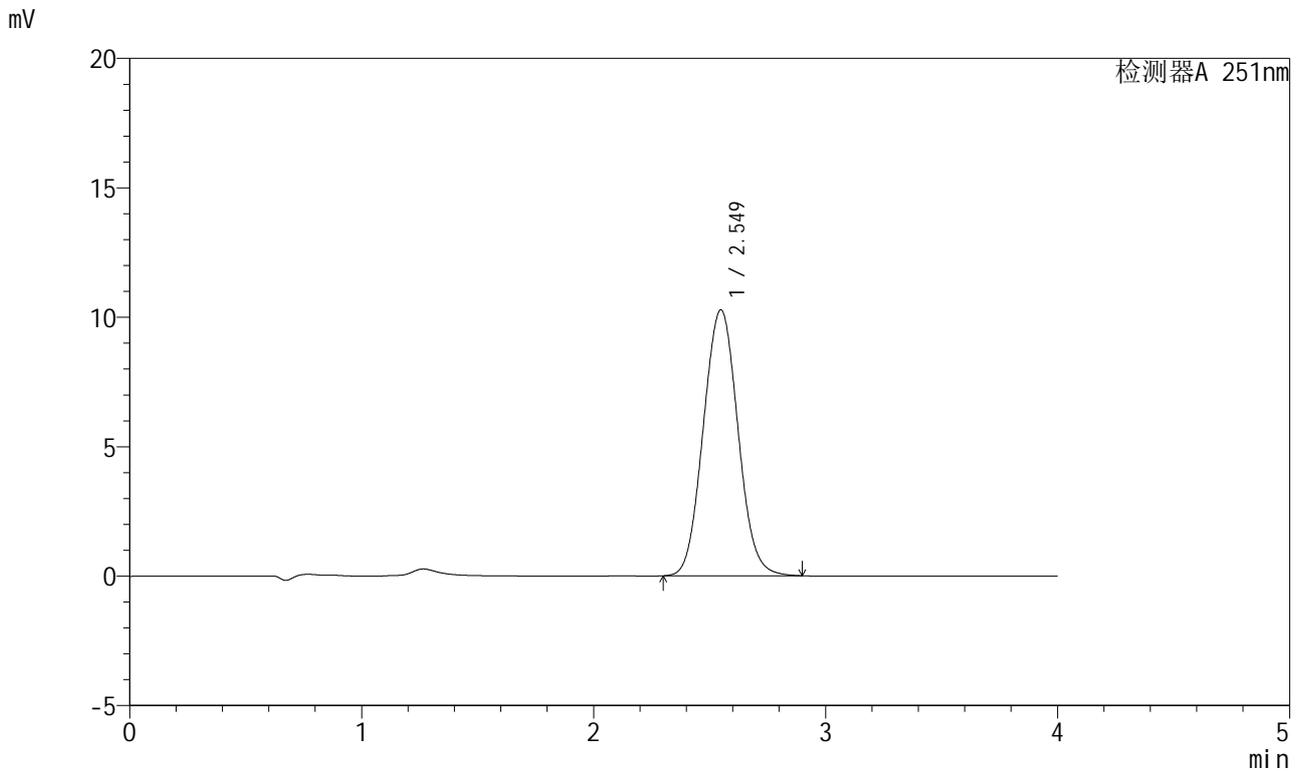

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	106649	100.000	10271	1398	1.056	--
总计		106649	100.000	10271			

图164 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3448-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:21:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

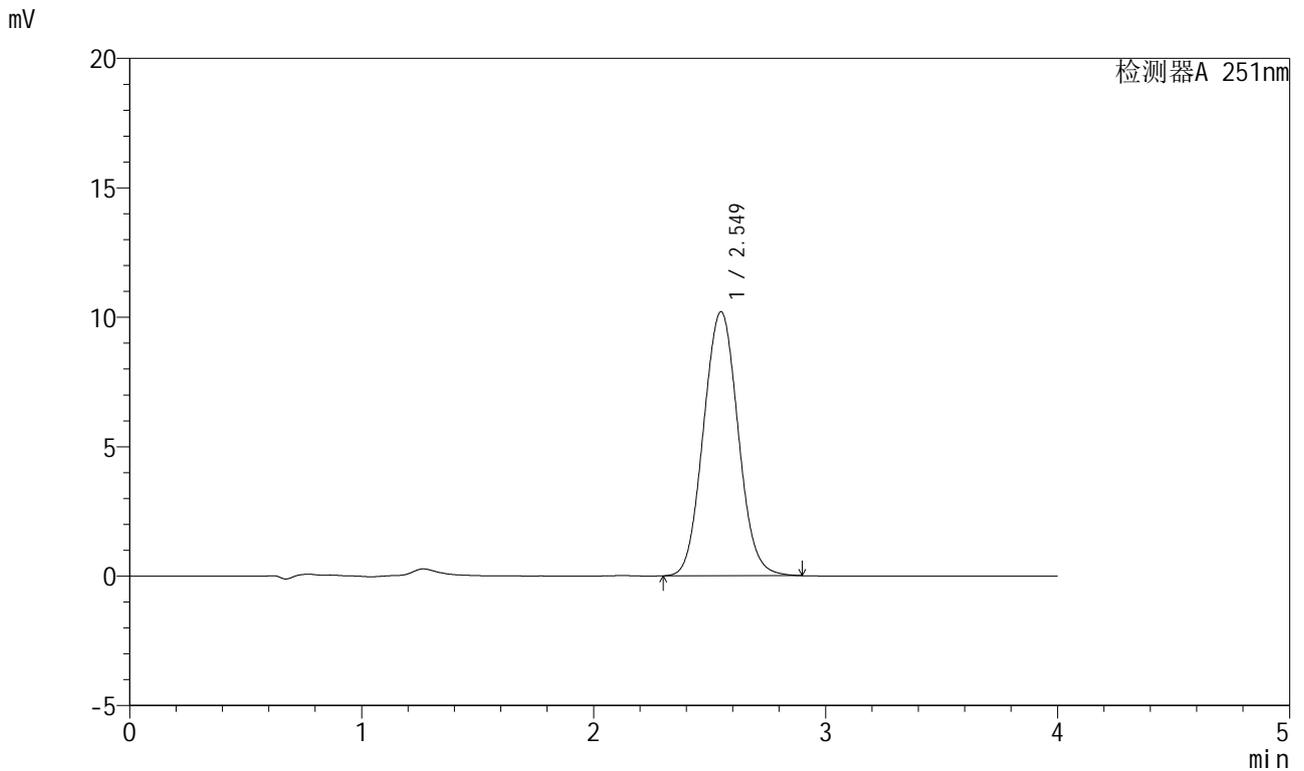

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105791	100.000	10196	1402	1.057	--
总计		105791	100.000	10196			

图165 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3449-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:26:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

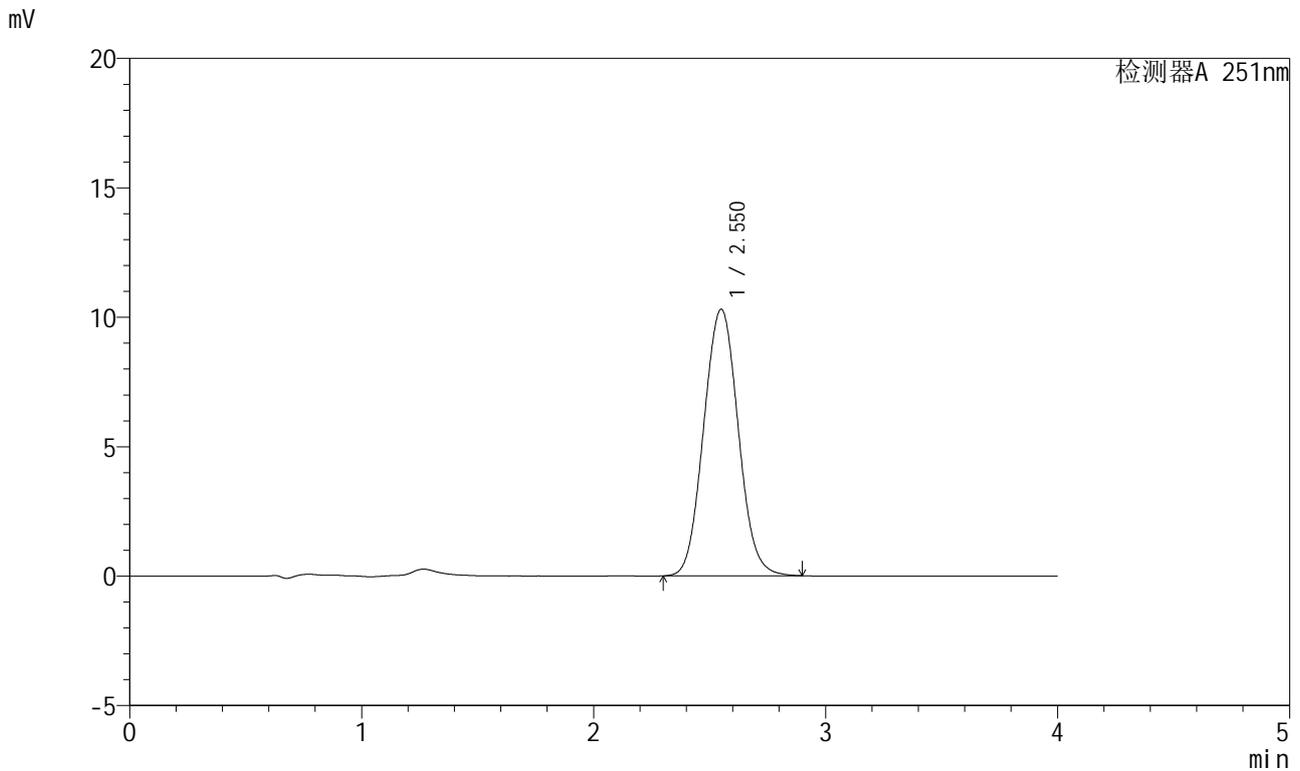

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	106635	100.000	10289	1408	1.057	--
总计		106635	100.000	10289			

图166 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3450-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:30:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

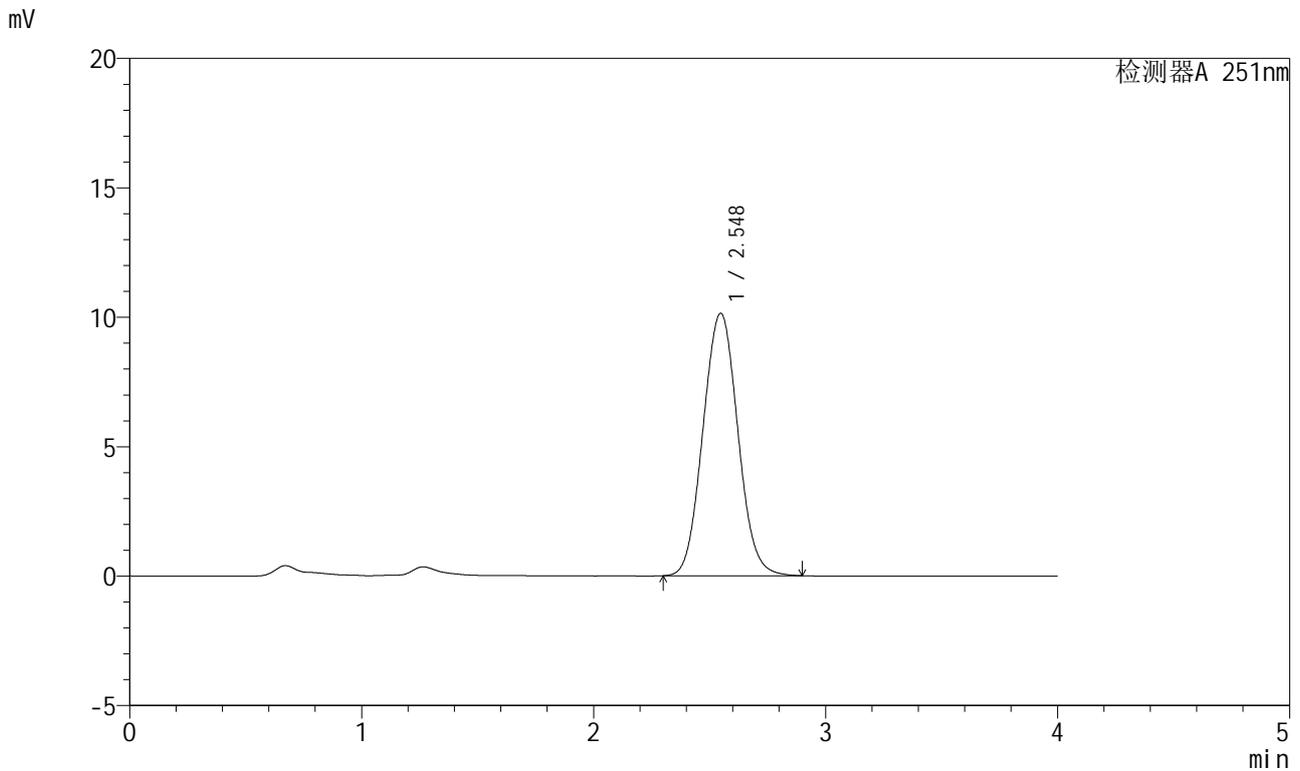

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	105950	100.000	10138	1373	1.057	--
总计		105950	100.000	10138			

图167 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3451-2 - zzp-2023111921p-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:34:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

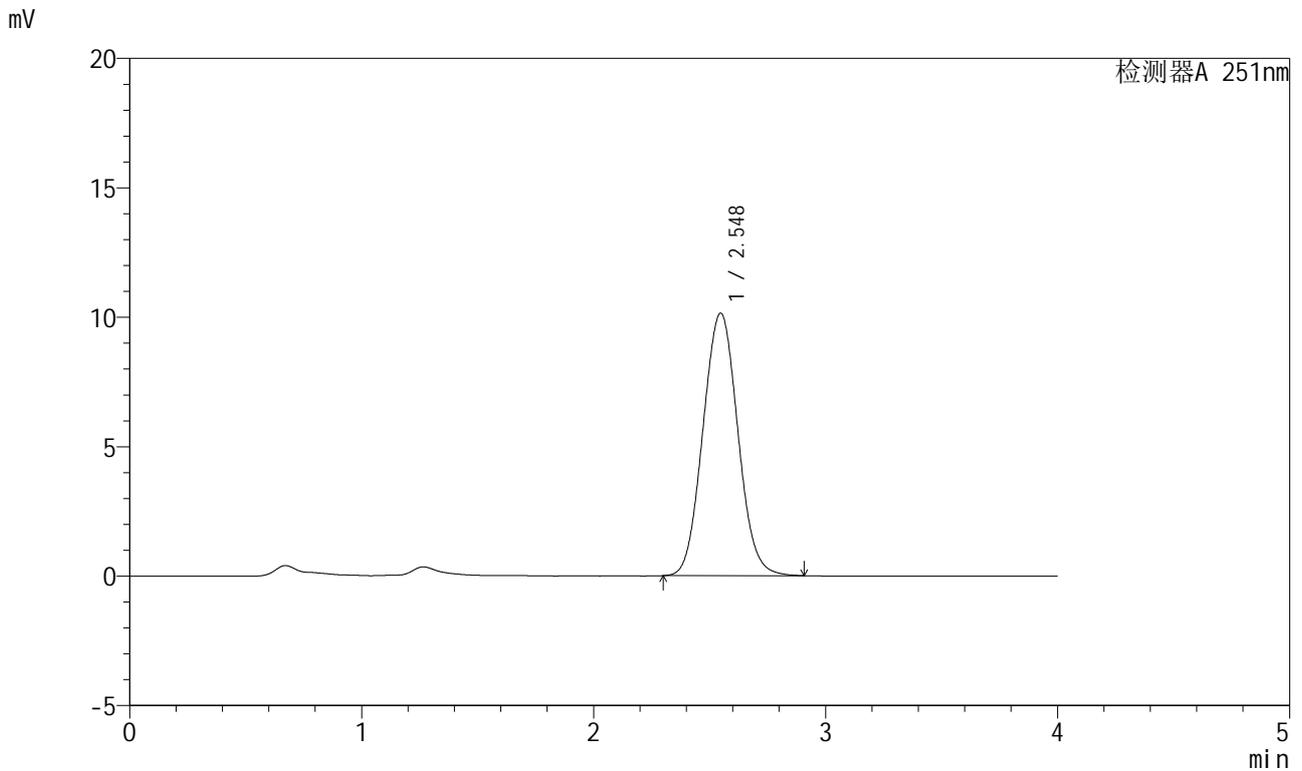

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	106005	100.000	10144	1374	1.058	--
总计		106005	100.000	10144			

图168 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3452-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:39:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

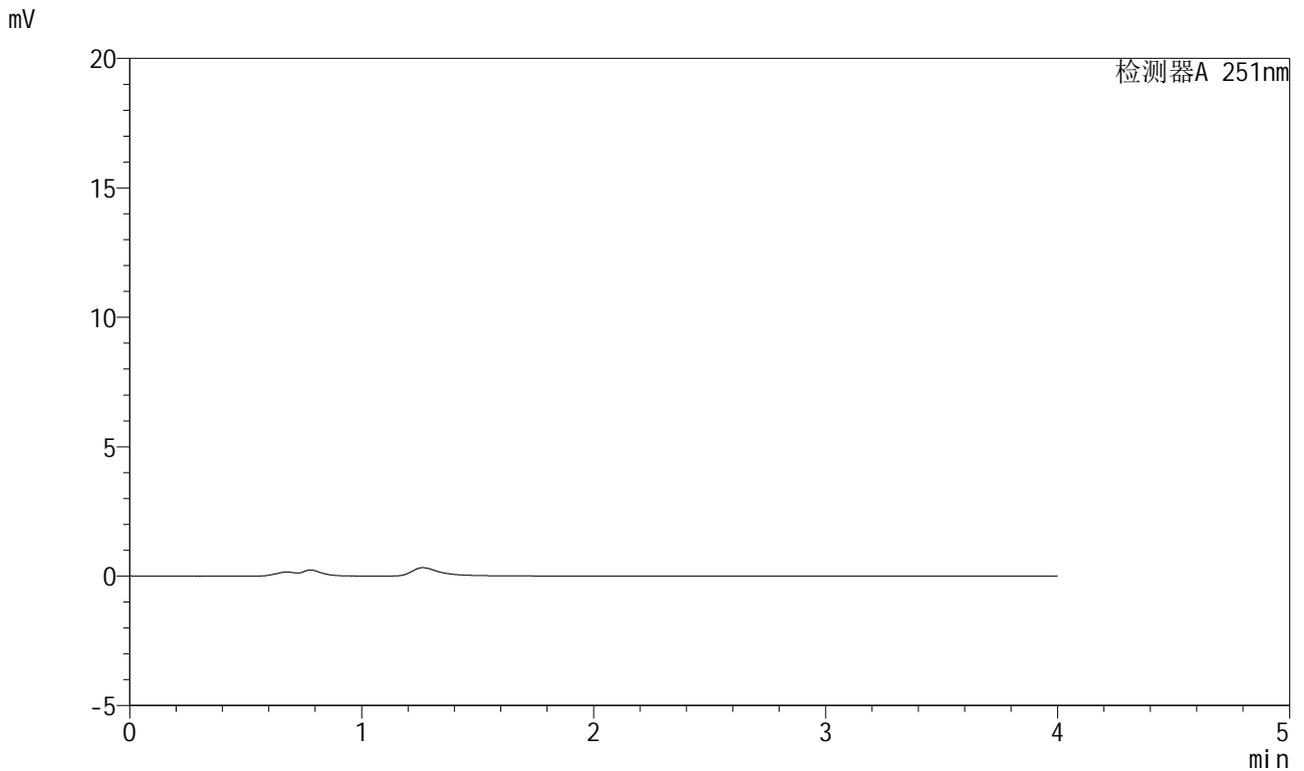

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质-浆法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3453-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:43:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:34:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

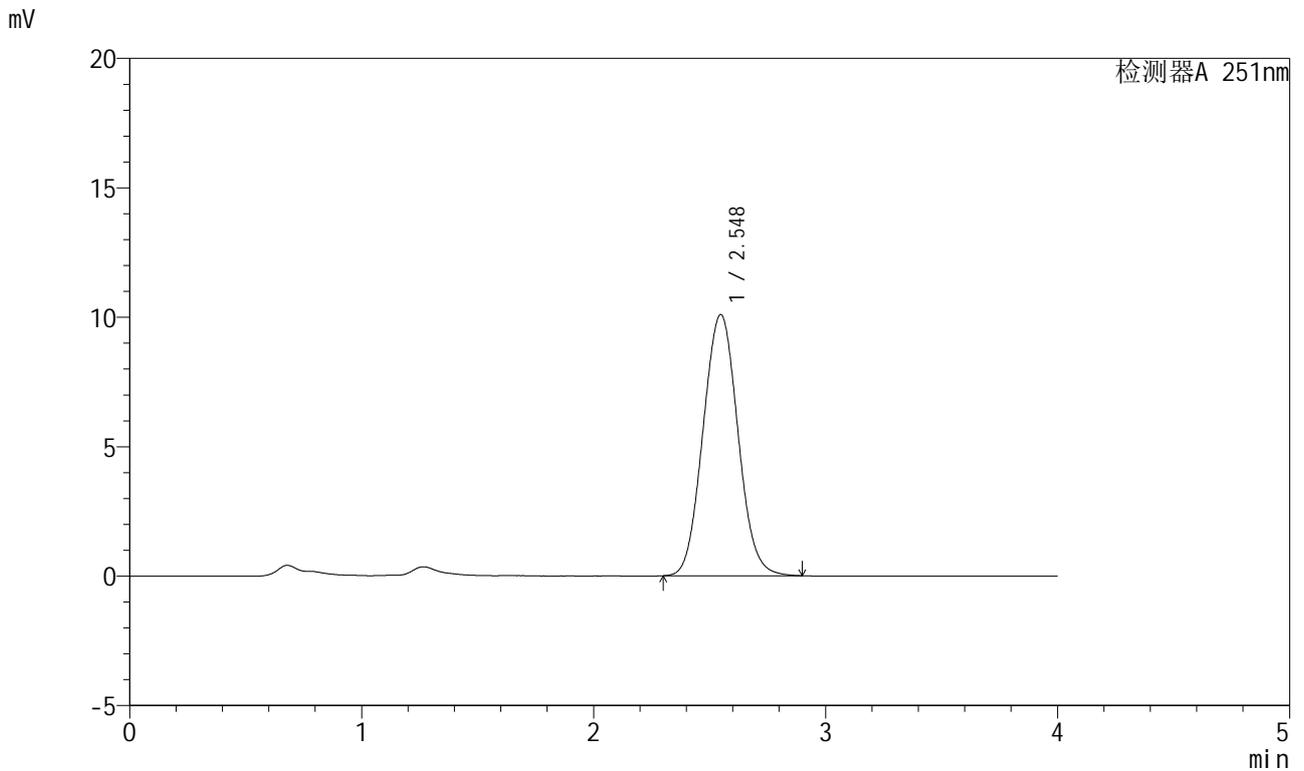

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	105471	100.000	10090	1375	1.057	--
总计		105471	100.000	10090			

图170 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3454-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:48:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

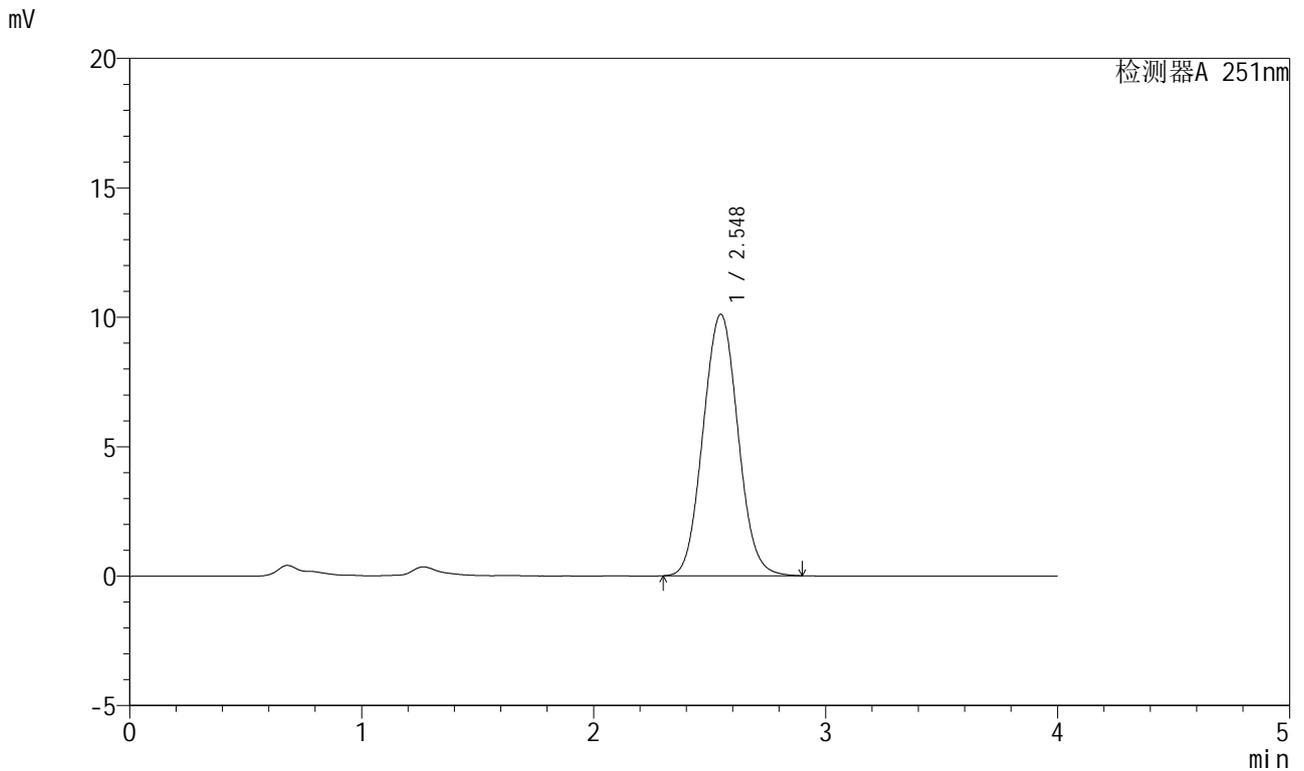

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	105555	100.000	10100	1372	1.056	--
总计		105555	100.000	10100			

图171 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3455-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:52:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

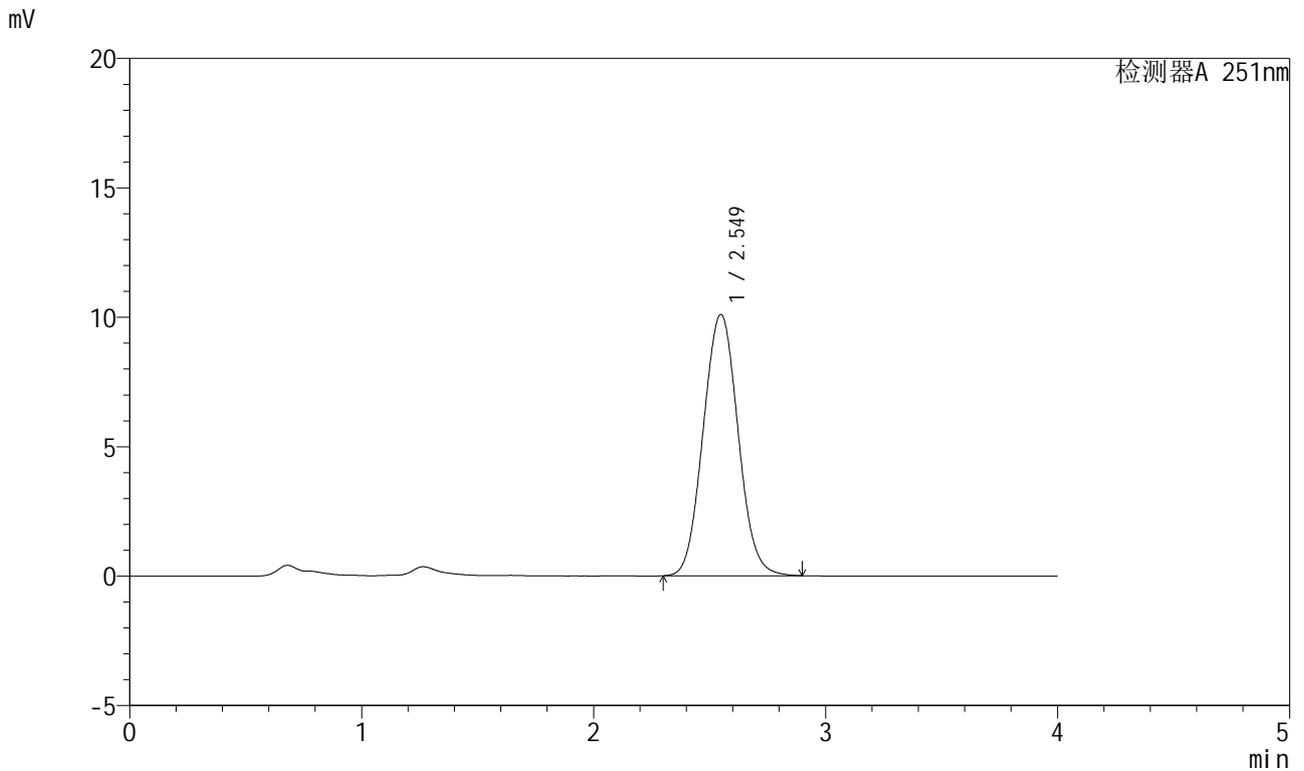

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	105531	100.000	10094	1376	1.056	--
总计		105531	100.000	10094			

图172 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3456-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 22:56:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

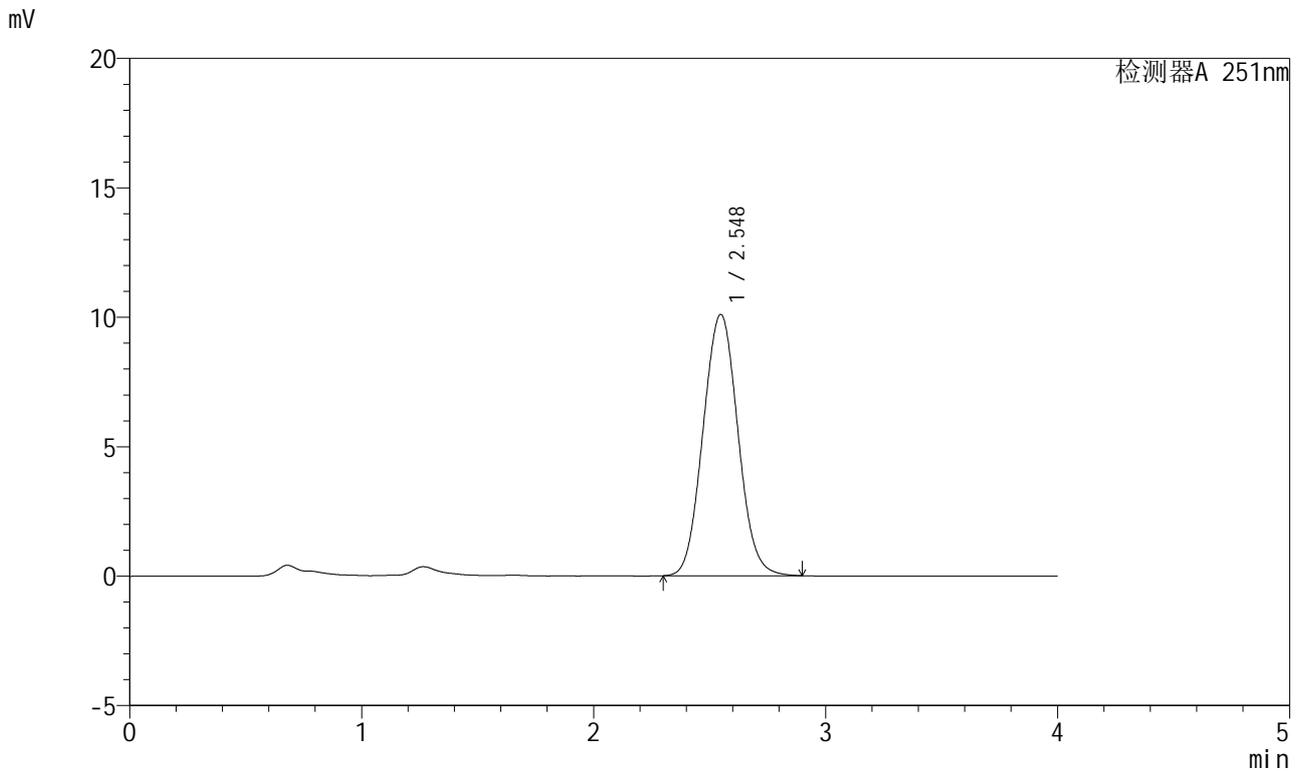

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	105490	100.000	10094	1372	1.056	--
总计		105490	100.000	10094			

图173 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3457-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:01:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

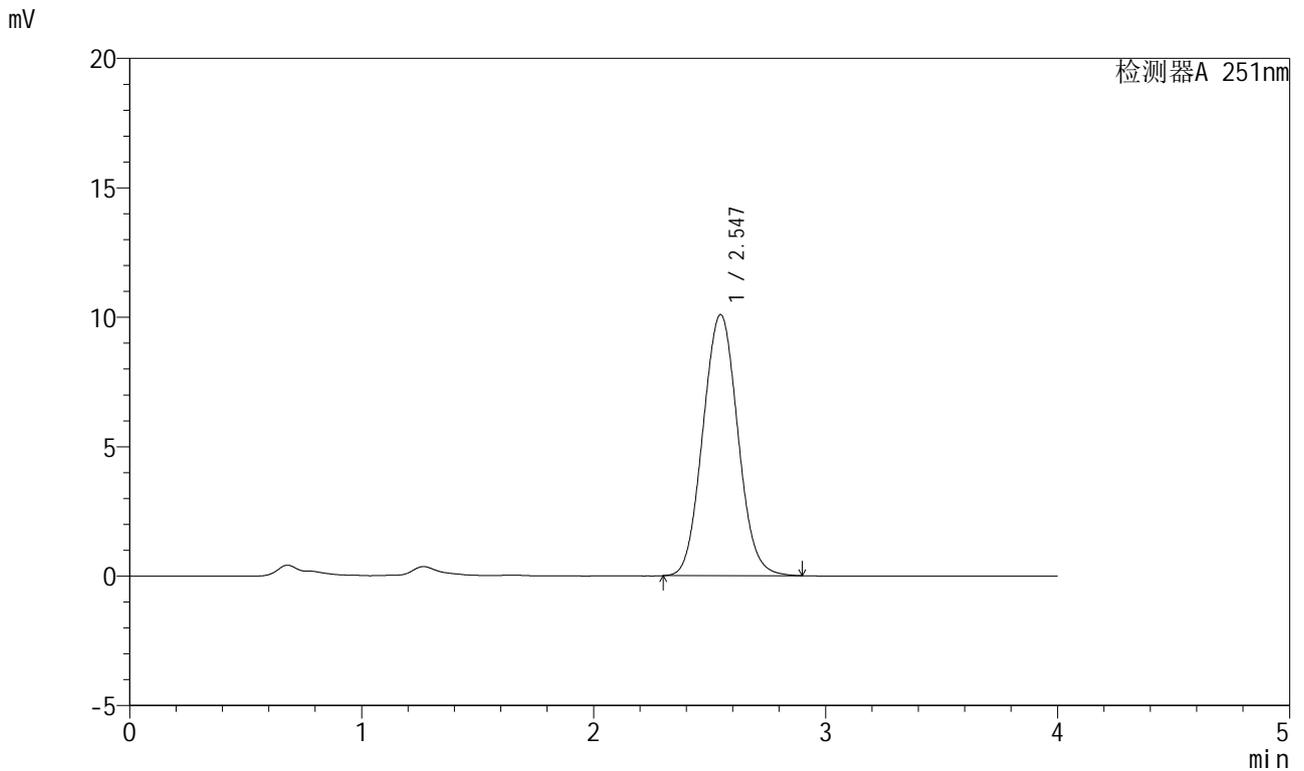

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.547	105457	100.000	10089	1372	1.058	--
总计		105457	100.000	10089			

图174 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3458-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:05:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

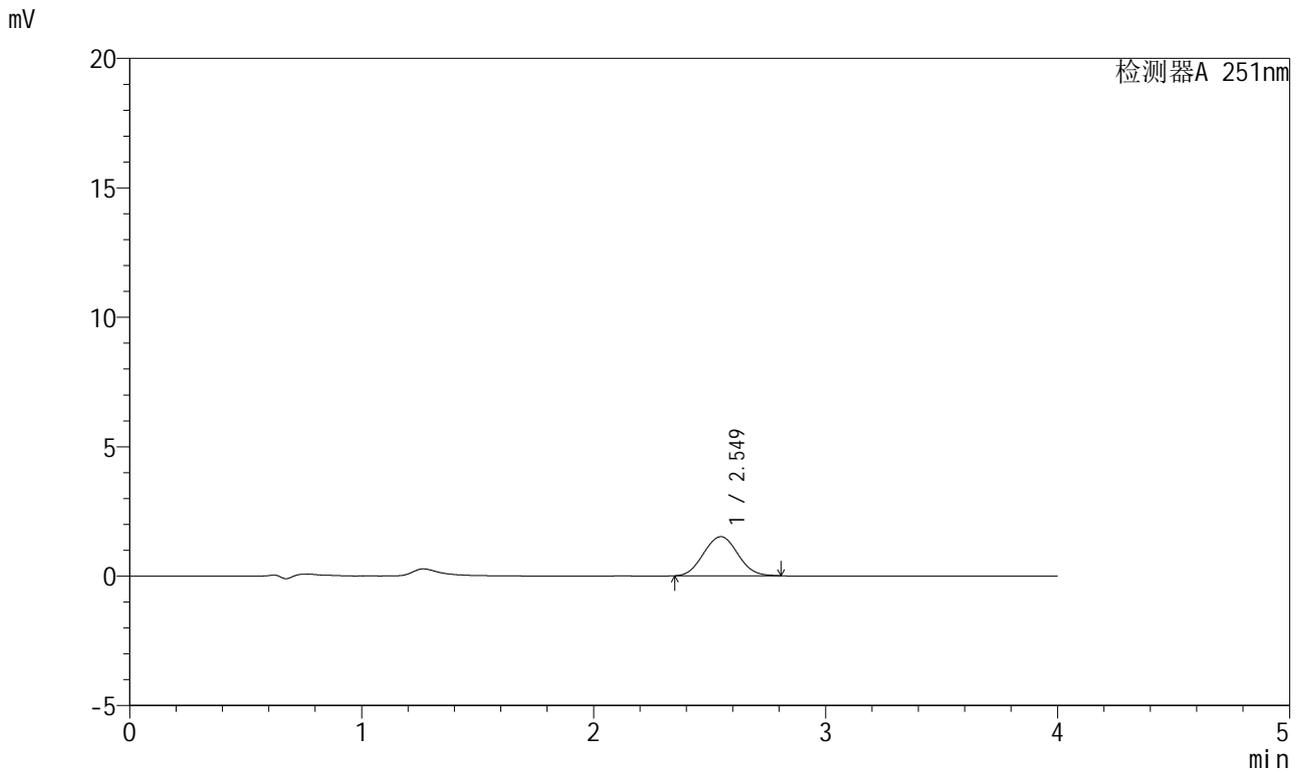

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	15513	100.000	1511	1406	1.049	--
总计		15513	100.000	1511			

图175 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3459-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:10:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

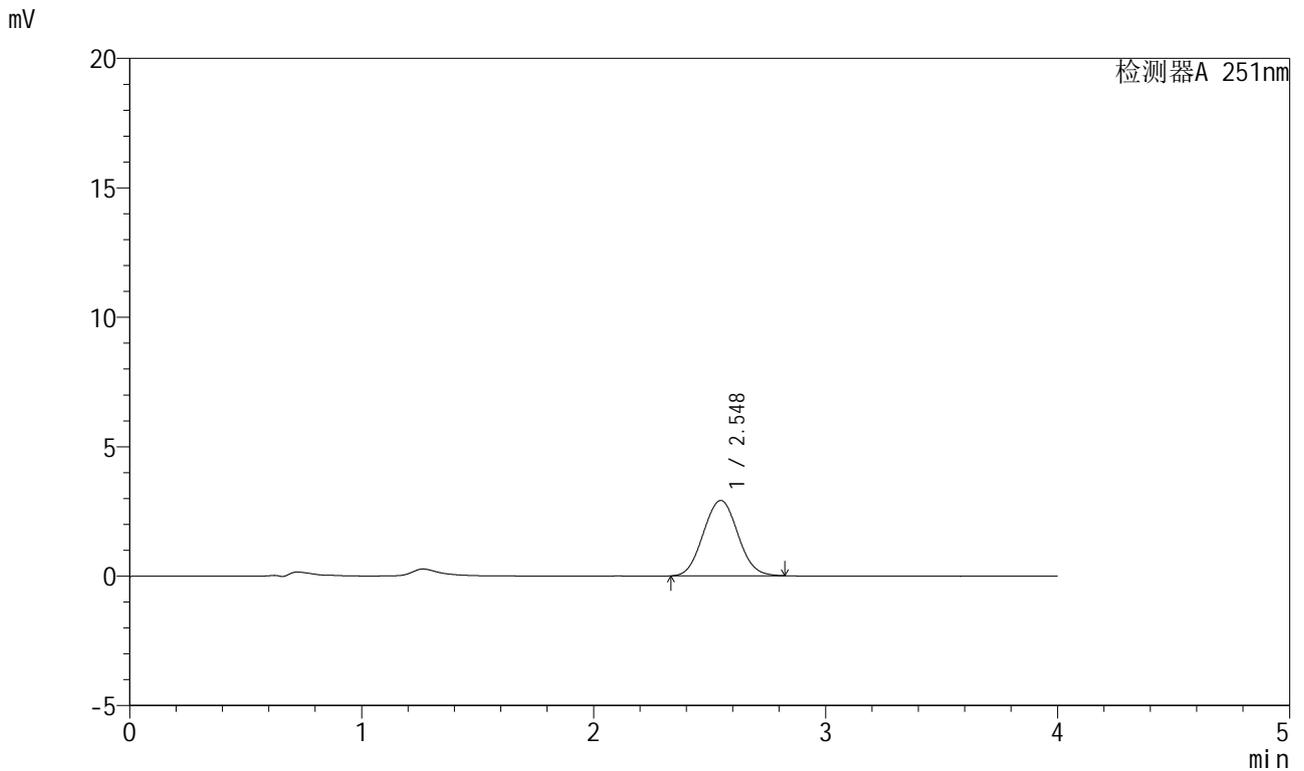

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	30058	100.000	2912	1401	1.048	--
总计		30058	100.000	2912			

图176 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3460-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:14:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

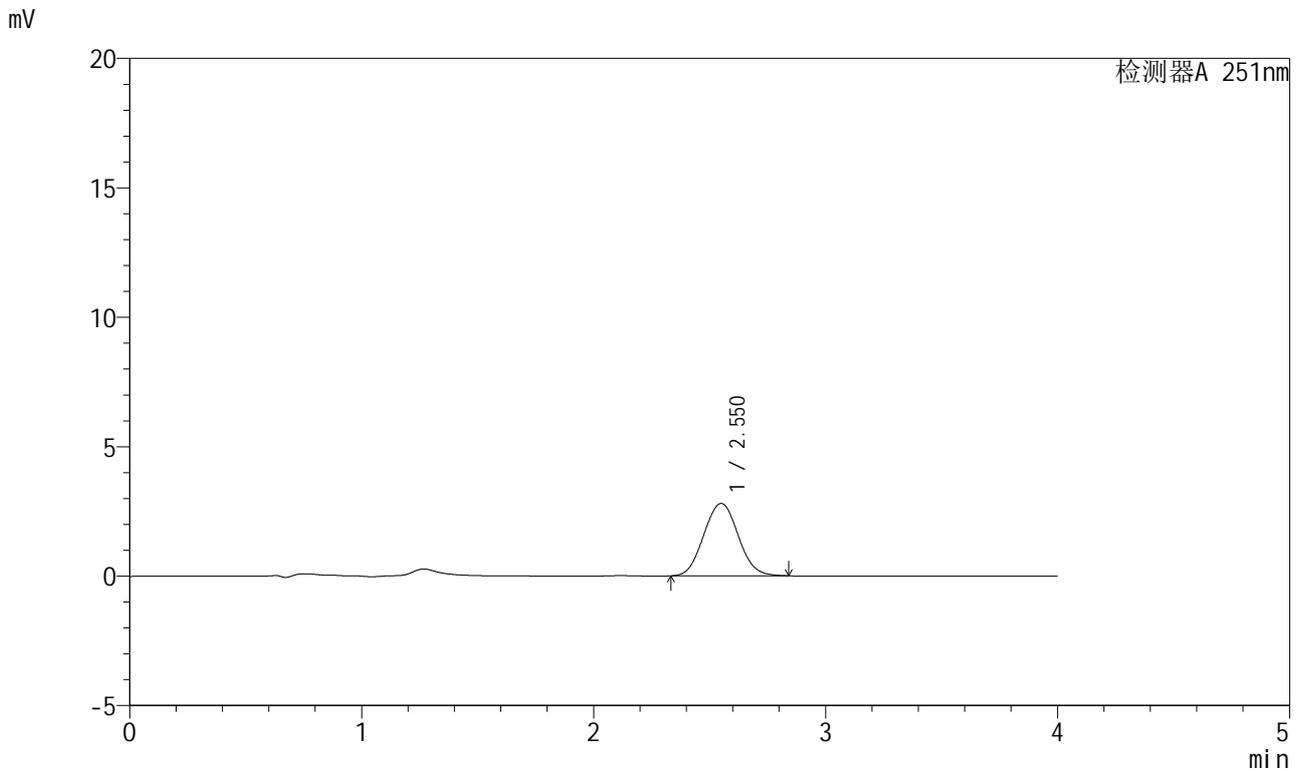

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	28934	100.000	2796	1403	1.054	--
总计		28934	100.000	2796			

图177 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3461-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:18:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

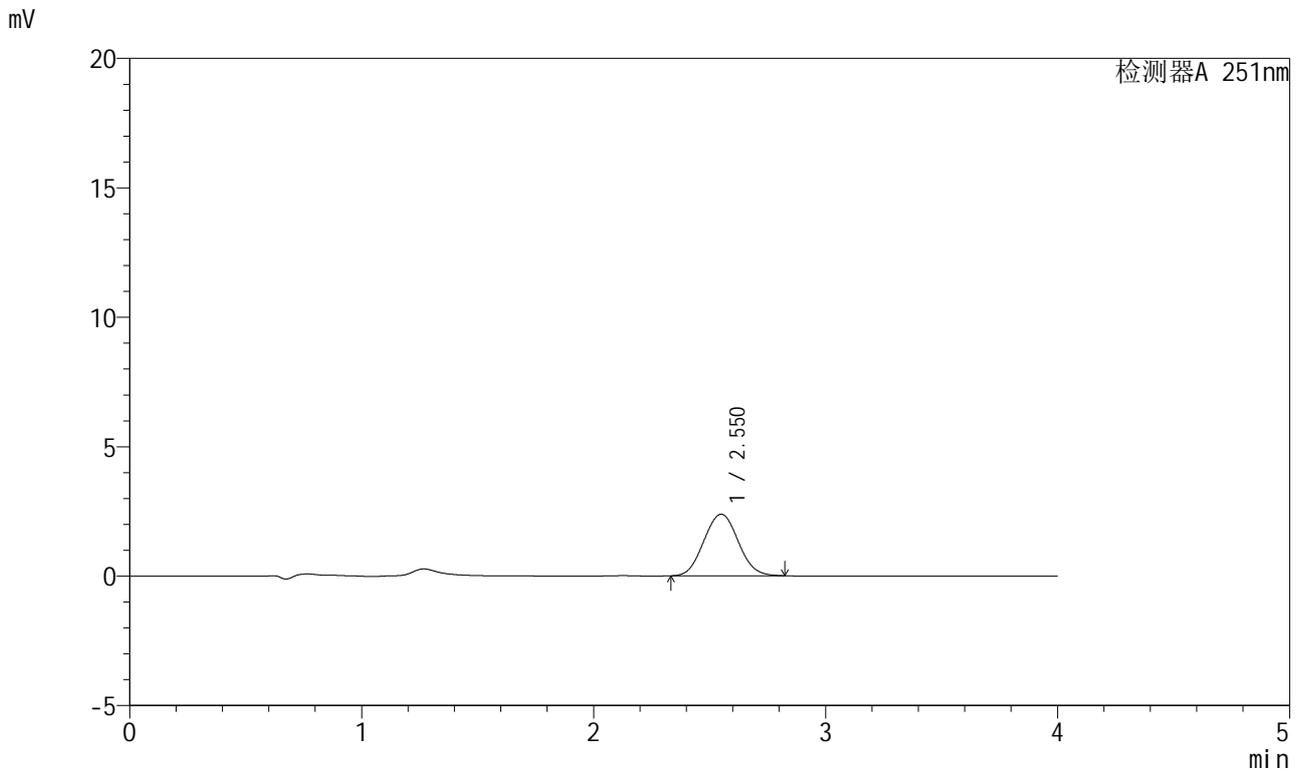

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	24536	100.000	2378	1401	1.052	--
总计		24536	100.000	2378			

图178 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3462-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:23:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

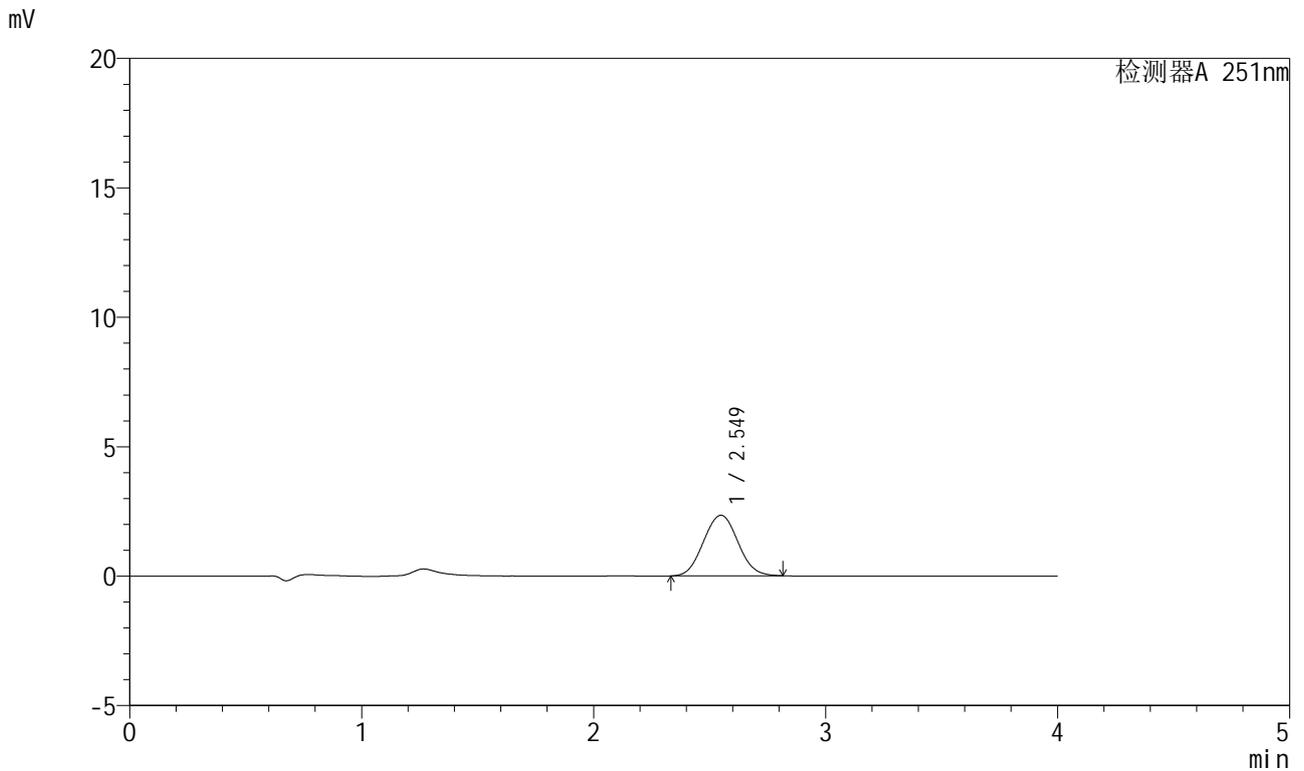

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	24135	100.000	2341	1394	1.045	--
总计		24135	100.000	2341			

图179 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3463-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:27:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

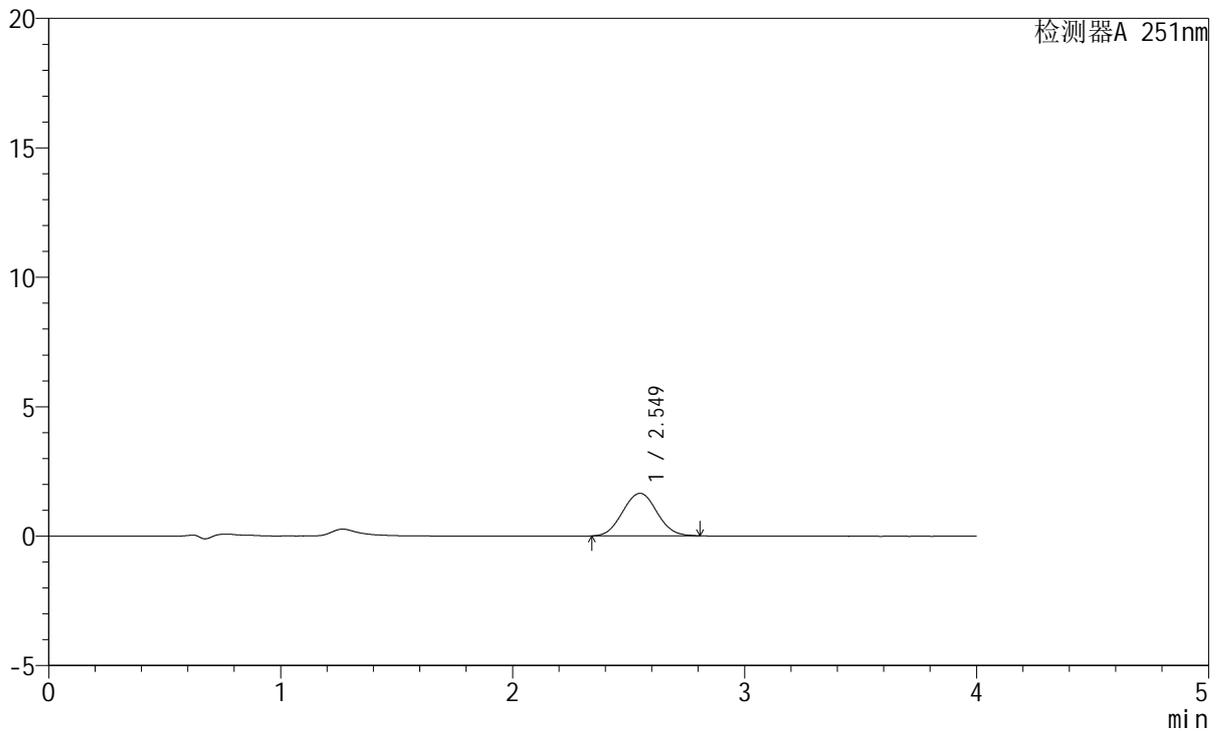

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	16923	100.000	1643	1405	1.045	--
总计		16923	100.000	1643			

图180 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3464-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:32:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

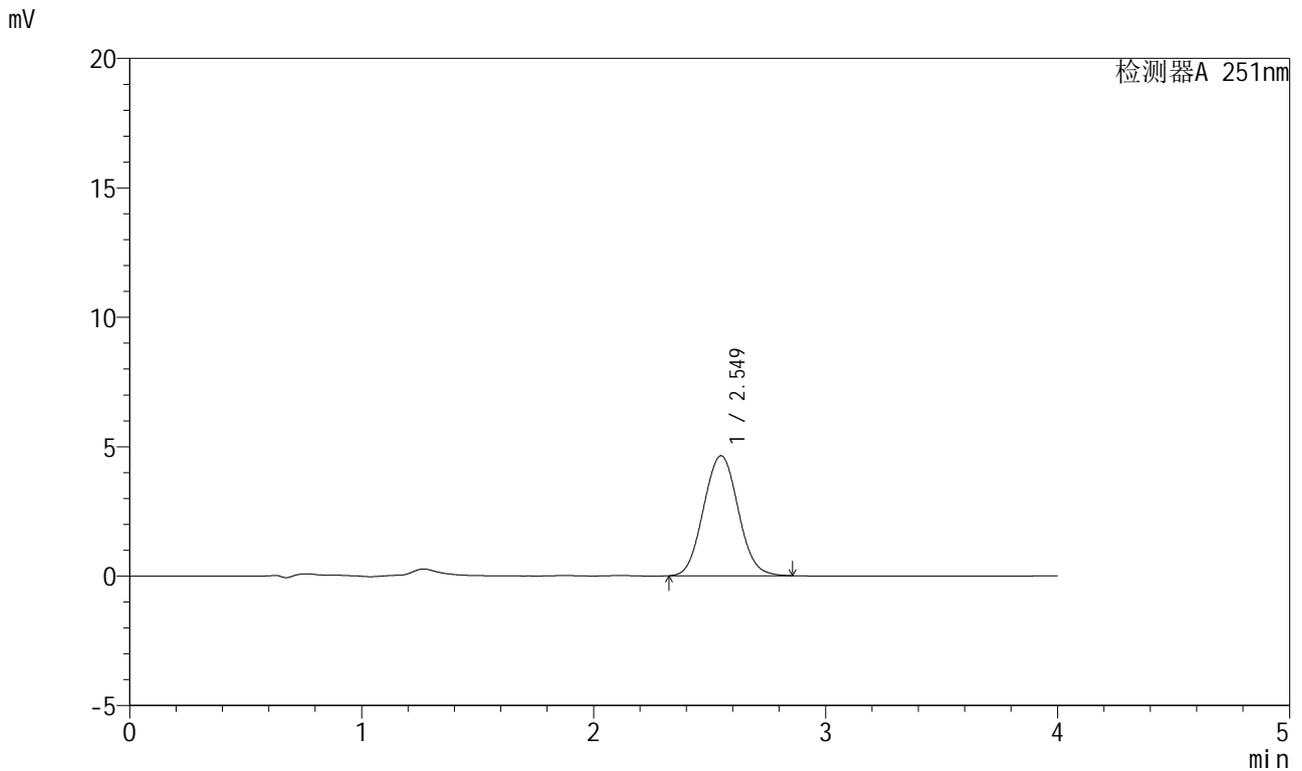

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	48077	100.000	4634	1397	1.055	--
总计		48077	100.000	4634			

图181 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3465-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:36:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

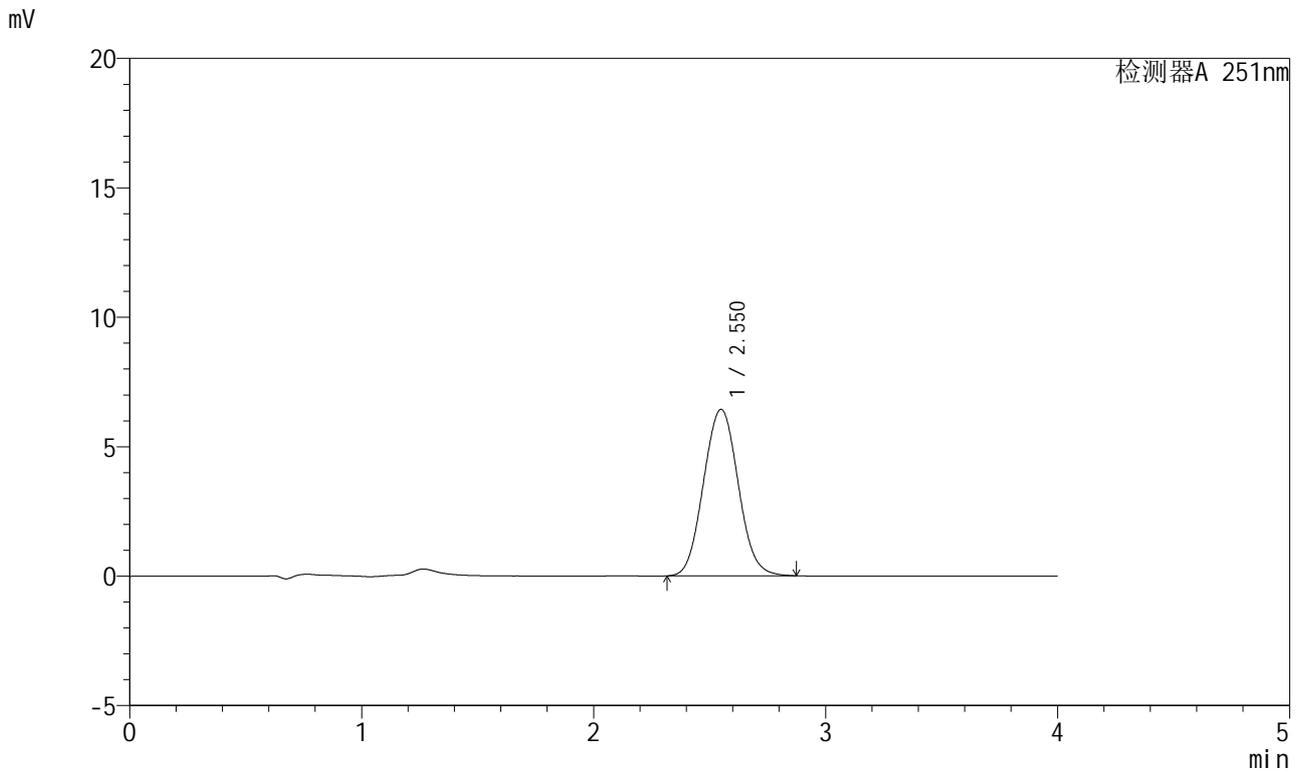

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	66877	100.000	6427	1390	1.057	--
总计		66877	100.000	6427			

图182 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3466-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:40:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

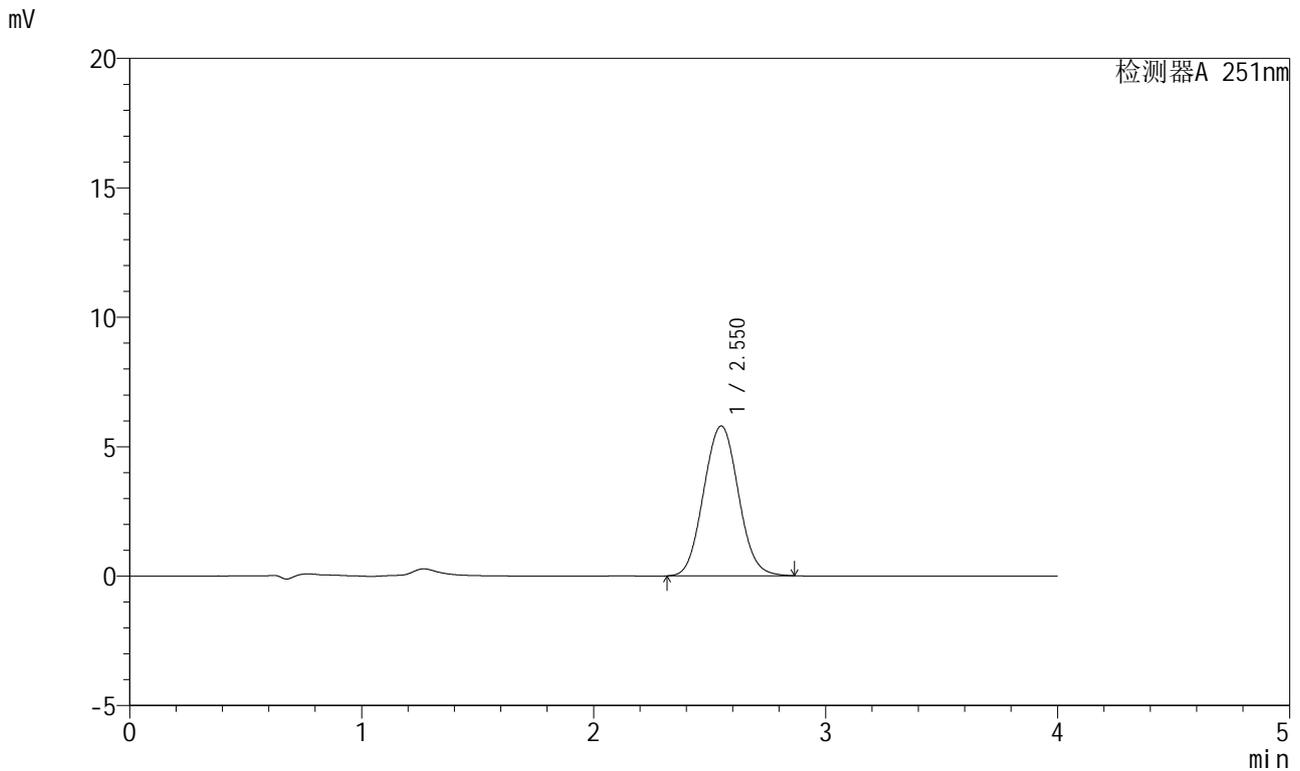

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	60195	100.000	5782	1390	1.054	--
总计		60195	100.000	5782			

图183 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3467-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:45:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

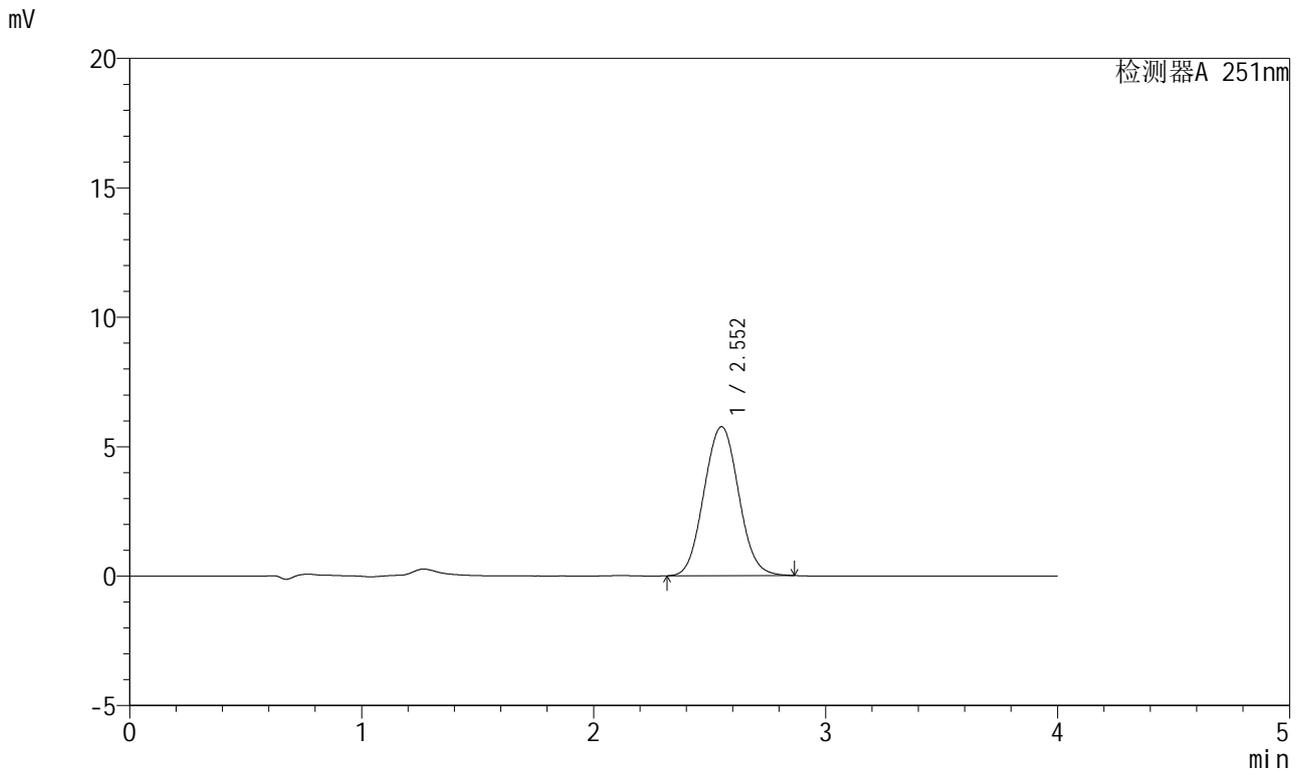

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	59761	100.000	5752	1395	1.053	--
总计		59761	100.000	5752			

图184 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3468-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:49:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

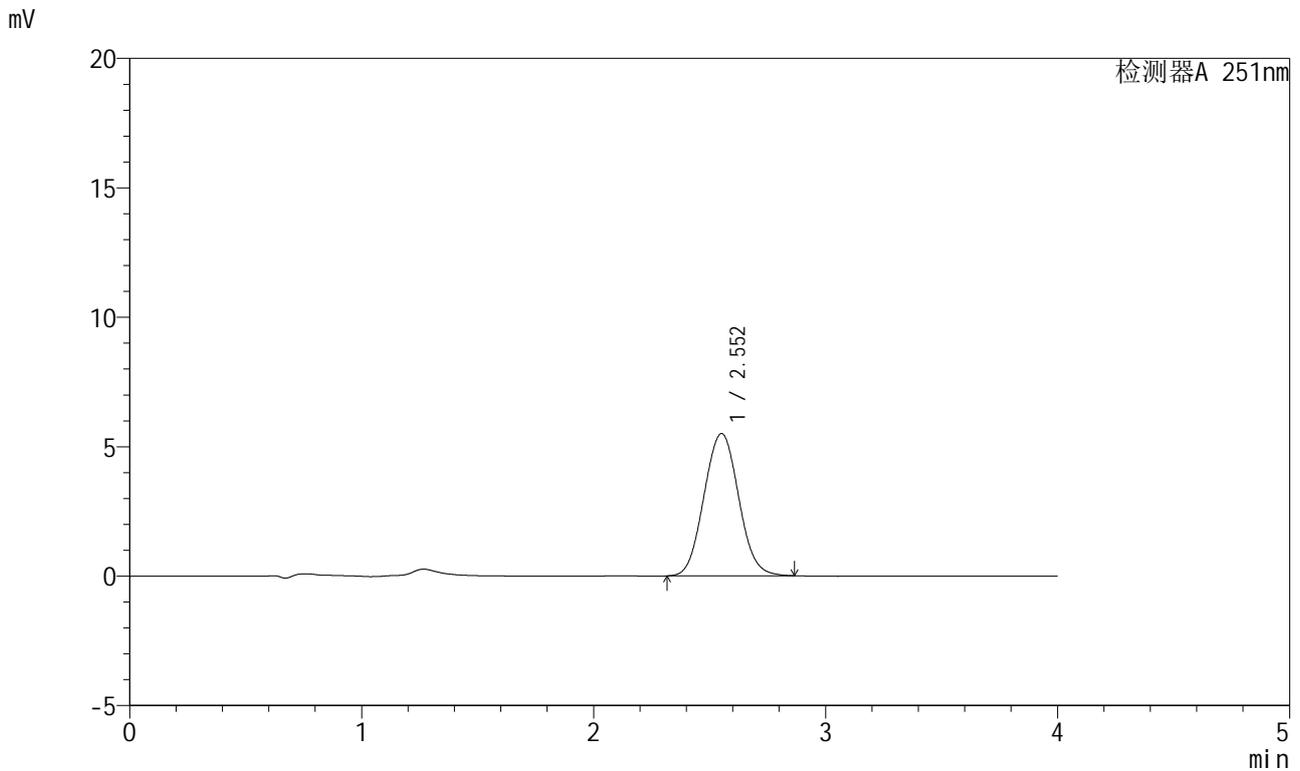

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	57032	100.000	5491	1399	1.053	--
总计		57032	100.000	5491			

图185 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3469-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:53:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

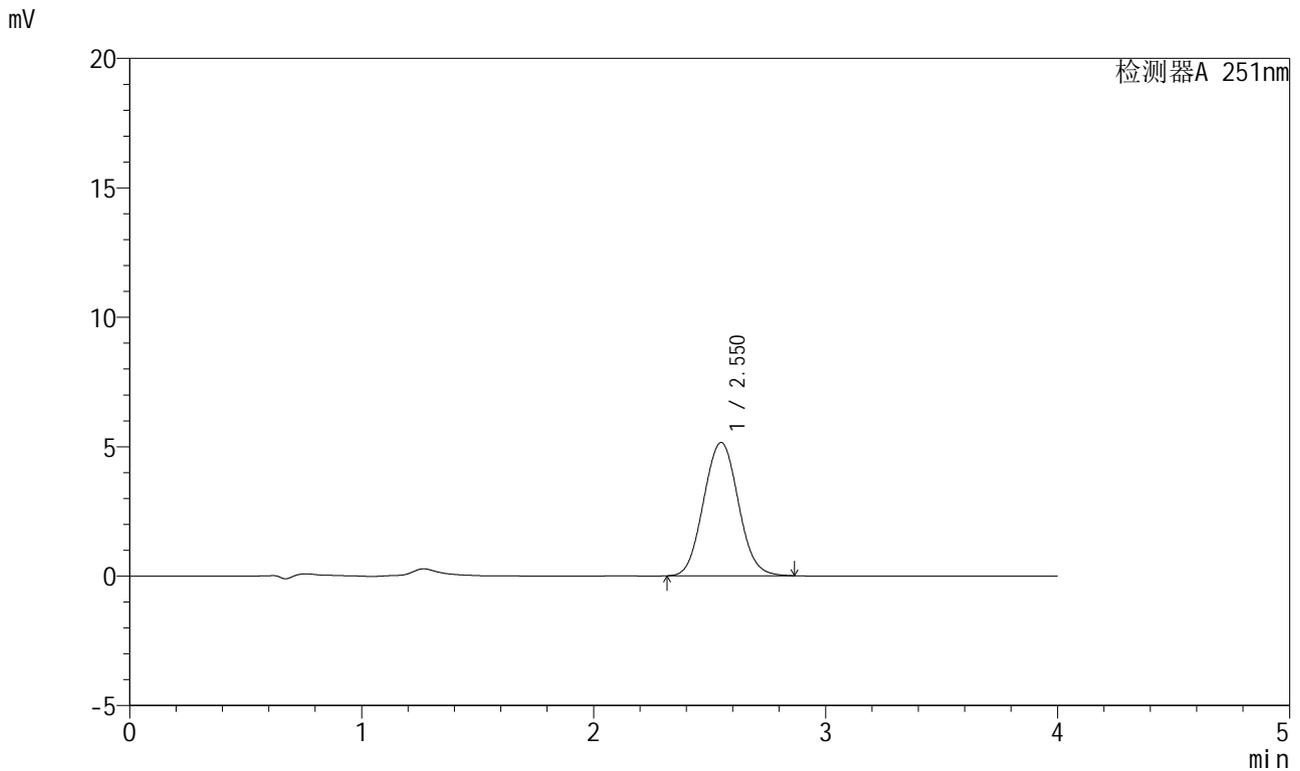

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	53537	100.000	5146	1390	1.057	--
总计		53537	100.000	5146			

图186 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3470-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/05 23:58:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

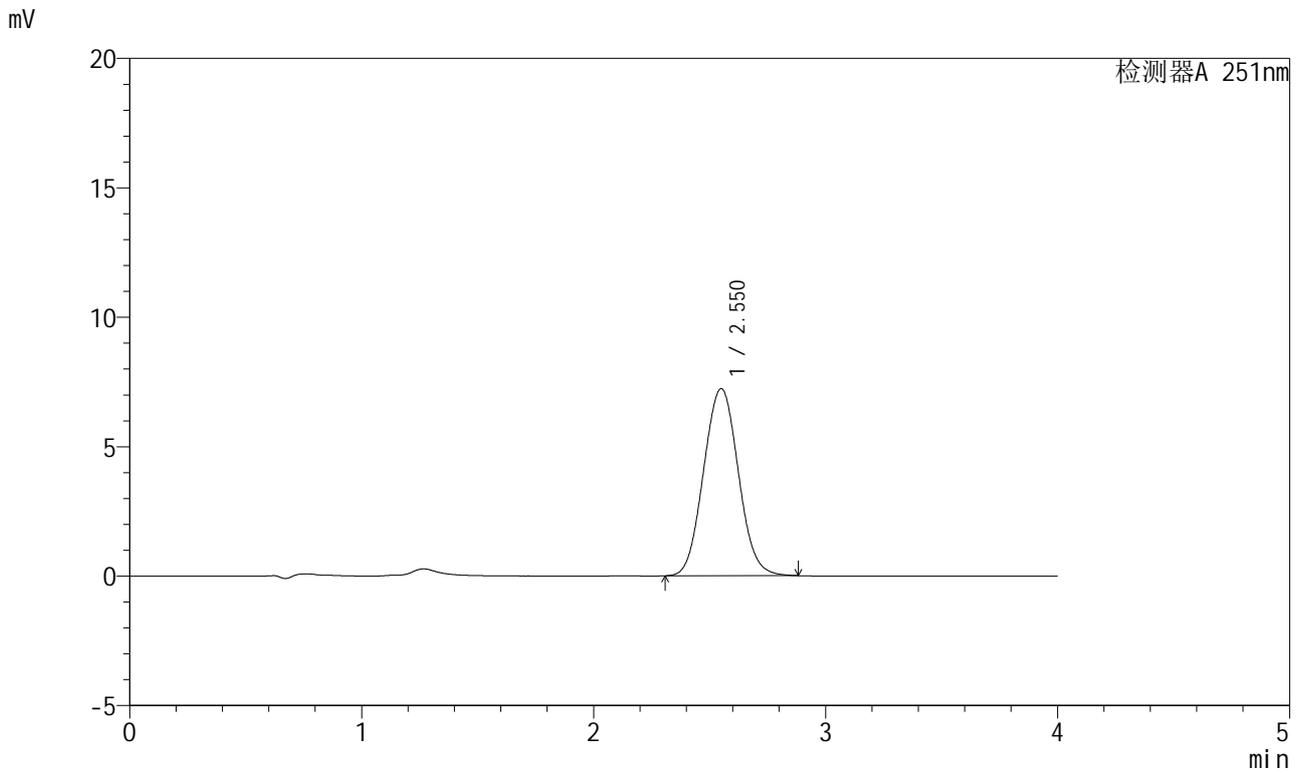

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	75340	100.000	7224	1388	1.055	--
总计		75340	100.000	7224			

图187 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3471-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:02:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

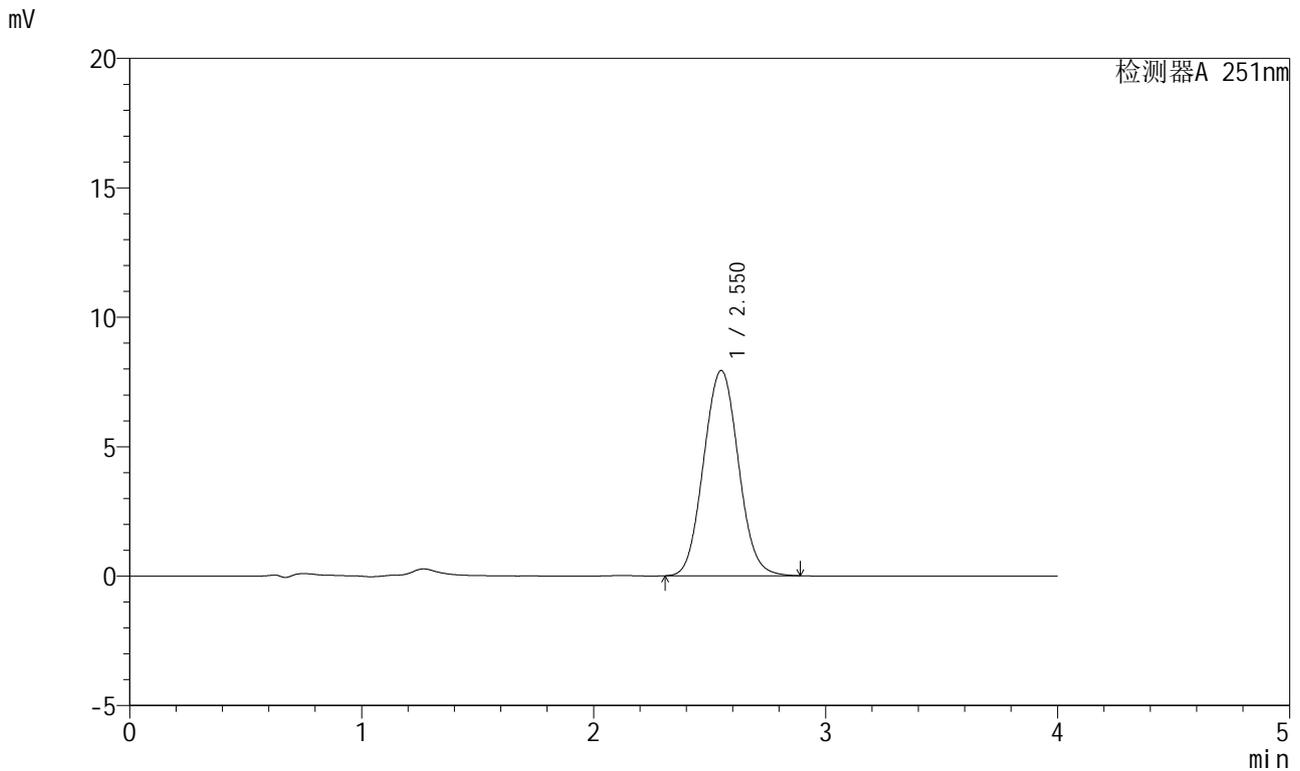

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	82618	100.000	7920	1388	1.056	--
总计		82618	100.000	7920			

图188 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3472-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:07:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

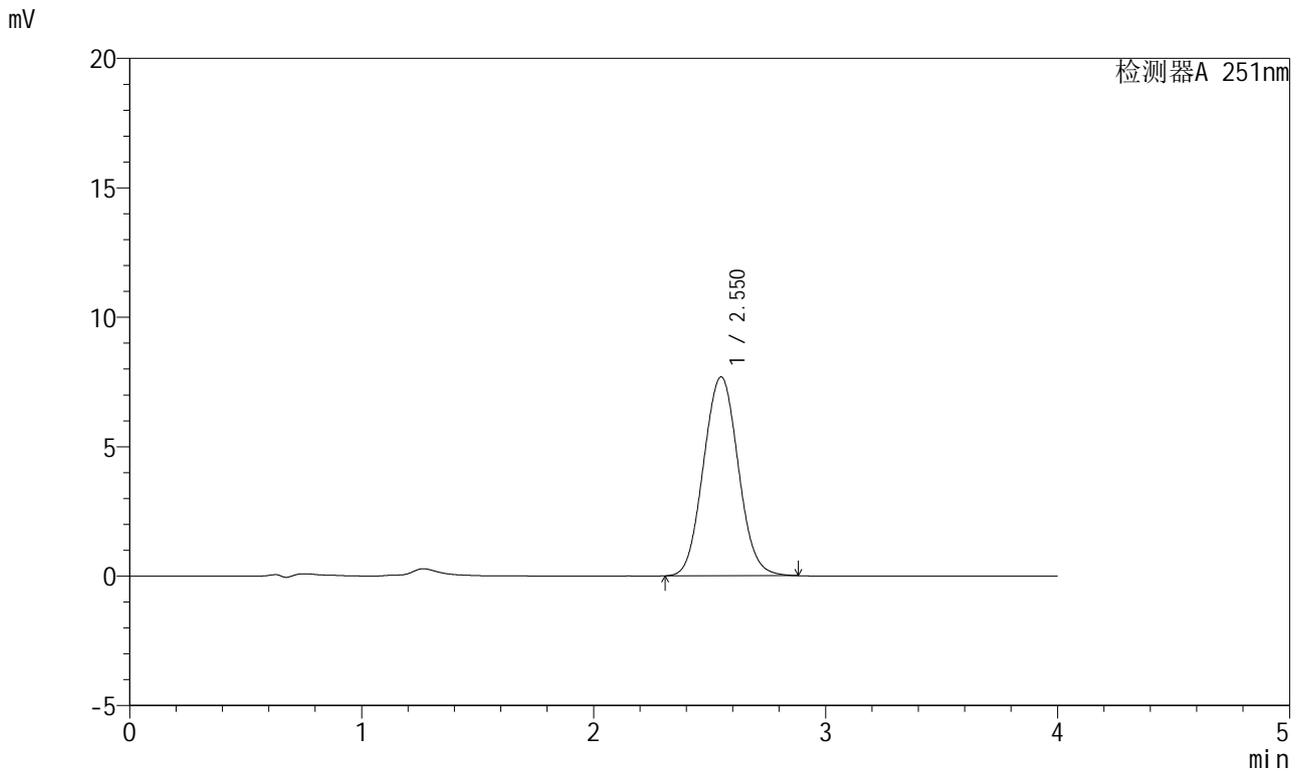

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	80033	100.000	7678	1387	1.056	--
总计		80033	100.000	7678			

图189 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3473-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:11:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

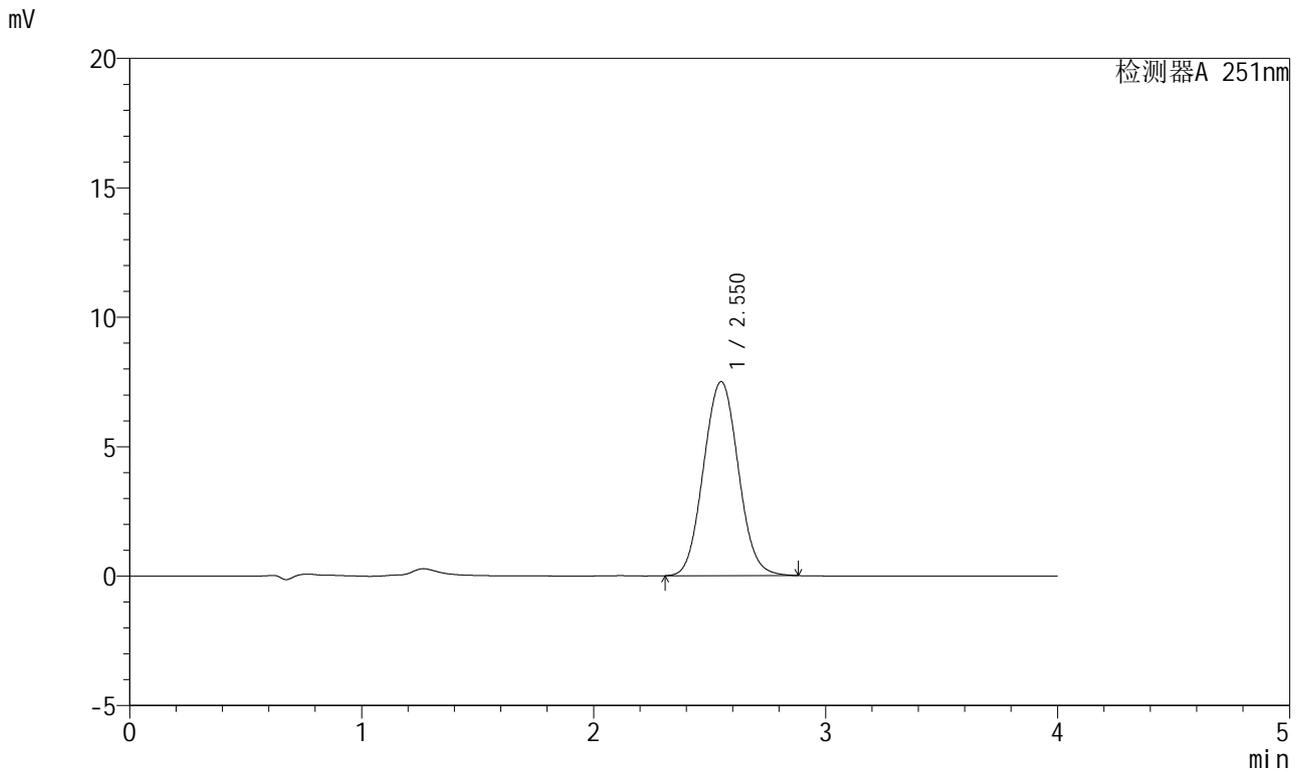

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	78016	100.000	7488	1389	1.054	--
总计		78016	100.000	7488			

图190 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3474-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:15:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

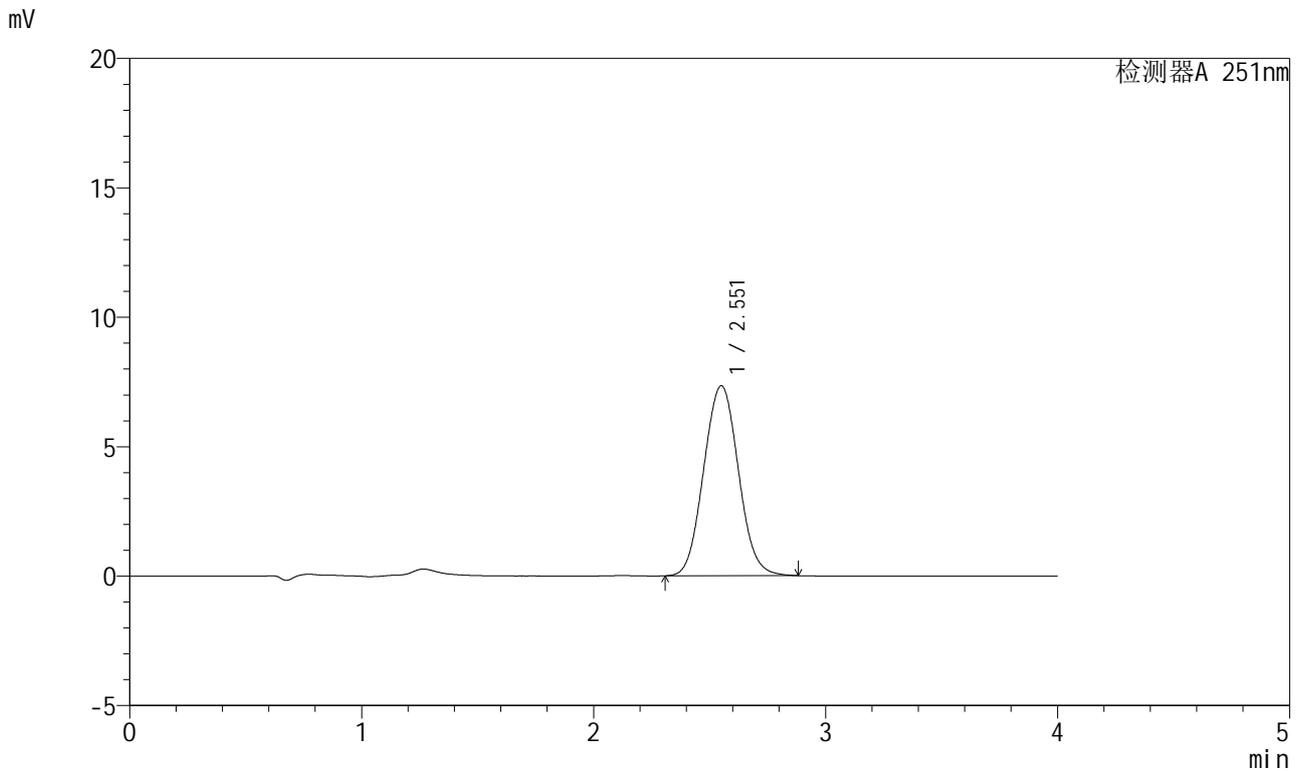

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	76376	100.000	7332	1394	1.056	--
总计		76376	100.000	7332			

图191 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3475-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:20:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

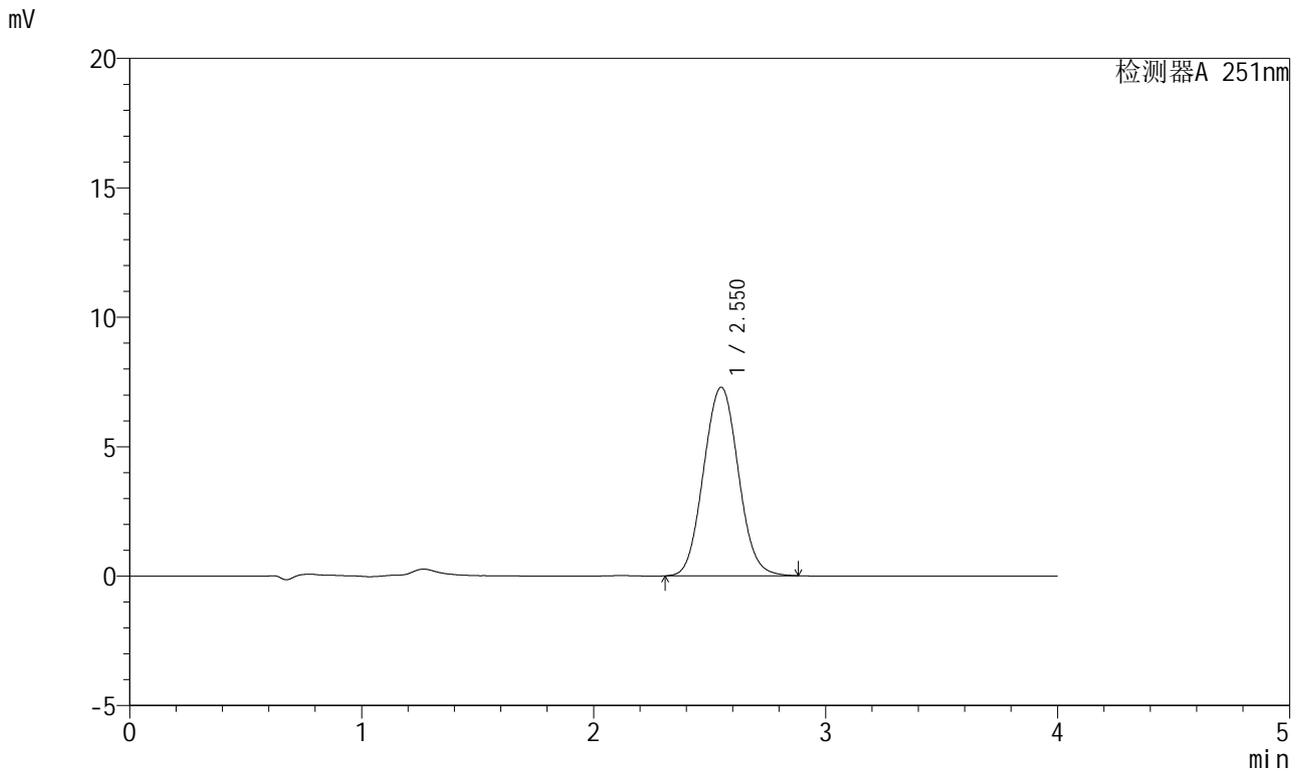

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	75836	100.000	7279	1392	1.056	--
总计		75836	100.000	7279			

图192 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3476-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:24:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

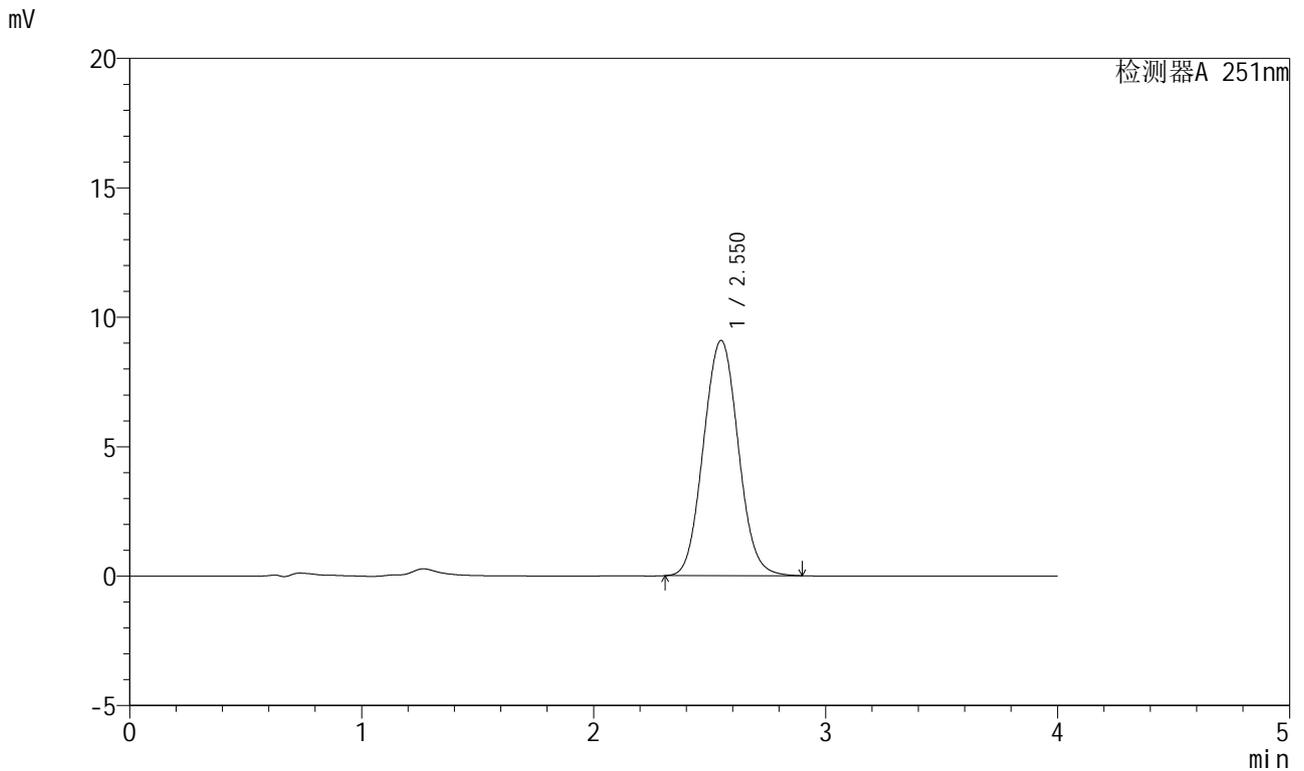

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	94645	100.000	9082	1391	1.057	--
总计		94645	100.000	9082			

图193 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3477-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:29:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:35:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

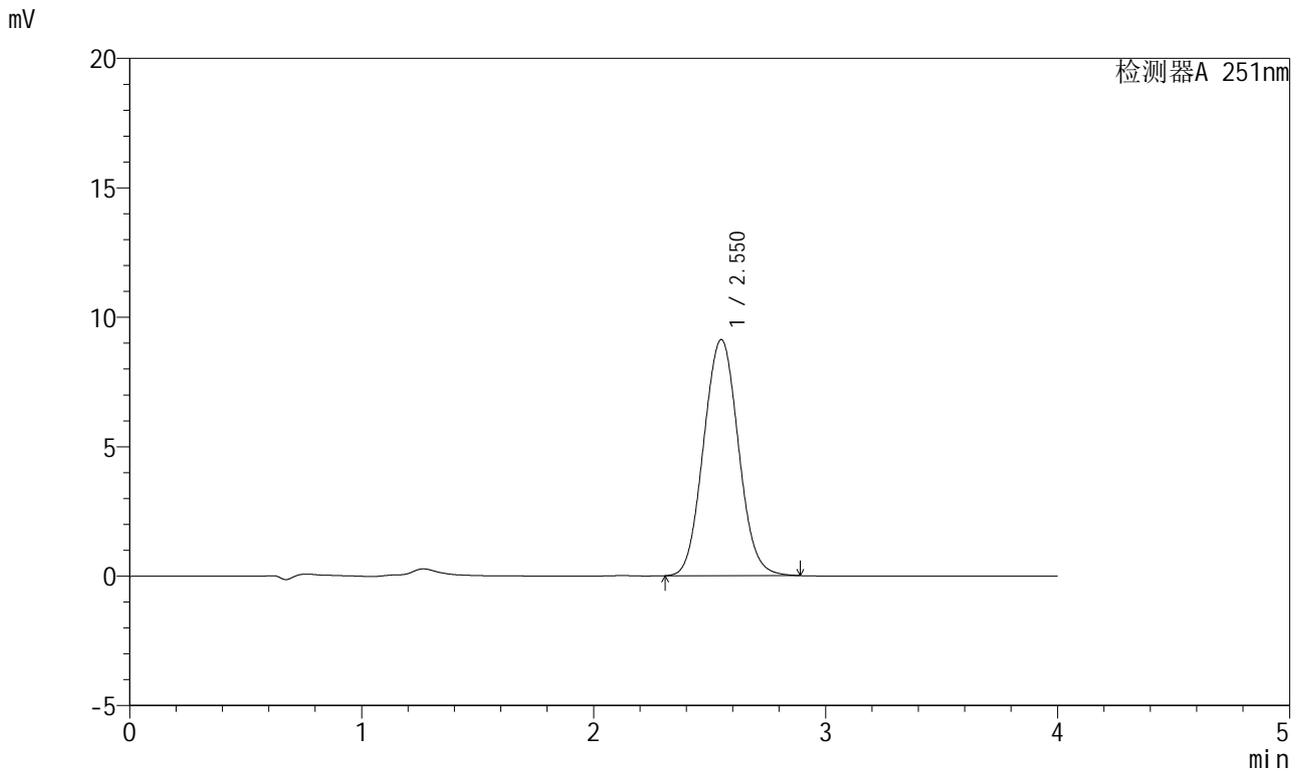

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	94995	100.000	9109	1389	1.055	--
总计		94995	100.000	9109			

图194 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3478-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:33:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

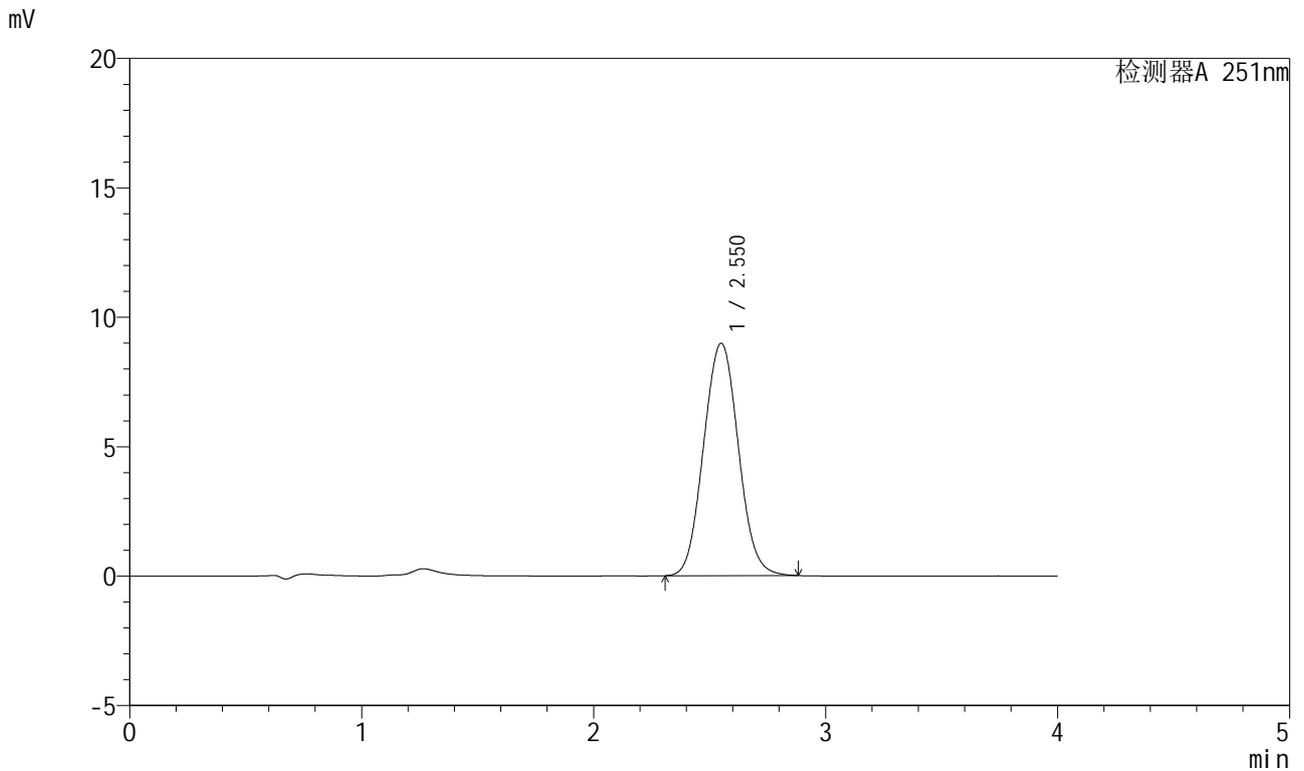

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	93543	100.000	8968	1387	1.056	--
总计		93543	100.000	8968			

图195 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3479-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:37:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

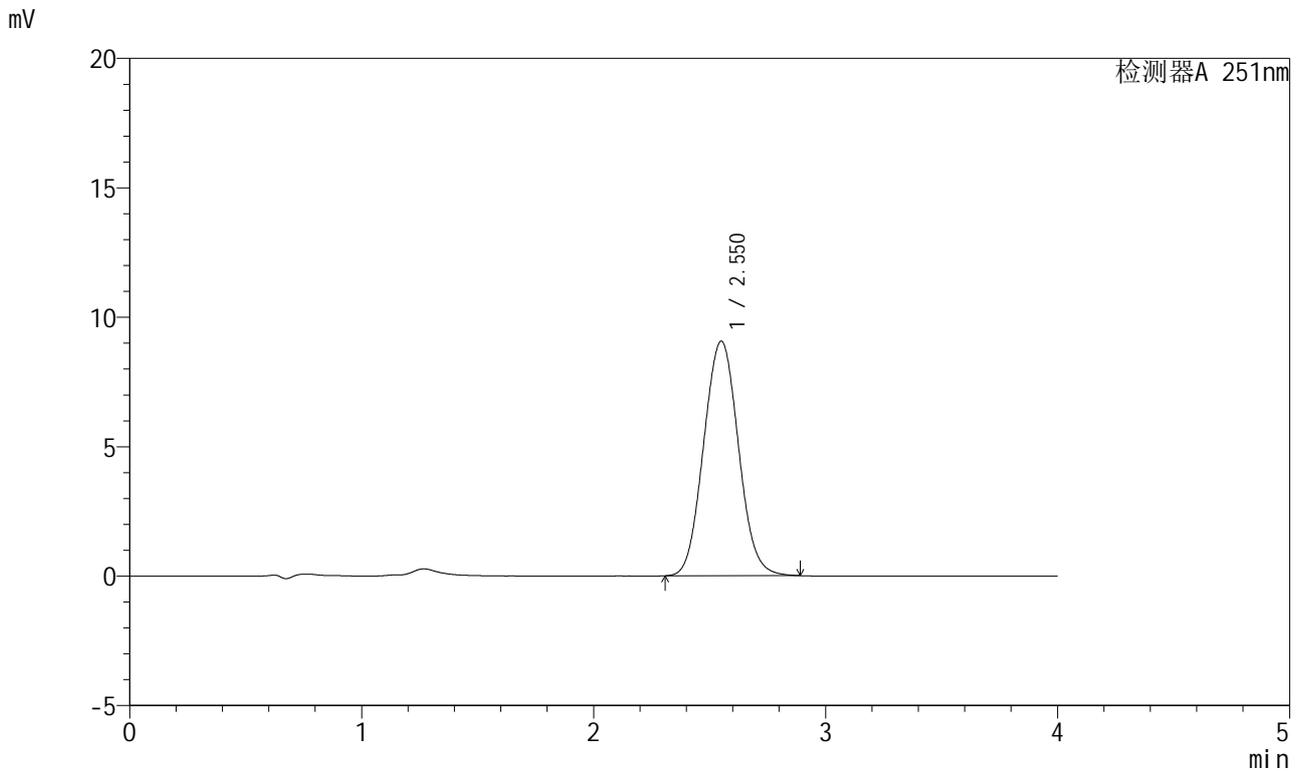

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	94489	100.000	9052	1386	1.056	--
总计		94489	100.000	9052			

图196 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3480-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:42:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

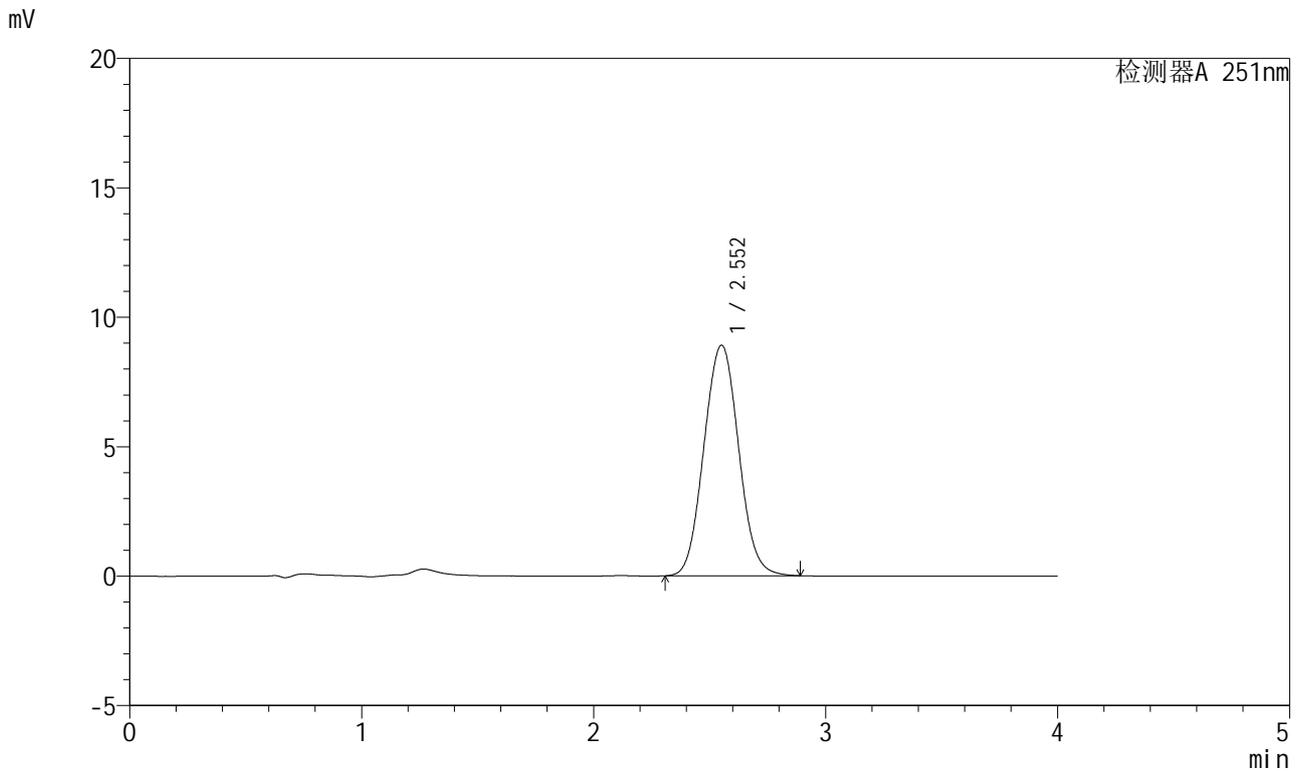

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	92709	100.000	8899	1394	1.056	--
总计		92709	100.000	8899			

图197 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3481-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:46:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

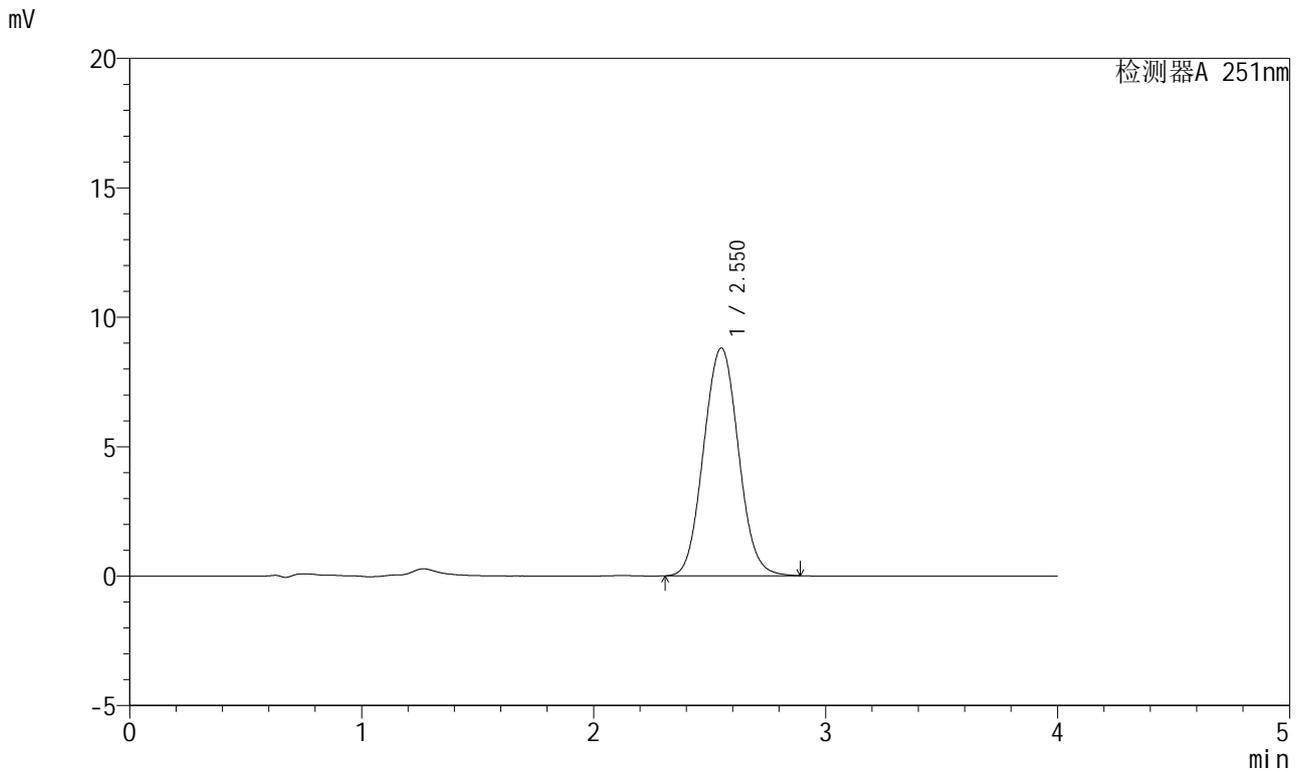

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	91763	100.000	8791	1388	1.056	--
总计		91763	100.000	8791			

图198 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3482-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:51:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

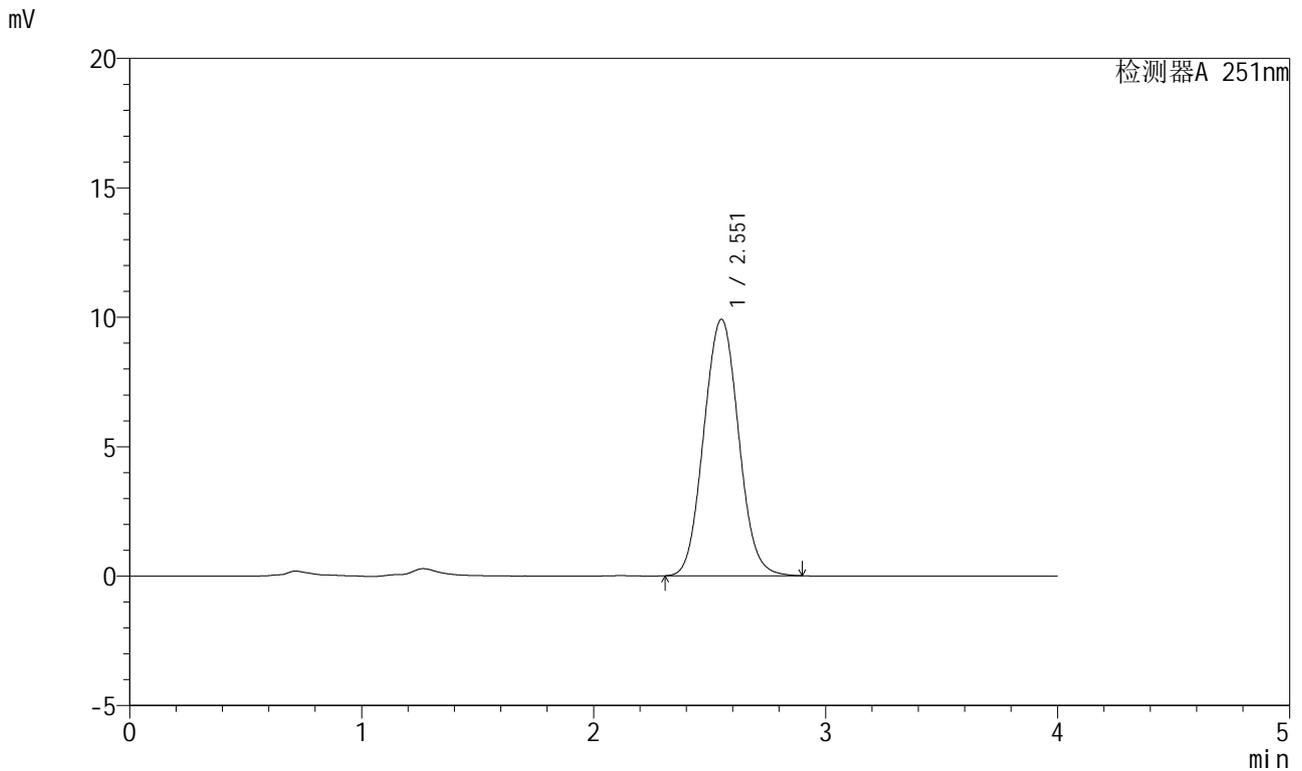

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	103202	100.000	9896	1391	1.055	--
总计		103202	100.000	9896			

图199 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3483-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:55:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

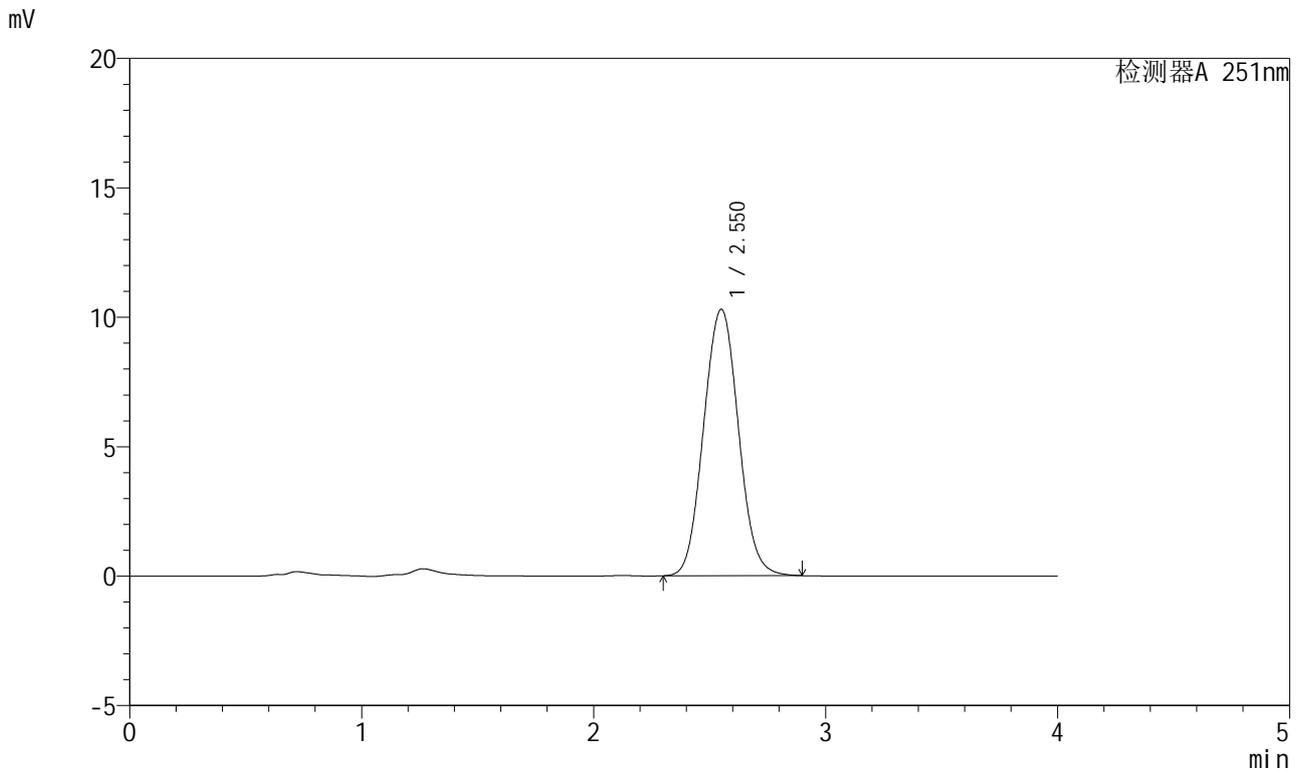

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.550	107415	100.000	10282	1388	1.056	--
总计		107415	100.000	10282			

图200 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3484-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 00:59:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

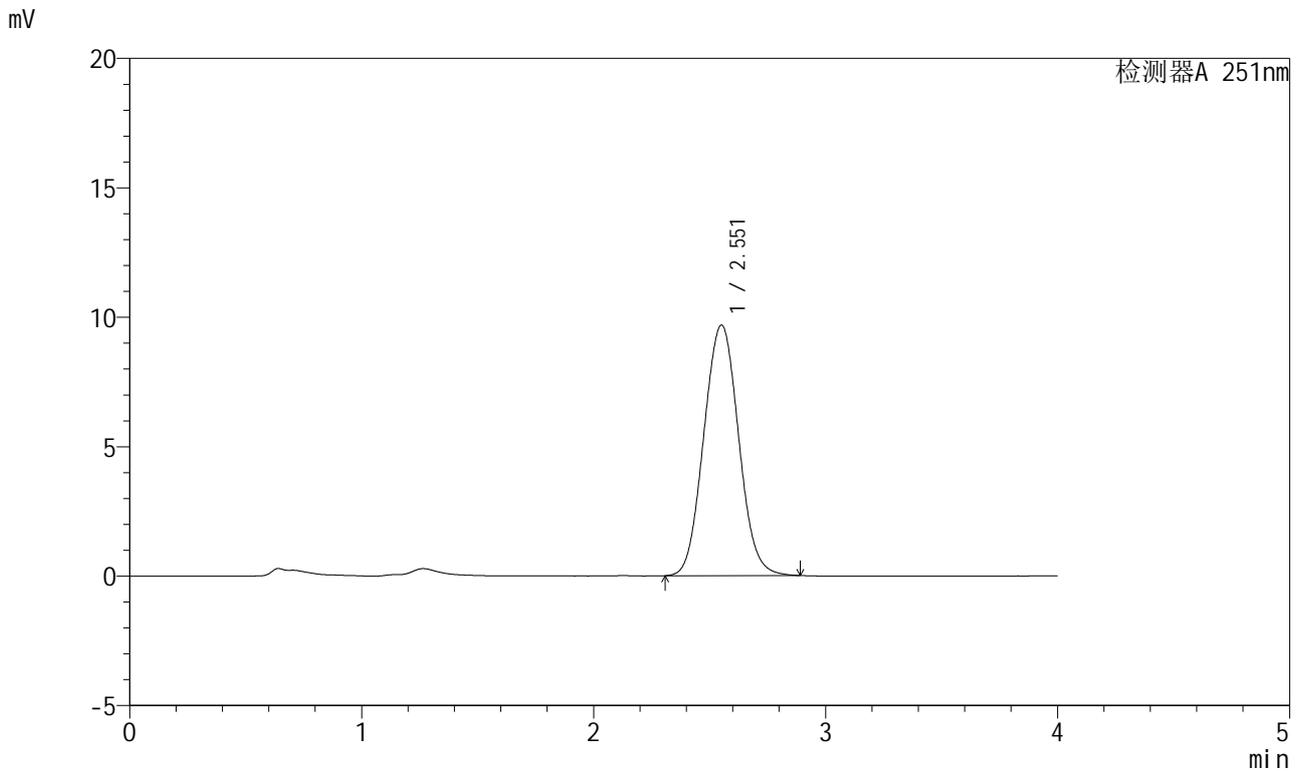

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	101010	100.000	9668	1385	1.055	--
总计		101010	100.000	9668			

图201 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3485-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:04:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

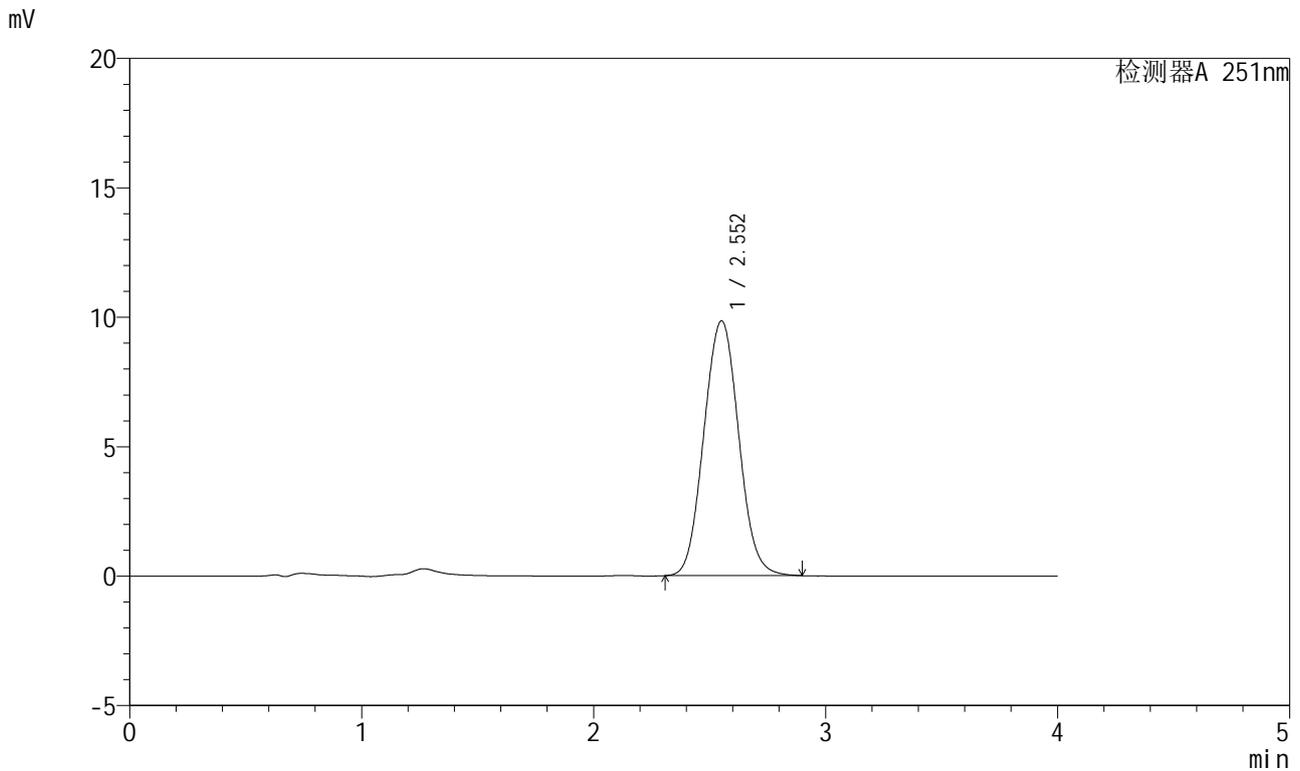

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	102680	100.000	9835	1388	1.057	--
总计		102680	100.000	9835			

图202 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3486-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:08:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

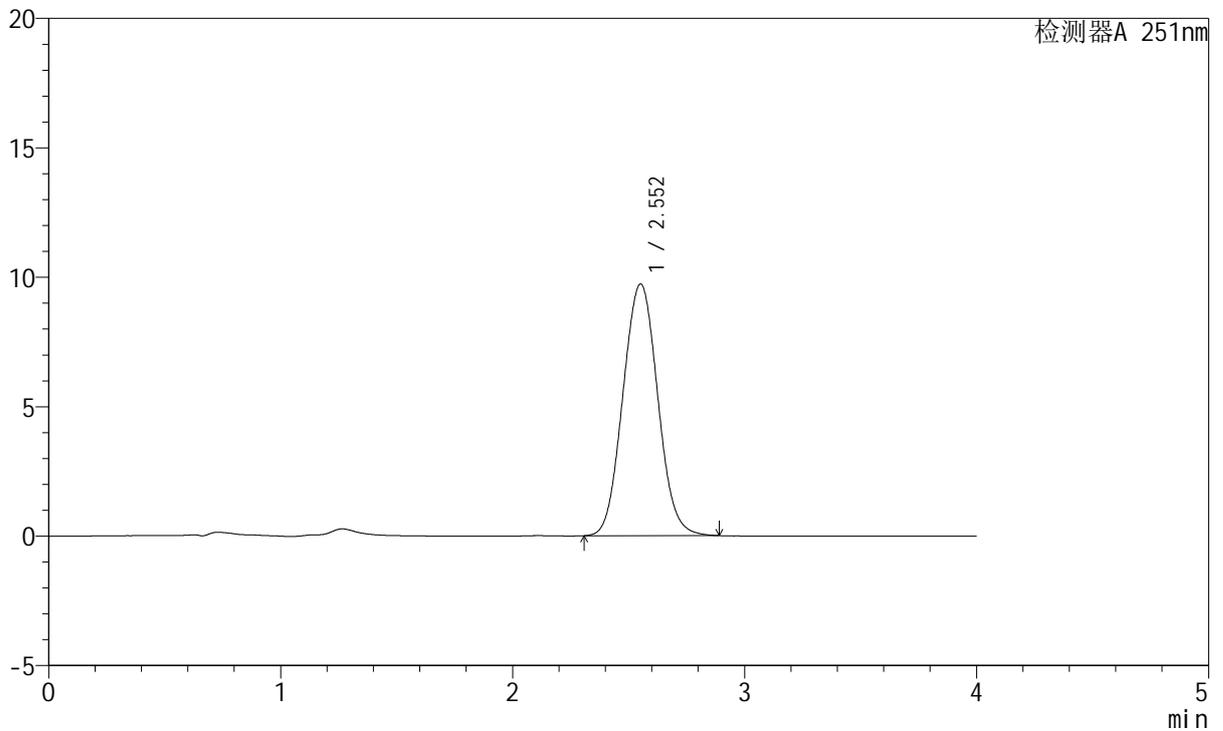

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	101408	100.000	9714	1387	1.054	--
总计		101408	100.000	9714			

图203 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3487-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:12:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

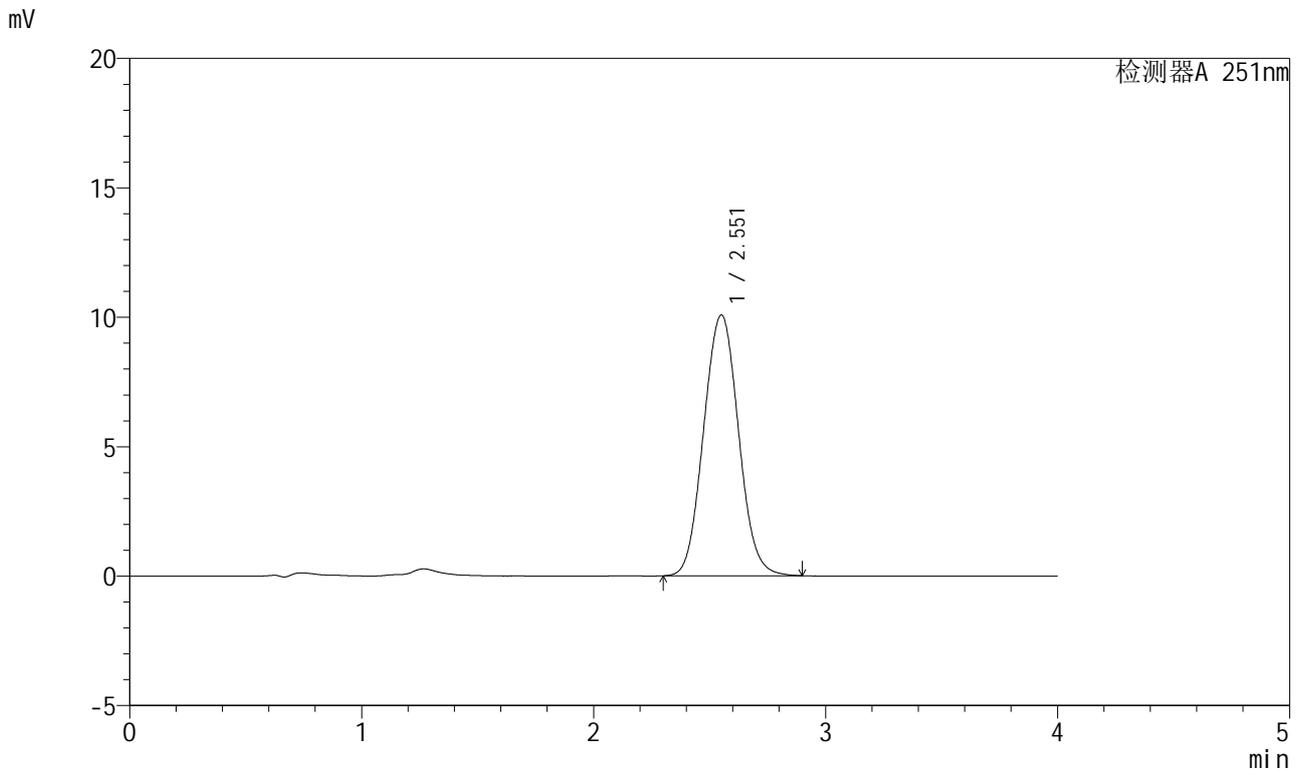

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	105406	100.000	10062	1380	1.057	--
总计		105406	100.000	10062			

图204 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3488-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:17:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

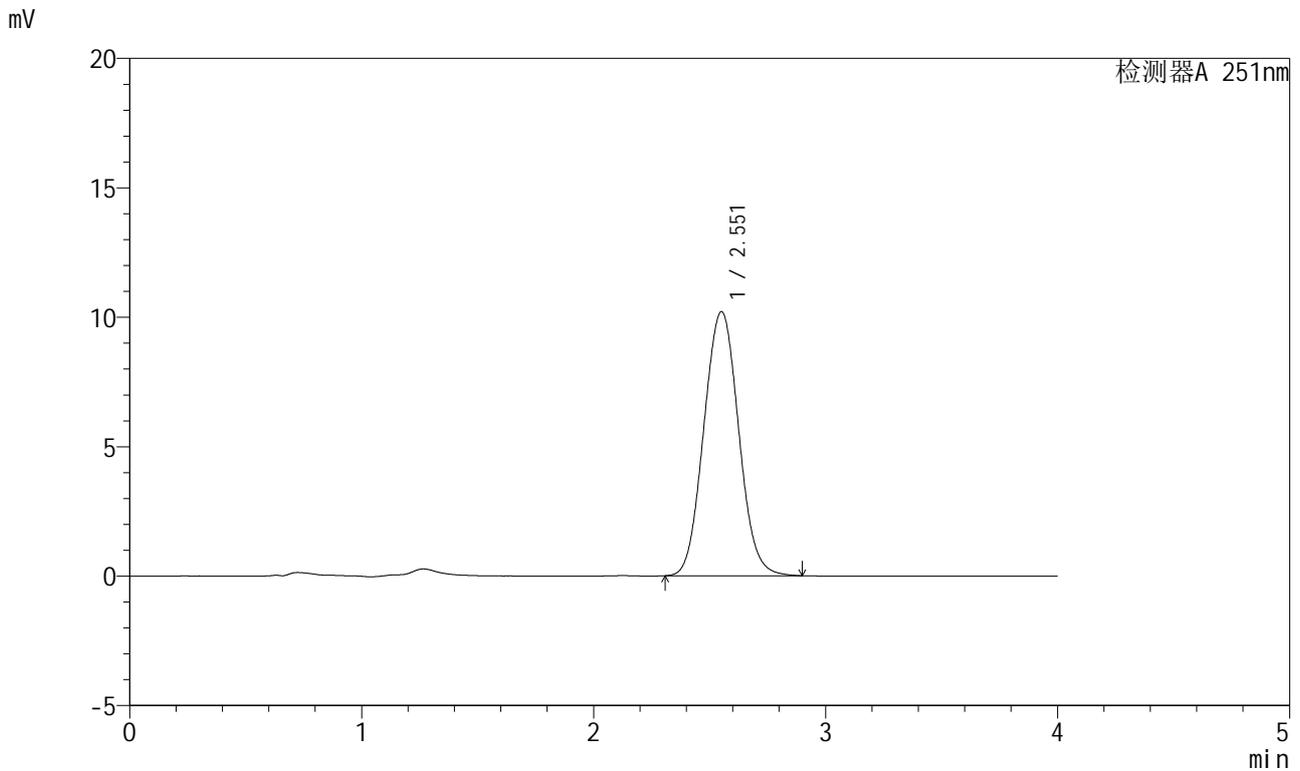

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	106423	100.000	10193	1389	1.056	--
总计		106423	100.000	10193			

图205 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3489-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:21:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

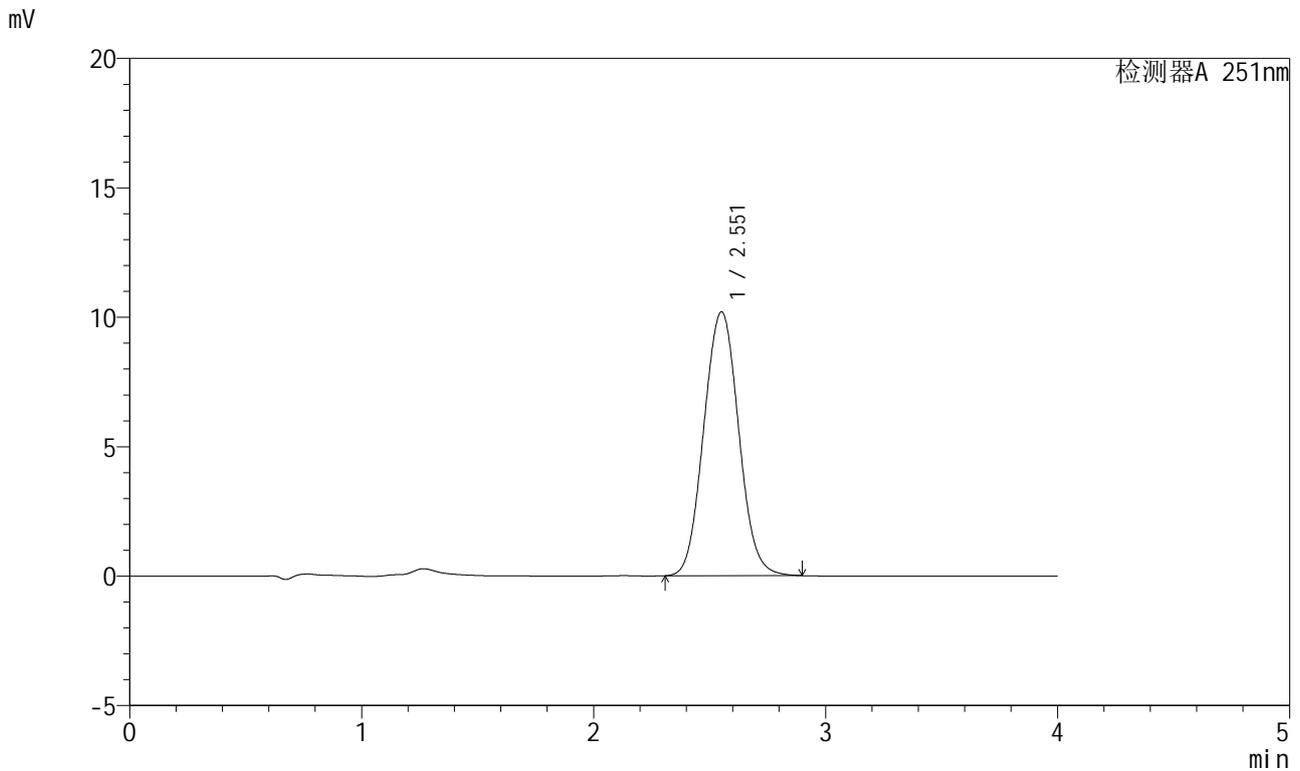

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	106569	100.000	10184	1382	1.055	--
总计		106569	100.000	10184			

图206 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3490-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:26:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

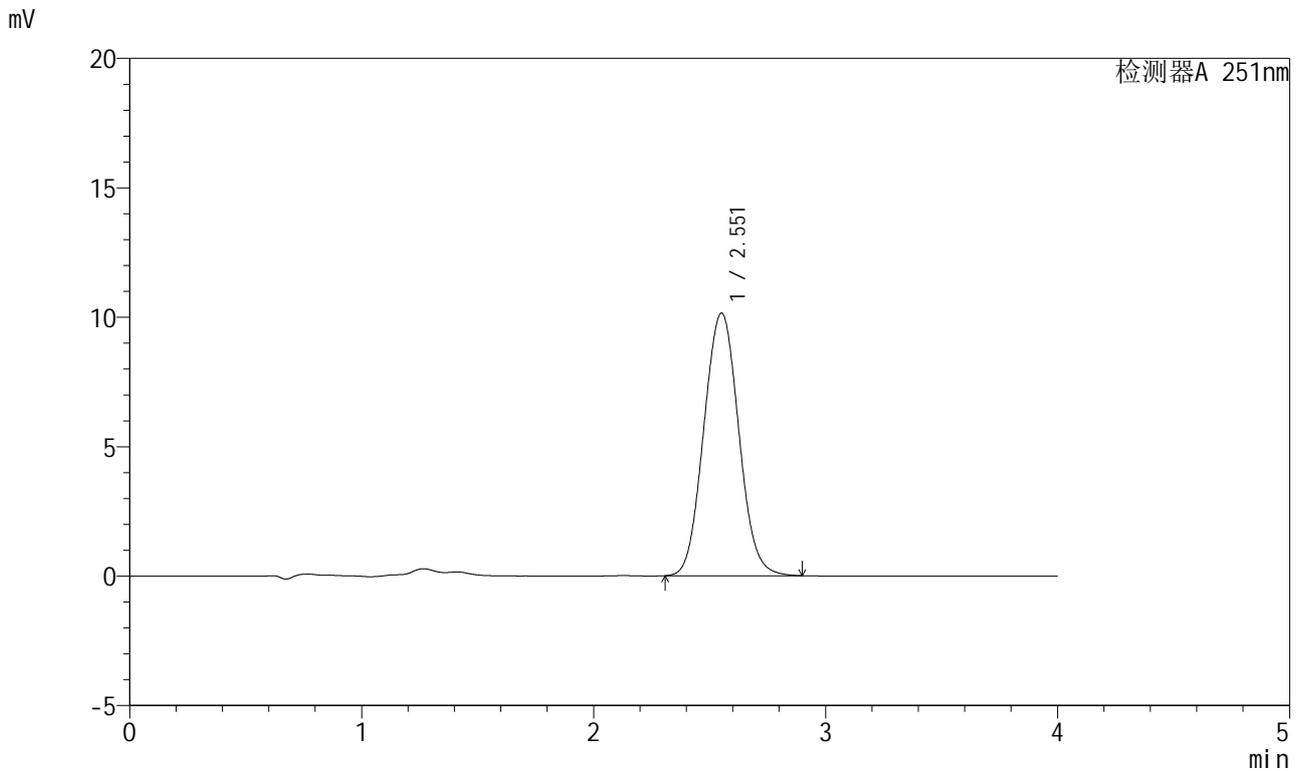

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	106094	100.000	10134	1382	1.056	--
总计		106094	100.000	10134			

图207 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3491-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:30:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

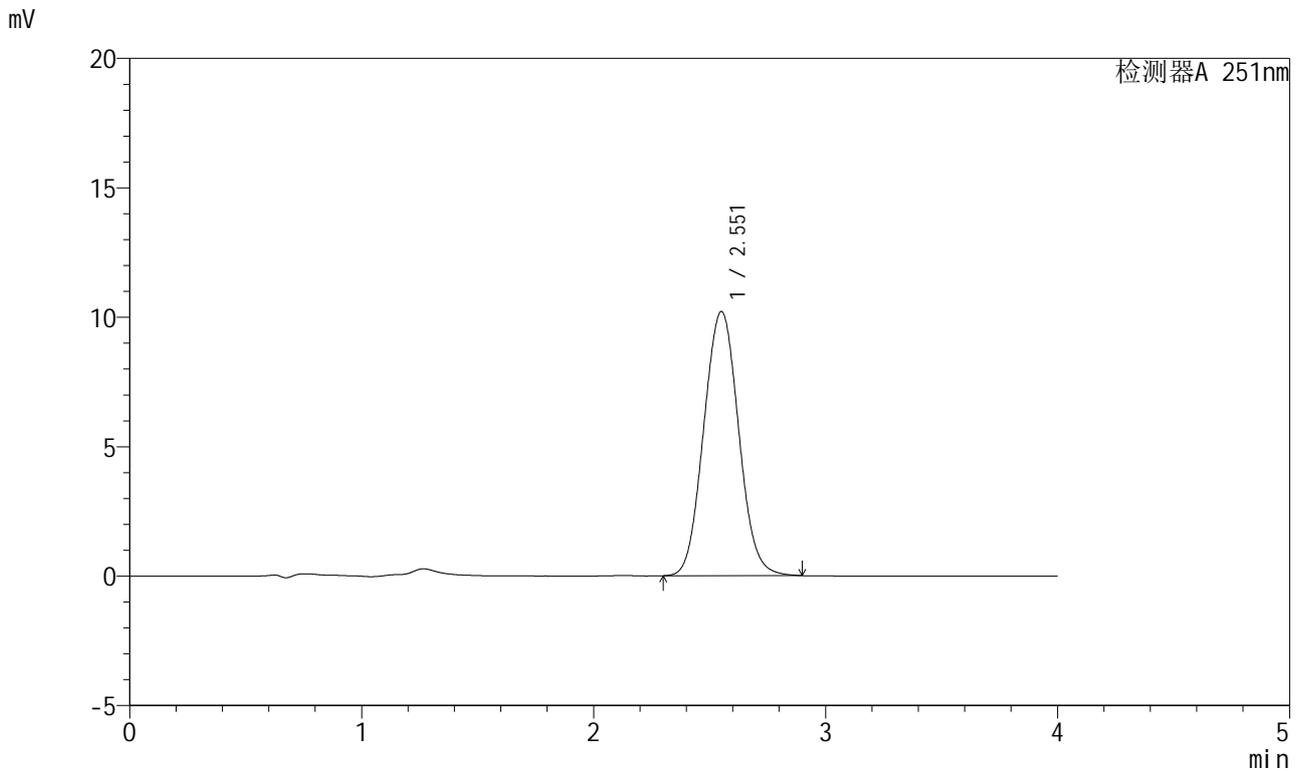

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	106676	100.000	10194	1383	1.056	--
总计		106676	100.000	10194			

图208 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3492-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:34:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

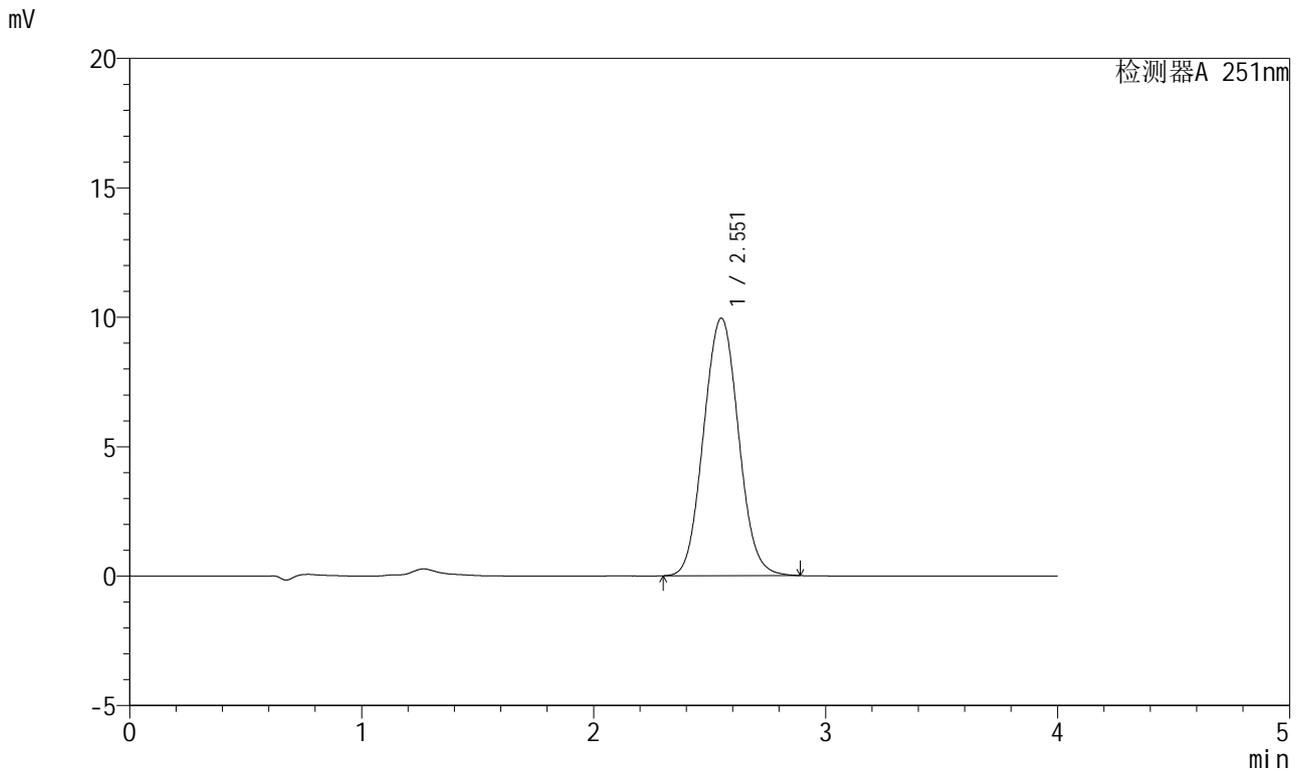

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	103916	100.000	9936	1381	1.053	--
总计		103916	100.000	9936			

图209 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3493-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:39:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

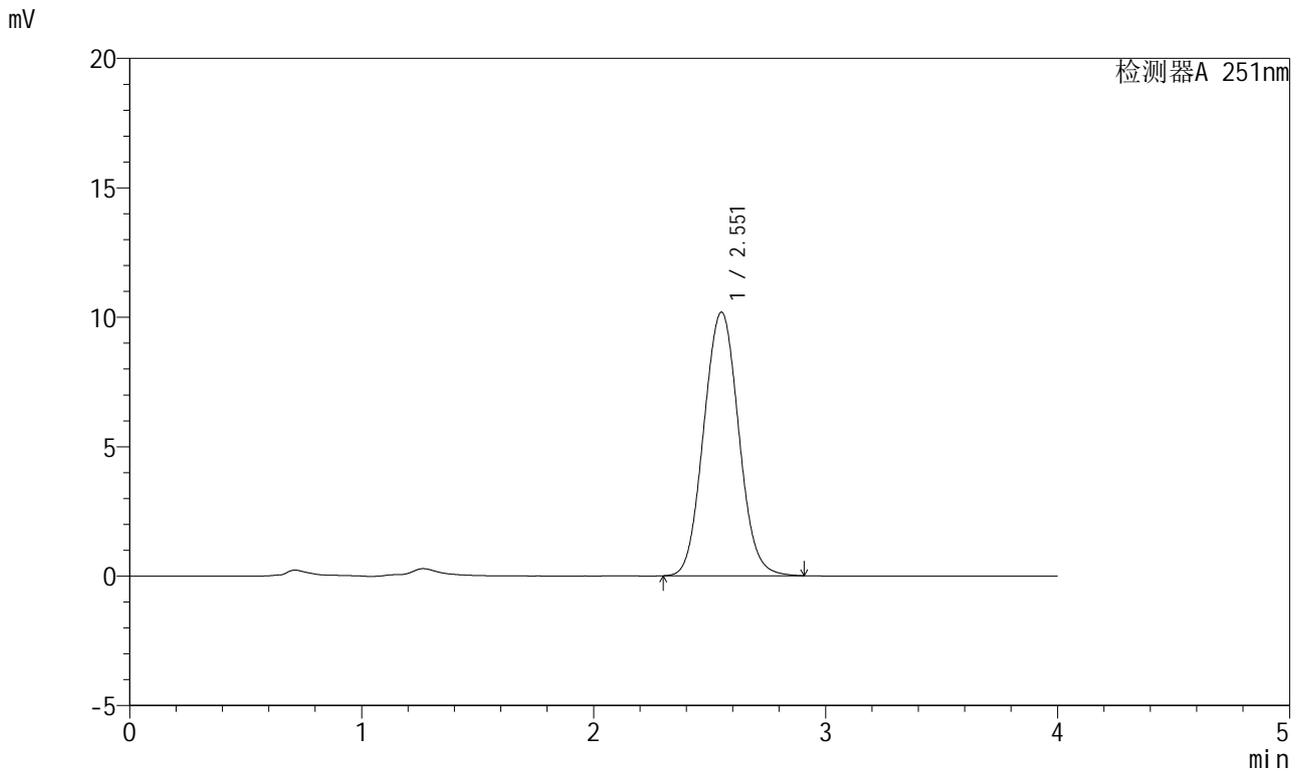

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.551	106501	100.000	10173	1384	1.055	--
总计		106501	100.000	10173			

图210 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3494-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:43:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

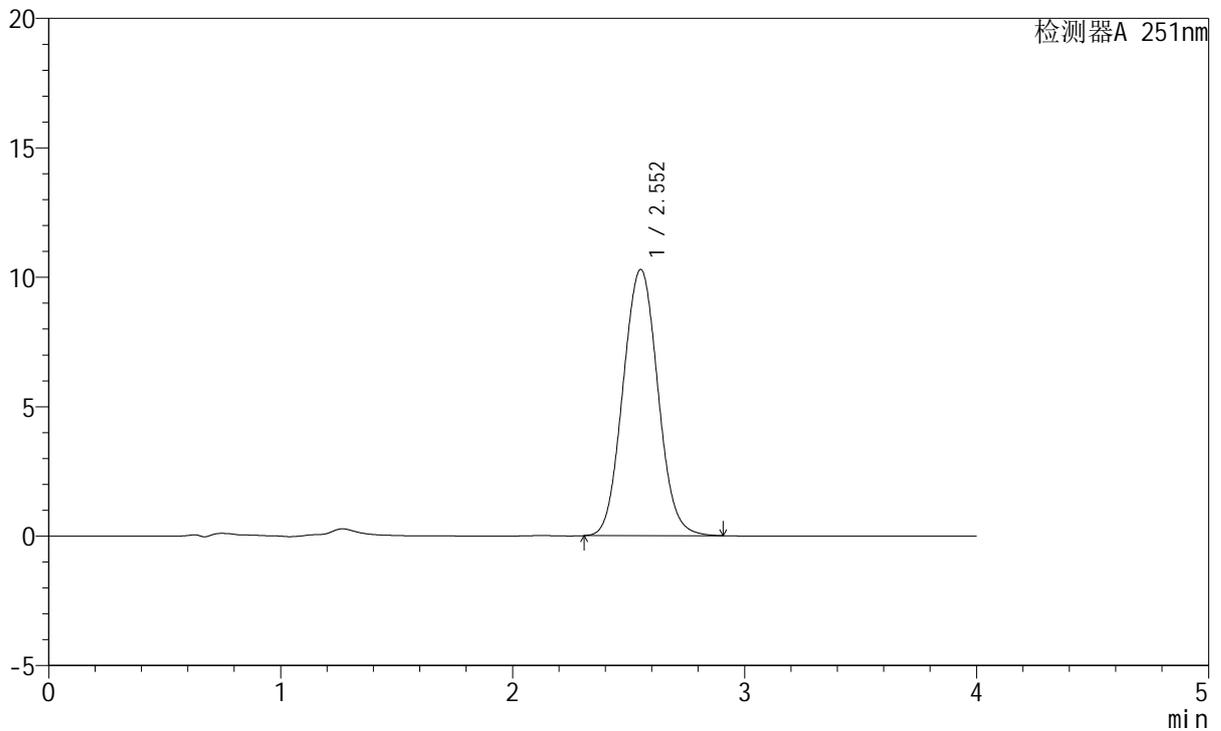

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	107353	100.000	10278	1388	1.056	--
总计		107353	100.000	10278			

图211 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3495-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:48:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

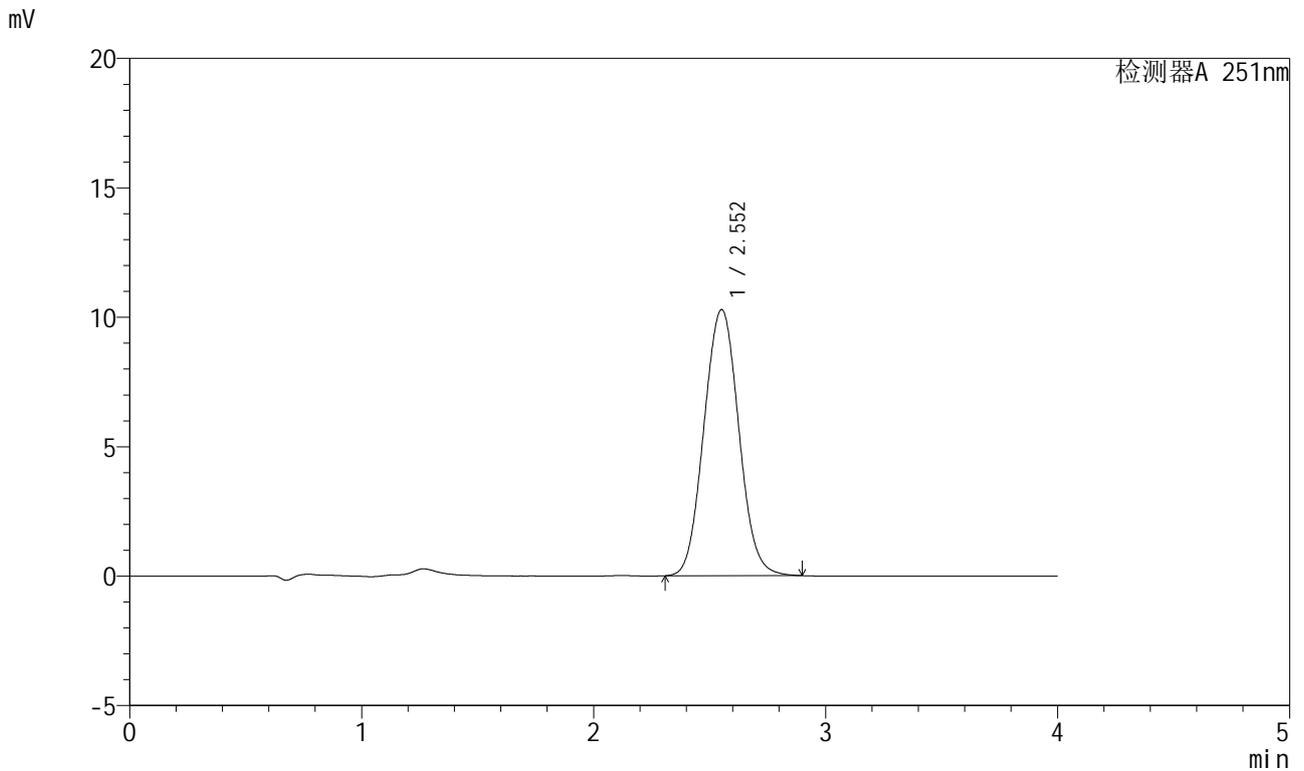

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	107375	100.000	10274	1387	1.054	--
总计		107375	100.000	10274			

图212 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3496-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:52:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

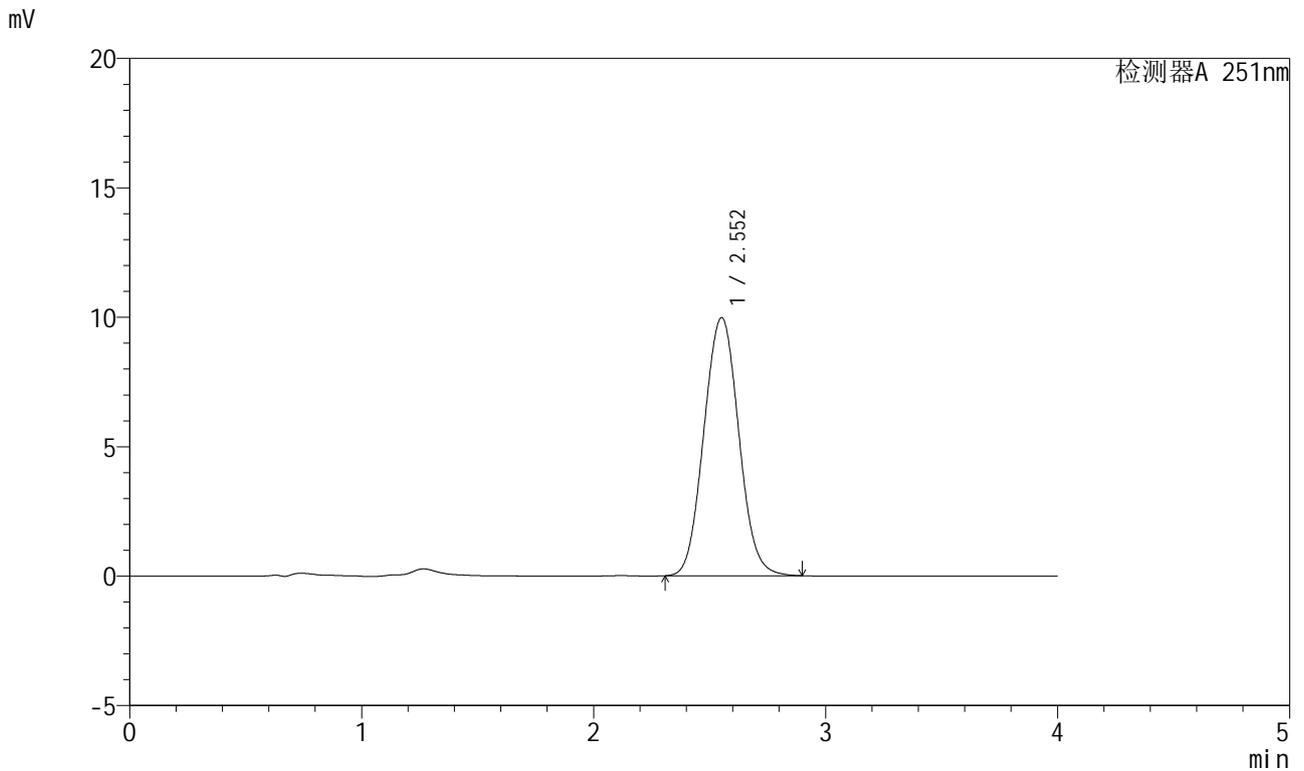

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	104183	100.000	9963	1385	1.055	--
总计		104183	100.000	9963			

图213 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3497-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 01:56:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

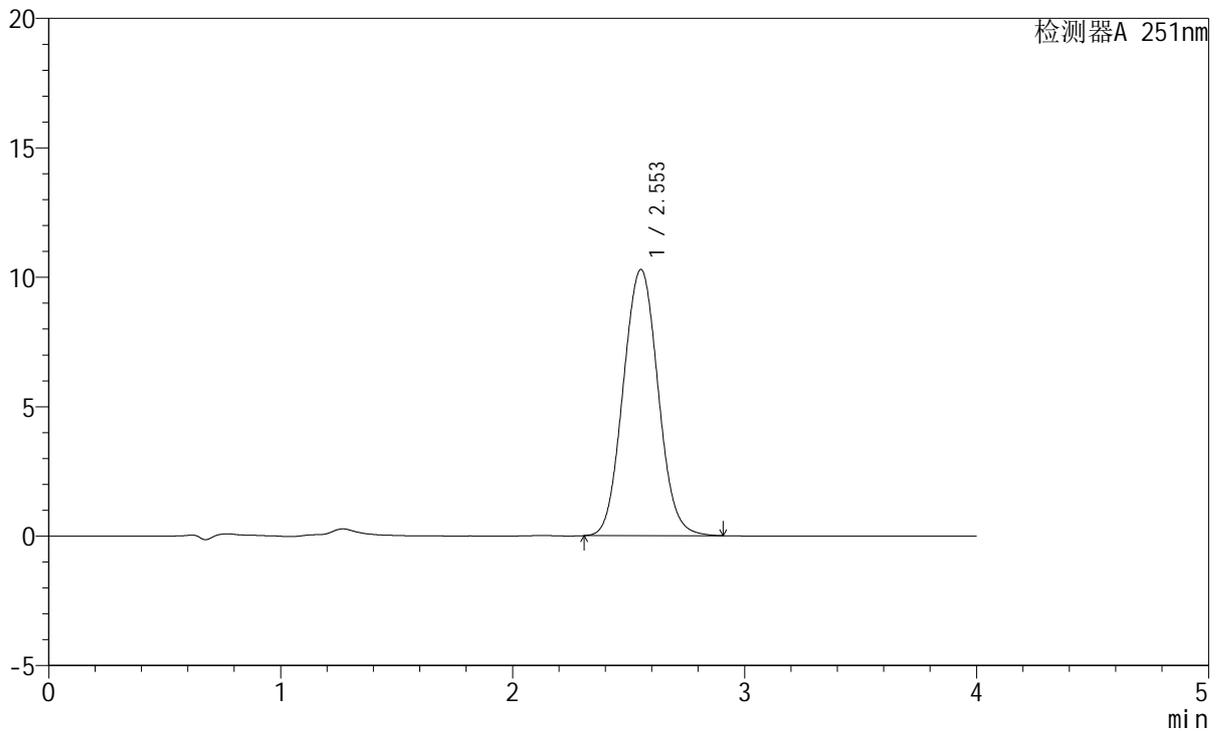

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.553	107392	100.000	10280	1388	1.056	--
总计		107392	100.000	10280			


图214 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3498-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:01:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

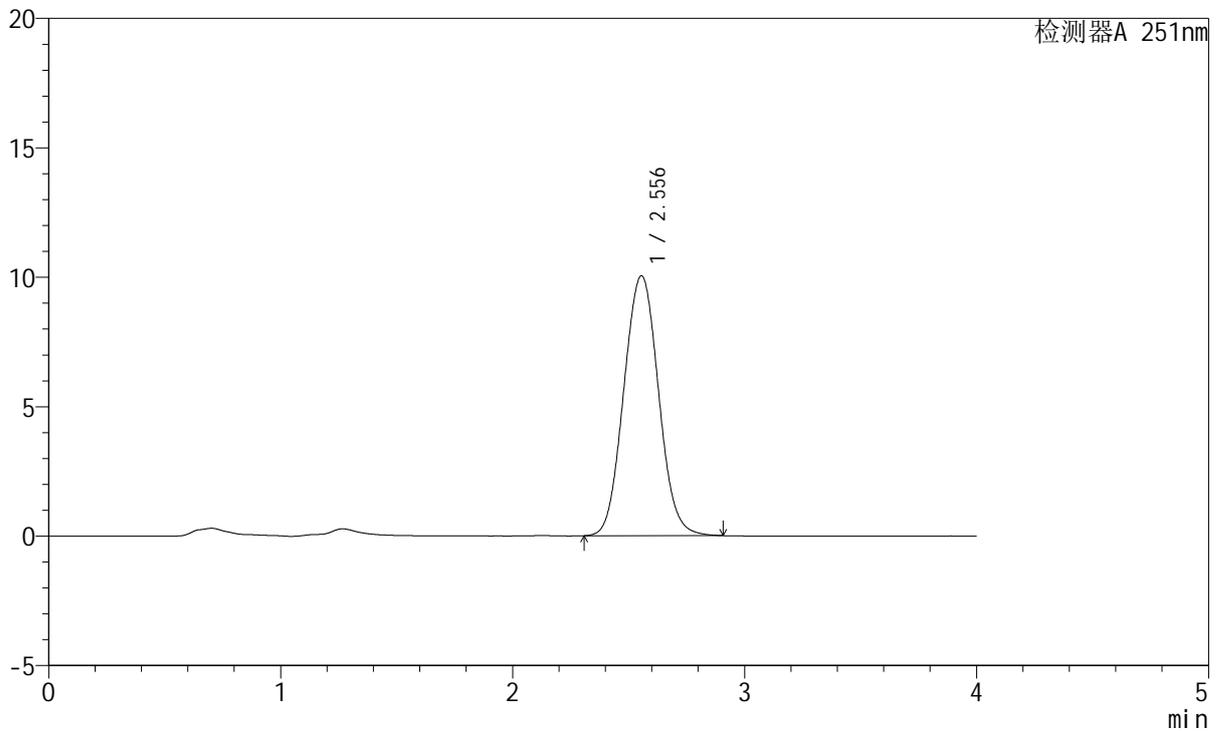

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.556	104500	100.000	10043	1403	1.053	--
总计		104500	100.000	10043			

图215 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3499-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:05:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

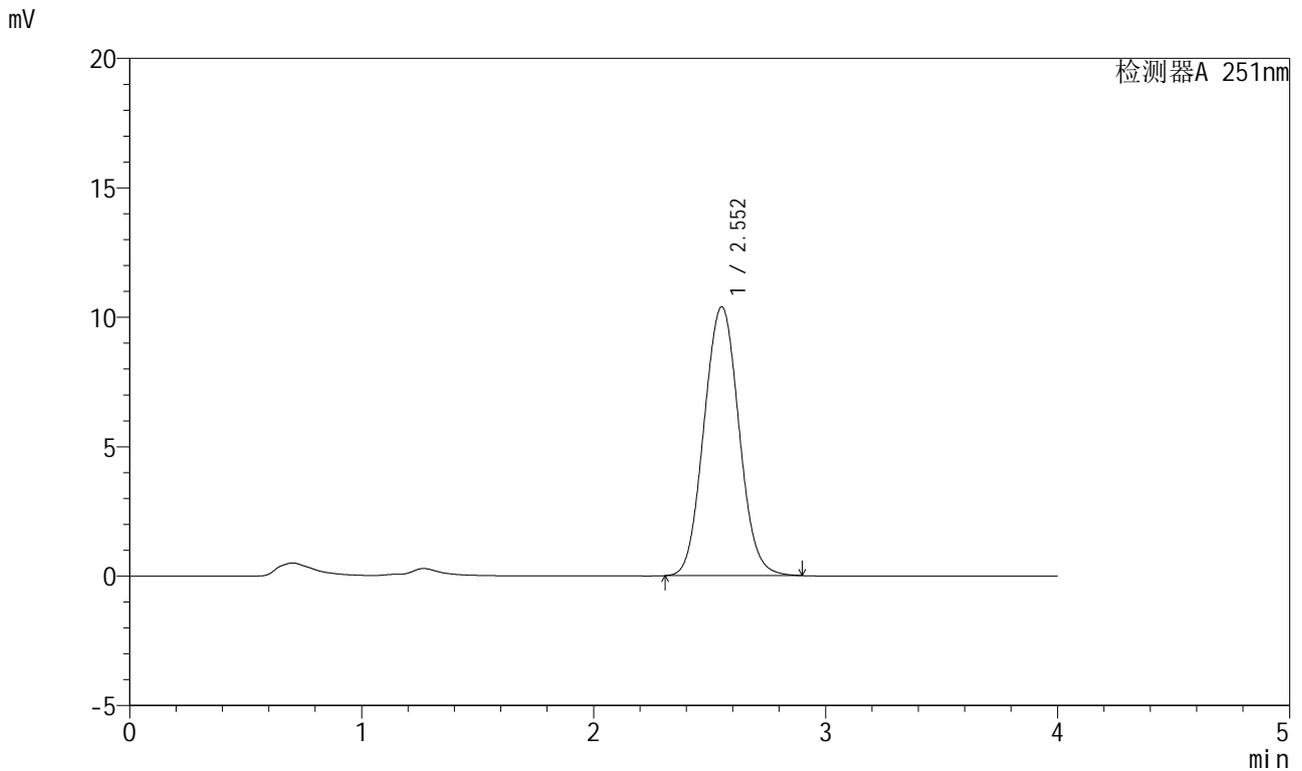

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	108801	100.000	10382	1378	1.055	--
总计		108801	100.000	10382			

图216 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3500-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:10:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

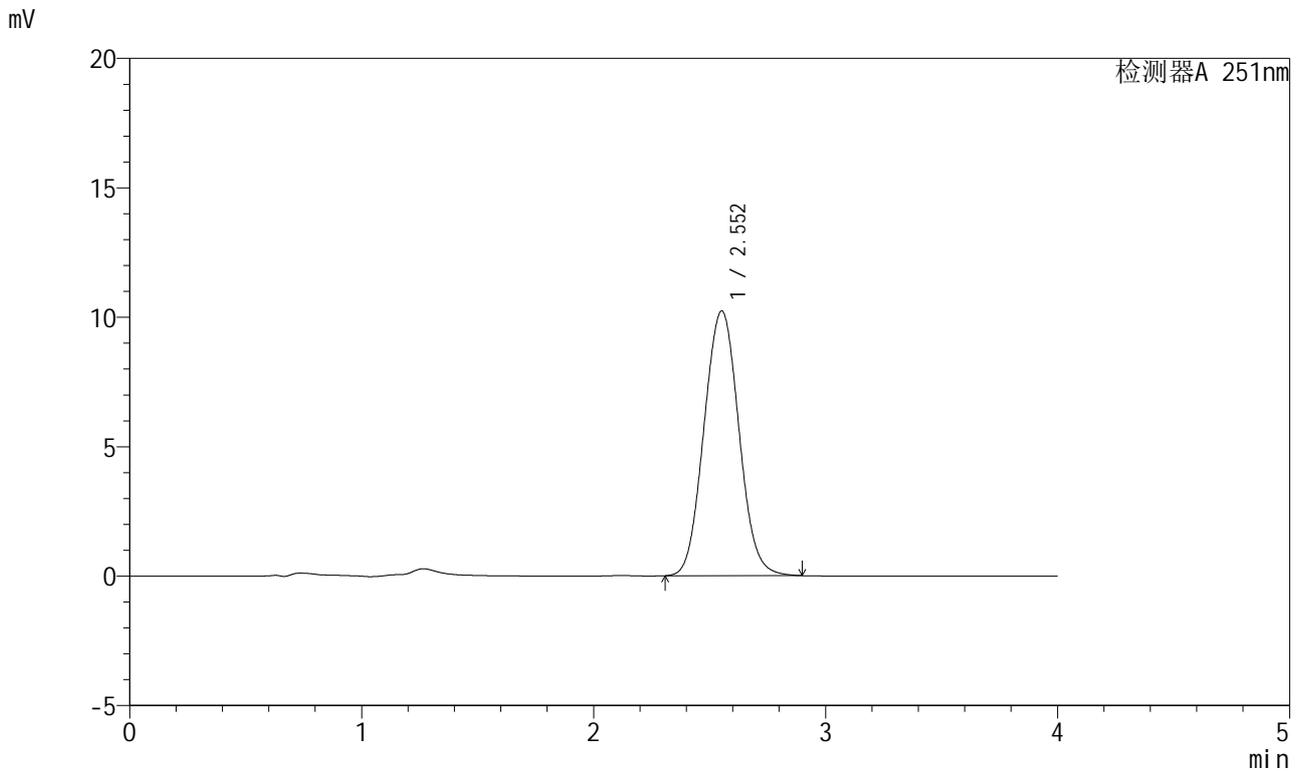

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	106999	100.000	10221	1382	1.054	--
总计		106999	100.000	10221			

图217 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3501-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:14:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

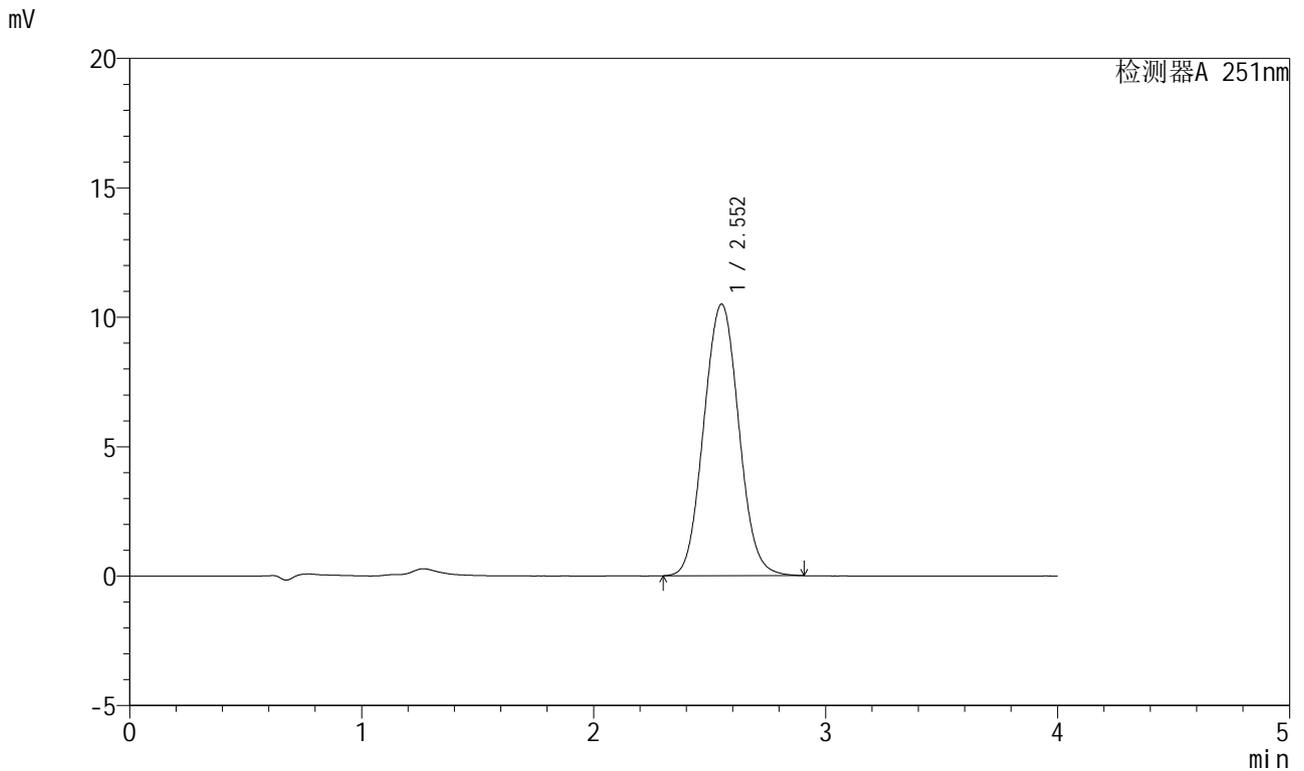

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	110043	100.000	10483	1375	1.055	--
总计		110043	100.000	10483			

图218 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3502-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:19:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:36:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

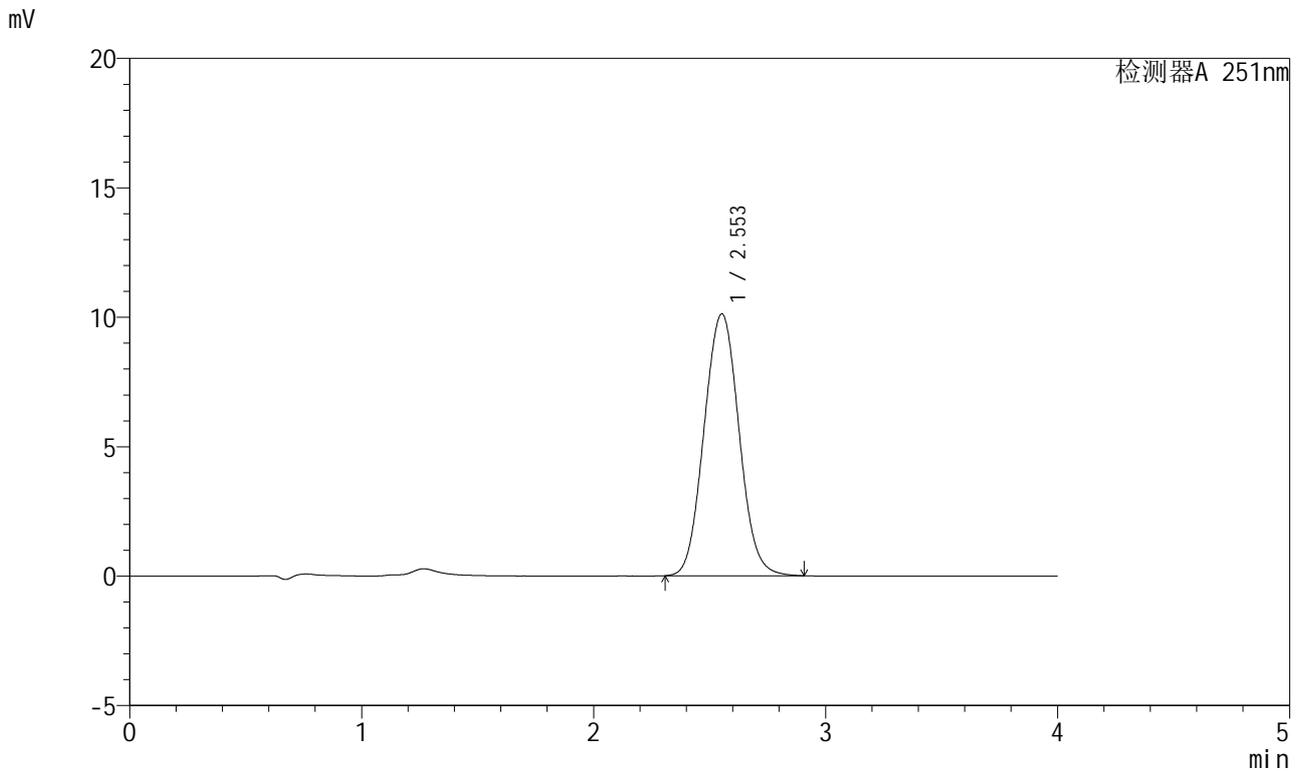

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.553	106098	100.000	10112	1375	1.055	--
总计		106098	100.000	10112			

图219 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3503-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:23:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:37:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

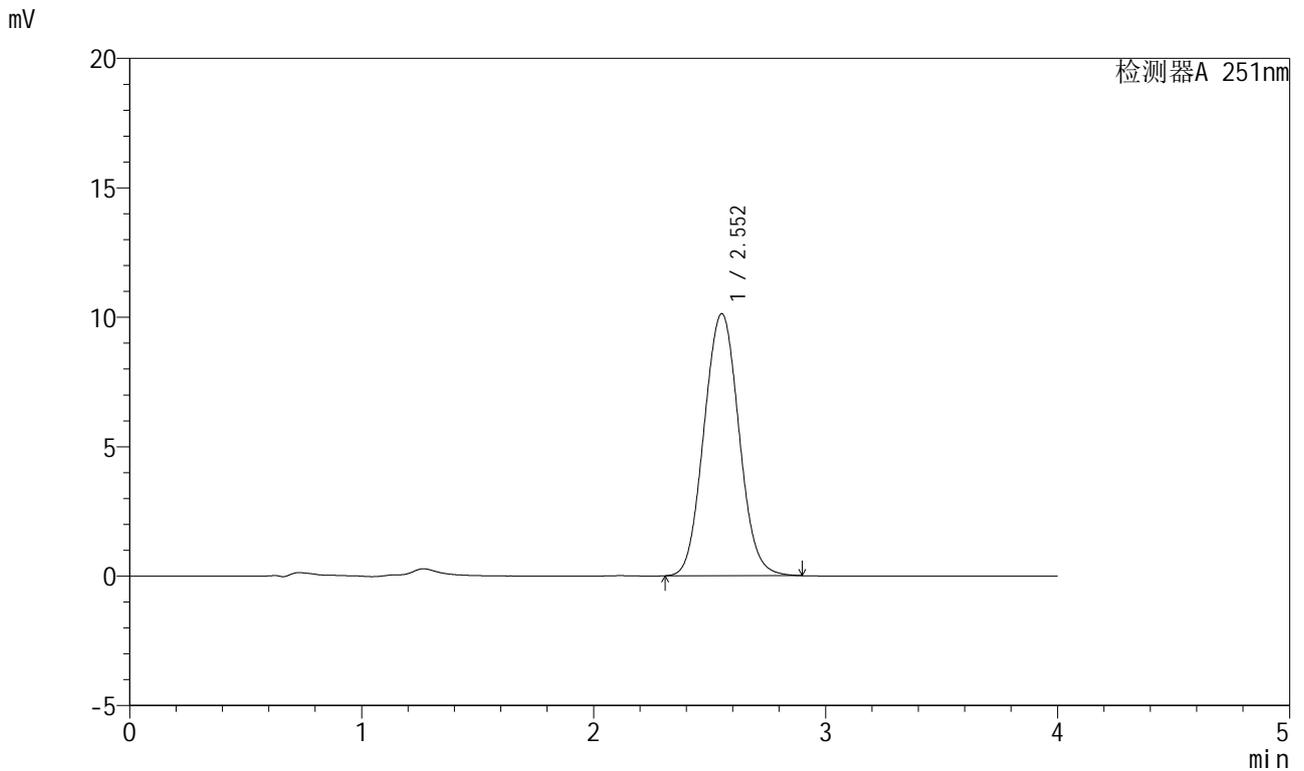

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	105997	100.000	10122	1380	1.055	--
总计		105997	100.000	10122			


图220 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3504-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:27:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:37:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

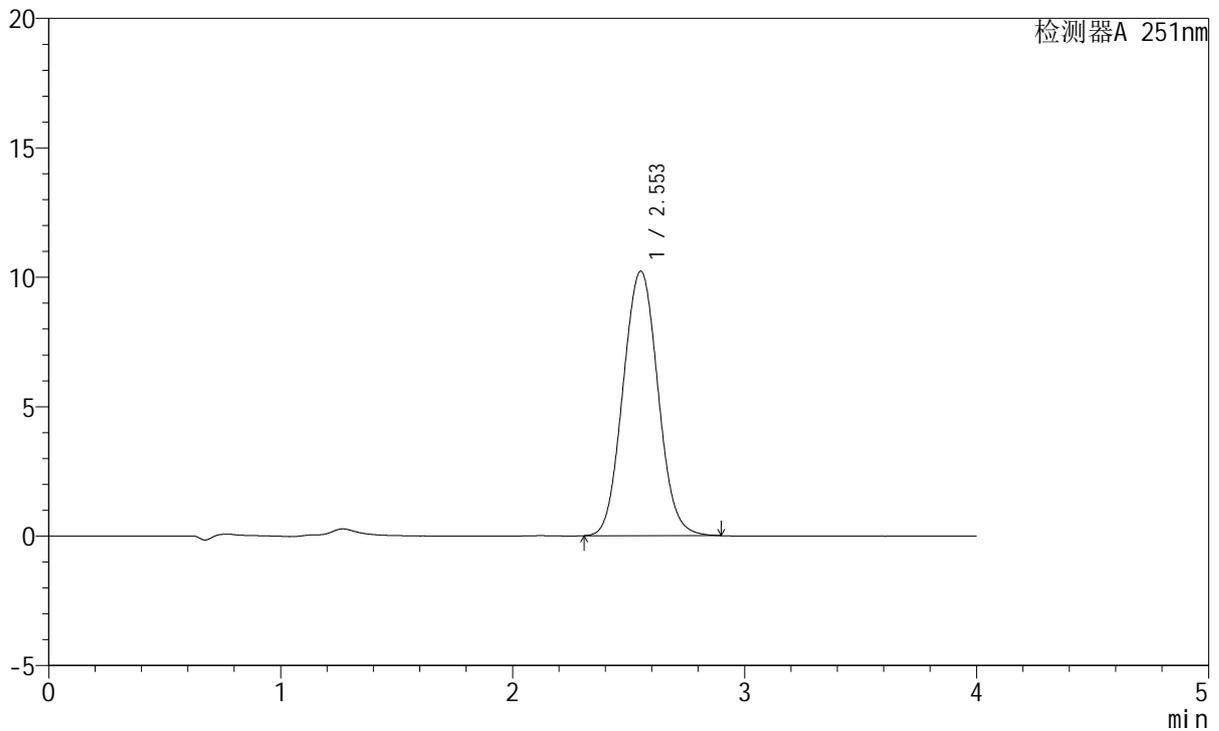

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.553	106980	100.000	10215	1379	1.055	--
总计		106980	100.000	10215			

图221 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3505-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:32:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:37:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

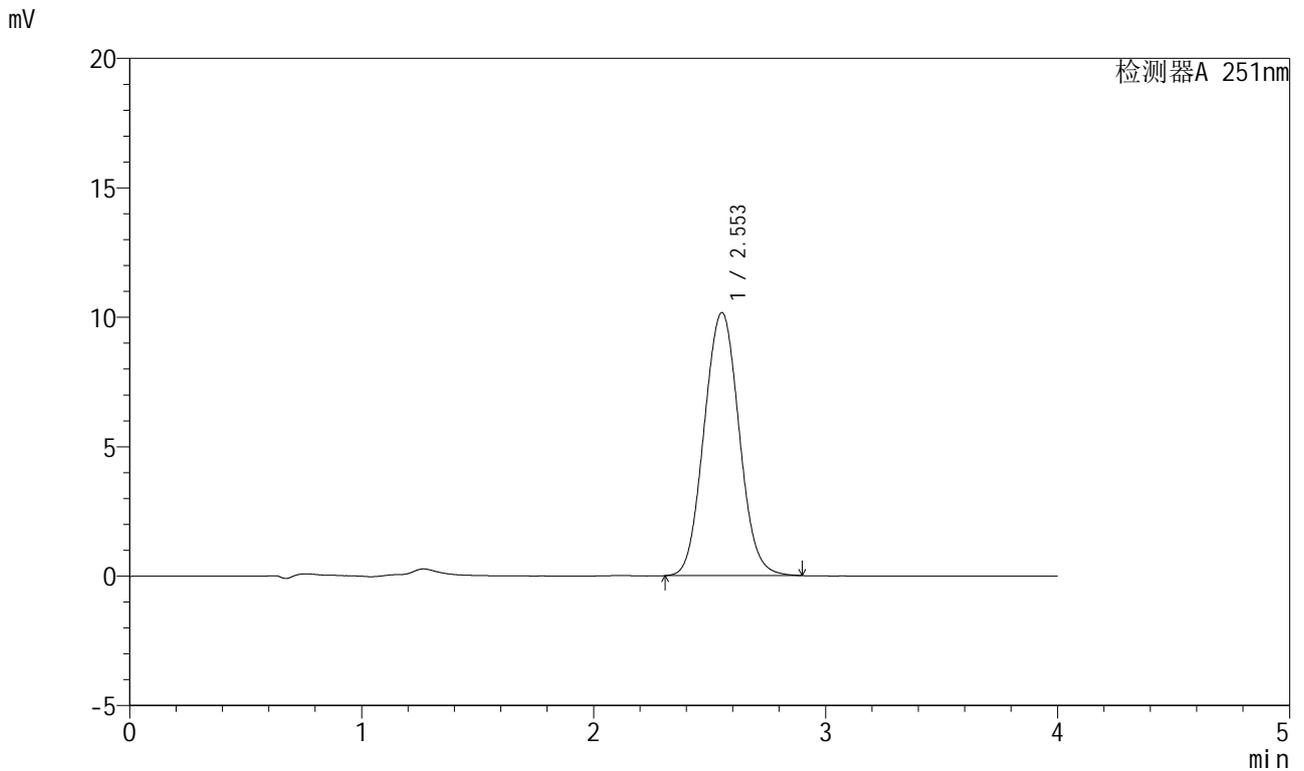

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.553	106407	100.000	10159	1380	1.054	--
总计		106407	100.000	10159			

图222 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3506-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:36:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:37:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

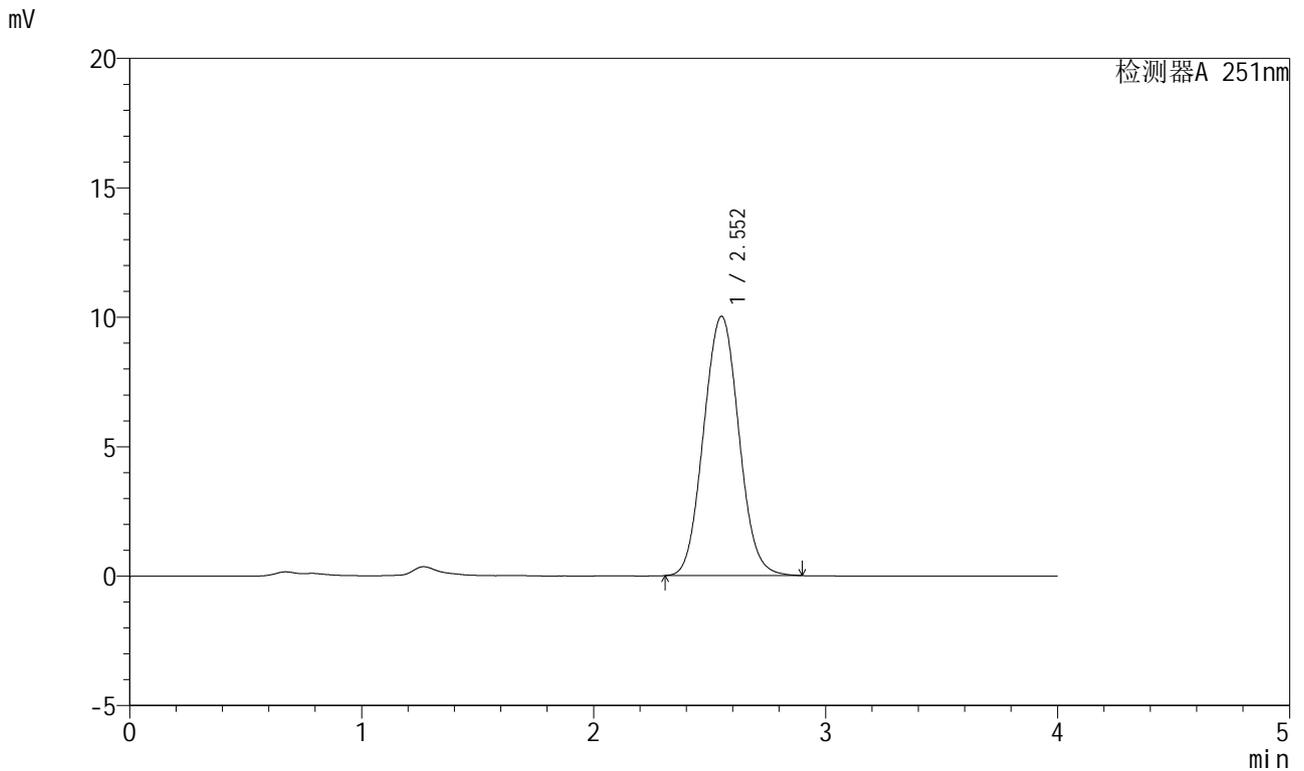

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	105604	100.000	10008	1353	1.053	--
总计		105604	100.000	10008			

图223 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-68/10-3507-2 - cbzj-542916-jyx2-cq6y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240605-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/06/06 02:41:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/06/06 08:37:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

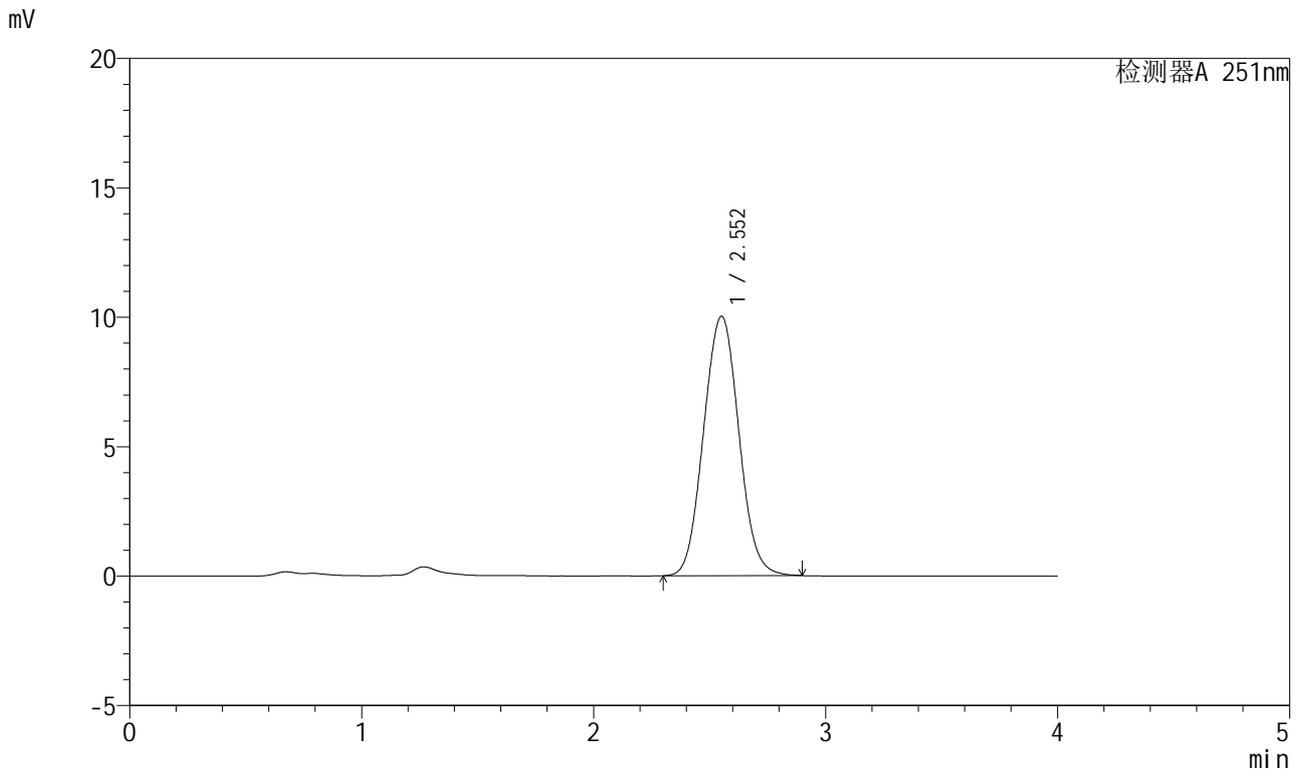

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.552	105782	100.000	10012	1351	1.053	--
总计		105782	100.000	10012			

图224 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2