



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.23	105628	105512	105503	105051	104426	105224	0.48
2	10.19	104649	104736				104692	0.06

单位质量响应值		RSD%	判断
10285.83	10273.99	0.09	数据可信

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

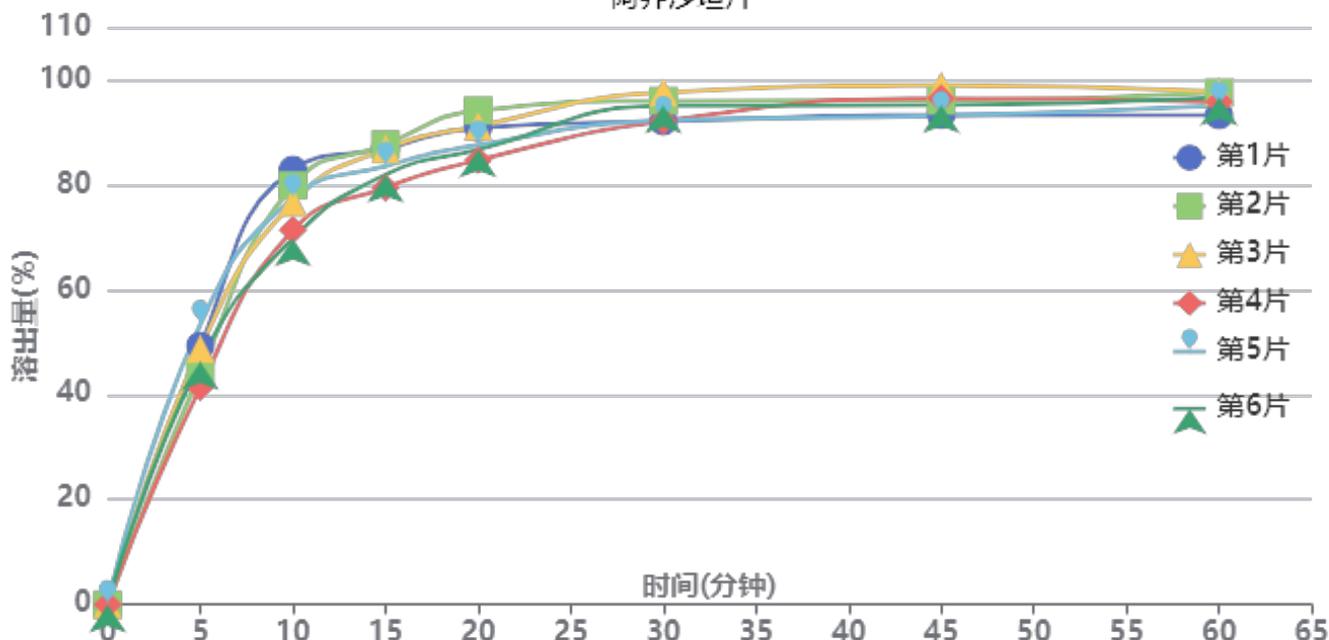

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



长期9月-供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	56473	-	56473	49.293	47.20	8.91	49.29	47.20	8.91
	2	50564	-	50564	44.136			44.14		
	3	55843	-	55843	48.744			48.74		
	4	47469	-	47469	41.434			41.43		
	5	61132	-	61132	53.360			53.36		
	6	52971	-	52971	46.237			46.24		
10min	1	94606	-	94606	82.579	76.05	6.56	82.85	76.31	6.55
	2	91225	-	91225	79.627			79.87		
	3	87490	-	87490	76.367			76.64		
	4	81506	-	81506	71.144			71.37		
	5	88359	-	88359	77.126			77.42		
	6	79582	-	79582	69.465			69.72		
15min	1	98735	-	98735	86.183	83.68	3.91	86.92	84.37	3.91
	2	99622	-	99622	86.957			87.64		
	3	98633	-	98633	86.094			86.79		
	4	90268	-	90268	78.792			79.42		
	5	94860	-	94860	82.800			83.53		
	6	93088	-	93088	81.254			81.90		
20min	1	102707	-	102707	89.650	88.03	3.91	90.86	89.18	3.91
	2	106515	-	106515	92.974			94.14		
	3	103087	-	103087	89.981			91.15		
	4	95778	-	95778	83.602			84.66		
	5	98953	-	98953	86.373			87.56		
	6	98062	-	98062	85.595			86.69		
30min	1	103536	-	103536	90.373	92.54	2.55	92.08	94.18	2.52
	2	108021	-	108021	94.288			95.98		
	3	109900	-	109900	95.928			97.60		
	4	103799	-	103799	90.603			92.13		
	5	103766	-	103766	90.574			92.24		
	6	107102	-	107102	93.486			95.06		
45min	1	104346	-	104346	91.080	93.34	2.32	93.29	95.49	2.26
	2	107458	-	107458	93.797			96.01		
	3	110769	-	110769	96.687			98.89		
	4	108184	-	108184	94.430			96.46		
	5	104235	-	104235	90.983			93.15		
	6	106613	-	106613	93.059			95.15		
60min	1	103719	-	103719	90.533	93.32	1.81	93.25	95.99	1.77
	2	108631	-	108631	94.821			97.55		
	3	108833	-	108833	94.997			97.74		
	4	106804	-	106804	93.226			95.78		
	5	105806	-	105806	92.355			95.03		
	6	107682	-	107682	93.992			96.60		
极限	1	107944	-	107944	94.221	95.78	1.21	97.44	98.98	1.14
	2	109282	-	109282	95.389			98.65		
	3	108950	-	108950	95.099			98.37		
	4	109694	-	109694	95.748			98.82		
	5	111322	-	111322	97.169			100.36		
	6	111218	-	111218	97.079			100.21		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.23	104922	104957	104874	104992	104829	104915	0.07
2	10.19	104990	105052				105021	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
10255.62		10306.28		0.35	数据可信			

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

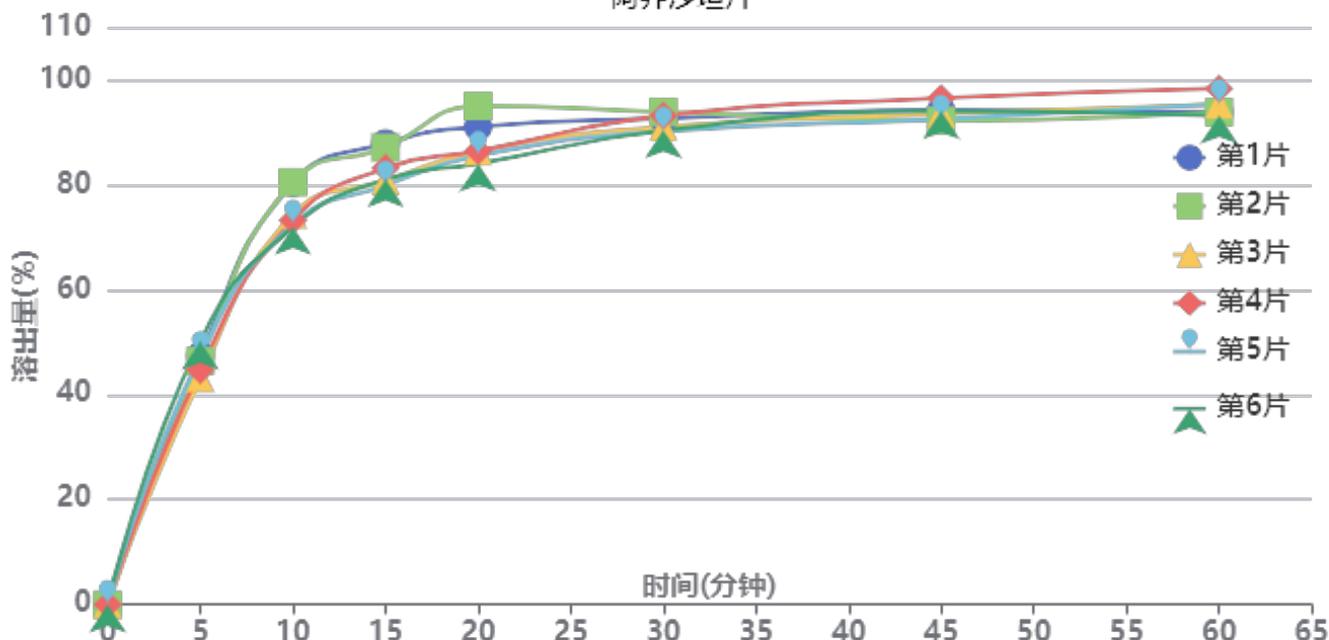

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



长期9月-供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	54266	-	54266	47.363	46.52	5.22	47.36	46.52	5.22
	2	53164	-	53164	46.401			46.40		
	3	49444	-	49444	43.154			43.15		
	4	51167	-	51167	44.658			44.66		
	5	54307	-	54307	47.398			47.40		
	6	57453	-	57453	50.144			50.14		
10min	1	91791	-	91791	80.114	75.20	5.23	80.38	75.46	5.21
	2	91901	-	91901	80.210			80.47		
	3	84876	-	84876	74.078			74.32		
	4	83606	-	83606	72.970			73.22		
	5	82705	-	82705	72.184			72.45		
	6	82102	-	82102	71.657			71.94		
15min	1	99884	-	99884	87.177	82.61	4.14	87.89	83.29	4.13
	2	98964	-	98964	86.374			87.08		
	3	91740	-	91740	80.069			80.72		
	4	94520	-	94520	82.496			83.15		
	5	90751	-	90751	79.206			79.87		
	6	92048	-	92048	80.338			81.01		
20min	1	102929	-	102929	89.835	86.92	4.71	91.03	88.05	4.69
	2	107473	-	107473	93.801			94.98		
	3	97706	-	97706	85.276			86.37		
	4	97712	-	97712	85.282			86.39		
	5	96767	-	96767	84.457			85.56		
	6	94938	-	94938	82.860			83.98		
30min	1	104177	-	104177	90.924	90.24	1.69	92.62	91.86	1.71
	2	105602	-	105602	92.168			93.87		
	3	102480	-	102480	89.443			91.01		
	4	104913	-	104913	91.566			93.15		
	5	101510	-	101510	88.596			90.17		
	6	101683	-	101683	88.747			90.33		
45min	1	105396	-	105396	91.988	91.68	1.71	94.18	93.80	1.65
	2	103113	-	103113	89.995			92.21		
	3	104746	-	104746	91.421			93.49		
	4	108159	-	108159	94.399			96.49		
	5	103546	-	103546	90.373			92.44		
	6	105317	-	105317	91.919			94.00		
60min	1	104442	-	104442	91.155	92.34	2.04	93.86	94.97	1.96
	2	104383	-	104383	91.104			93.82		
	3	106228	-	106228	92.714			95.29		
	4	109644	-	109644	95.696			98.31		
	5	106306	-	106306	92.782			95.35		
	6	103801	-	103801	90.596			93.18		
极限	1	109436	-	109436	95.514	93.69	1.54	98.73	96.83	1.50
	2	106512	-	106512	92.962			96.18		
	3	108619	-	108619	94.801			97.89		
	4	105093	-	105093	91.724			94.87		
	5	106271	-	106271	92.752			95.83		
	6	108147	-	108147	94.389			97.48		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.23	105108	105075	104973	104959	104980	105019	0.07
2	10.19	103490	103480				103485	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
10265.79		10155.54		0.77	数据可信			

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

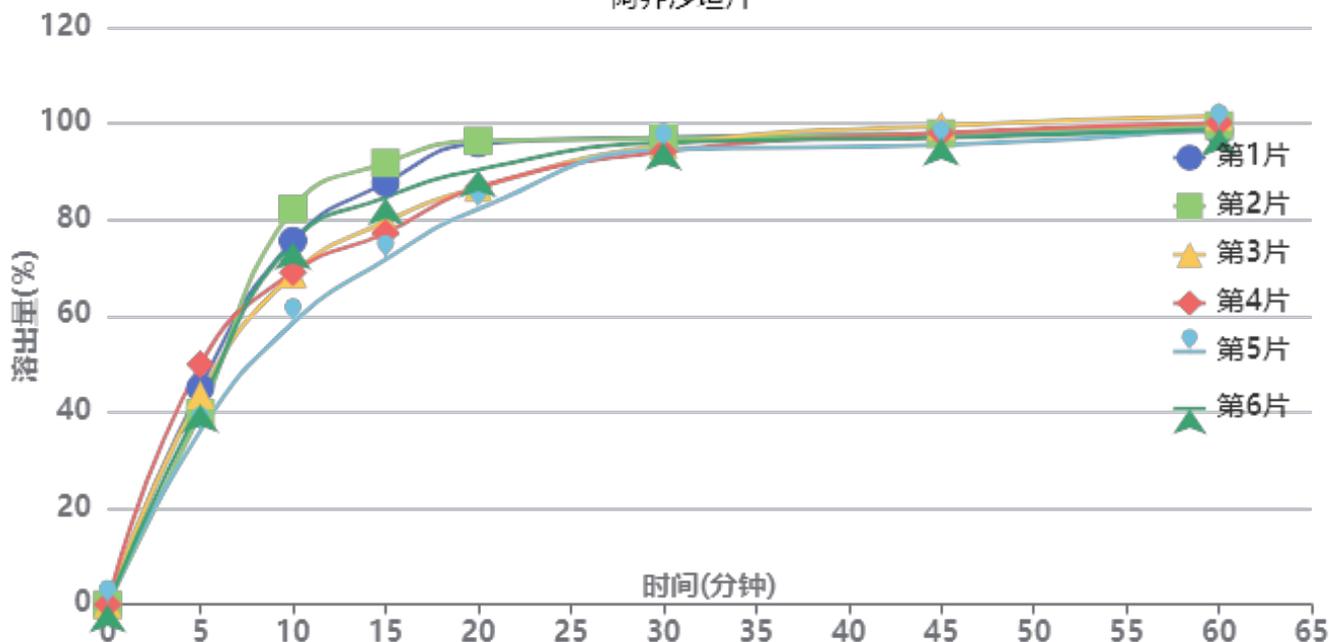

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



中间条件9月-供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	51265	-	51265	45.052	42.66	11.12	45.05	42.66	11.12
	2	45275	-	45275	39.788			39.79		
	3	49553	-	49553	43.548			43.55		
	4	56818	-	56818	49.932			49.93		
	5	41035	-	41035	36.062			36.06		
	6	47297	-	47297	41.565			41.57		
10min	1	85749	-	85749	75.357	71.32	11.38	75.61	71.56	11.35
	2	93339	-	93339	82.027			82.25		
	3	77807	-	77807	68.378			68.62		
	4	78232	-	78232	68.751			69.03		
	5	66375	-	66375	58.331			58.53		
	6	85457	-	85457	75.101			75.33		
15min	1	99002	-	99002	87.004	81.47	8.95	87.67	82.10	8.93
	2	103663	-	103663	91.100			91.78		
	3	89846	-	89846	78.958			79.58		
	4	87111	-	87111	76.554			77.21		
	5	81035	-	81035	71.215			71.74		
	6	95551	-	95551	83.971			84.62		
20min	1	107767	-	107767	94.707	88.62	6.23	95.86	89.71	6.25
	2	108327	-	108327	95.199			96.38		
	3	97410	-	97410	85.605			86.67		
	4	97463	-	97463	85.652			86.74		
	5	92504	-	92504	81.294			82.21		
	6	101593	-	101593	89.281			90.40		
30min	1	108553	-	108553	95.398	94.13	1.18	97.08	95.71	1.26
	2	108317	-	108317	95.190			96.90		
	3	106928	-	106928	93.970			95.51		
	4	105323	-	105323	92.559			94.12		
	5	106089	-	106089	93.232			94.60		
	6	107452	-	107452	94.430			96.04		
45min	1	108823	-	108823	95.635	95.55	1.33	97.84	97.64	1.36
	2	108873	-	108873	95.679			97.92		
	3	110930	-	110930	97.487			99.54		
	4	109188	-	109188	95.956			98.03		
	5	106536	-	106536	93.625			95.51		
	6	107985	-	107985	94.899			97.03		
60min	1	108787	-	108787	95.603	96.93	1.19	98.34	99.56	1.13
	2	110161	-	110161	96.811			99.58		
	3	112505	-	112505	98.871			101.47		
	4	110989	-	110989	97.539			100.15		
	5	109838	-	109838	96.527			98.94		
	6	109495	-	109495	96.226			98.89		
极限	1	109478	-	109478	96.211	96.44	0.99	99.48	99.61	0.92
	2	108139	-	108139	95.034			98.34		
	3	109682	-	109682	96.390			99.54		
	4	111509	-	111509	97.996			101.15		
	5	109611	-	109611	96.328			99.27		
	6	109994	-	109994	96.664			99.86		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.23	103507	103410	103430	103291	103387	103405	0.08
2	10.19	104933	105014				104974	0.06
单位质量响应值			RSD%		判断			
10108.02		10301.67		1.35		数据可信		

溶出曲线测定

阿齐沙坦片

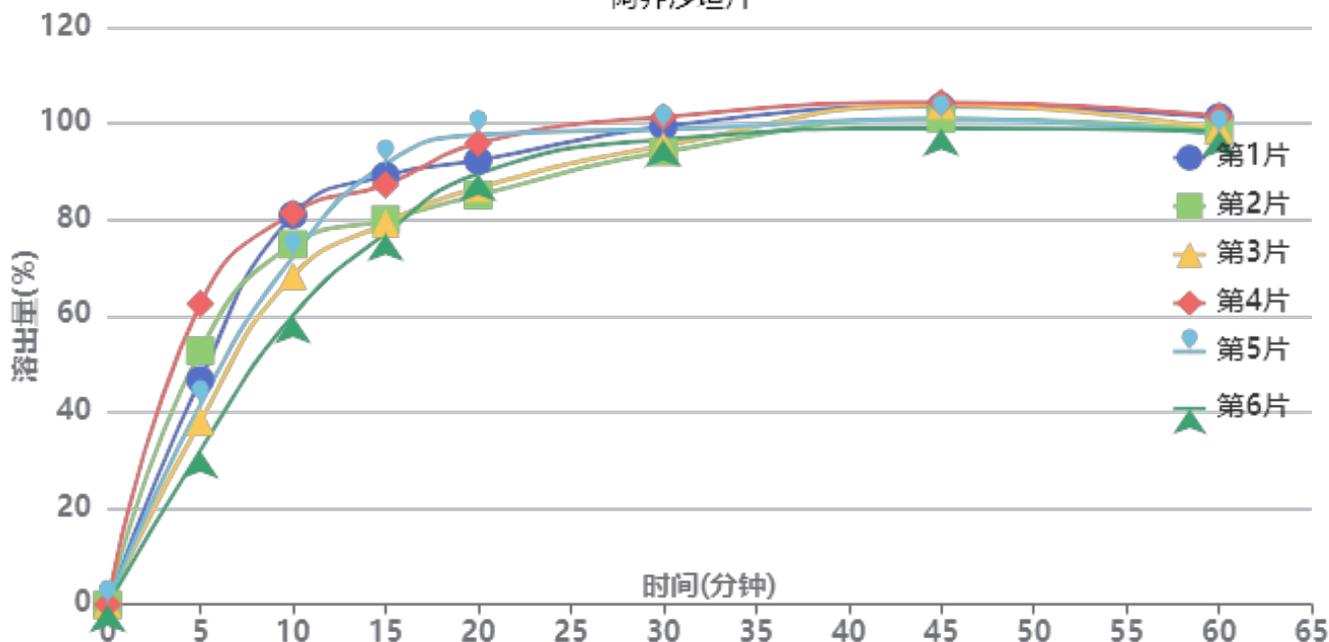

操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本



中间条件9月-供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	53102	-	53102	46.696	45.59	23.96	46.70	45.59	23.97
	2	59984	-	59984	52.748			52.75		
	3	43269	-	43269	38.049			38.05		
	4	71080	-	71080	62.505			62.51		
	5	47266	-	47266	41.564			41.56		
	6	36378	-	36378	31.990			31.99		
10min	1	91761	-	91761	80.692	72.71	11.05	80.95	72.96	11.08
	2	84809	-	84809	74.578			74.87		
	3	77426	-	77426	68.086			68.30		
	4	92138	-	92138	81.023			81.37		
	5	81858	-	81858	71.983			72.21		
	6	68108	-	68108	59.892			60.07		
15min	1	100599	-	100599	88.464	83.40	7.14	89.17	84.06	7.15
	2	90178	-	90178	79.300			80.01		
	3	89411	-	89411	78.625			79.21		
	4	98300	-	98300	86.442			87.24		
	5	103403	-	103403	90.929			91.56		
	6	87136	-	87136	76.625			77.14		
20min	1	103623	-	103623	91.123	90.07	5.51	92.32	91.19	5.51
	2	95465	-	95465	83.949			85.10		
	3	97337	-	97337	85.595			86.62		
	4	107606	-	107606	94.625			95.90		
	5	109750	-	109750	96.511			97.65		
	6	100760	-	100760	88.605			89.54		
30min	1	111067	-	111067	97.669	95.98	2.73	99.37	97.60	2.79
	2	105170	-	105170	92.483			94.10		
	3	106750	-	106750	93.872			95.37		
	4	113225	-	113225	99.566			101.37		
	5	110414	-	110414	97.094			98.77		
	6	108286	-	108286	95.223			96.65		
45min	1	115179	-	115179	101.285	99.94	2.04	103.53	102.10	2.08
	2	112418	-	112418	98.857			100.98		
	3	115775	-	115775	101.809			103.83		
	4	116003	-	116003	102.009			104.37		
	5	112159	-	112159	98.629			100.84		
	6	110386	-	110386	97.070			99.03		
60min	1	112012	-	112012	98.500	96.72	1.54	101.31	99.42	1.60
	2	109128	-	109128	95.964			98.64		
	3	109471	-	109471	96.265			98.85		
	4	112128	-	112128	98.602			101.52		
	5	108022	-	108022	94.991			97.75		
	6	109152	-	109152	95.985			98.48		
极限	1	109966	-	109966	96.701	97.35	1.67	100.06	100.59	1.71
	2	109686	-	109686	96.454			99.66		
	3	111492	-	111492	98.042			101.17		
	4	111766	-	111766	98.283			101.75		
	5	113258	-	113258	99.595			102.88		
	6	108029	-	108029	94.997			98.03		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-08-30

复核者:

未审阅版本




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3522-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 14:33:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

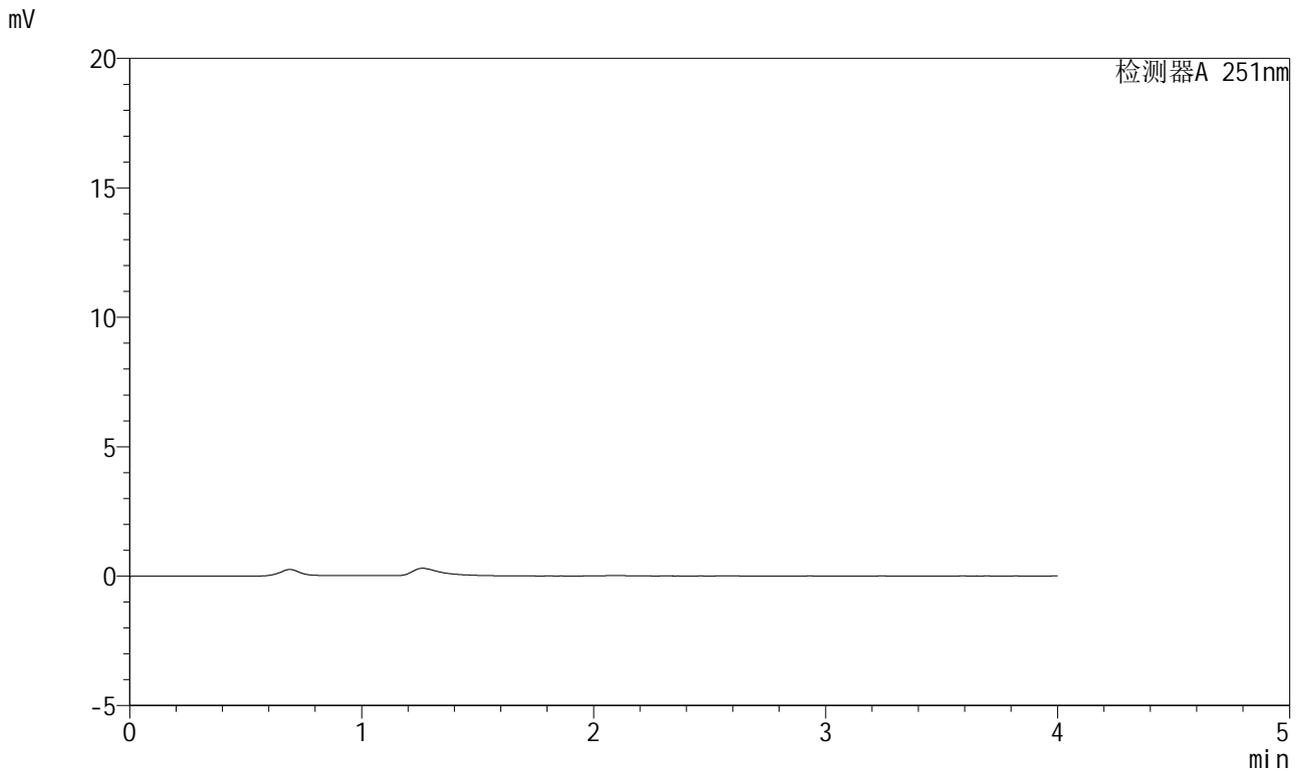

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3523-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 14:38:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

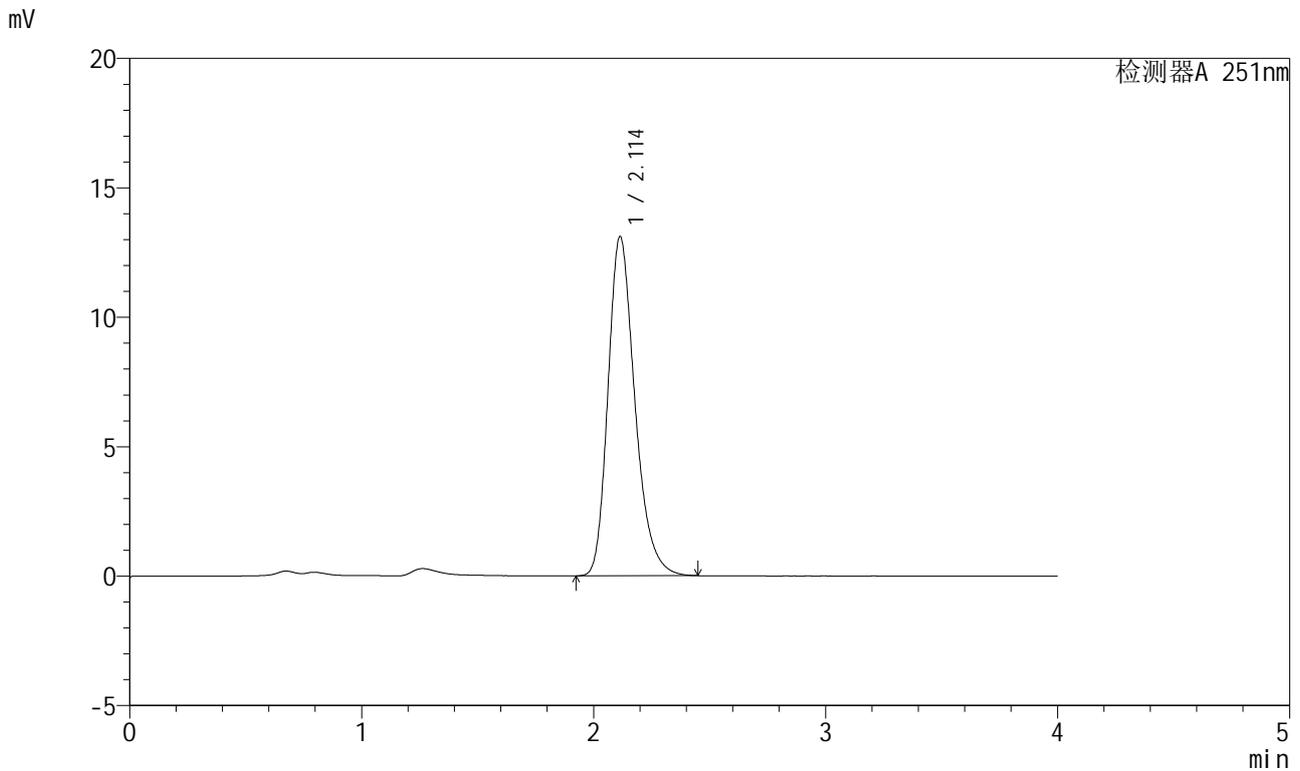

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	105628	100.000	13111	1650	1.263	--
总计		105628	100.000	13111			

图2 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3524-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 14:42:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

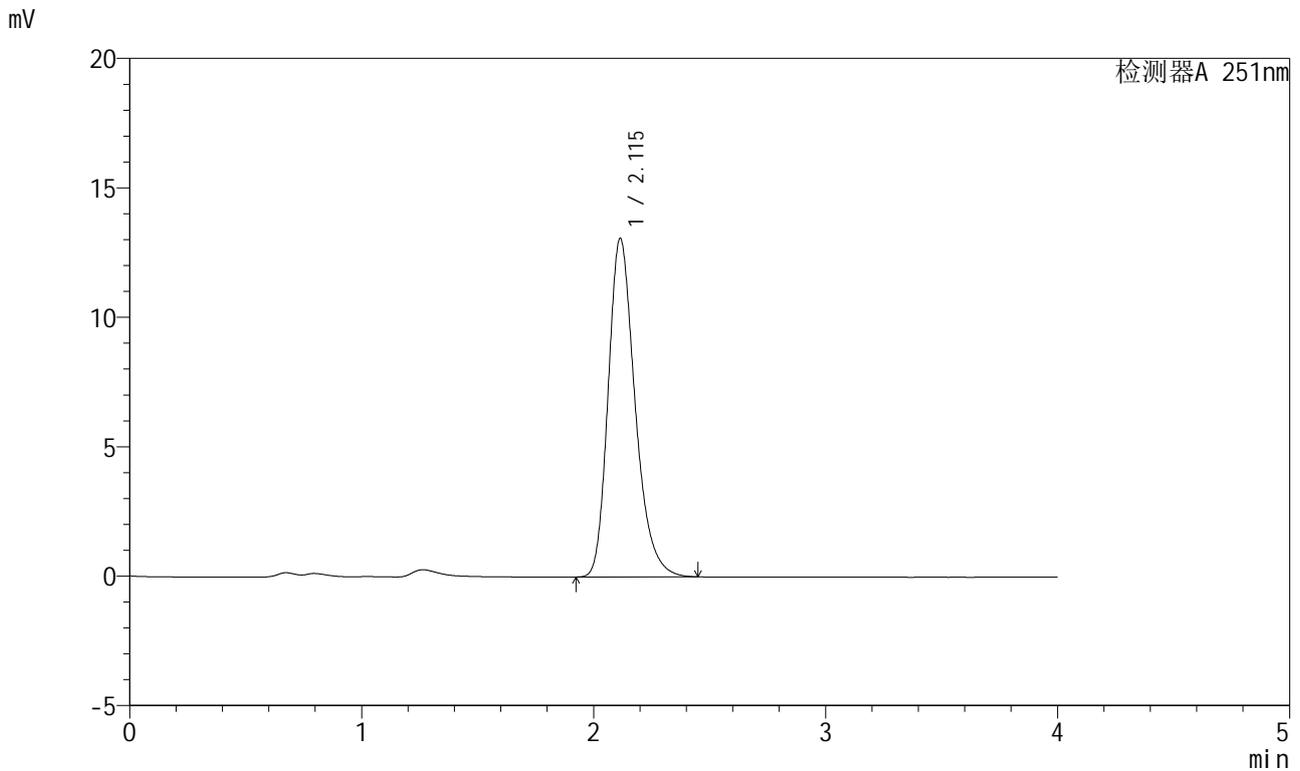

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	105512	100.000	13077	1649	1.266	--
总计		105512	100.000	13077			

图3 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3525-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 14:46:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

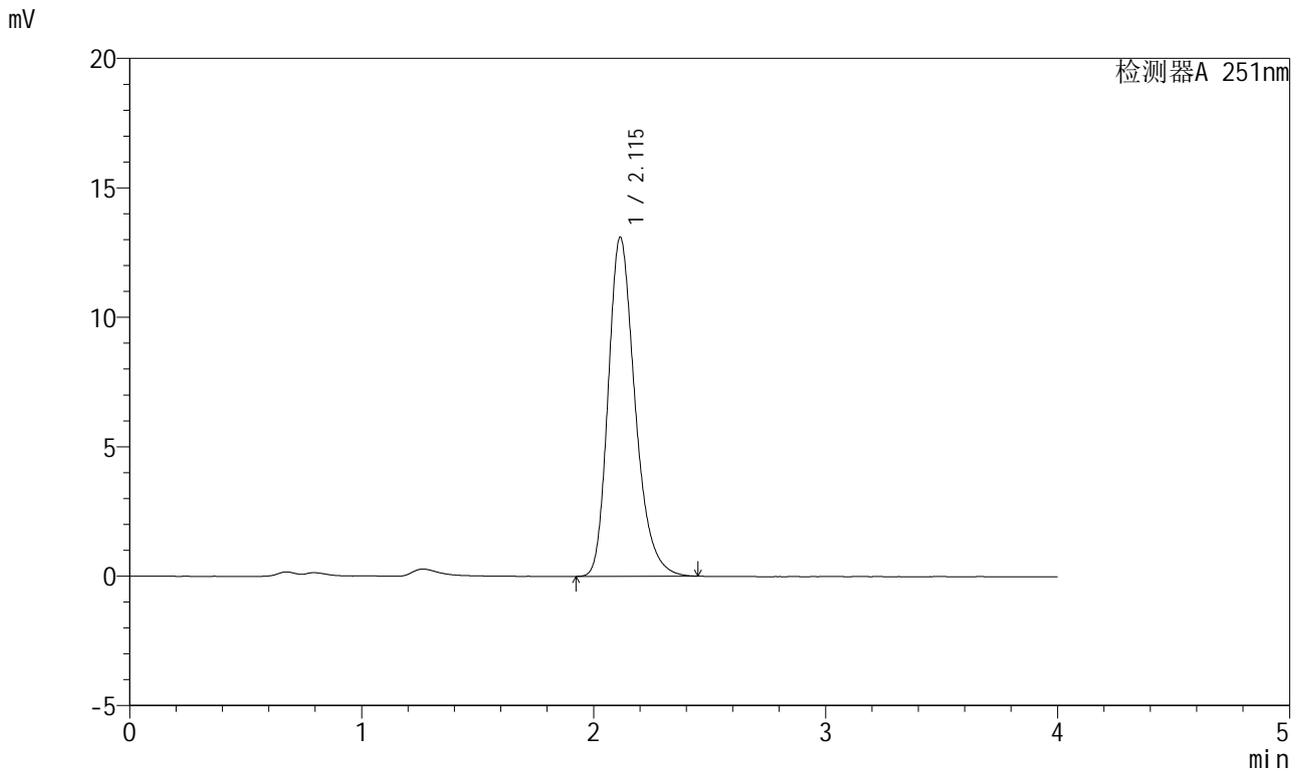

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	105503	100.000	13097	1658	1.267	--
总计		105503	100.000	13097			


图4 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3526-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 14:51:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

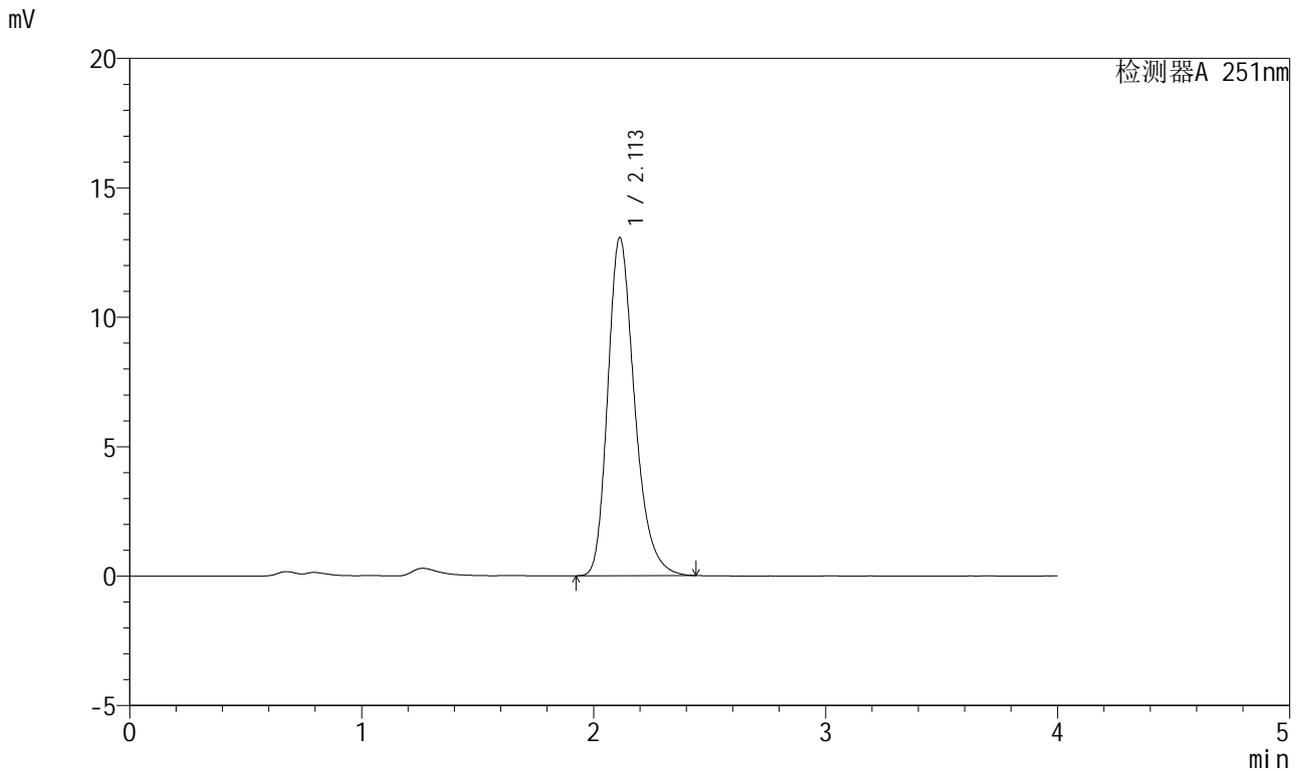

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	105051	100.000	13069	1662	1.269	--
总计		105051	100.000	13069			

图5 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3527-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 14:55:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

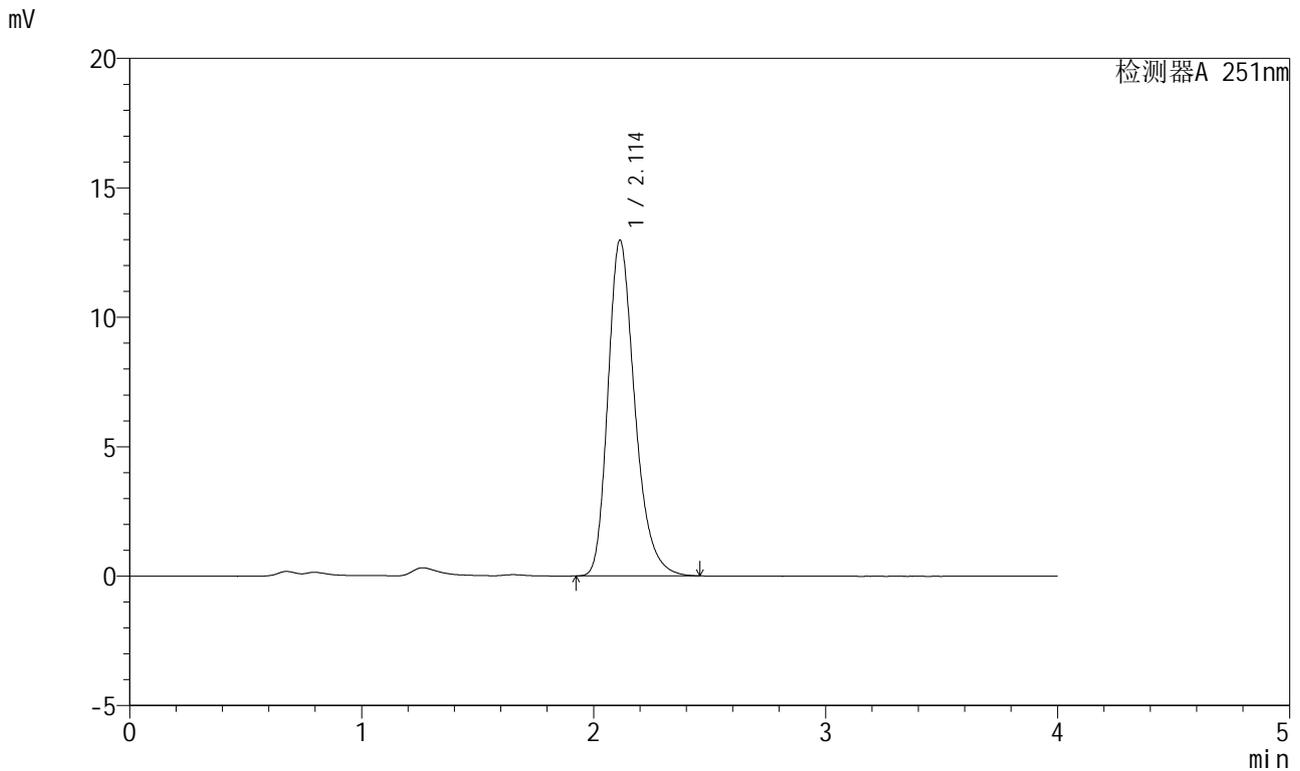

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	104426	100.000	12975	1661	1.273	--
总计		104426	100.000	12975			

图6 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3528-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:00:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

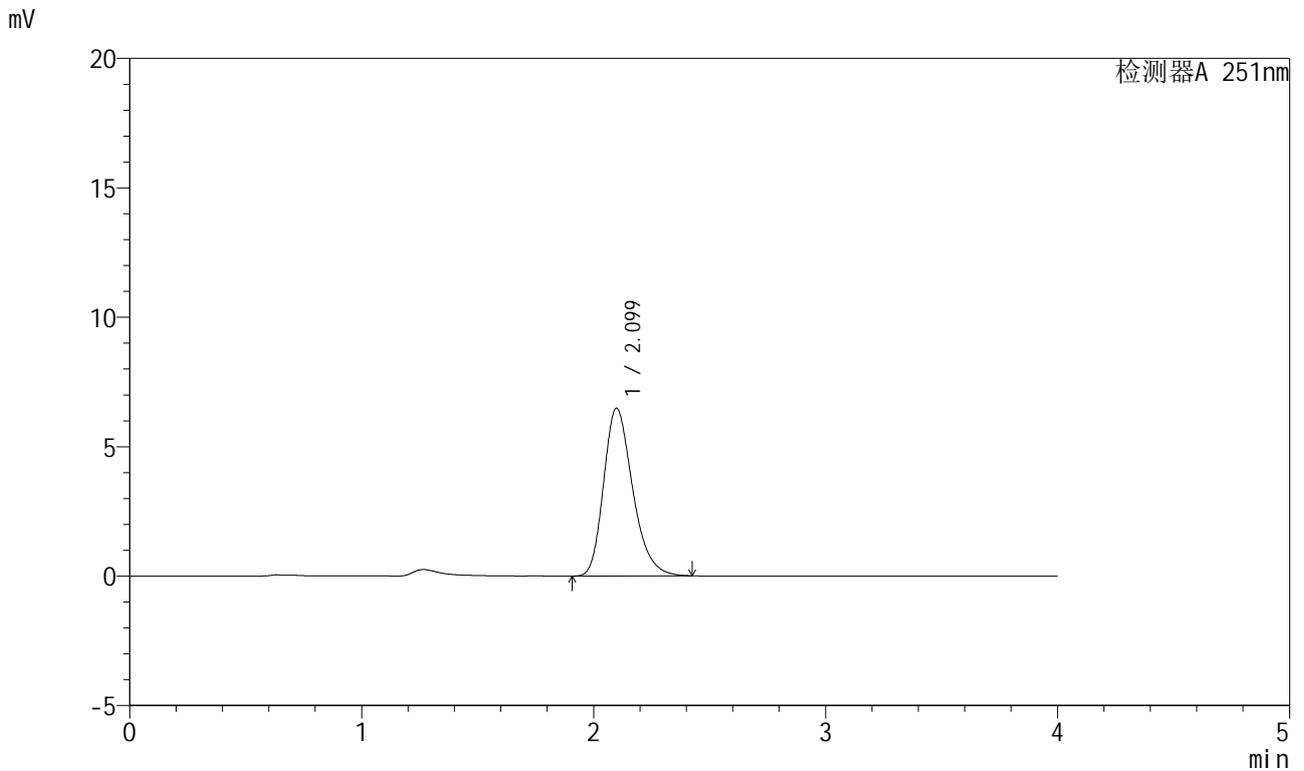

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	56473	100.000	6478	1378	1.269	--
总计		56473	100.000	6478			

图7 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3529-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:04:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

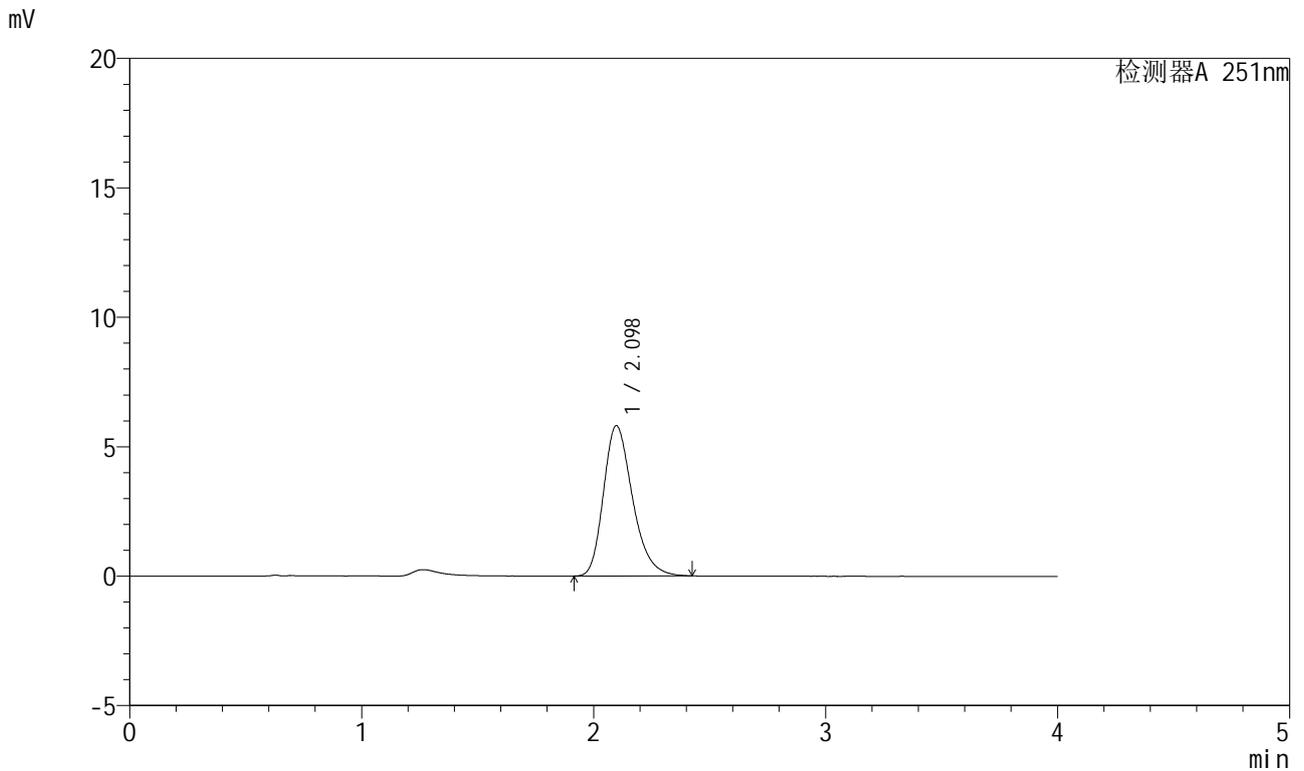

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	50564	100.000	5806	1381	1.273	--
总计		50564	100.000	5806			

图8 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3530-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:08:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

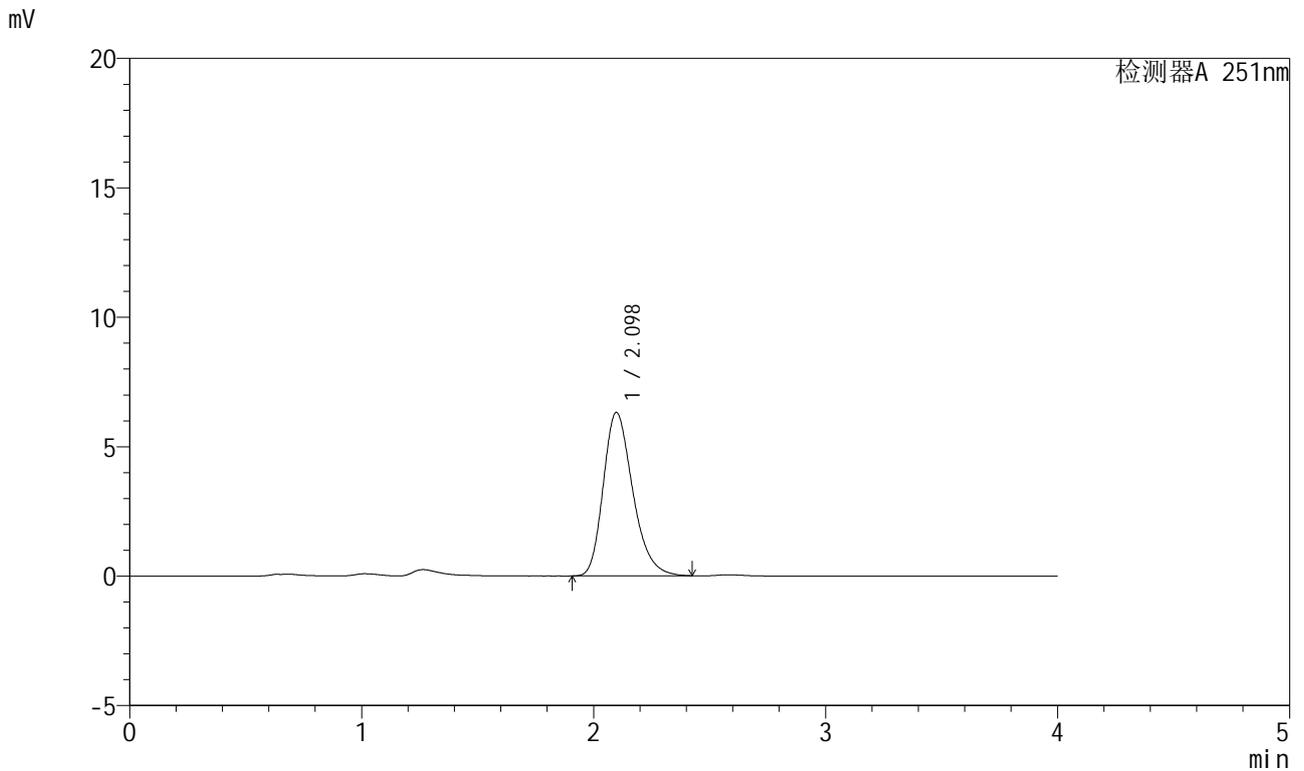

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	55843	100.000	6315	1332	1.270	--
总计		55843	100.000	6315			

图9 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3531-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:13:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

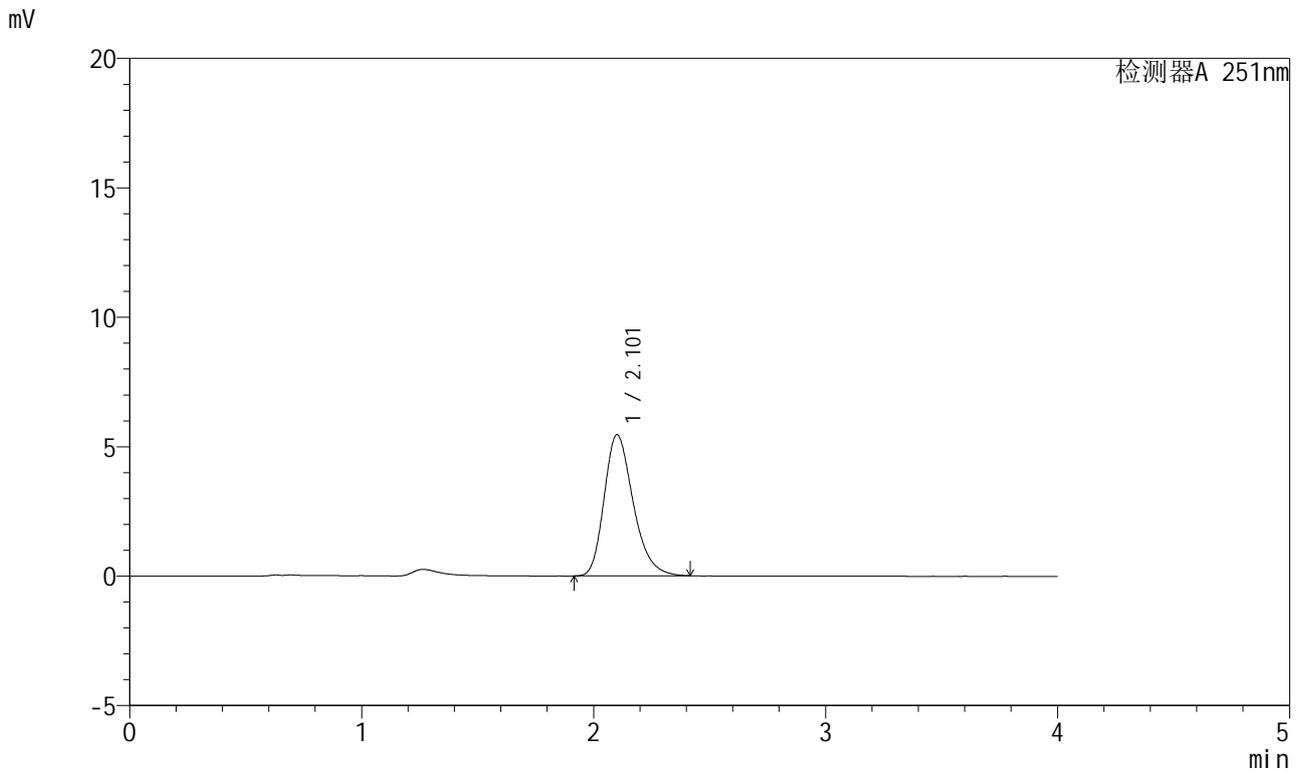

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	47469	100.000	5442	1383	1.271	--
总计		47469	100.000	5442			


图10 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3532-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:17:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

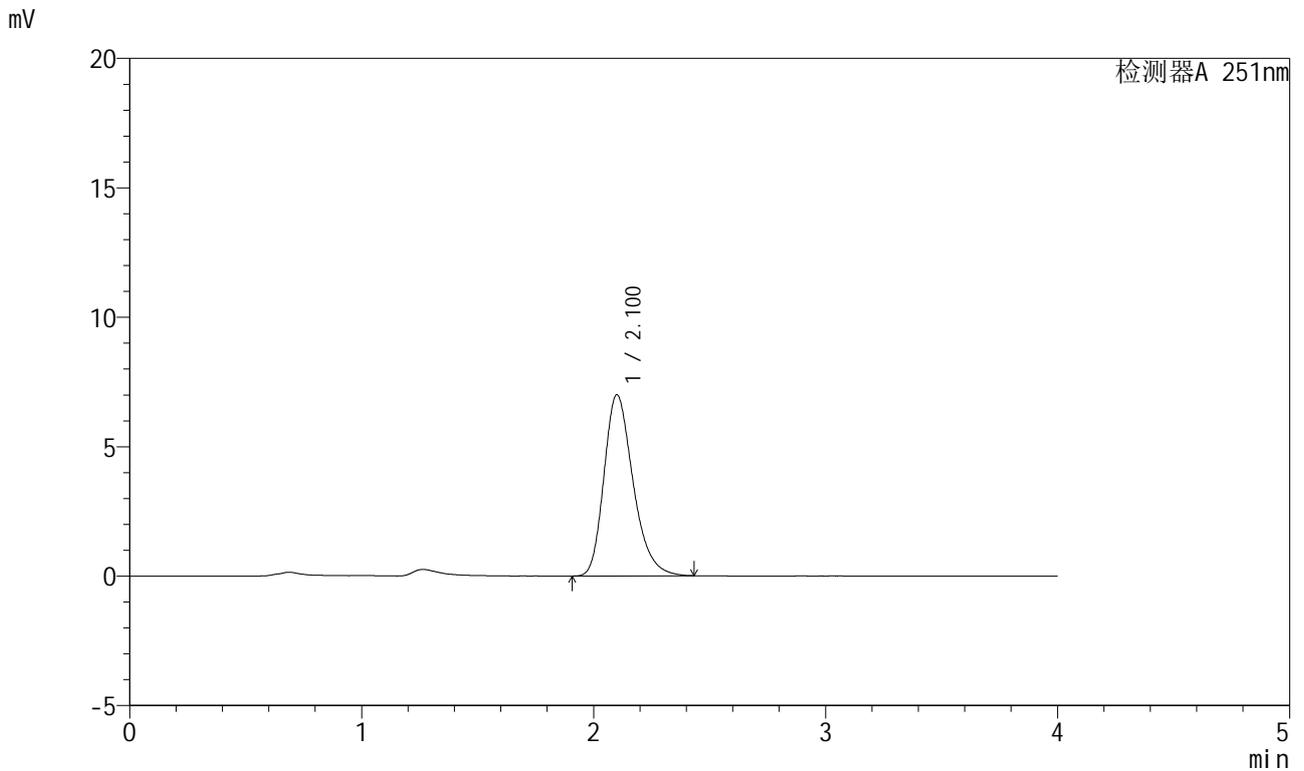

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	61132	100.000	6986	1378	1.277	--
总计		61132	100.000	6986			

图11 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3533-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:21:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

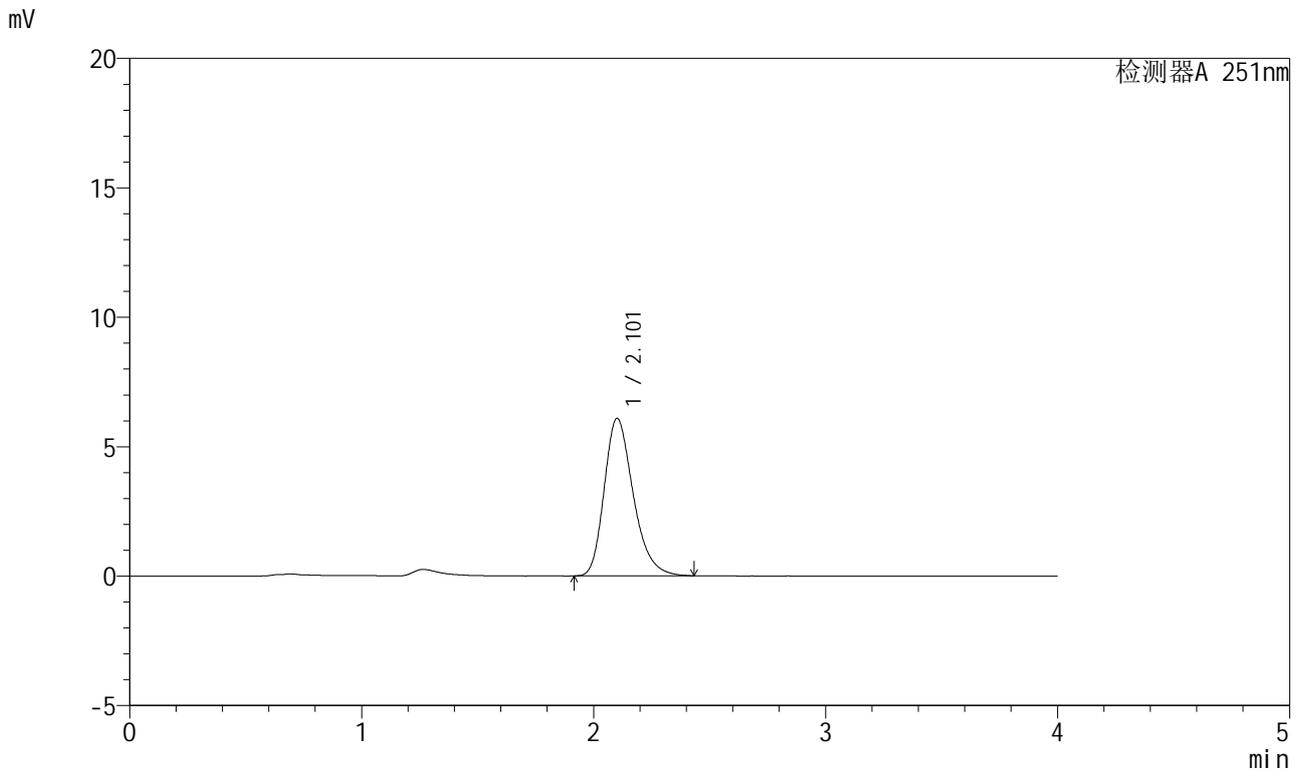

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	52971	100.000	6071	1389	1.278	--
总计		52971	100.000	6071			

图12 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3534-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:26:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

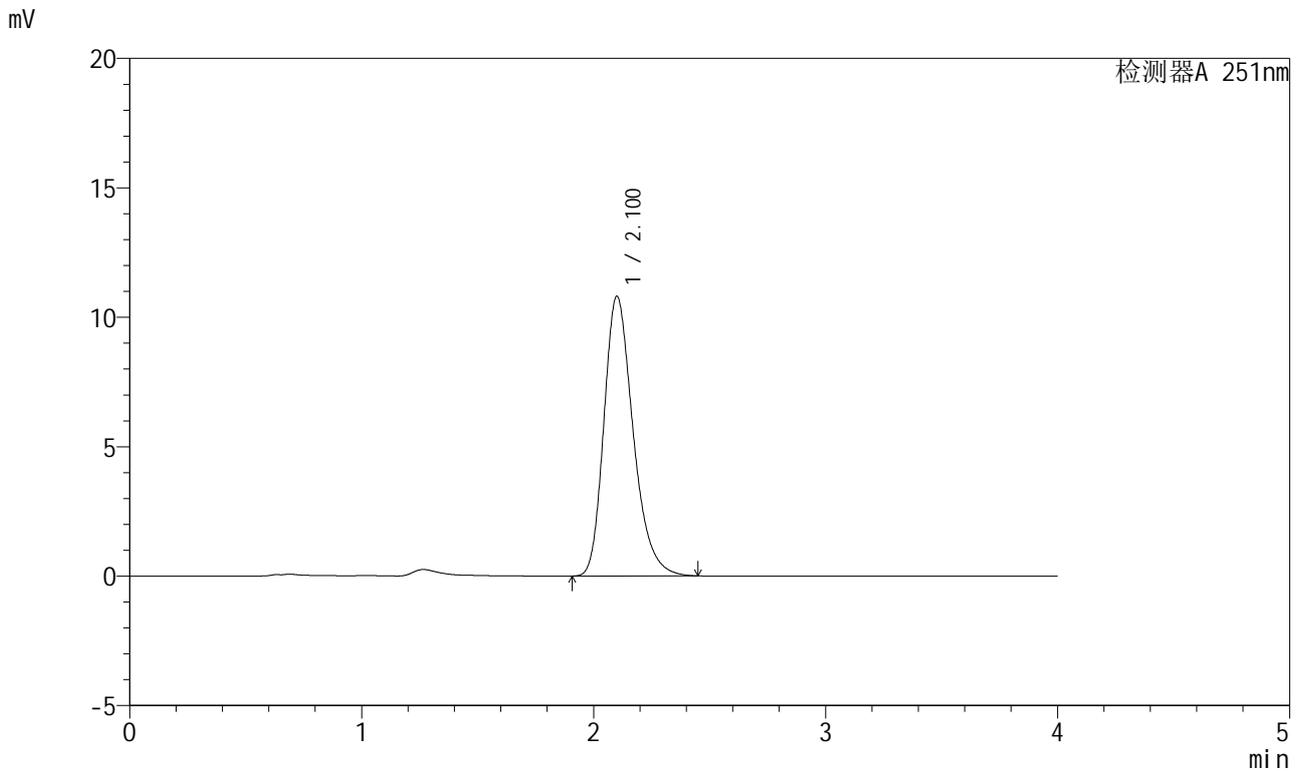

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	94606	100.000	10784	1373	1.277	--
总计		94606	100.000	10784			

图13 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3535-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:30:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

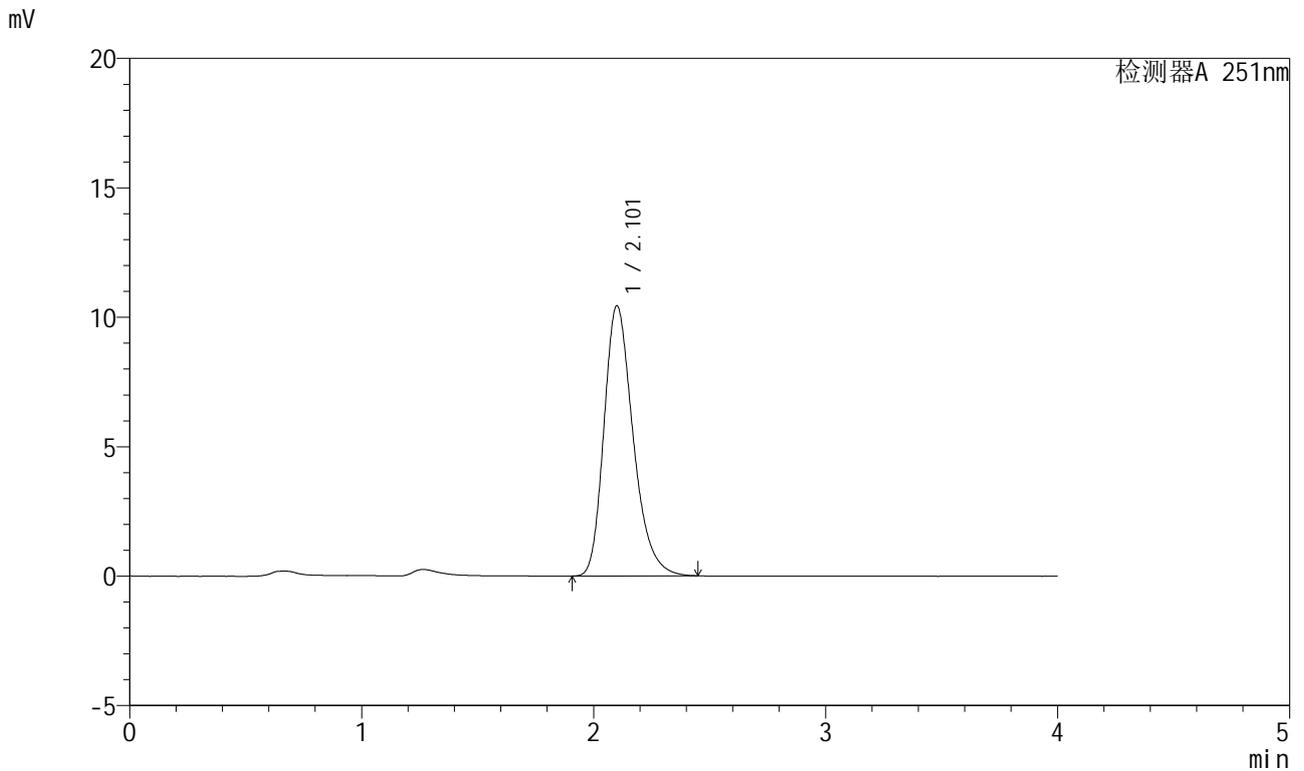

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	91225	100.000	10413	1377	1.278	--
总计		91225	100.000	10413			

图14 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3536-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:35:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

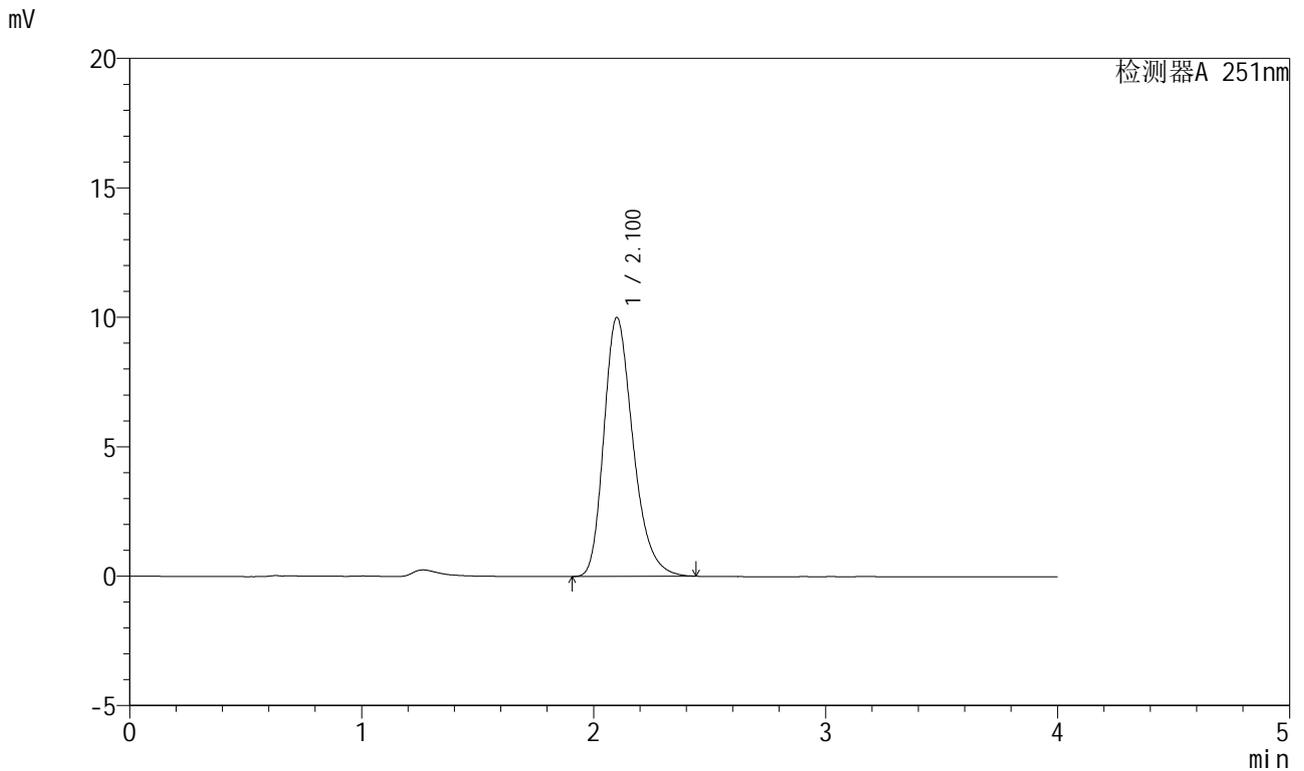

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	87490	100.000	9986	1374	1.279	--
总计		87490	100.000	9986			

图15 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3537-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:39:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:01:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

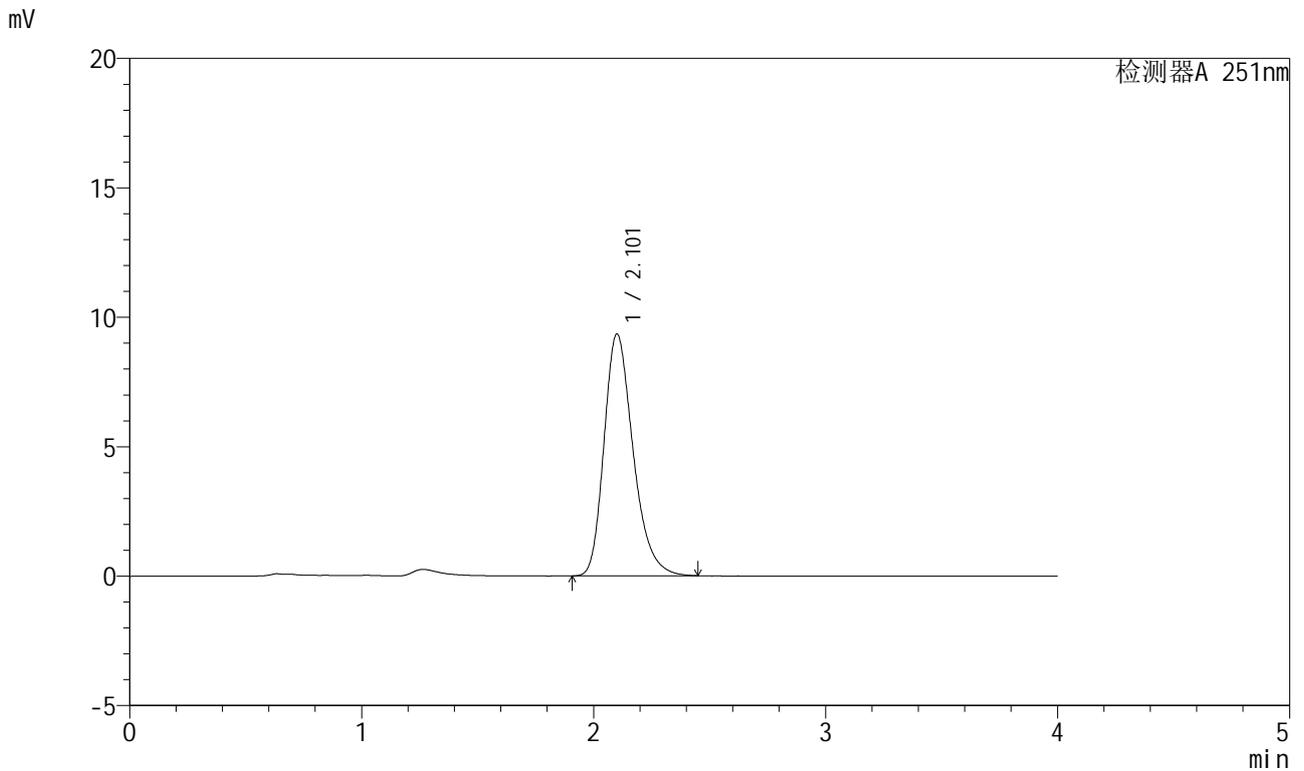

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	81506	100.000	9322	1385	1.280	--
总计		81506	100.000	9322			

图16 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3538-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:43:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

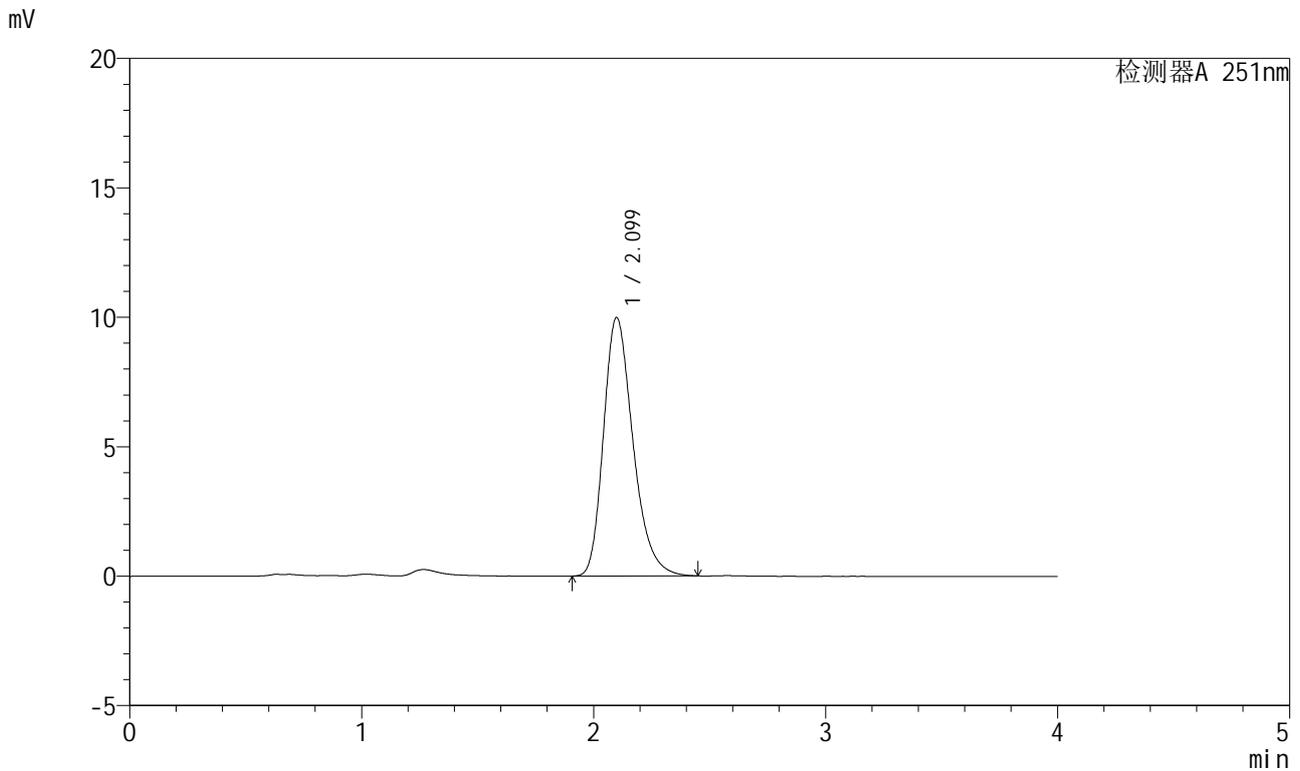

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	88359	100.000	9983	1342	1.280	--
总计		88359	100.000	9983			

图17 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3539-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:48:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

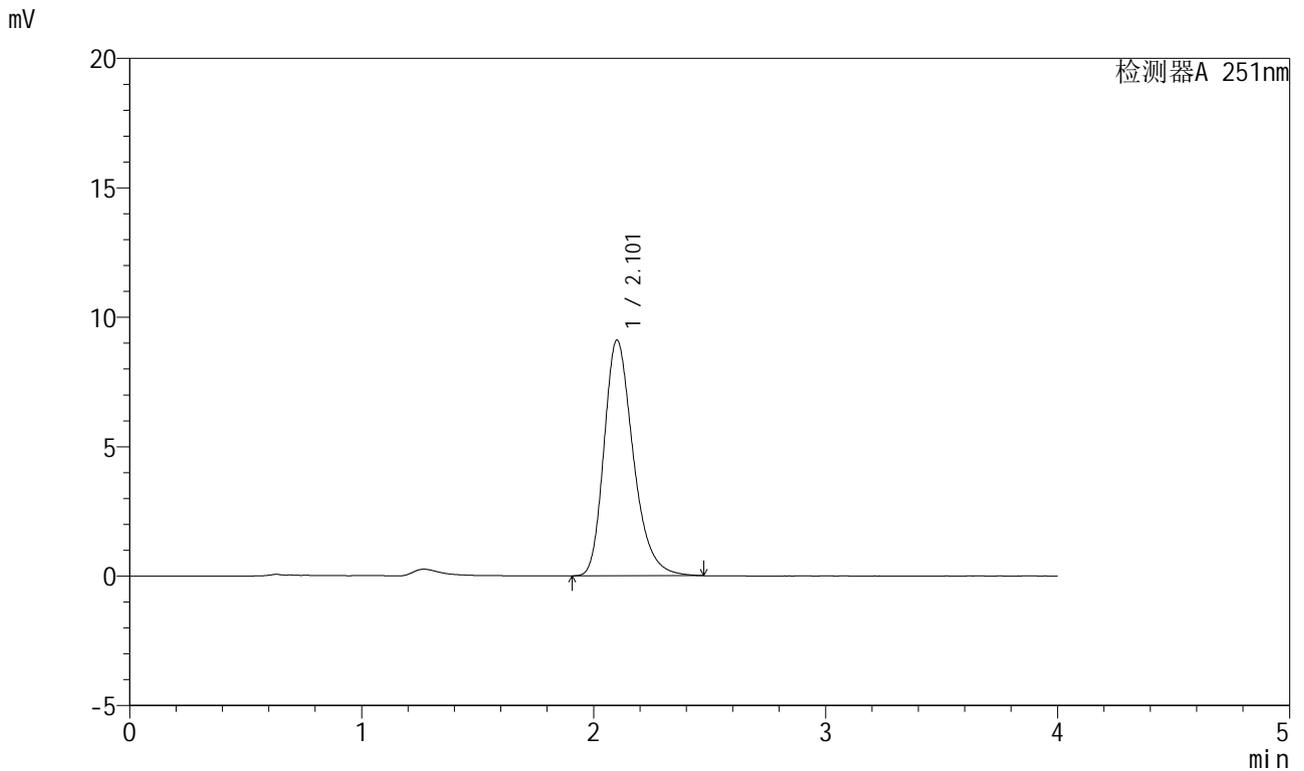

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	79582	100.000	9083	1388	1.286	--
总计		79582	100.000	9083			

图18 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3540-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:52:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

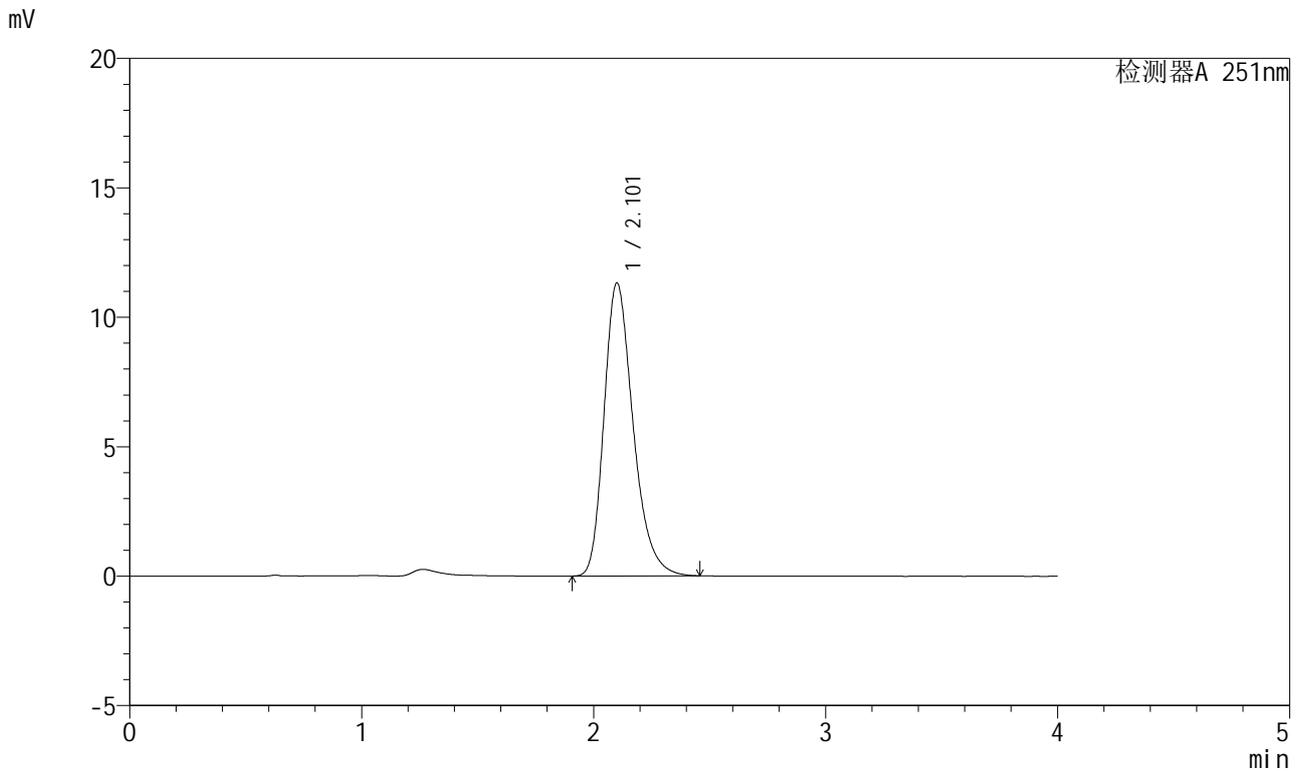

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	98735	100.000	11296	1388	1.285	--
总计		98735	100.000	11296			

图19 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3541-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 15:56:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

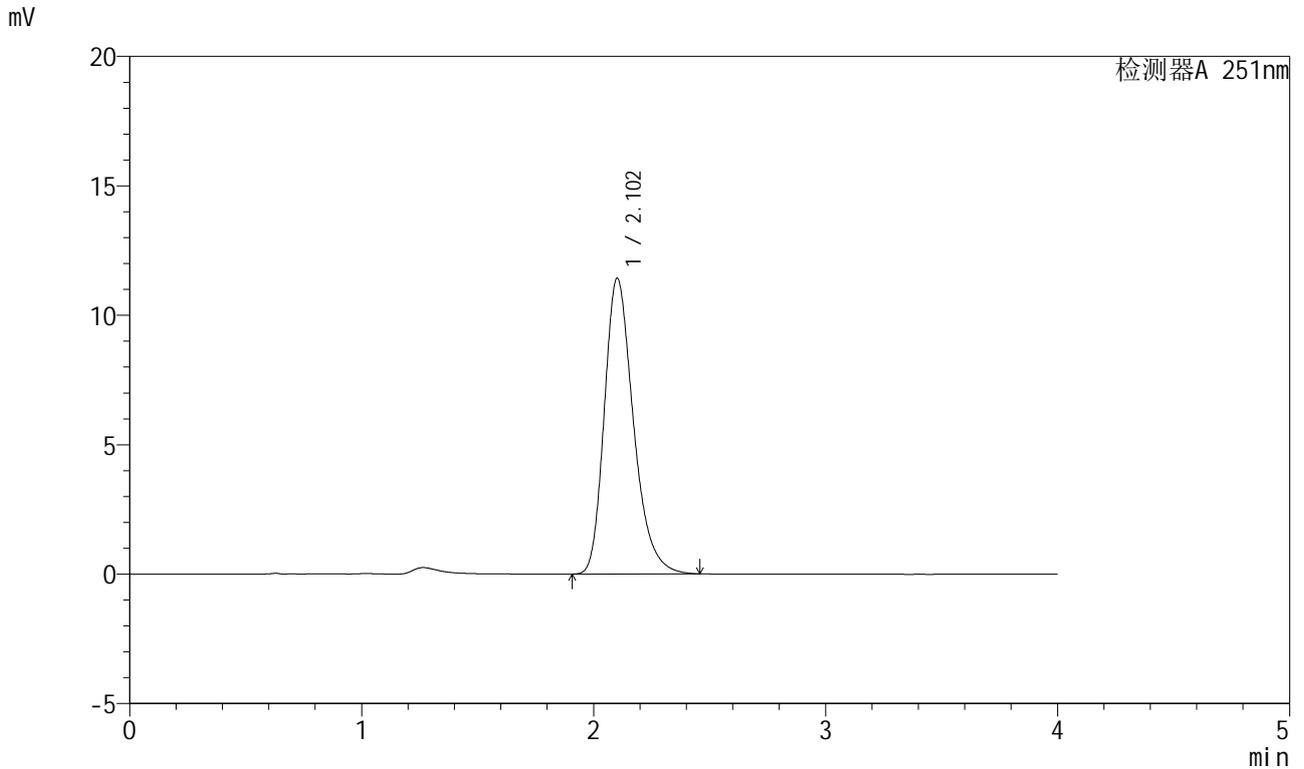

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	99622	100.000	11408	1390	1.285	--
总计		99622	100.000	11408			

图20 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3542-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:01:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

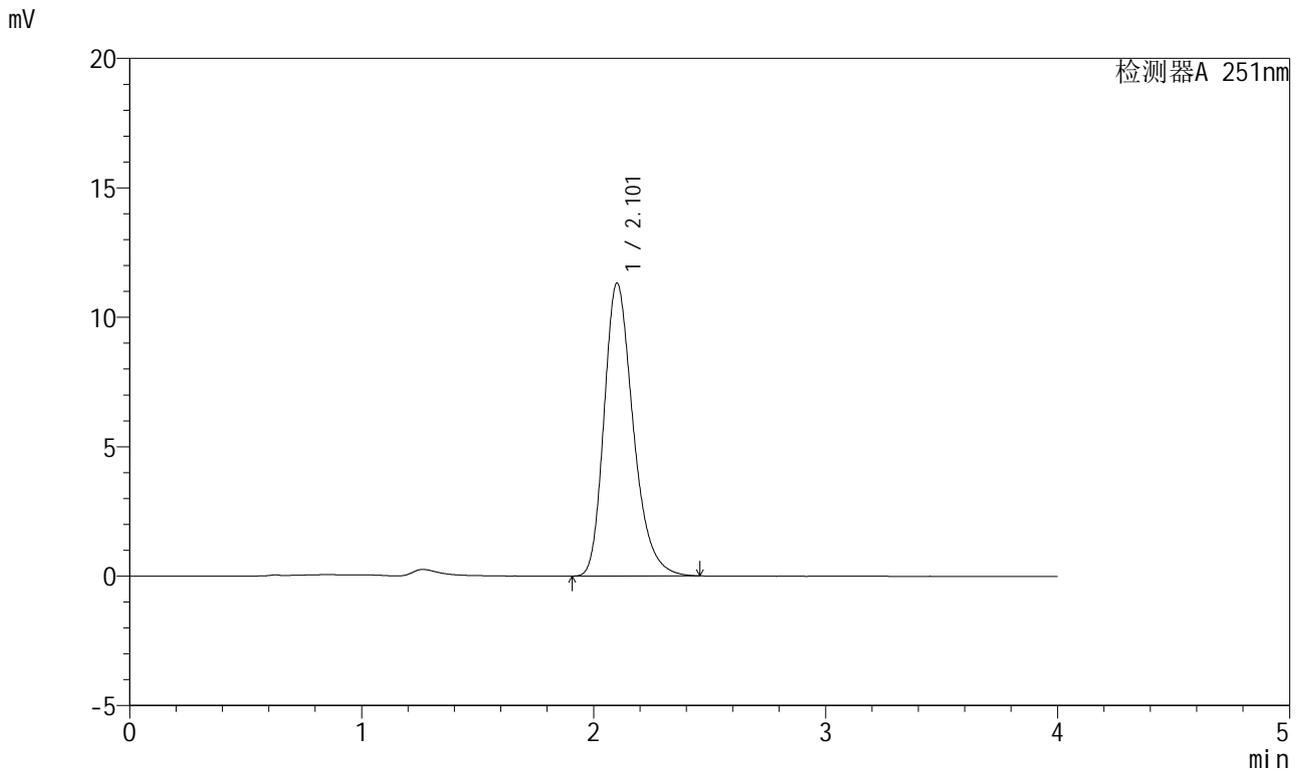

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	98633	100.000	11288	1392	1.281	--
总计		98633	100.000	11288			

图21 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3543-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:05:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

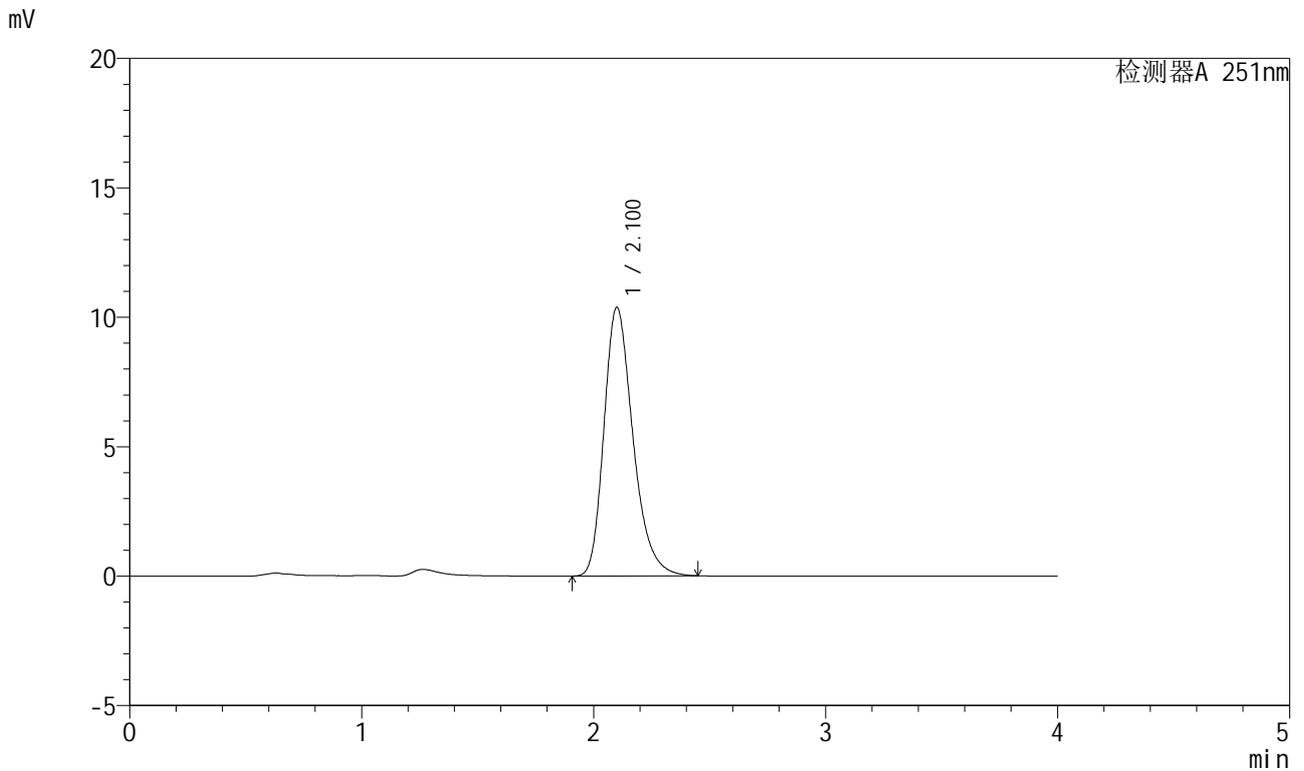

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	90268	100.000	10357	1394	1.282	--
总计		90268	100.000	10357			

图22 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3544-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:10:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

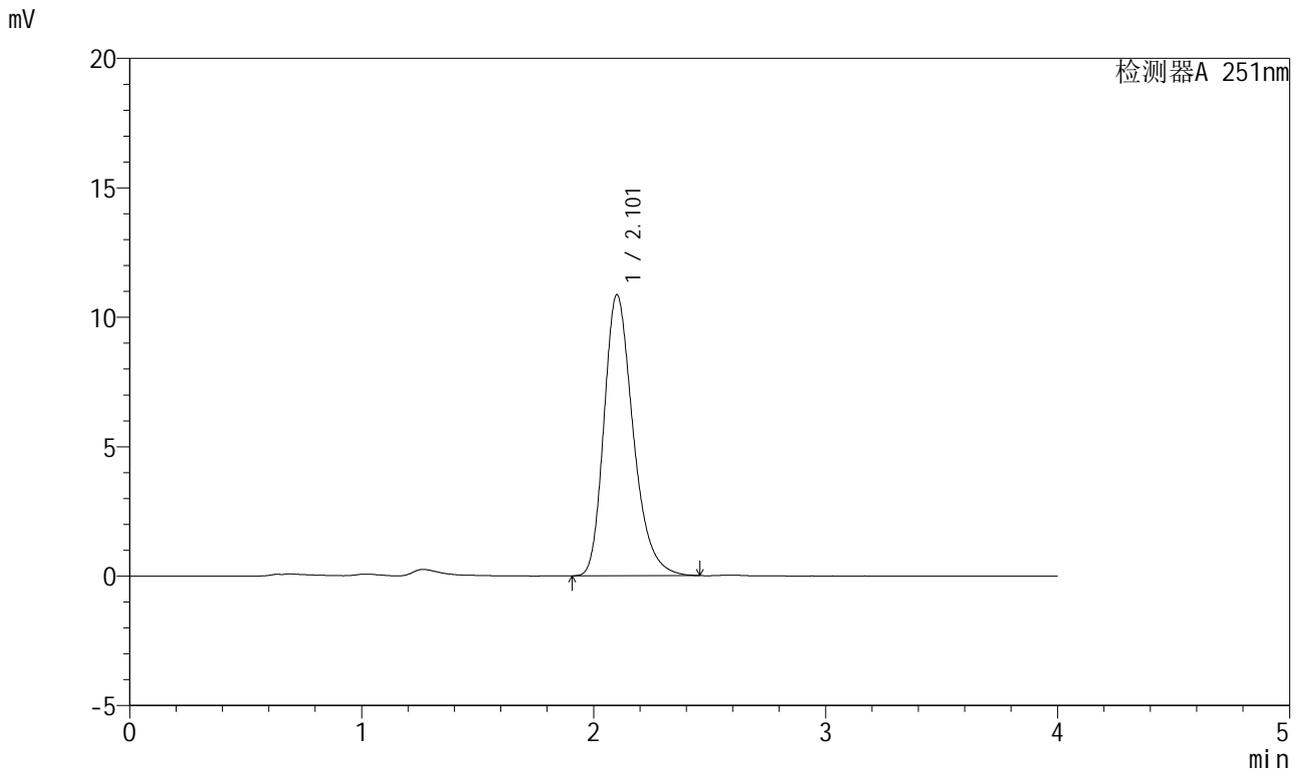

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	94860	100.000	10833	1384	1.282	--
总计		94860	100.000	10833			

图23 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3545-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:14:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

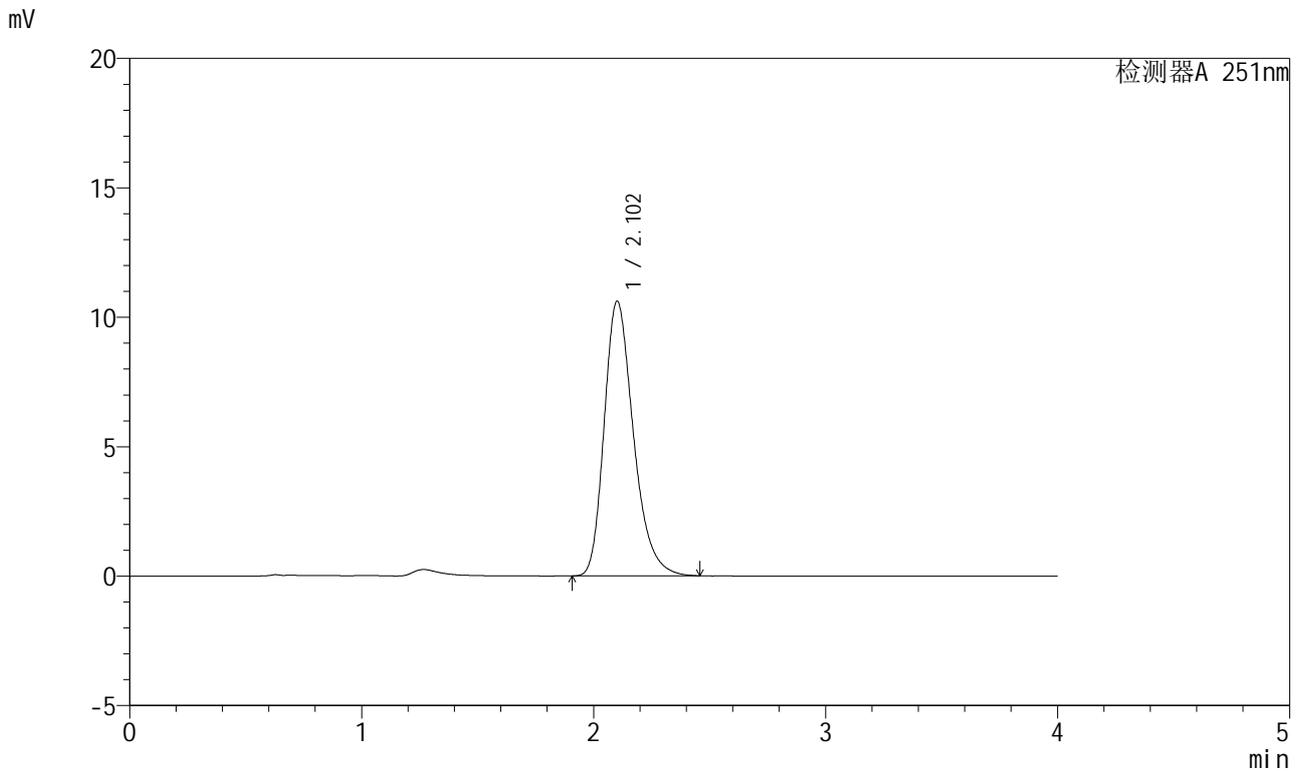

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	93088	100.000	10595	1375	1.284	--
总计		93088	100.000	10595			

图24 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3546-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:18:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

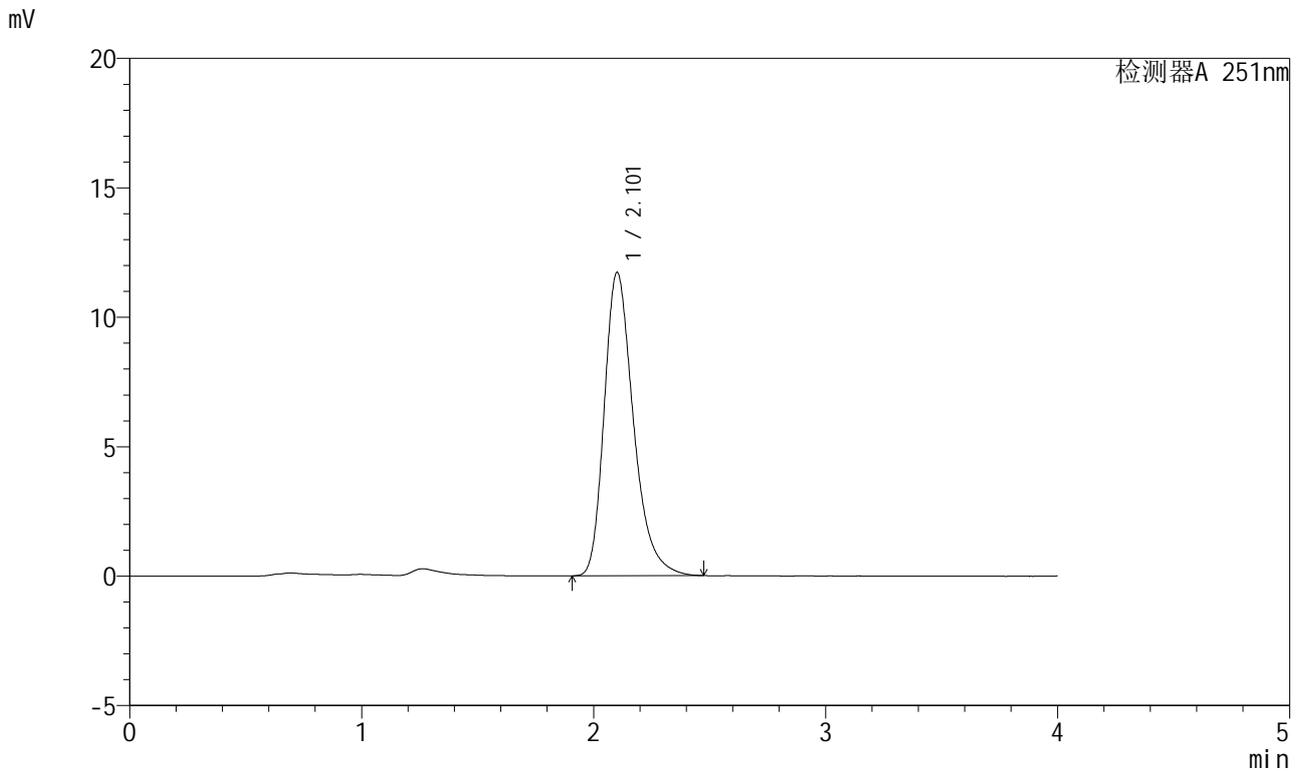

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	102707	100.000	11698	1393	1.310	--
总计		102707	100.000	11698			

图25 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3547-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:23:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

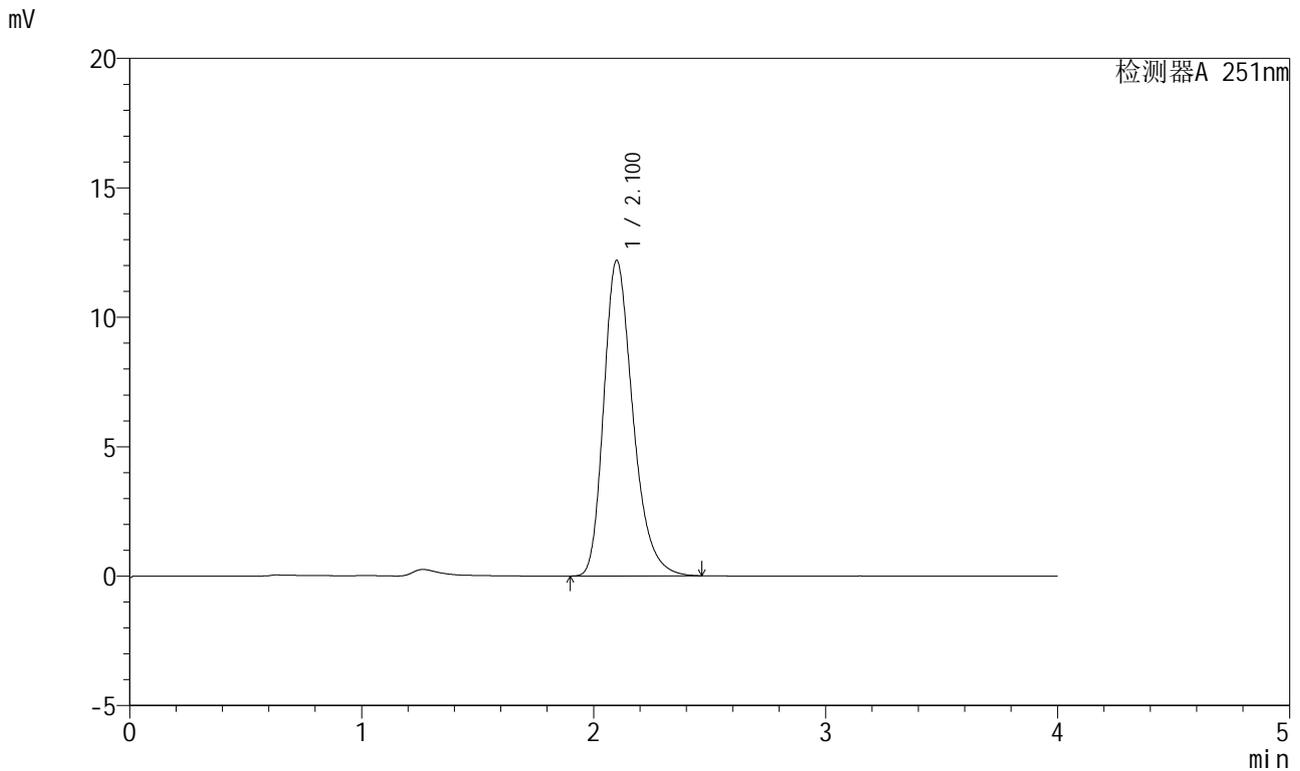

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	106515	100.000	12181	1386	1.288	--
总计		106515	100.000	12181			

图26 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3548-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:27:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

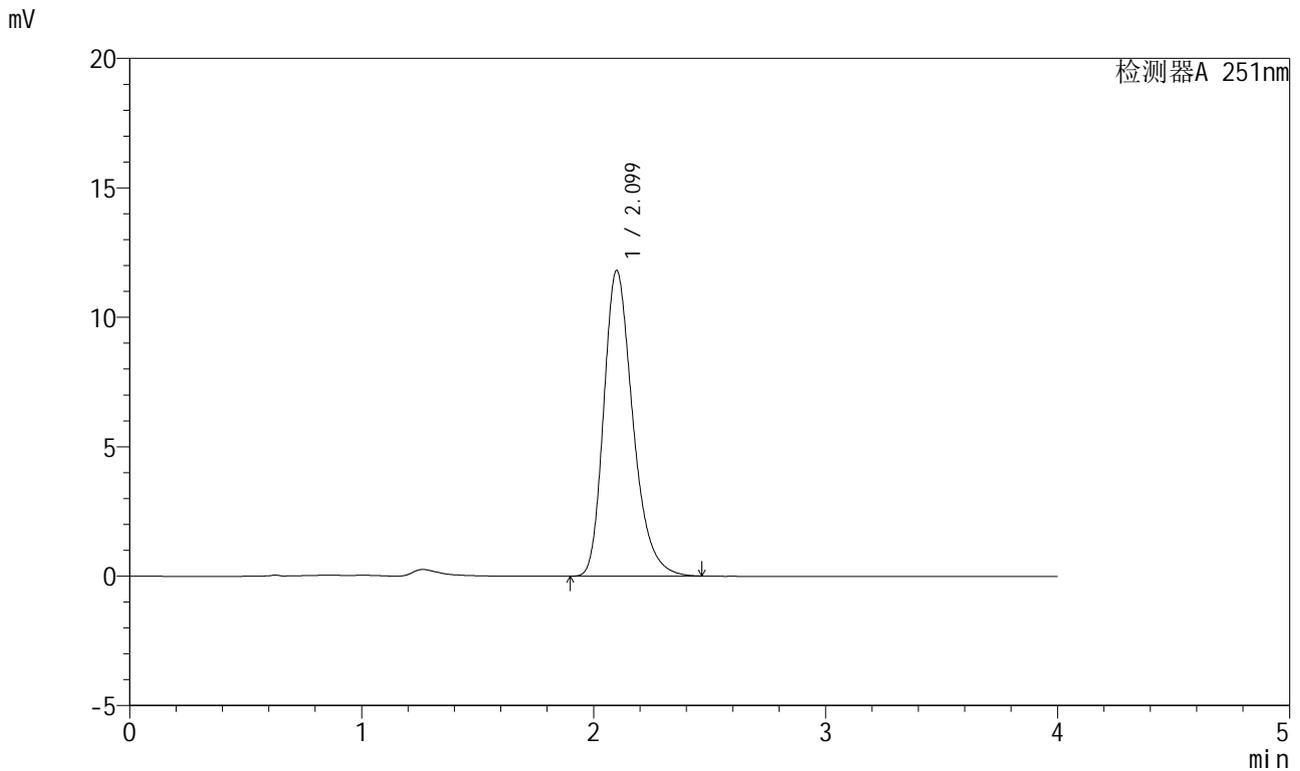

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	103087	100.000	11799	1387	1.287	--
总计		103087	100.000	11799			

图27 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3549-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:32:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

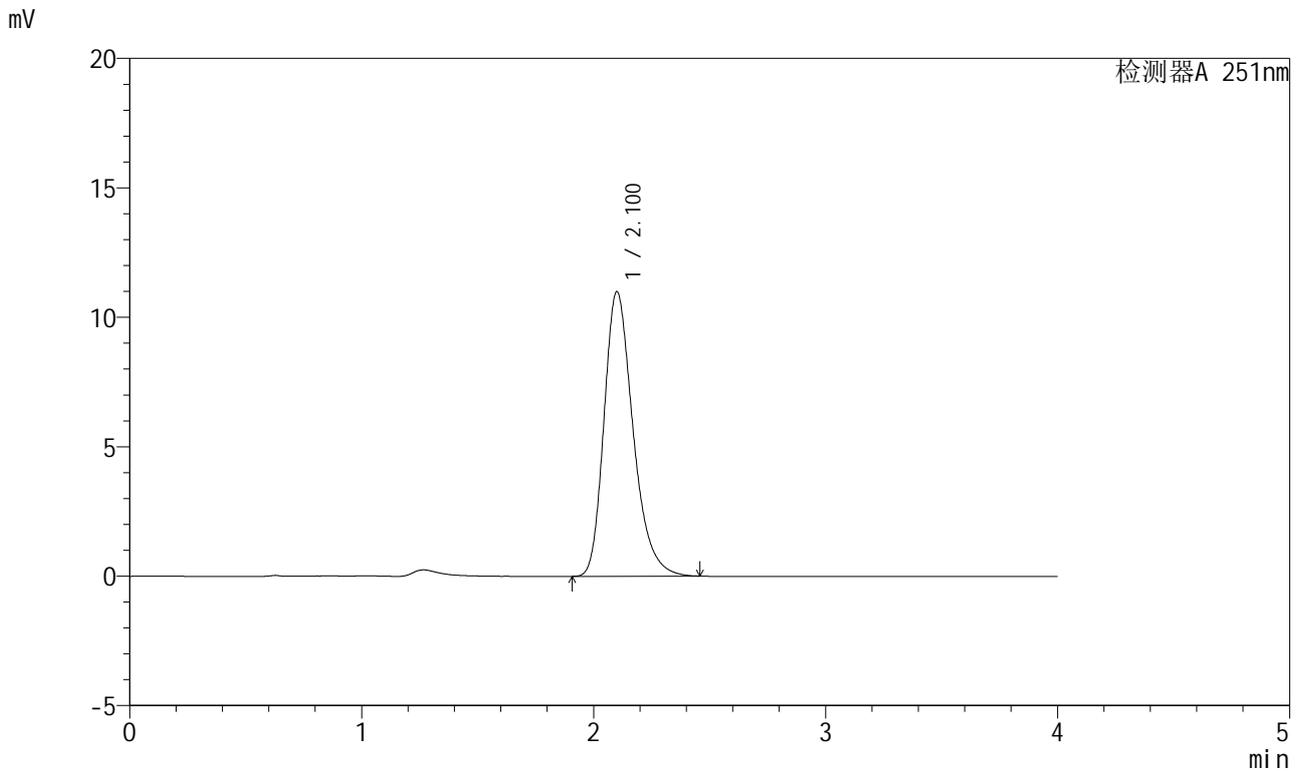

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	95778	100.000	10974	1394	1.287	--
总计		95778	100.000	10974			

图28 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3550-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:36:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

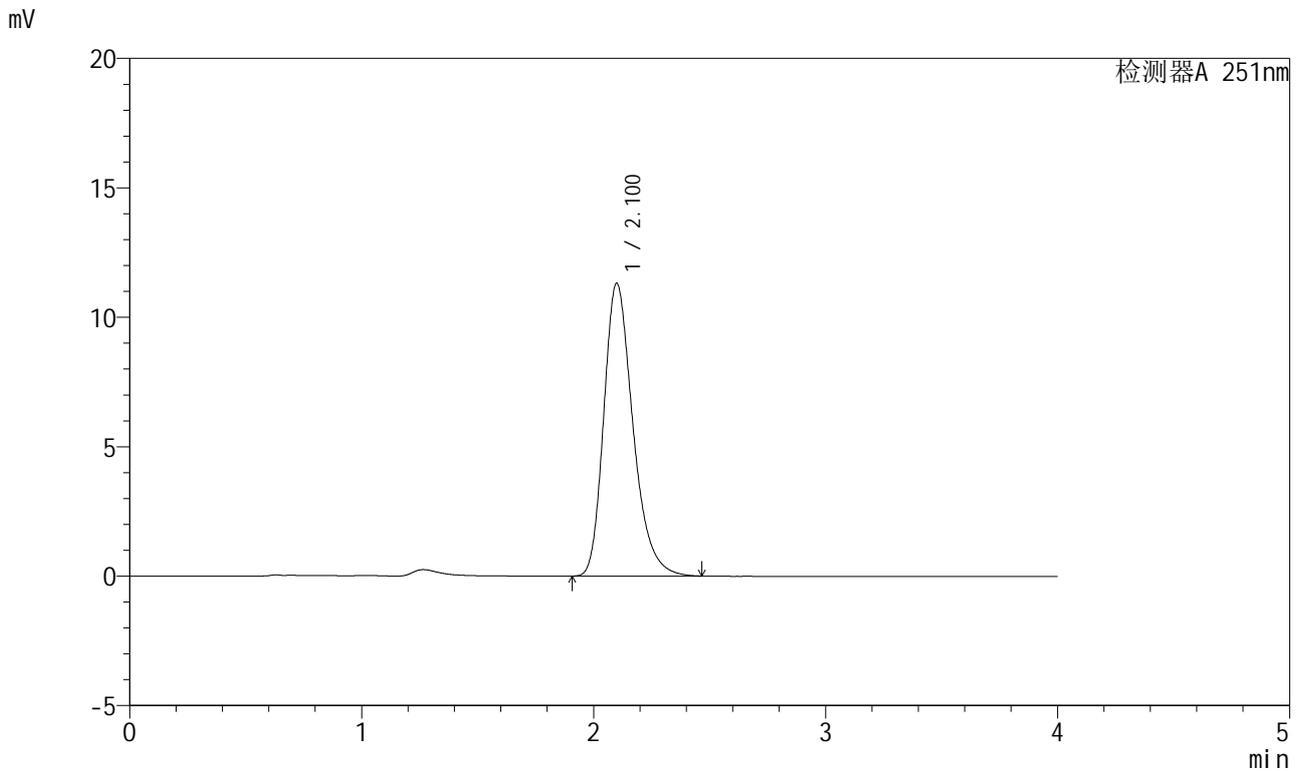

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	98953	100.000	11301	1383	1.287	--
总计		98953	100.000	11301			


图29 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3551-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:40:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

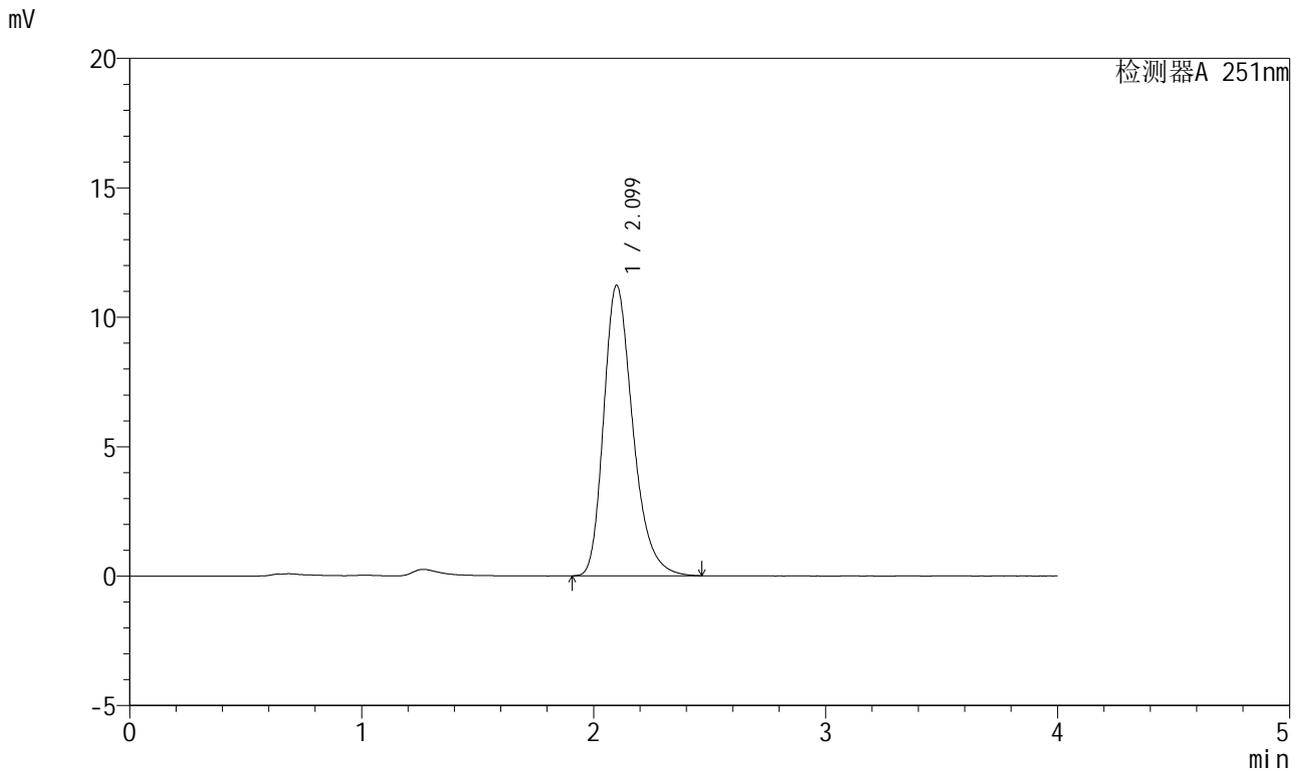

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	98062	100.000	11216	1386	1.289	--
总计		98062	100.000	11216			

图30 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3552-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:45:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

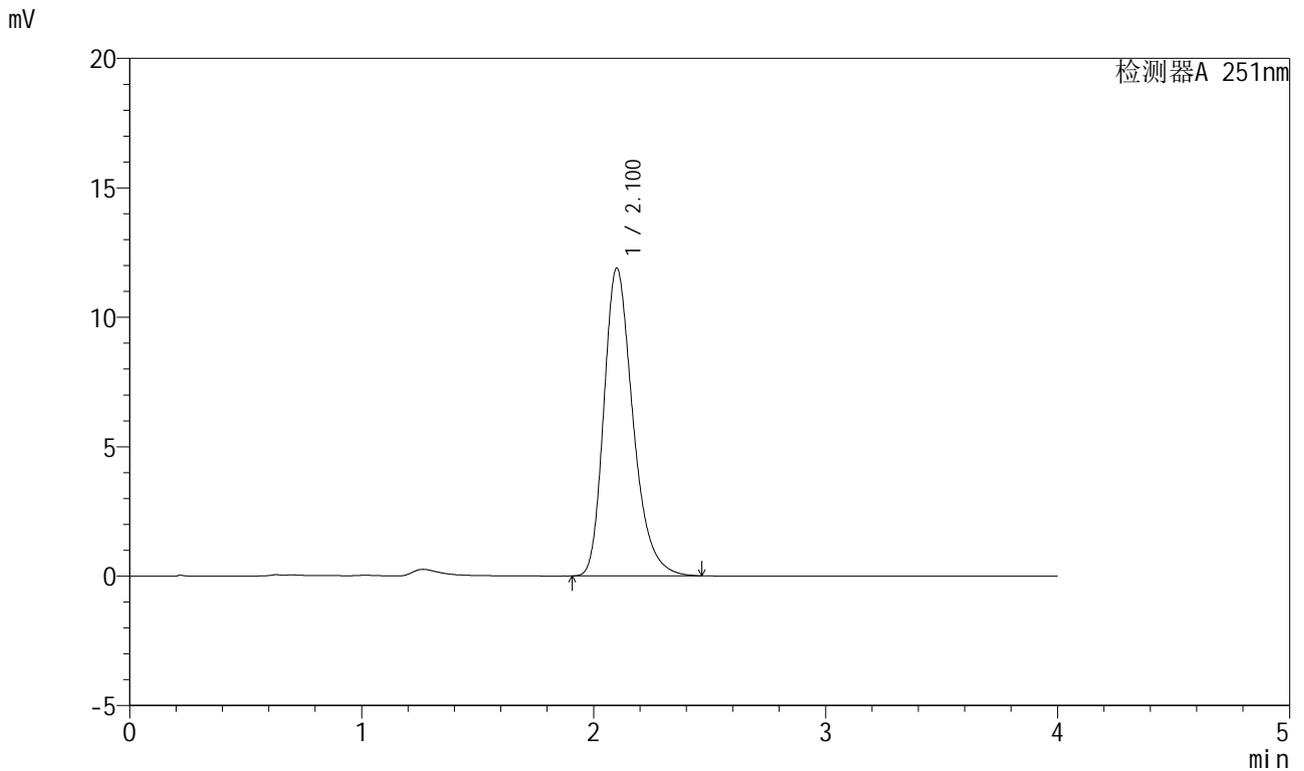

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	103536	100.000	11872	1397	1.291	--
总计		103536	100.000	11872			

图31 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3553-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:49:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

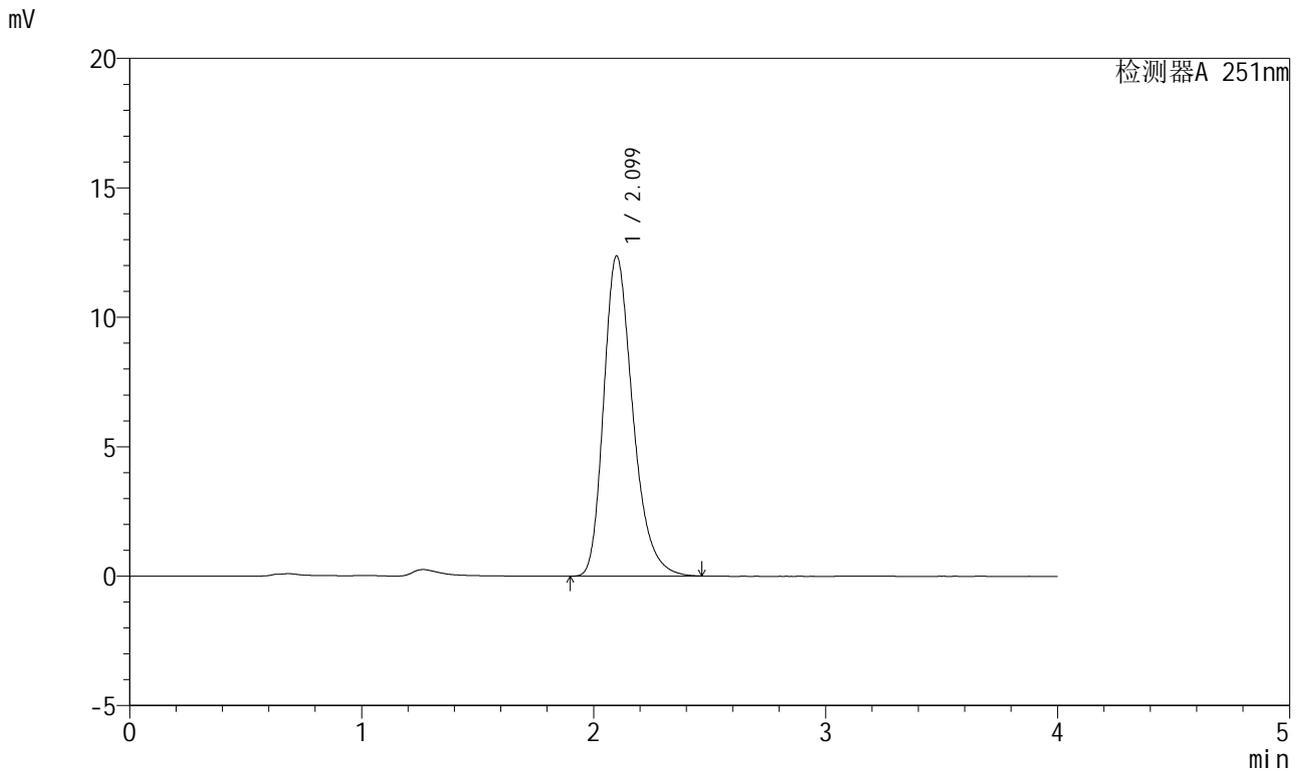

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	108021	100.000	12358	1388	1.289	--
总计		108021	100.000	12358			

图32 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3554-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:53:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

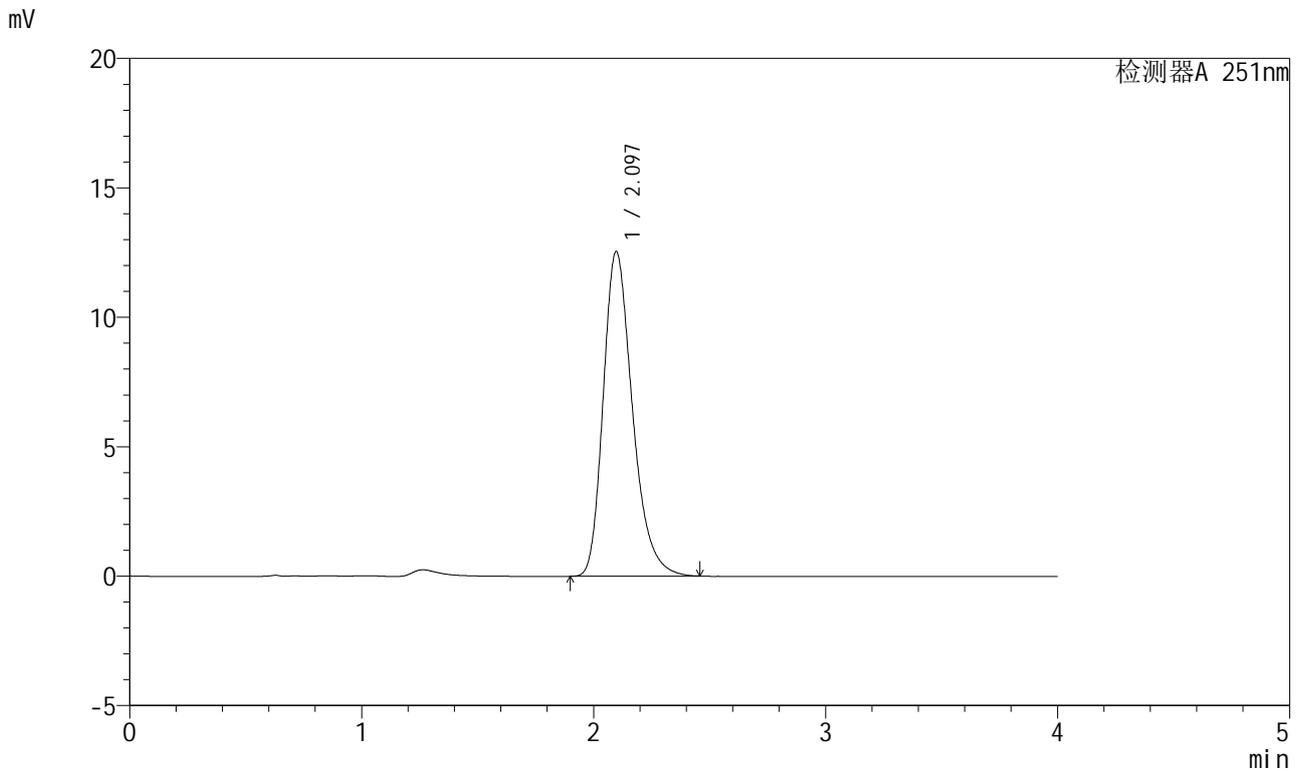

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	109900	100.000	12544	1374	1.287	--
总计		109900	100.000	12544			

图33 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3555-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 16:58:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

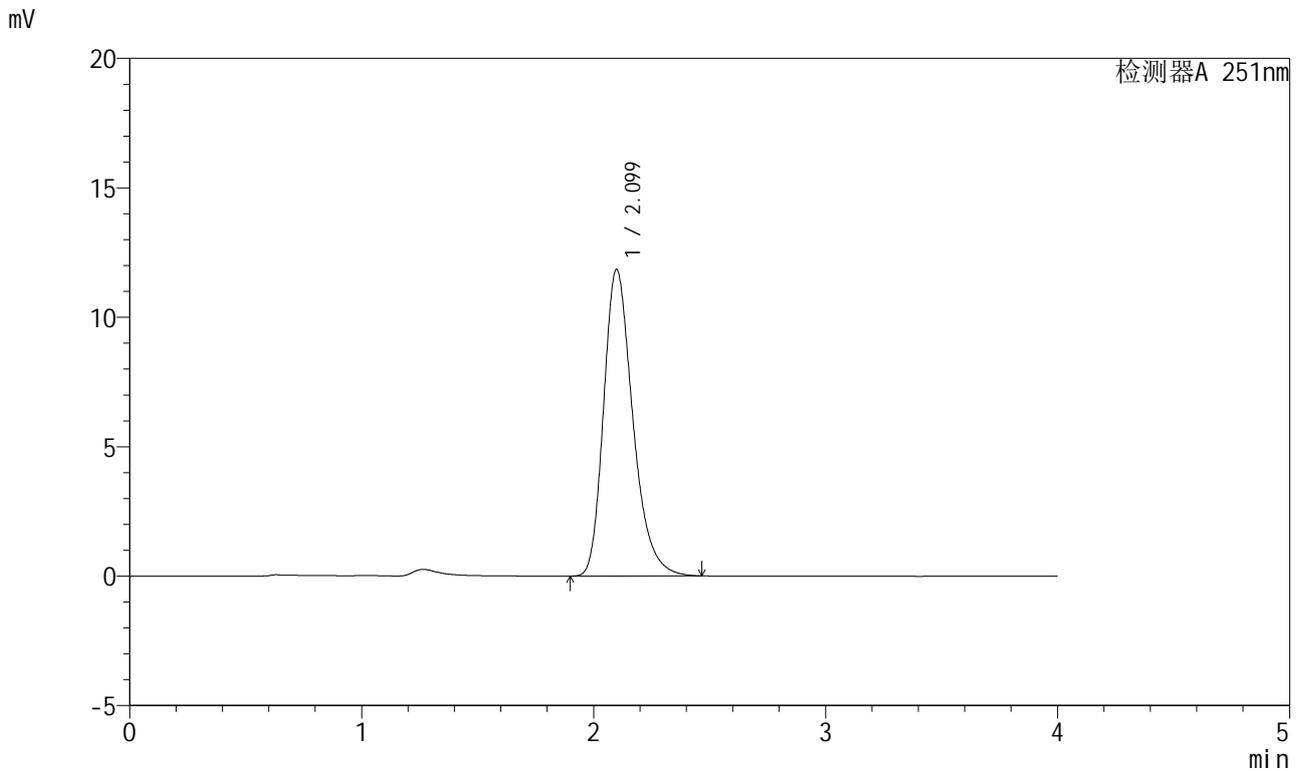

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	103799	100.000	11837	1378	1.288	--
总计		103799	100.000	11837			


图34 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3556-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:02:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

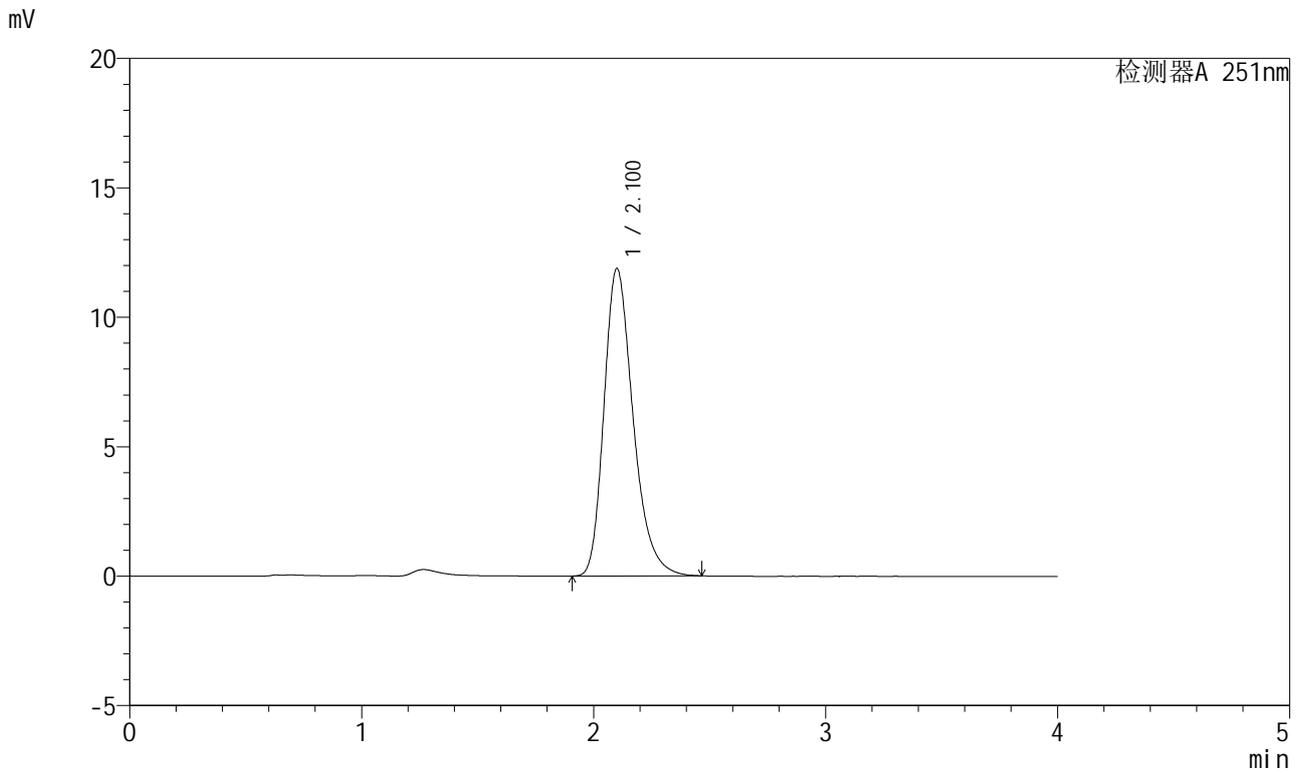

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	103766	100.000	11854	1389	1.291	--
总计		103766	100.000	11854			


图35 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3557-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:07:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

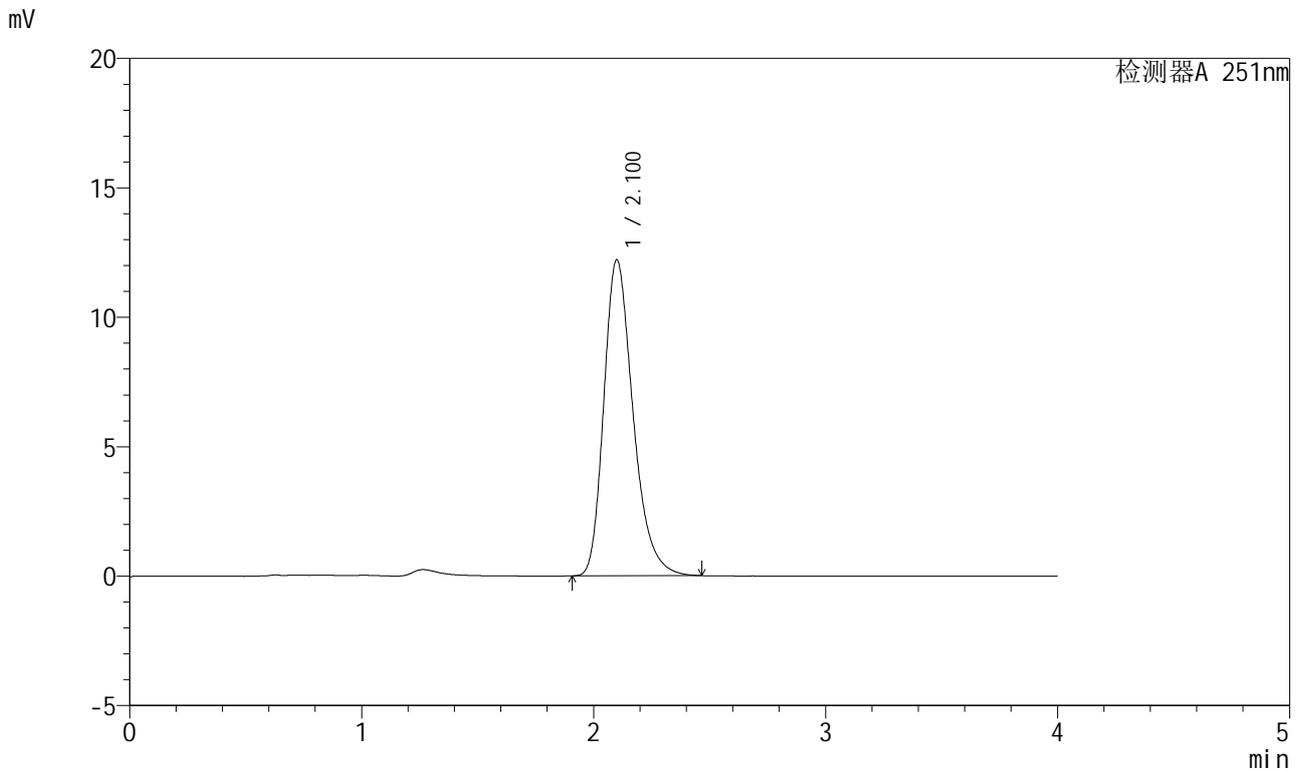

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	107102	100.000	12193	1376	1.290	--
总计		107102	100.000	12193			

图36 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3558-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:11:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

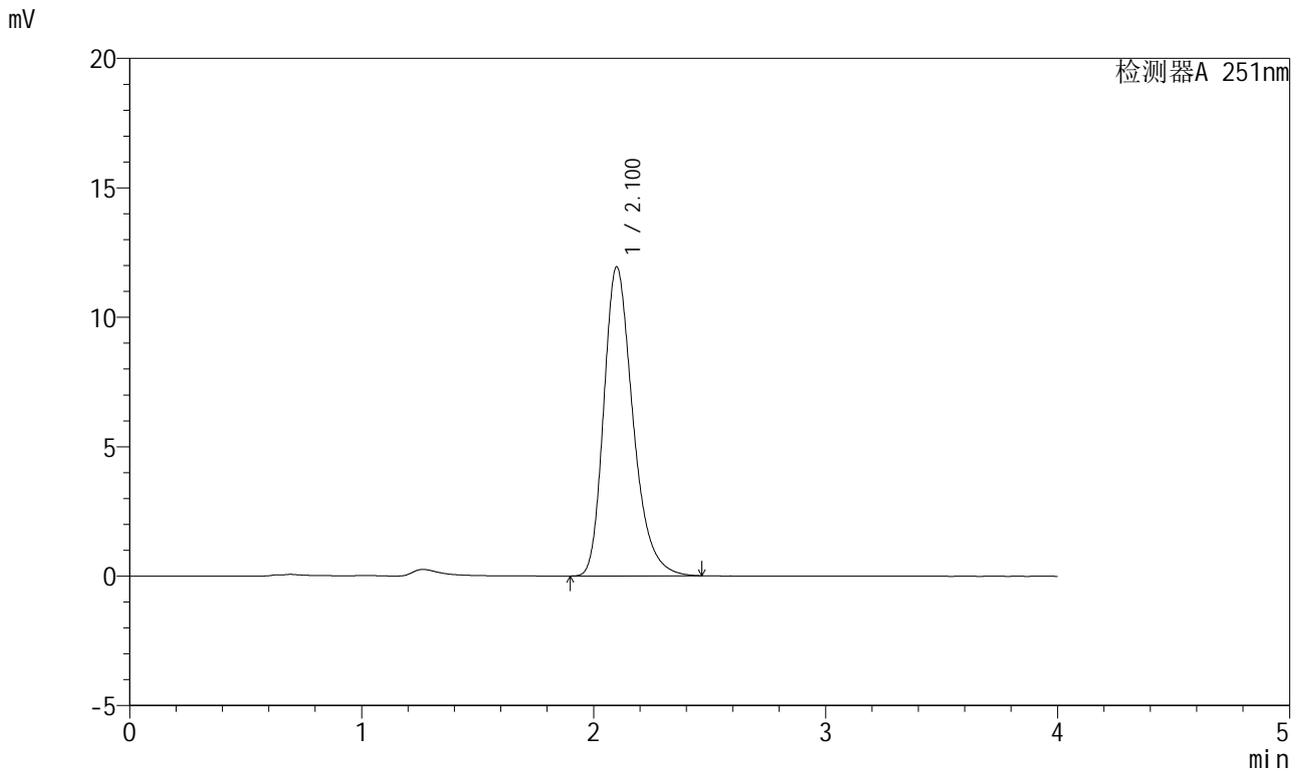

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	104346	100.000	11928	1389	1.291	--
总计		104346	100.000	11928			


图37 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3559-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:15:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

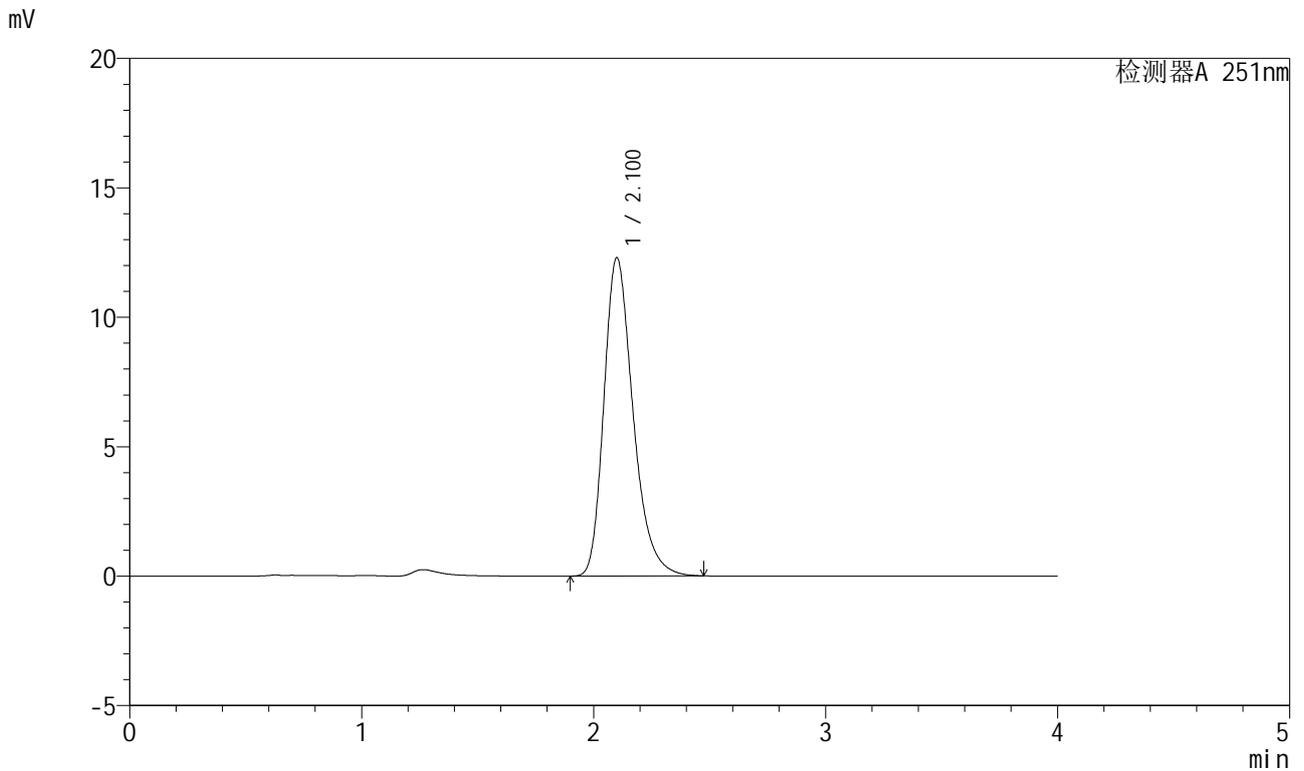

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	107458	100.000	12274	1388	1.291	--
总计		107458	100.000	12274			


图38 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3560-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:20:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:02:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

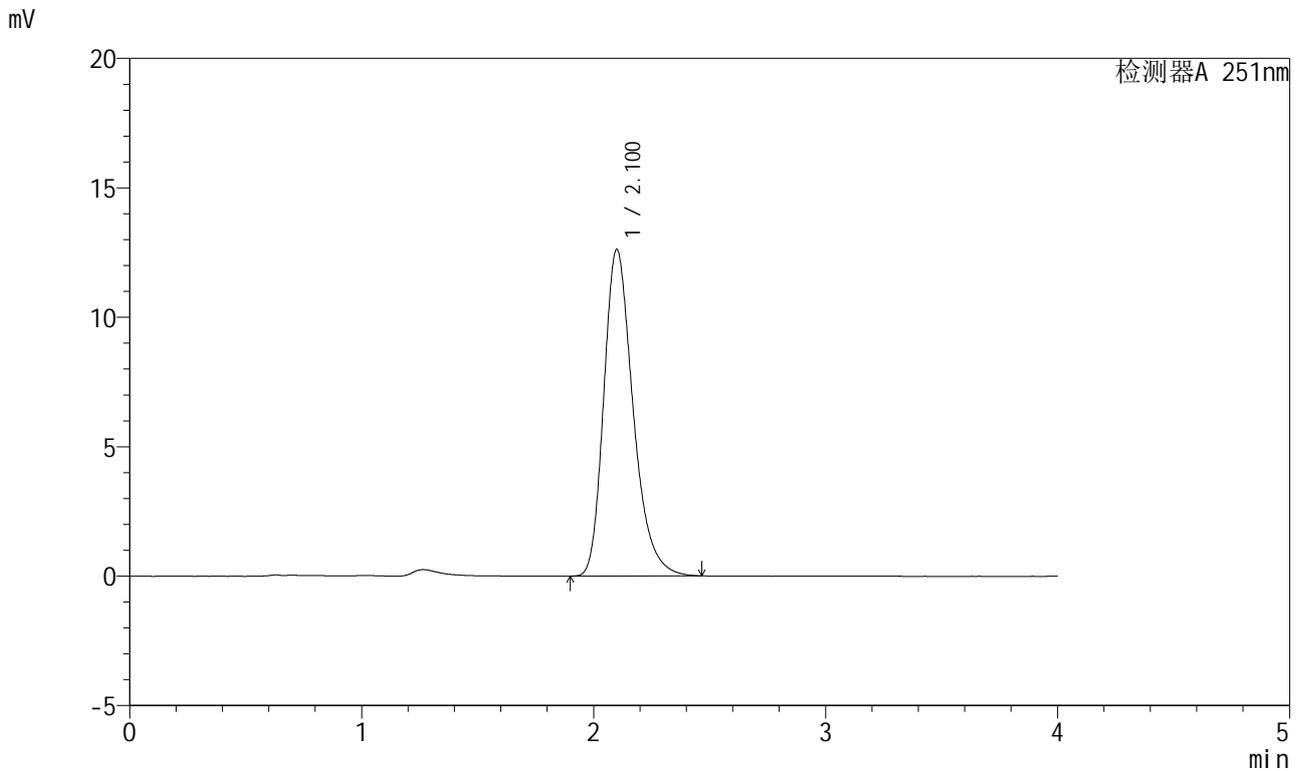

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	110769	100.000	12599	1374	1.290	--
总计		110769	100.000	12599			

图39 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3561-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:24:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

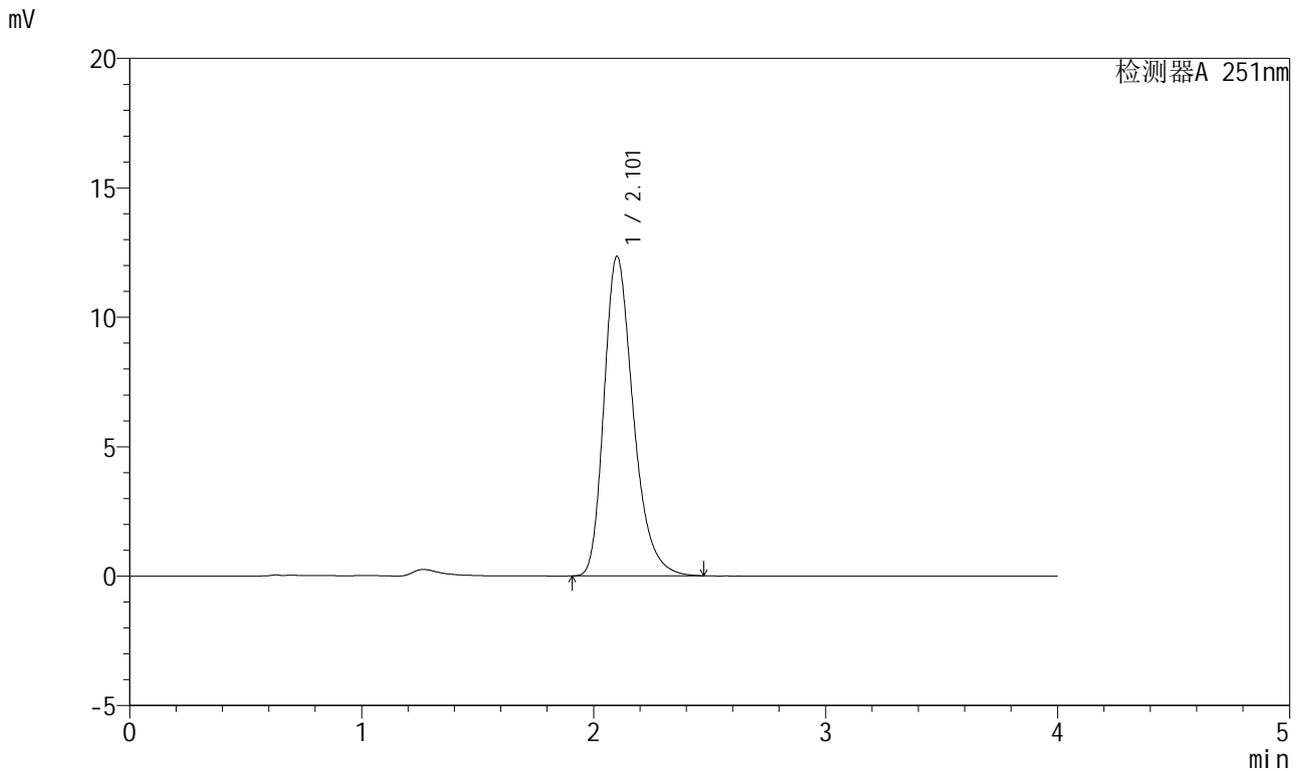

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	108184	100.000	12312	1382	1.293	--
总计		108184	100.000	12312			

图40 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3562-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:29:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

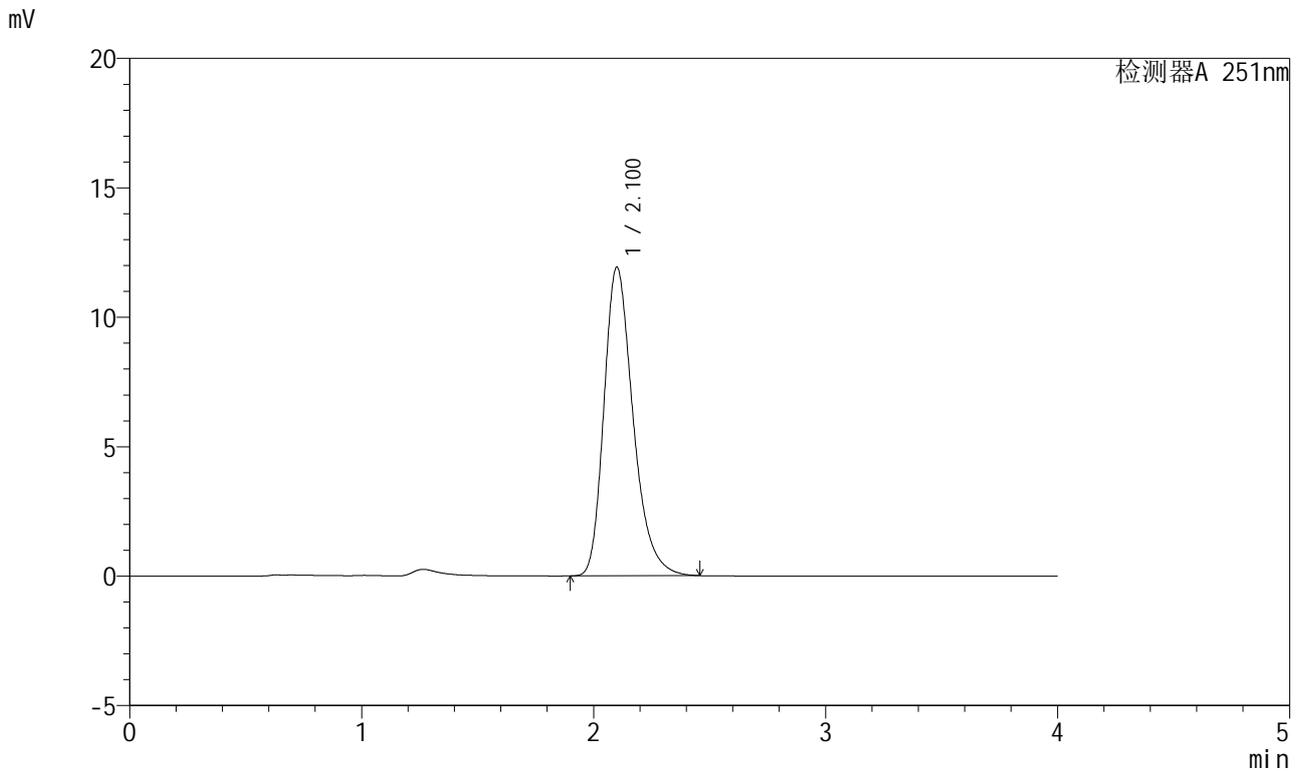

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	104235	100.000	11902	1389	1.291	--
总计		104235	100.000	11902			

图41 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3563-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:33:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

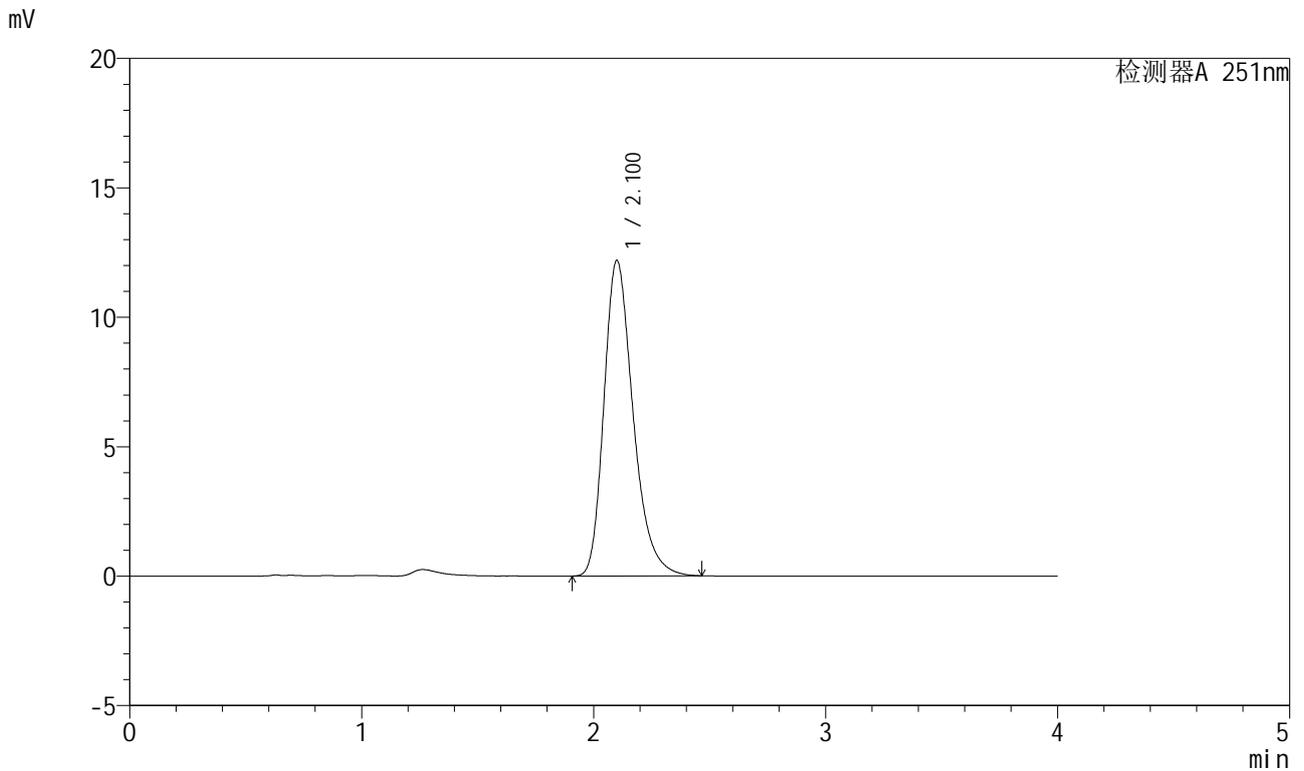

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	106613	100.000	12166	1387	1.294	--
总计		106613	100.000	12166			

图42 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3564-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:37:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

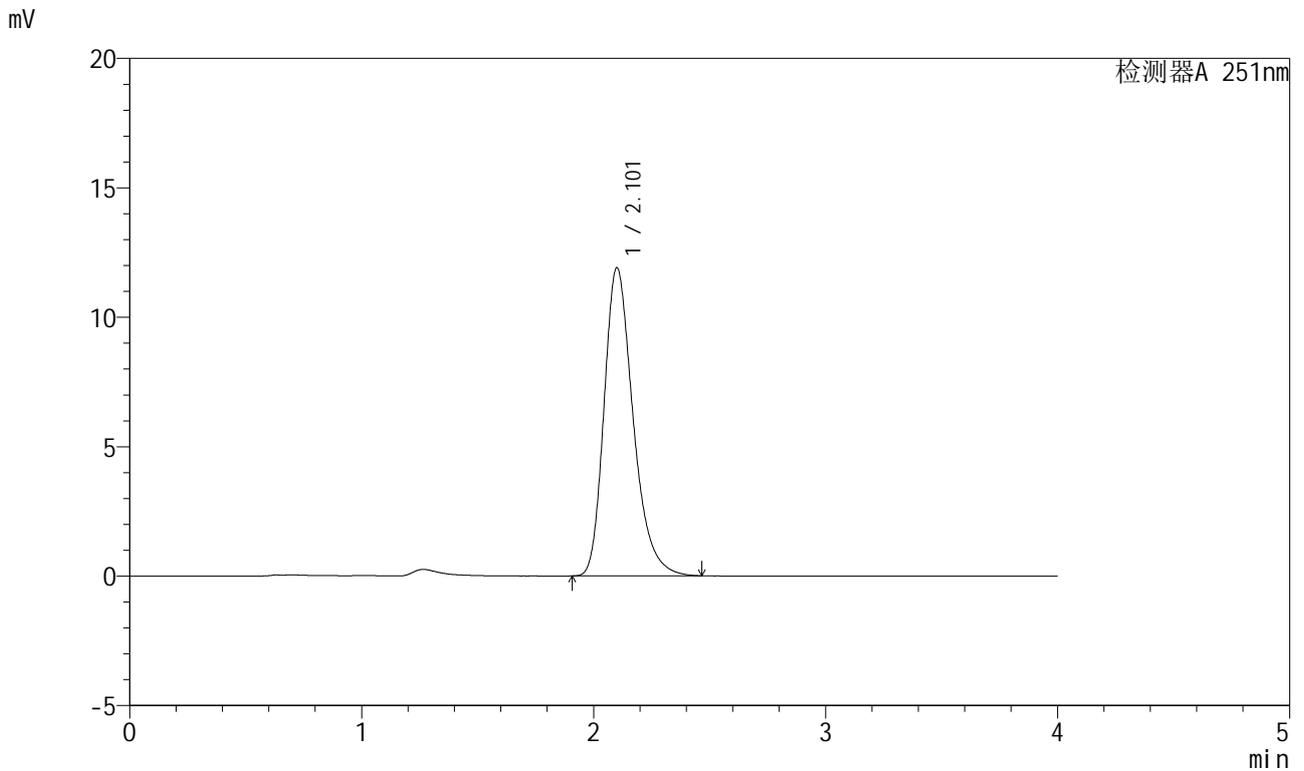

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	103719	100.000	11880	1399	1.293	--
总计		103719	100.000	11880			

图43 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3565-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:42:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

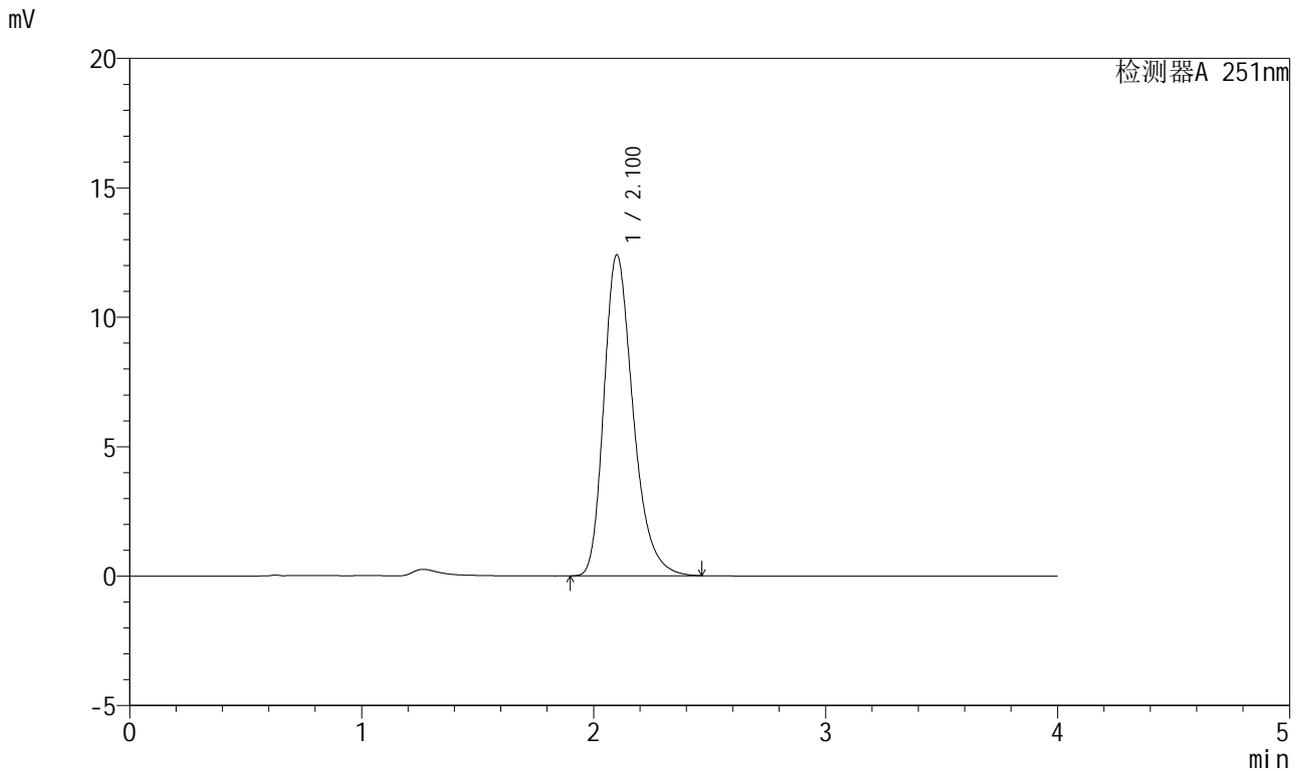

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	108631	100.000	12381	1385	1.291	--
总计		108631	100.000	12381			

图44 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3566-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:46:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

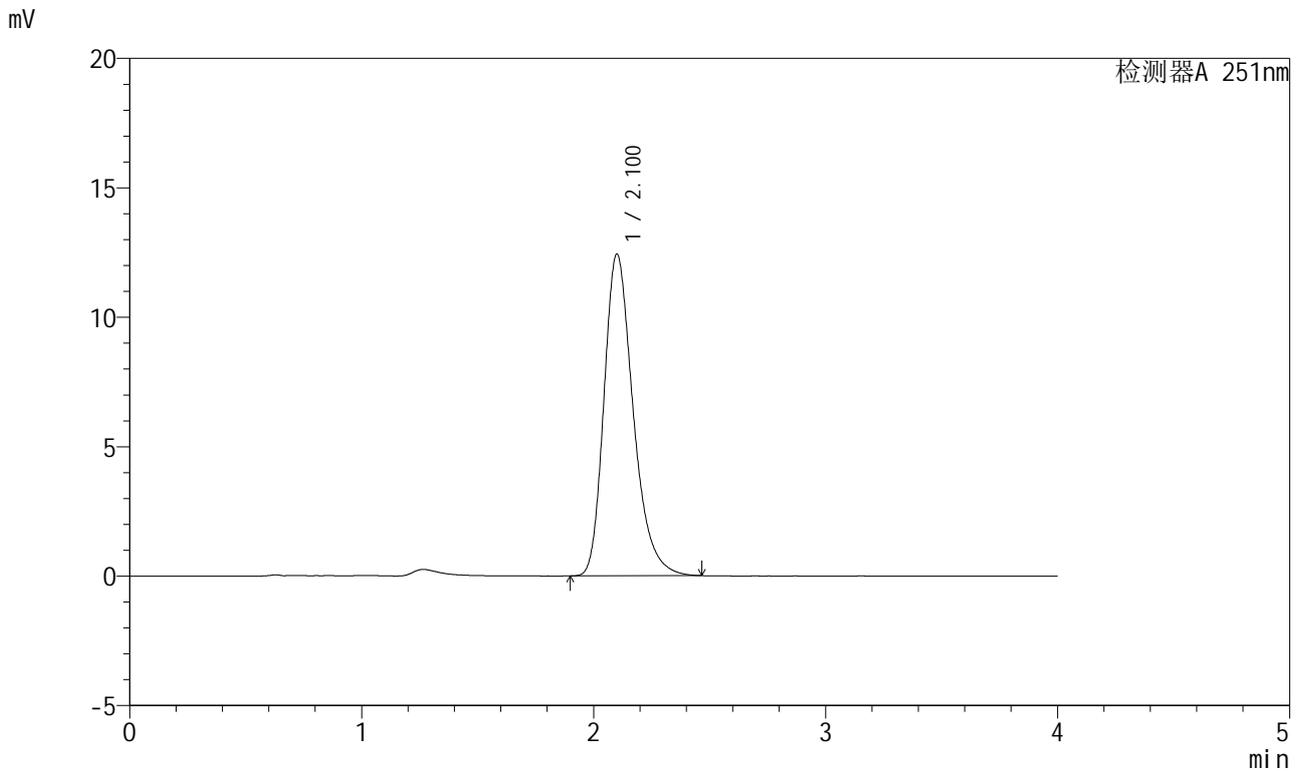

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	108833	100.000	12404	1383	1.292	--
总计		108833	100.000	12404			

图45 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3567-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:50:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

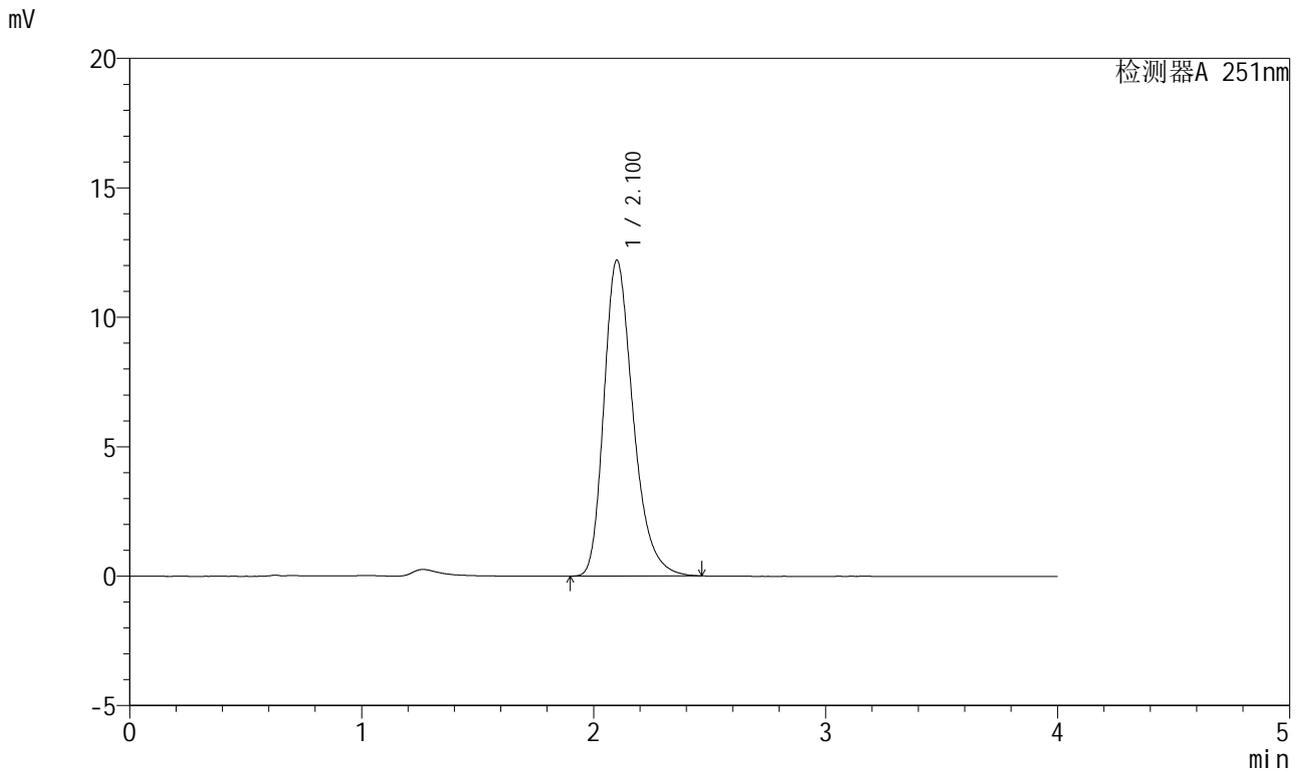

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	106804	100.000	12182	1387	1.293	--
总计		106804	100.000	12182			


图46 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3568-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:55:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

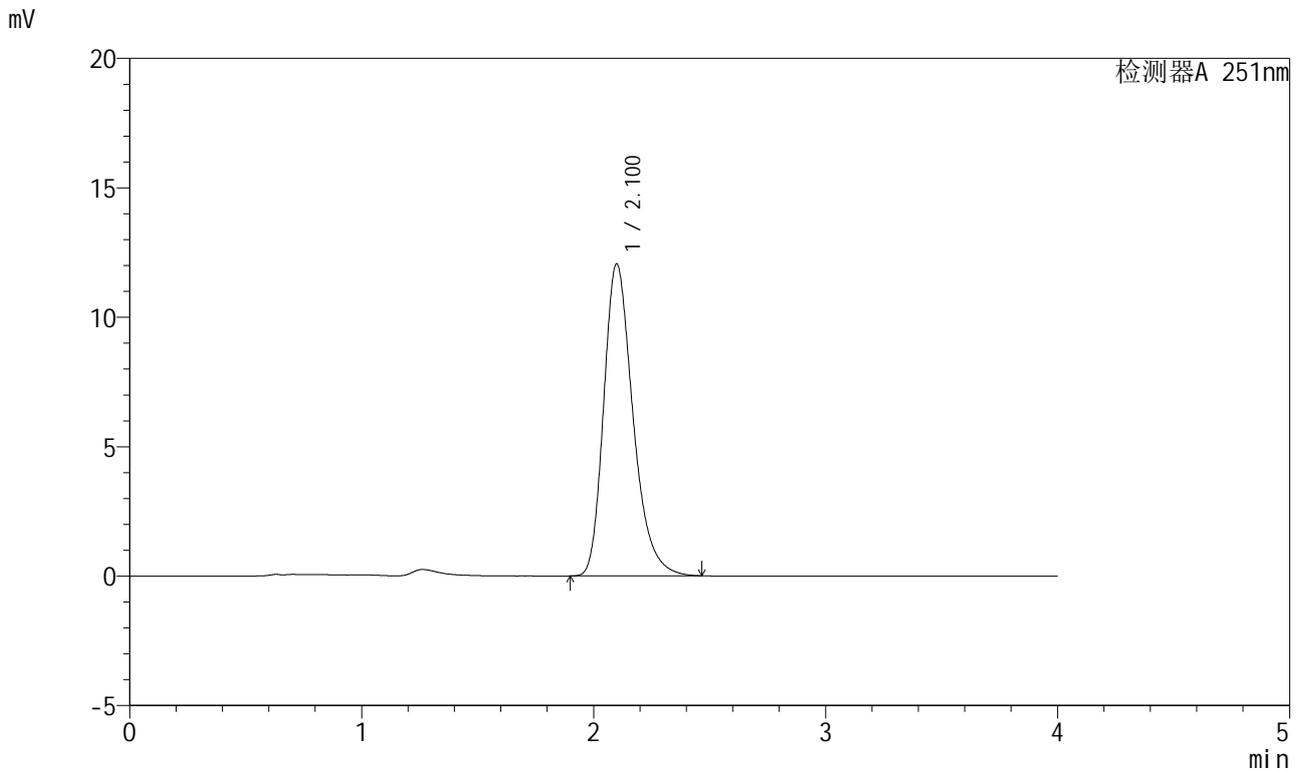

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	105806	100.000	12042	1374	1.292	--
总计		105806	100.000	12042			

图47 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3569-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 17:59:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

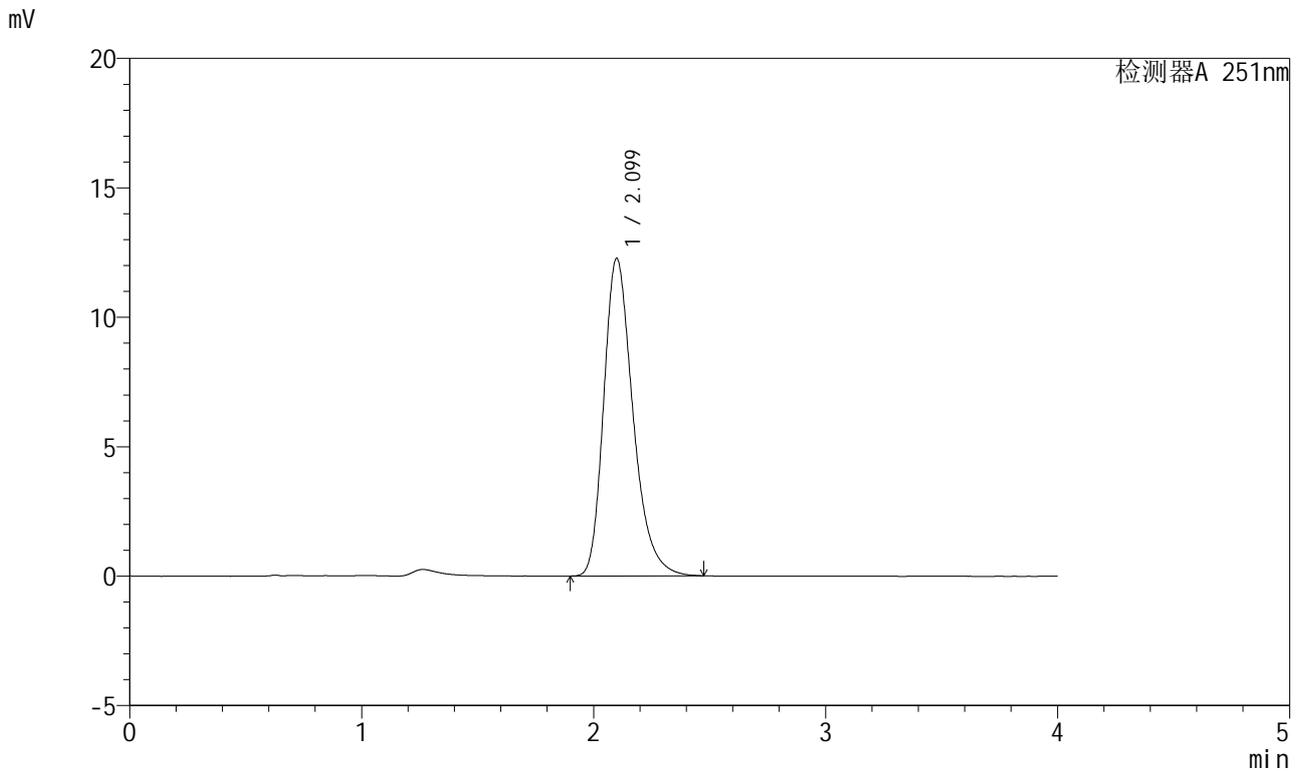

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	107682	100.000	12257	1378	1.292	--
总计		107682	100.000	12257			

图48 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3570-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:04:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

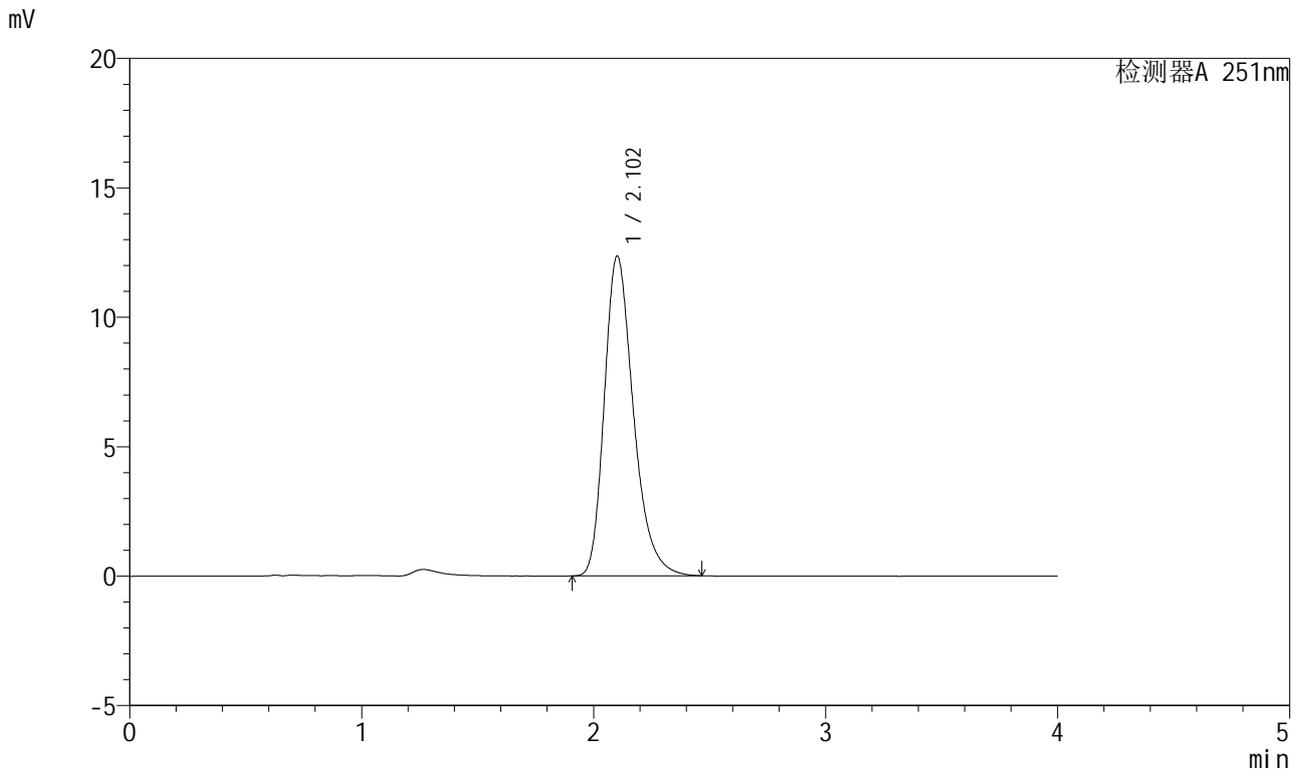

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	107944	100.000	12336	1391	1.293	--
总计		107944	100.000	12336			

图49 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3571-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:08:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

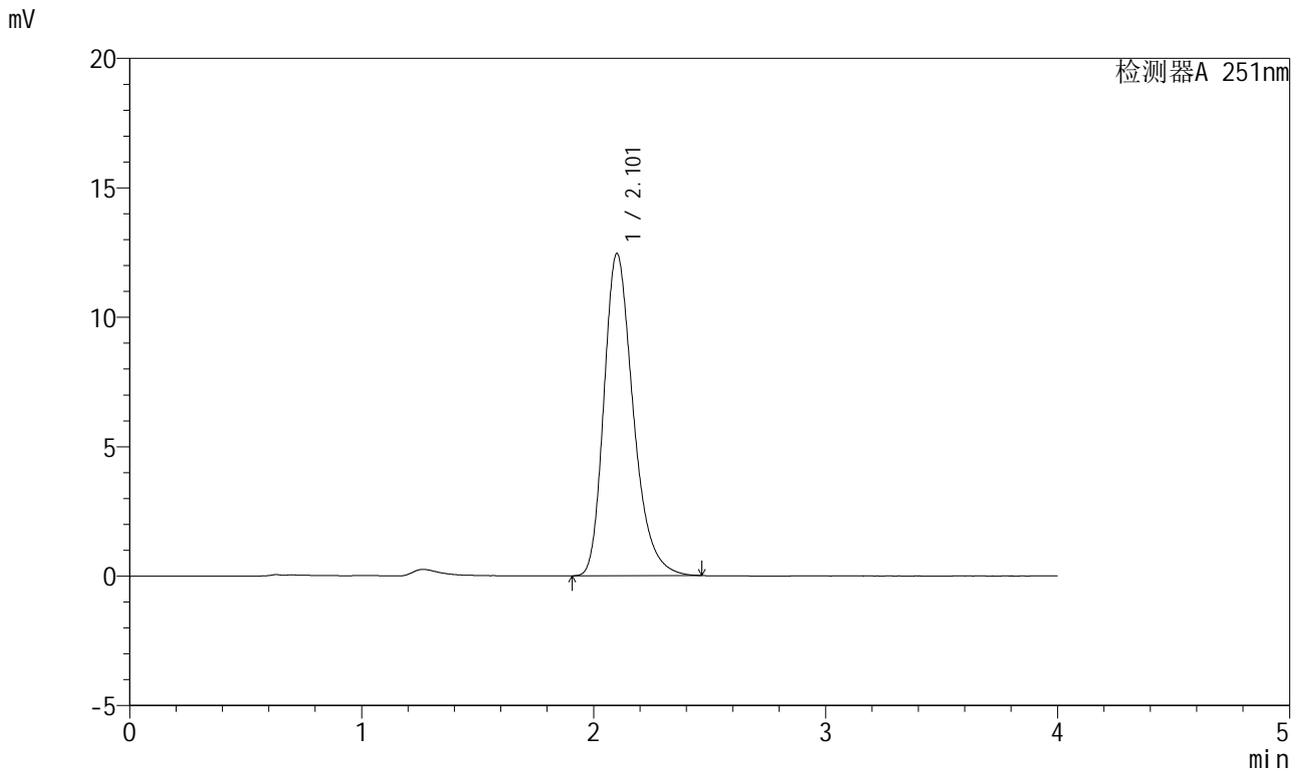

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	109282	100.000	12419	1376	1.292	--
总计		109282	100.000	12419			

图50 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3572-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:12:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

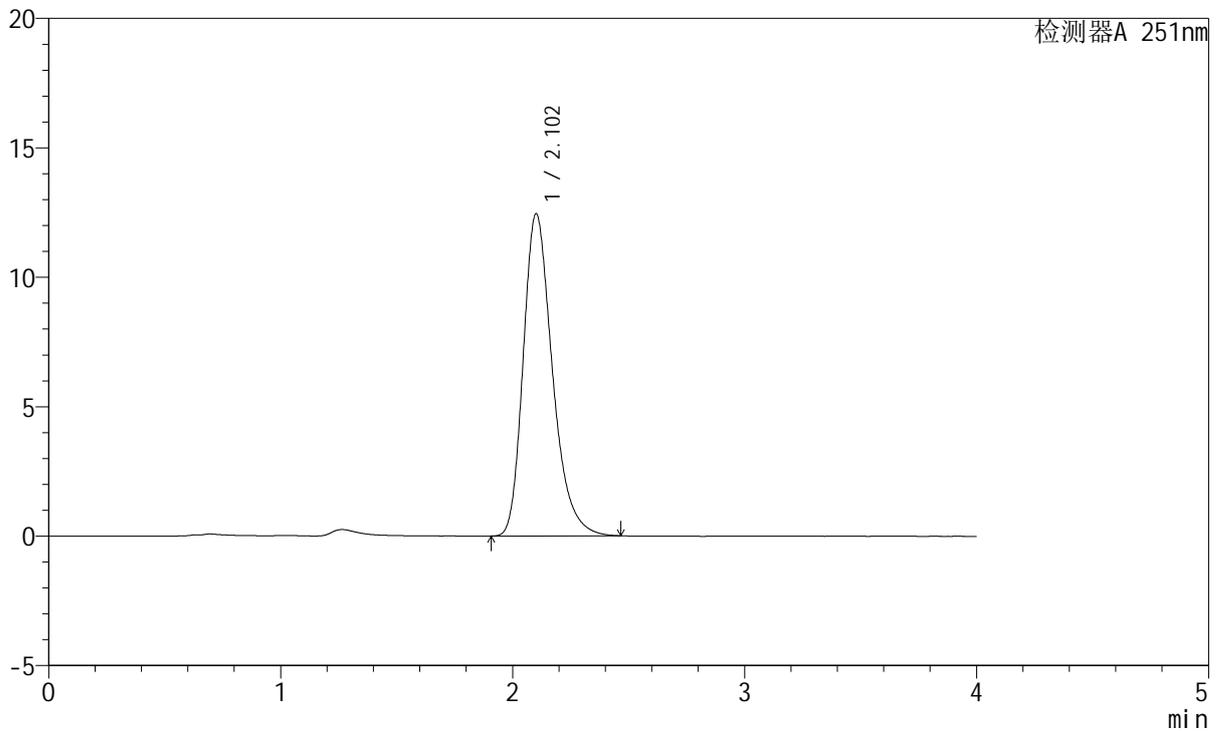

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	108950	100.000	12426	1385	1.292	--
总计		108950	100.000	12426			


图51 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3573-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:17:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

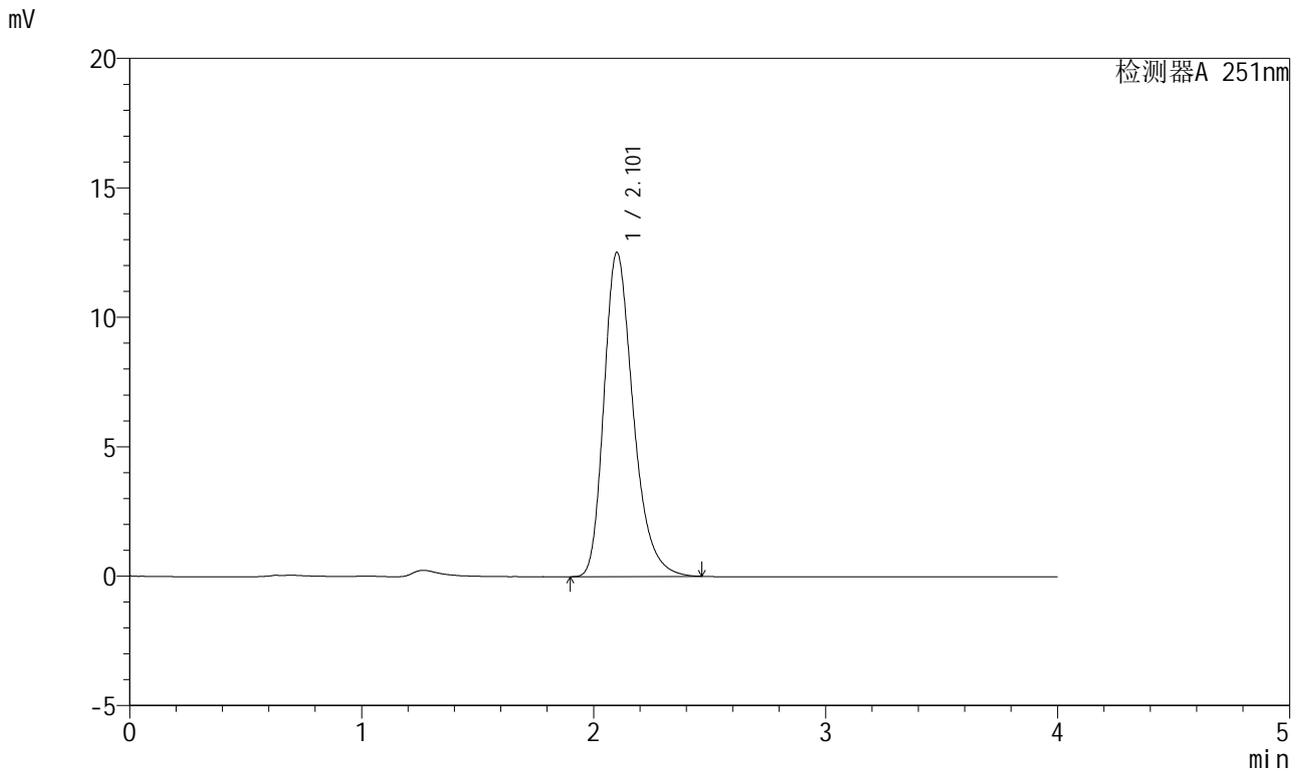

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	109694	100.000	12496	1384	1.293	--
总计		109694	100.000	12496			


图52 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3574-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:21:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

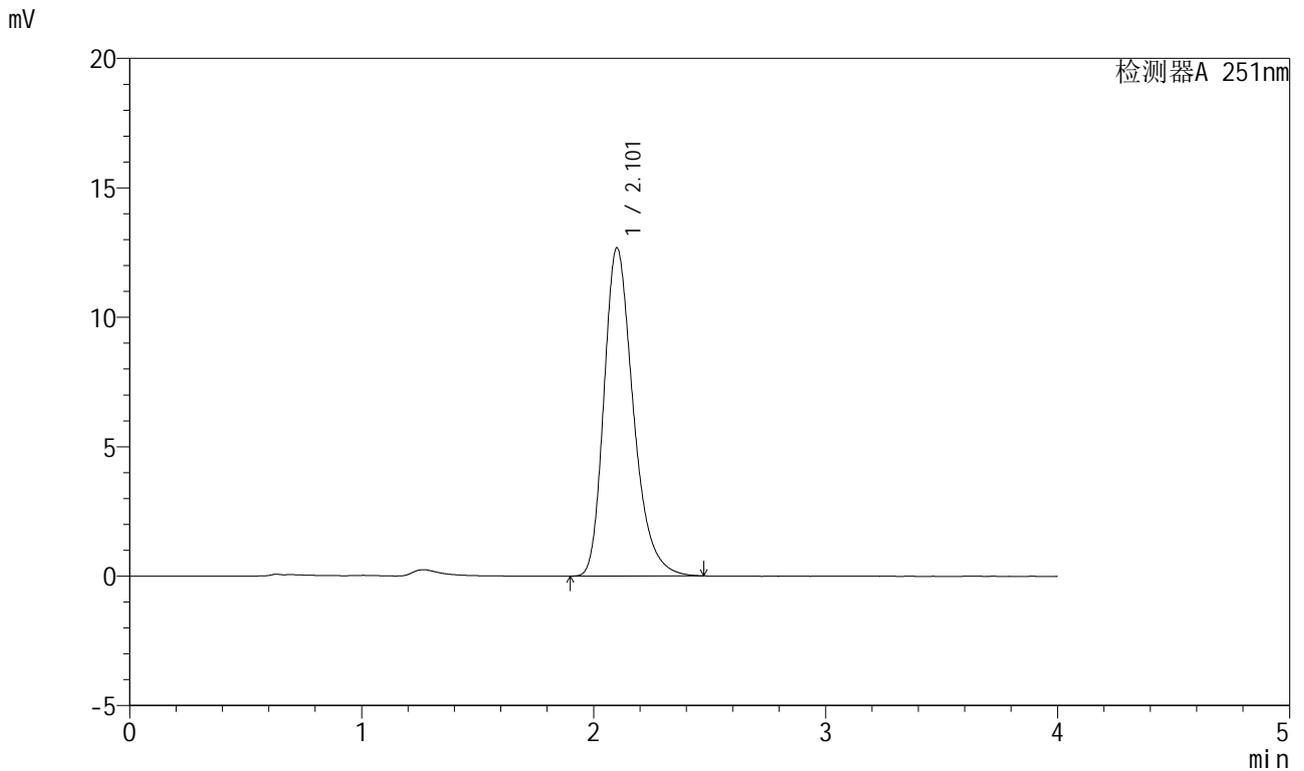

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	111322	100.000	12651	1379	1.295	--
总计		111322	100.000	12651			

图53 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3575-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:26:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

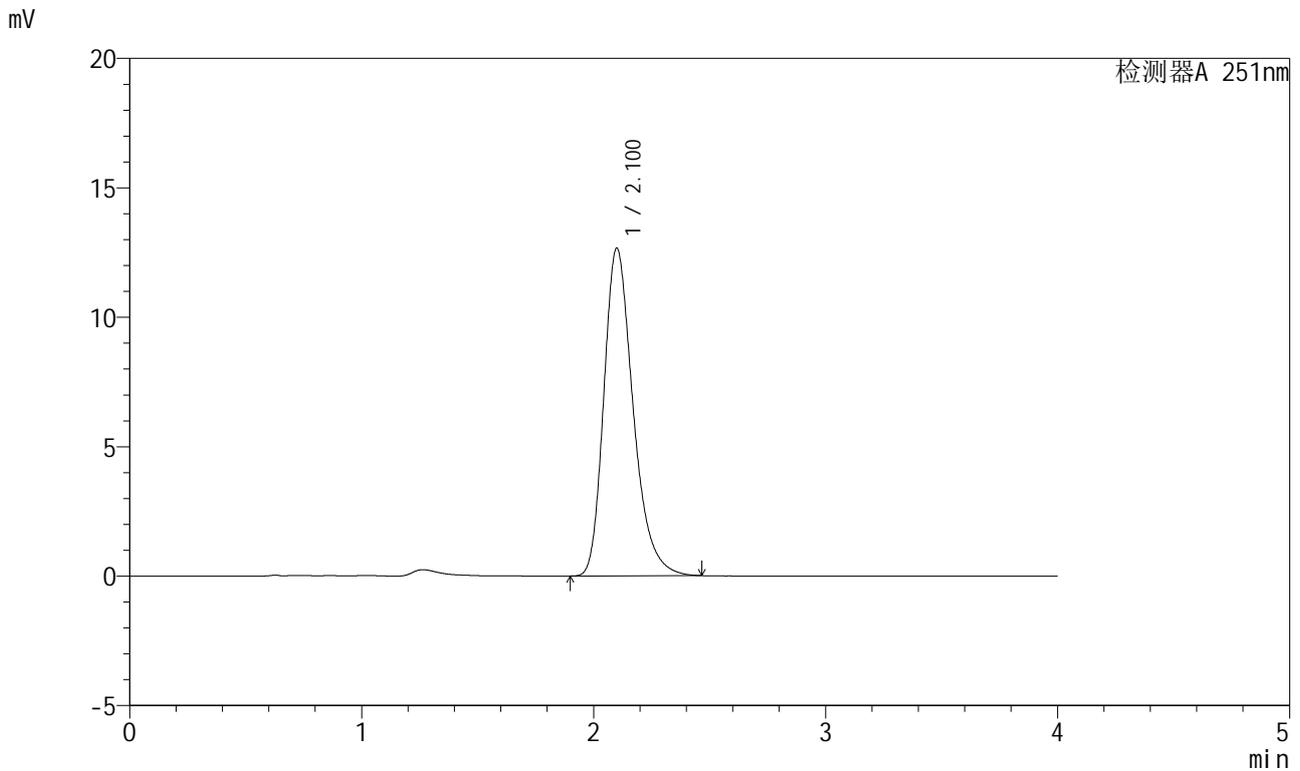

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	111218	100.000	12643	1374	1.295	--
总计		111218	100.000	12643			

图54 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3576-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:30:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

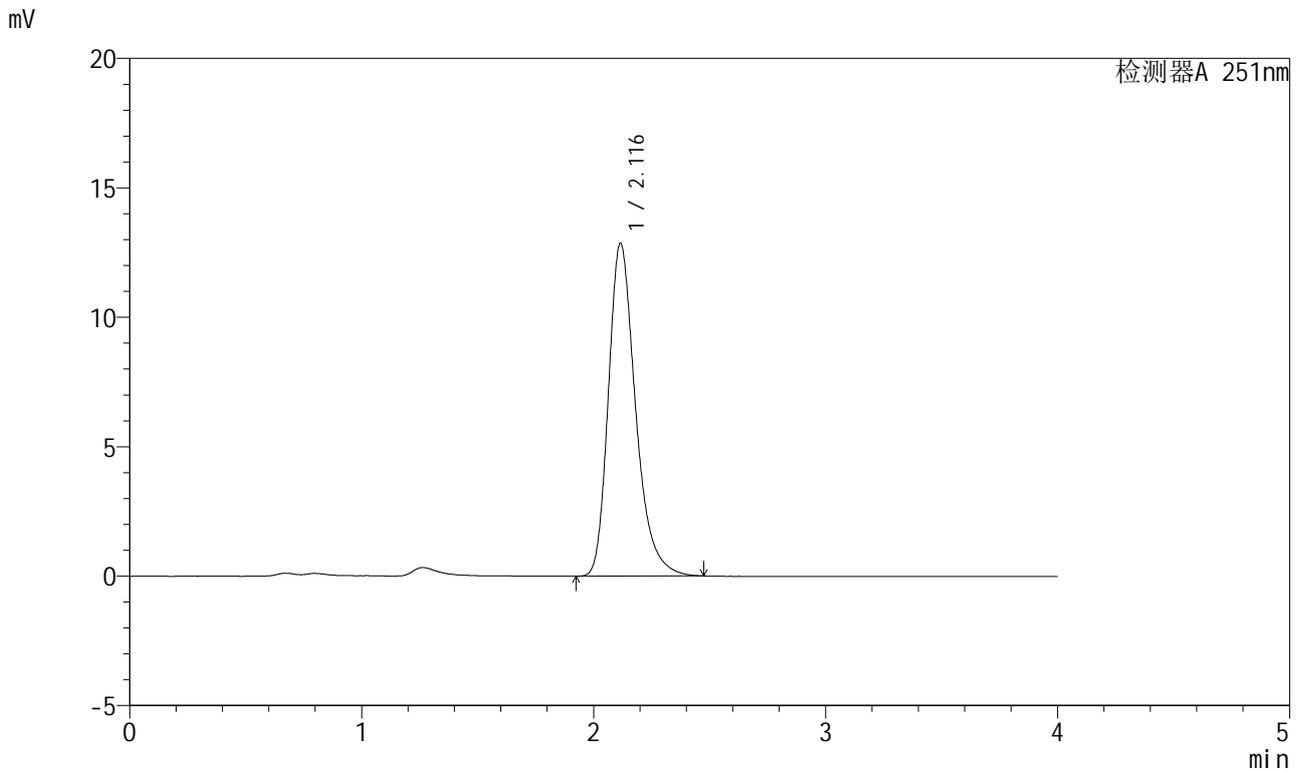

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	104649	100.000	12845	1647	1.296	--
总计		104649	100.000	12845			

图55 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3577-2 - zzp-2023111821p-jyx1-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:34:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

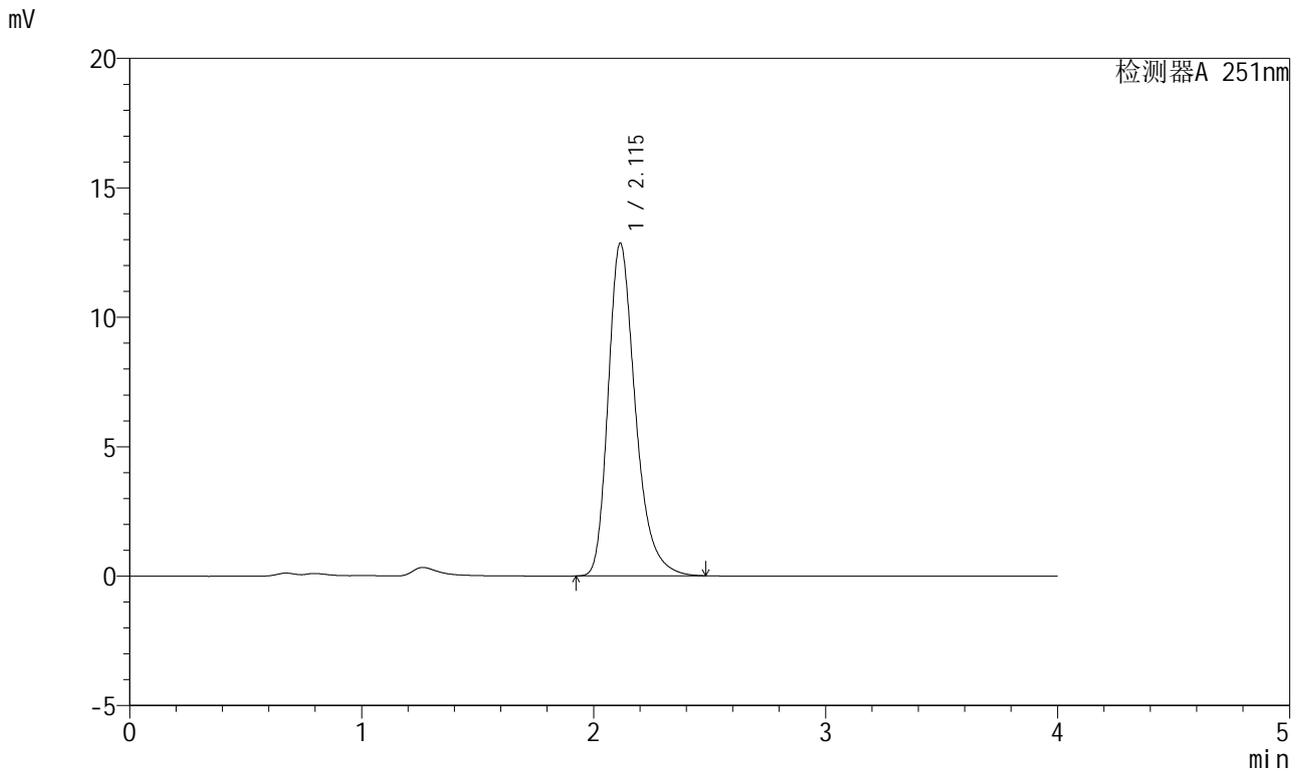

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	104736	100.000	12850	1644	1.299	--
总计		104736	100.000	12850			

图56 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3578-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:39:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

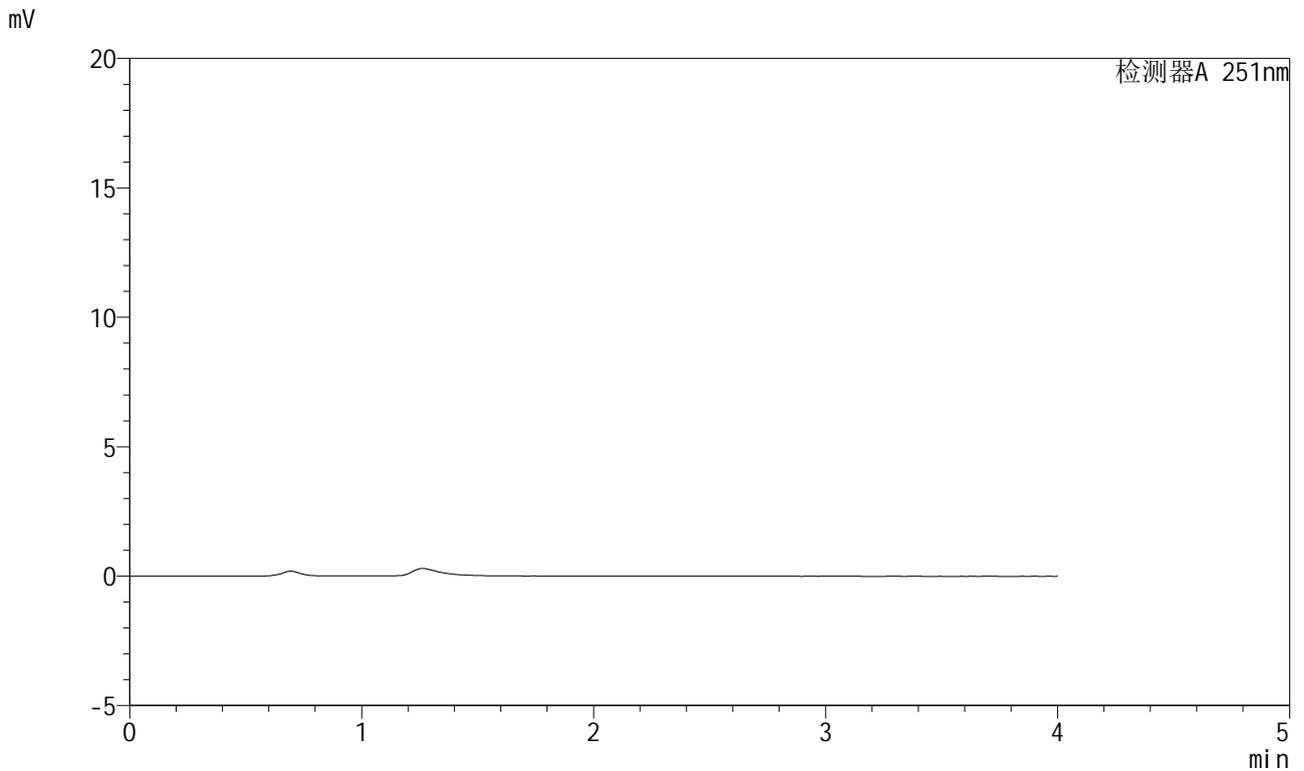

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3579-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:43:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

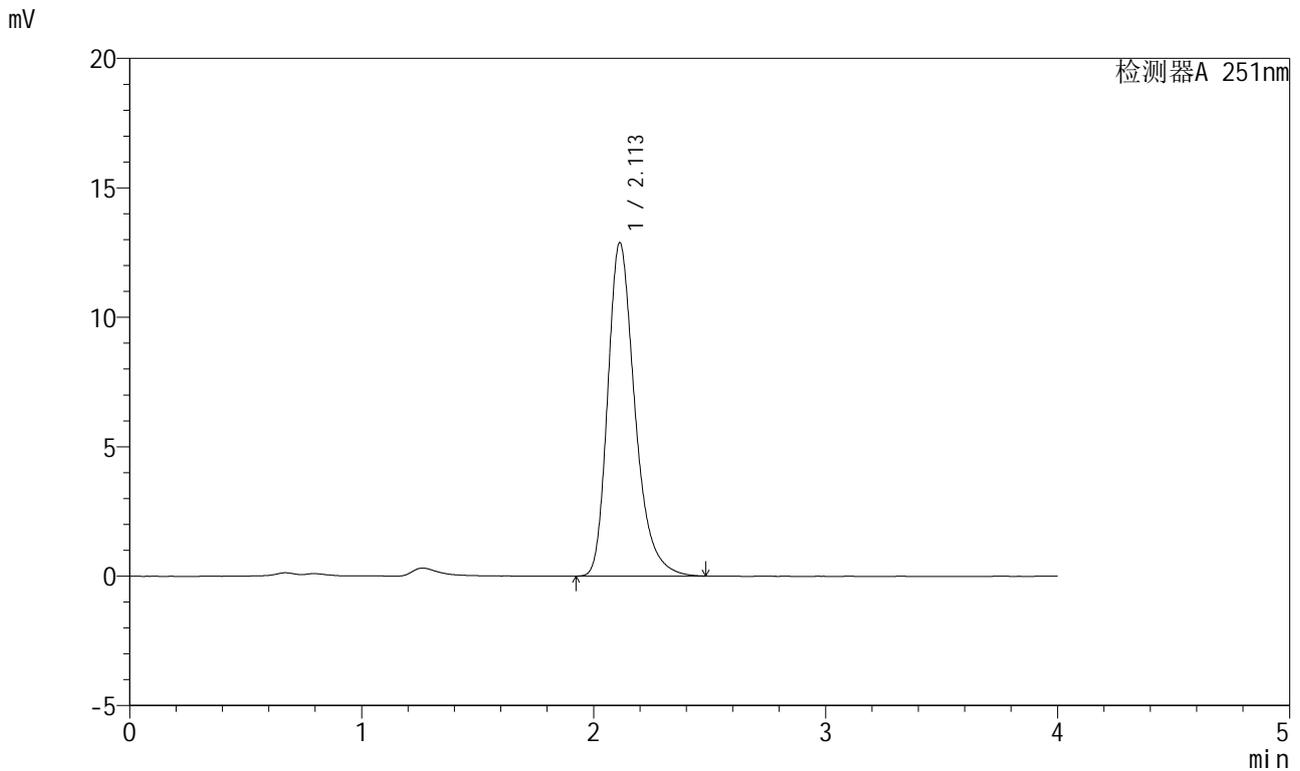

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	104922	100.000	12884	1643	1.301	--
总计		104922	100.000	12884			

图58 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3580-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:48:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

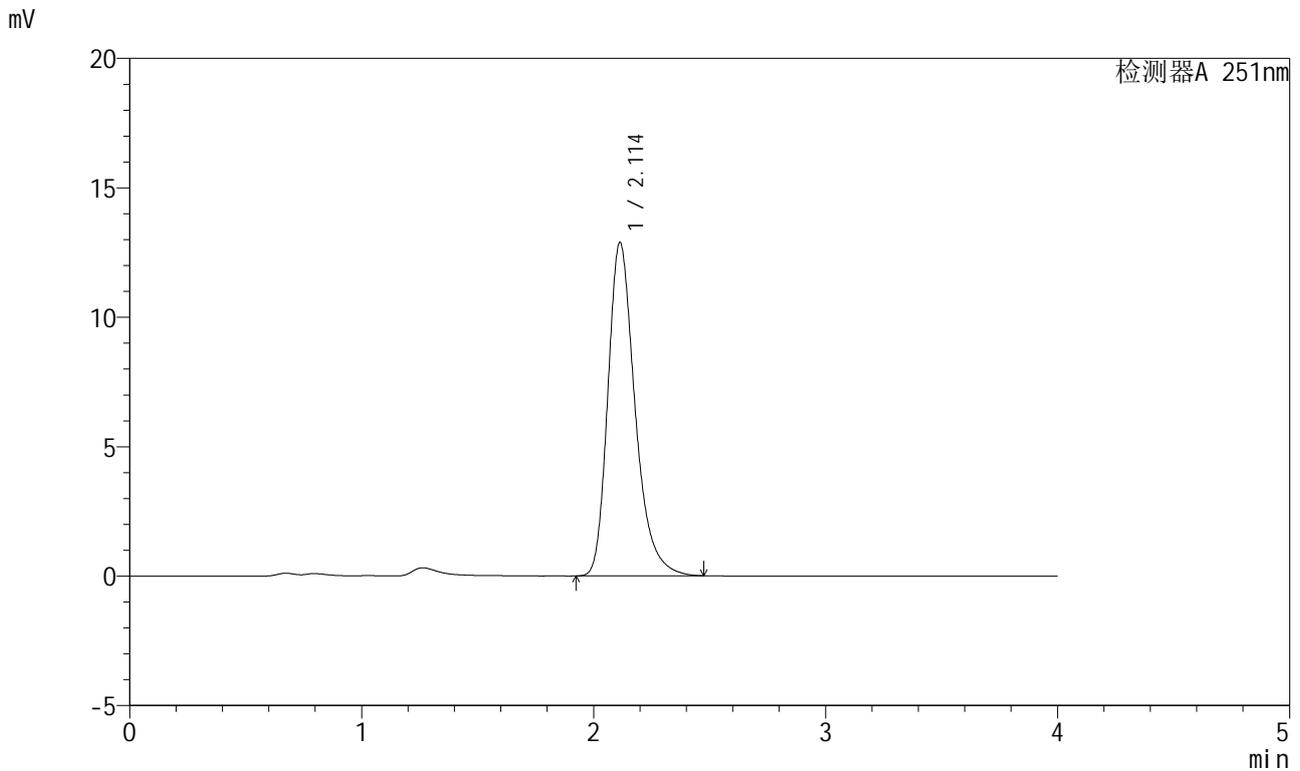

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	104957	100.000	12883	1640	1.299	--
总计		104957	100.000	12883			

图59 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3581-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:52:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

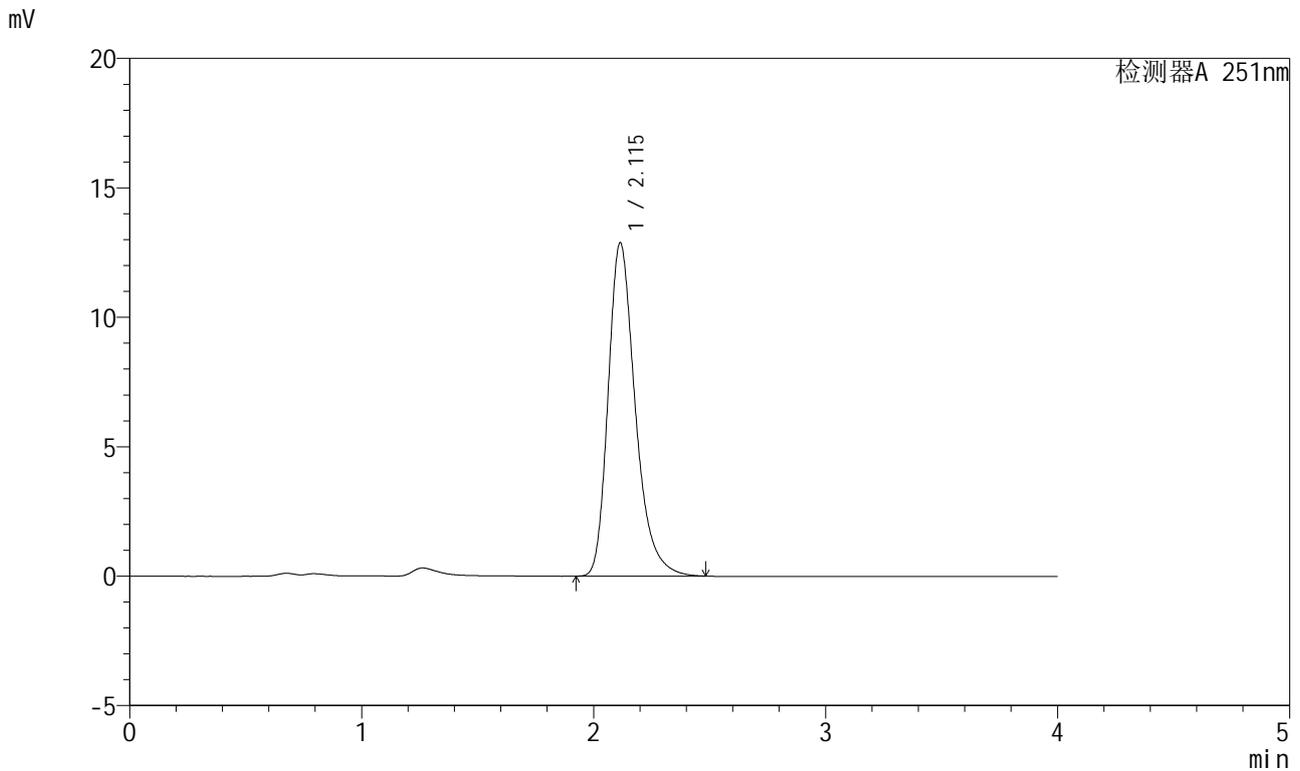

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	104874	100.000	12877	1643	1.299	--
总计		104874	100.000	12877			


图60 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3582-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 18:56:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

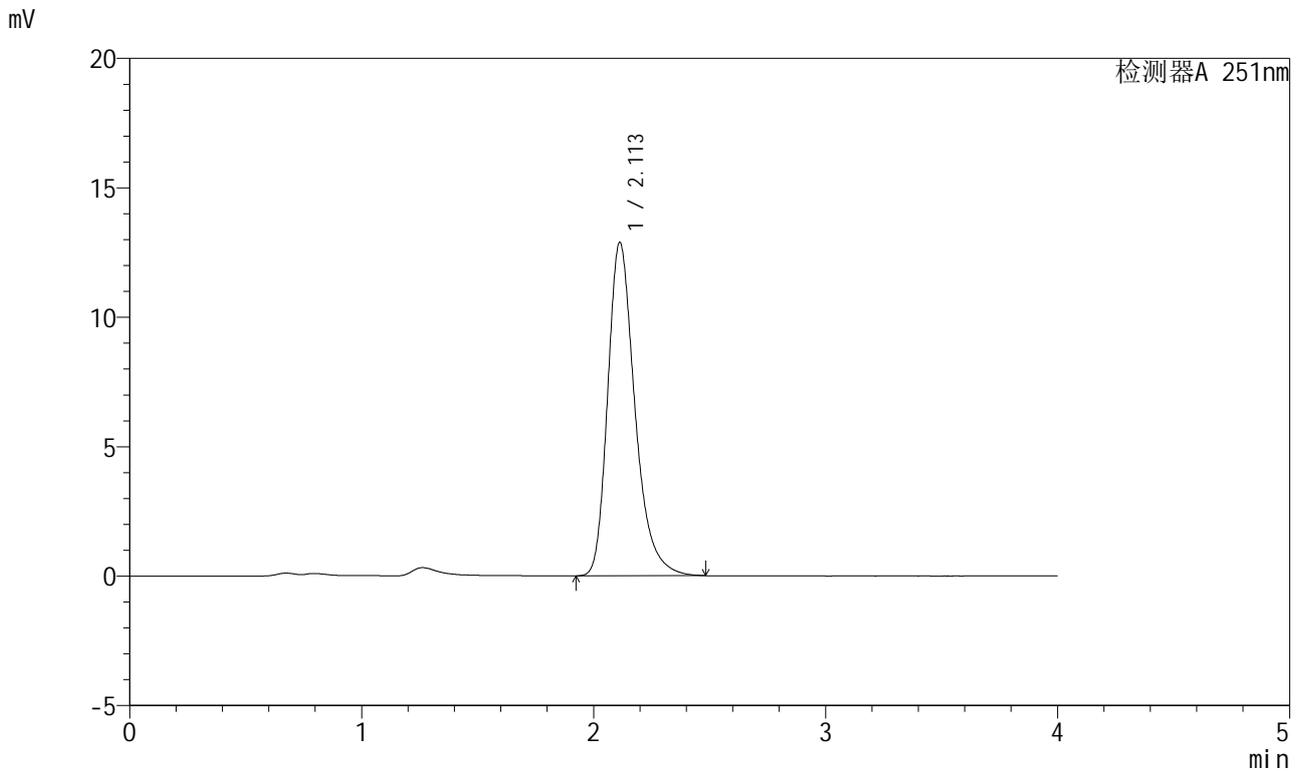

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	104992	100.000	12883	1641	1.301	--
总计		104992	100.000	12883			

图61 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3583-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:01:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

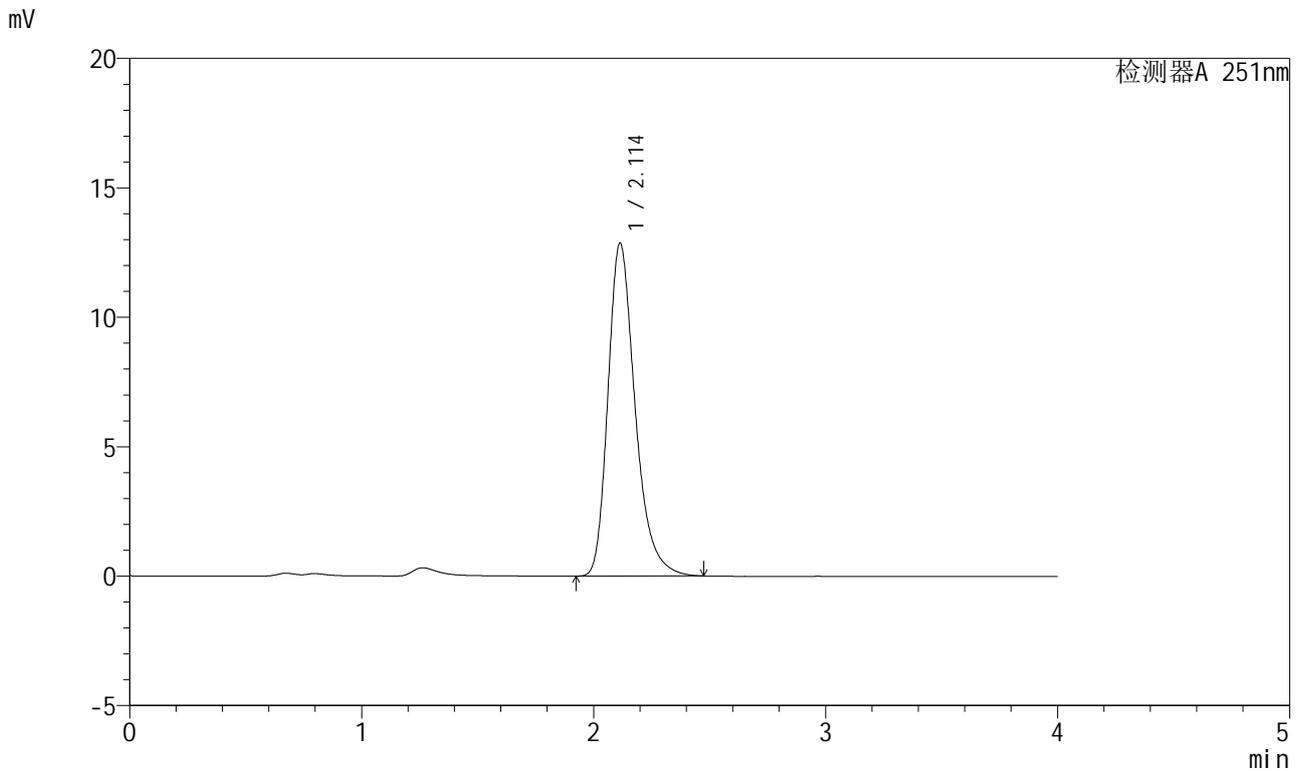

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	104829	100.000	12869	1643	1.299	--
总计		104829	100.000	12869			

图62 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3584-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:05:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:03:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

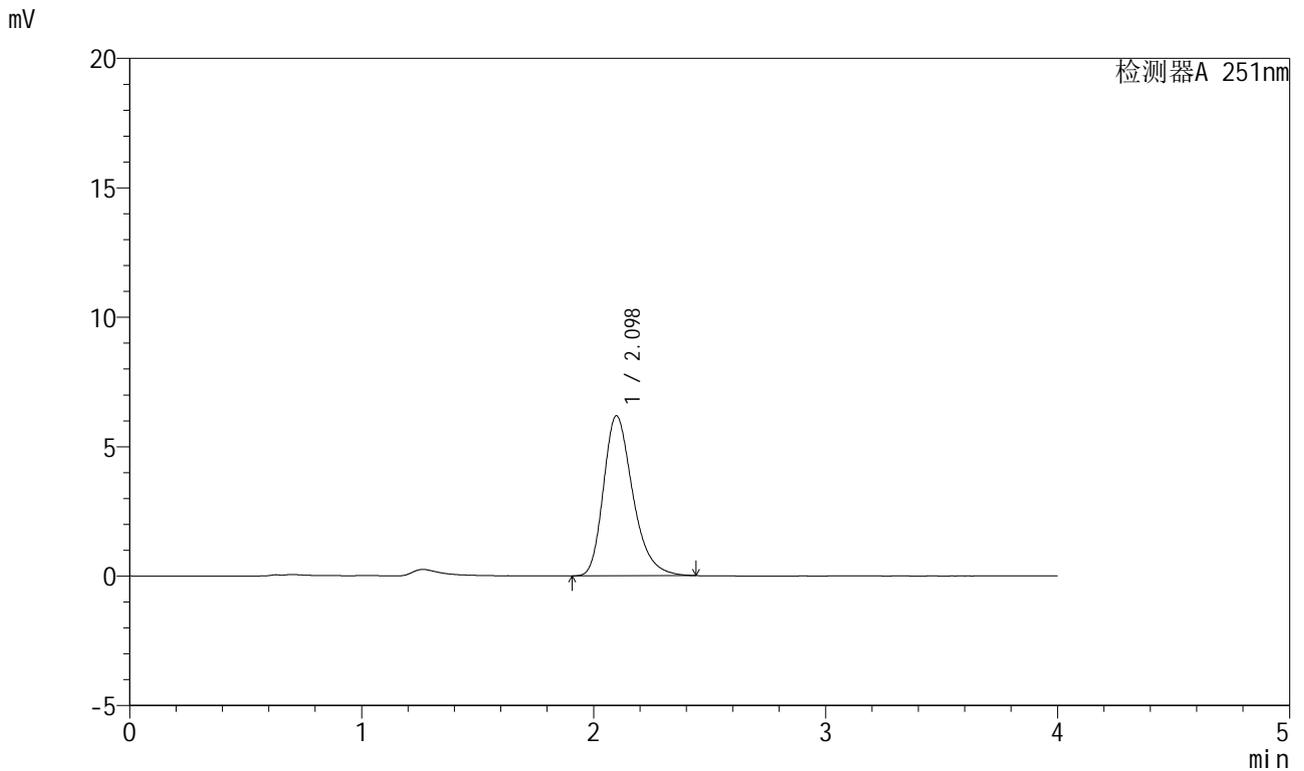

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	54266	100.000	6179	1371	1.296	--
总计		54266	100.000	6179			

图63 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3585-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:10:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

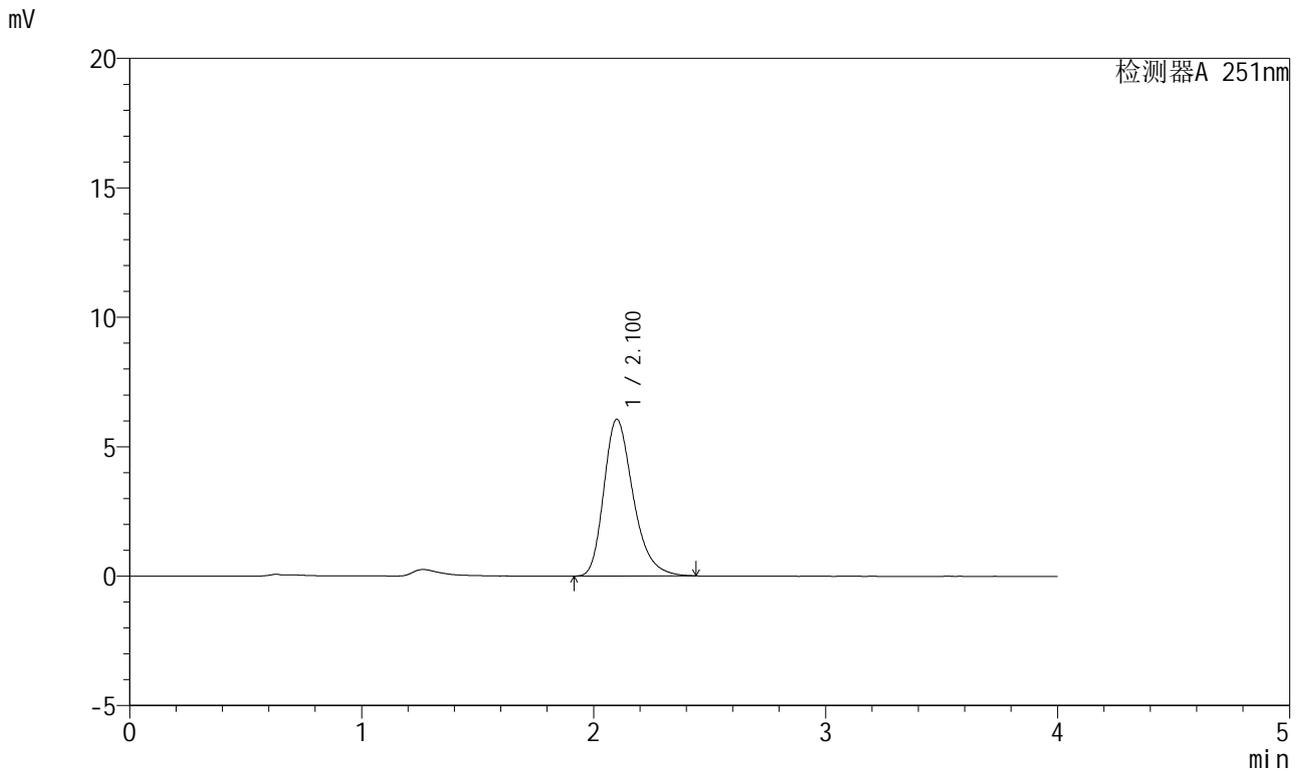

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	53164	100.000	6047	1372	1.294	--
总计		53164	100.000	6047			

图64 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3586-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:14:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

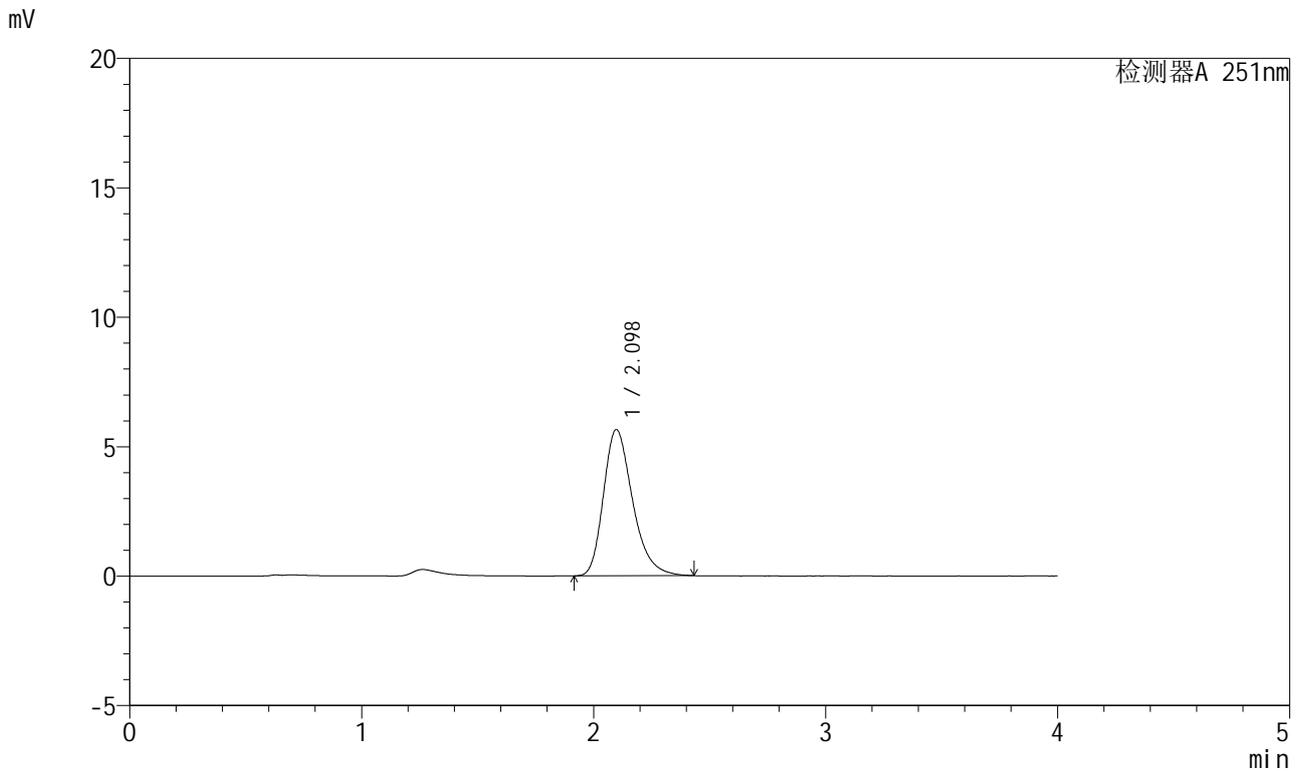

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	49444	100.000	5651	1375	1.296	--
总计		49444	100.000	5651			

图65 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3587-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:18:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

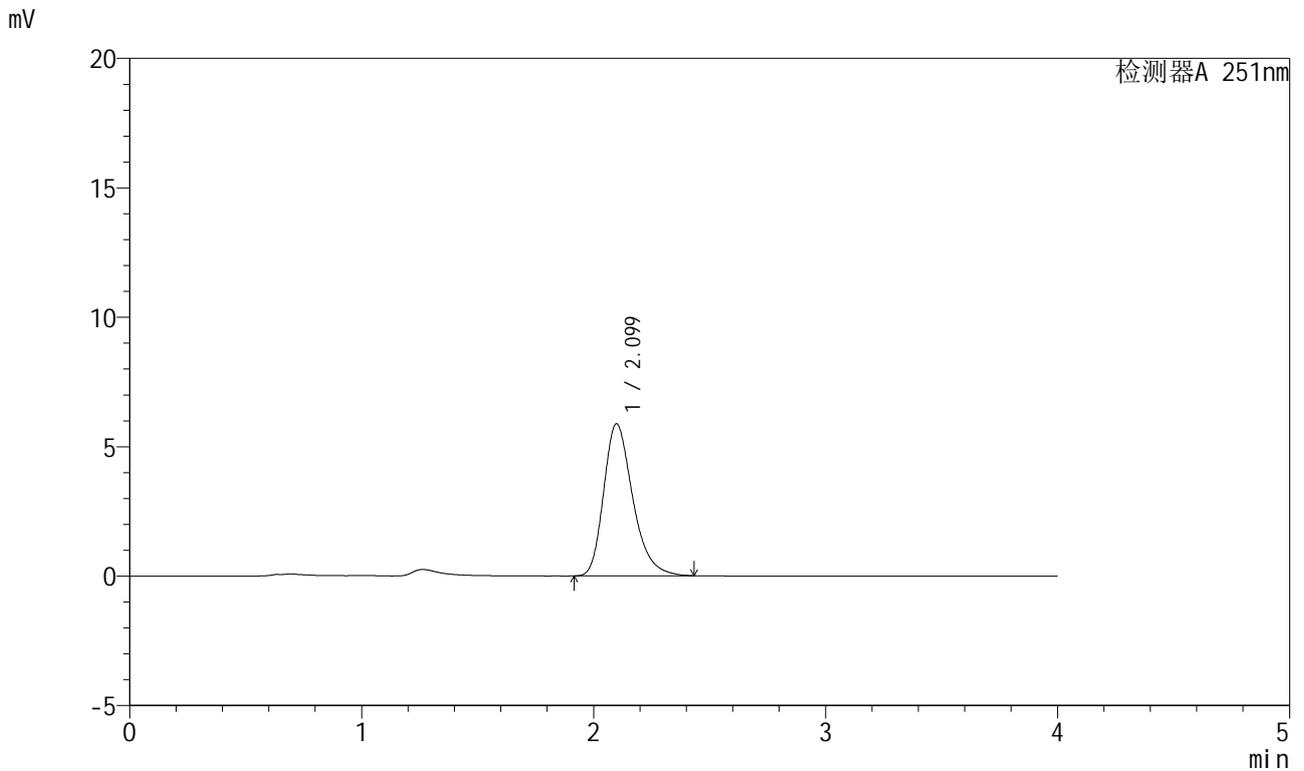

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	51167	100.000	5870	1391	1.296	--
总计		51167	100.000	5870			

图66 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3588-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:23:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

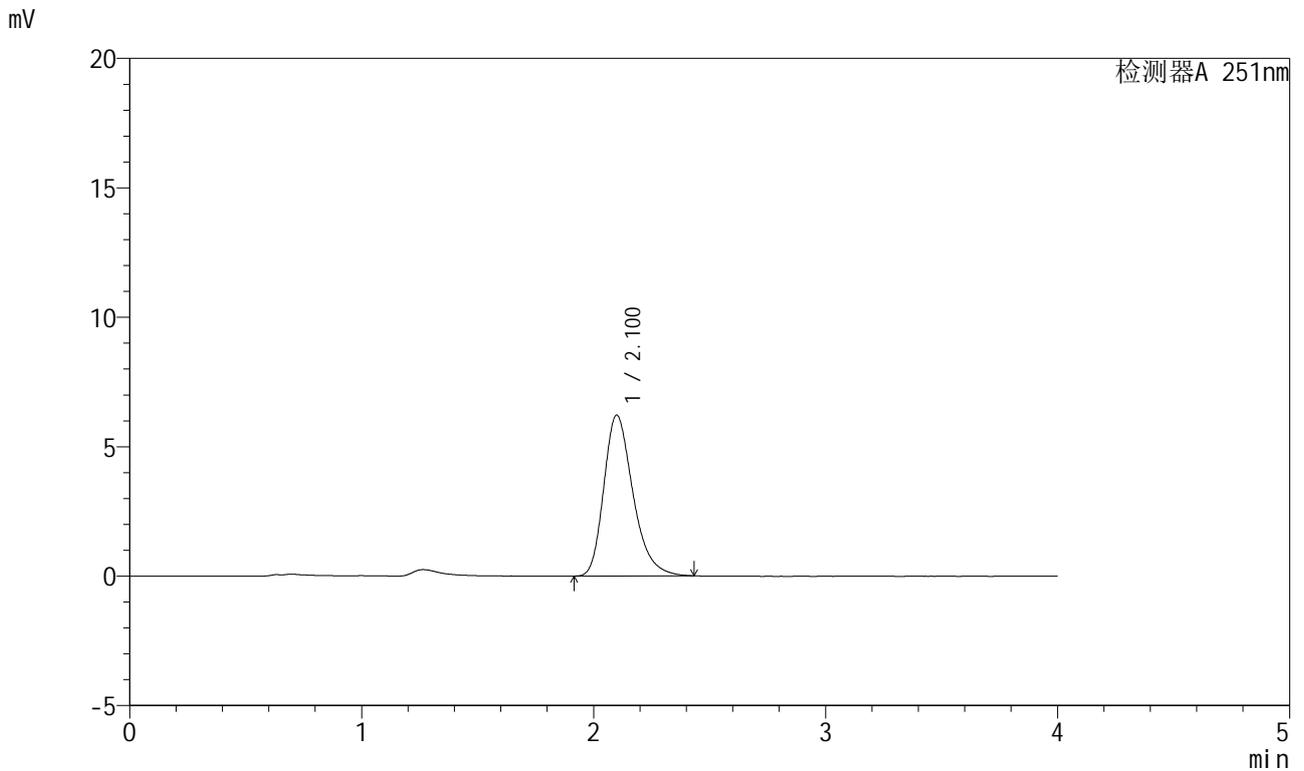

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	54307	100.000	6207	1383	1.295	--
总计		54307	100.000	6207			

图67 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3589-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:27:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

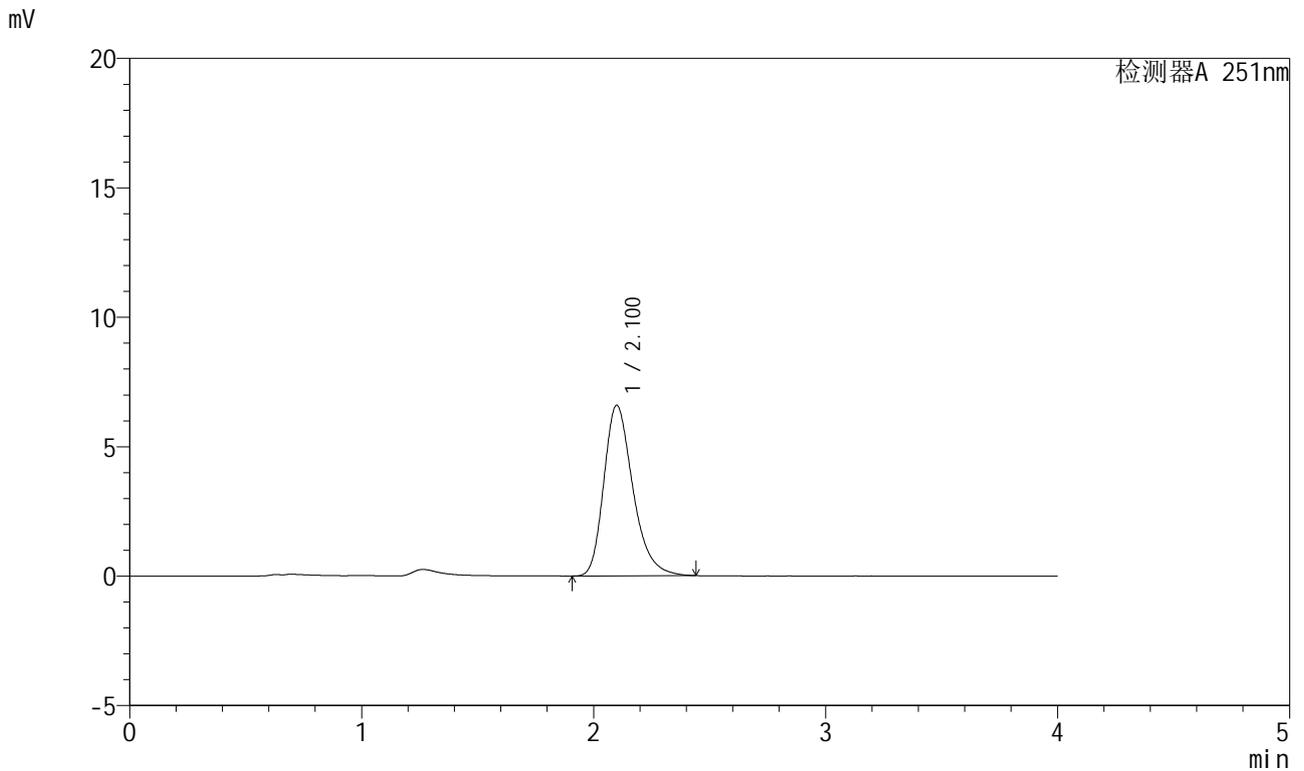

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	57453	100.000	6583	1395	1.292	--
总计		57453	100.000	6583			

图68 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3590-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:32:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

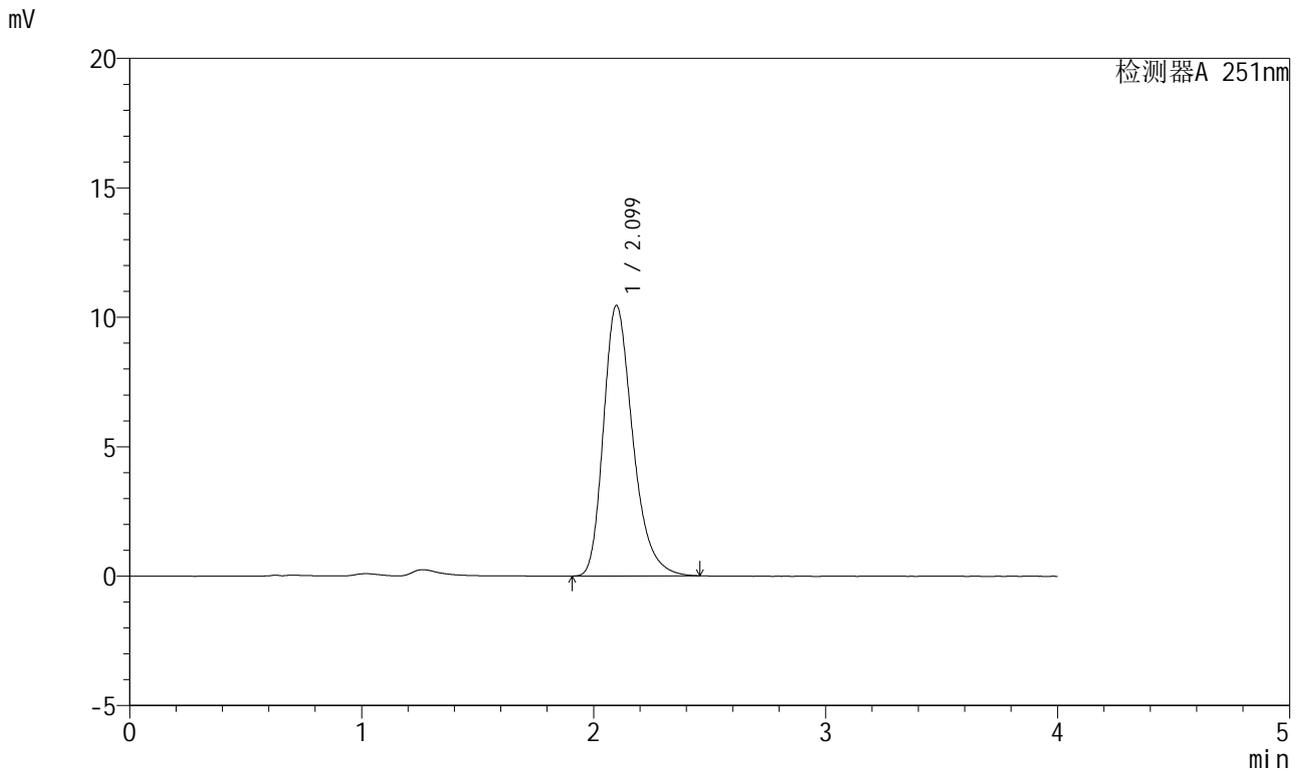

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	91791	100.000	10450	1373	1.295	--
总计		91791	100.000	10450			


图69 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3591-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:36:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

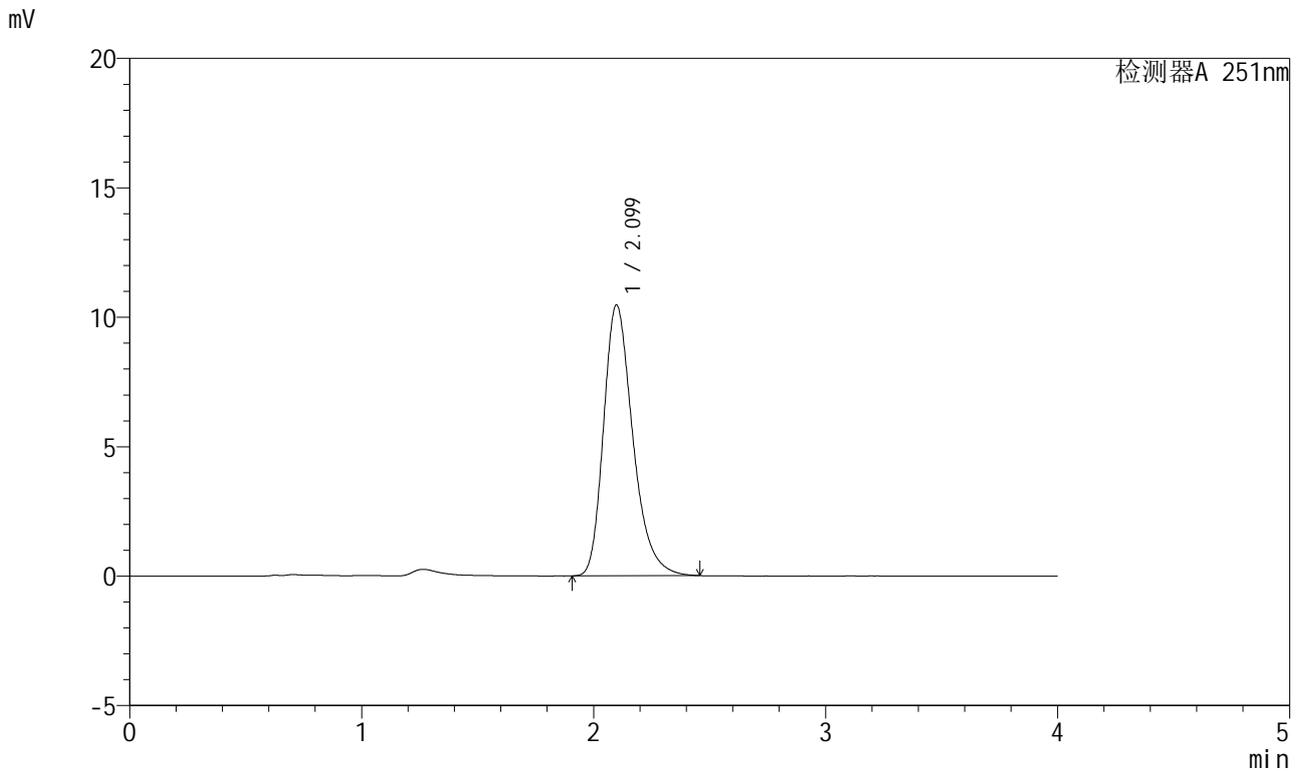

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	91901	100.000	10459	1373	1.296	--
总计		91901	100.000	10459			

图70 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3592-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:41:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

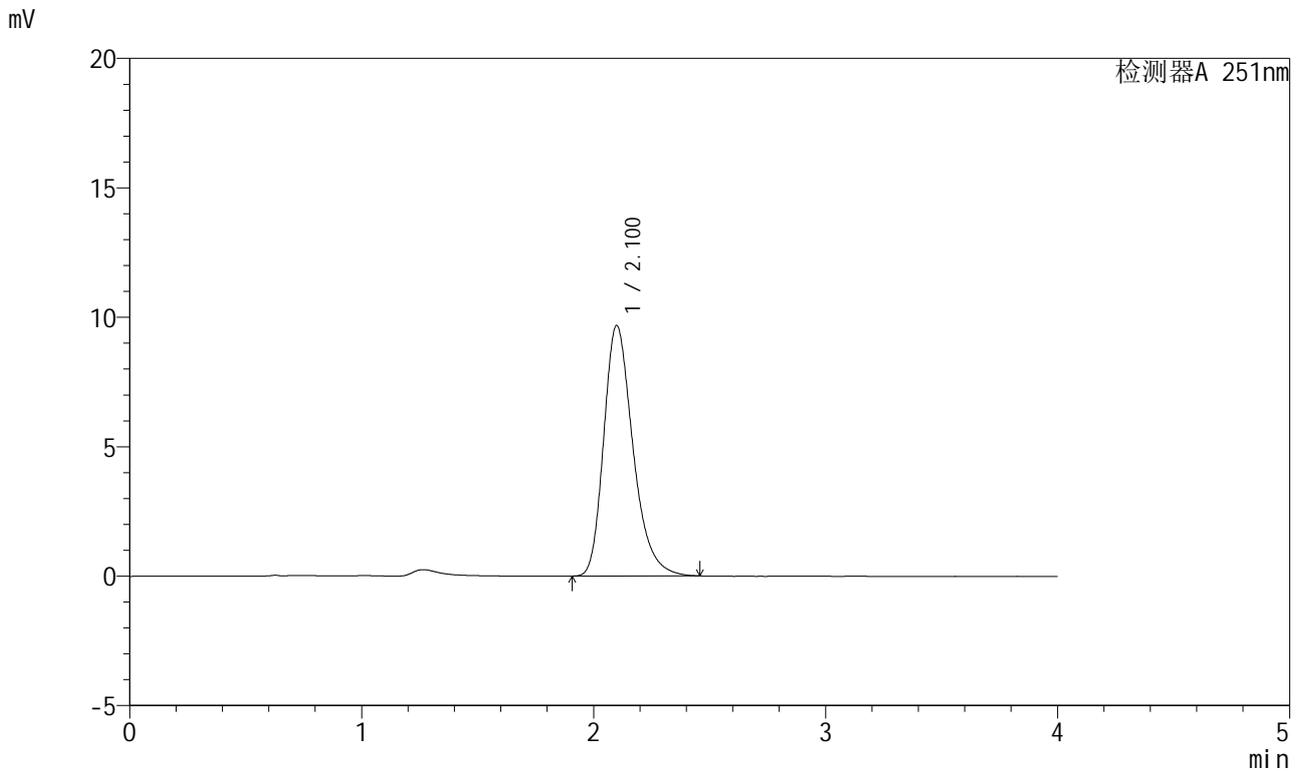

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	84876	100.000	9669	1380	1.294	--
总计		84876	100.000	9669			

图71 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3593-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:45:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

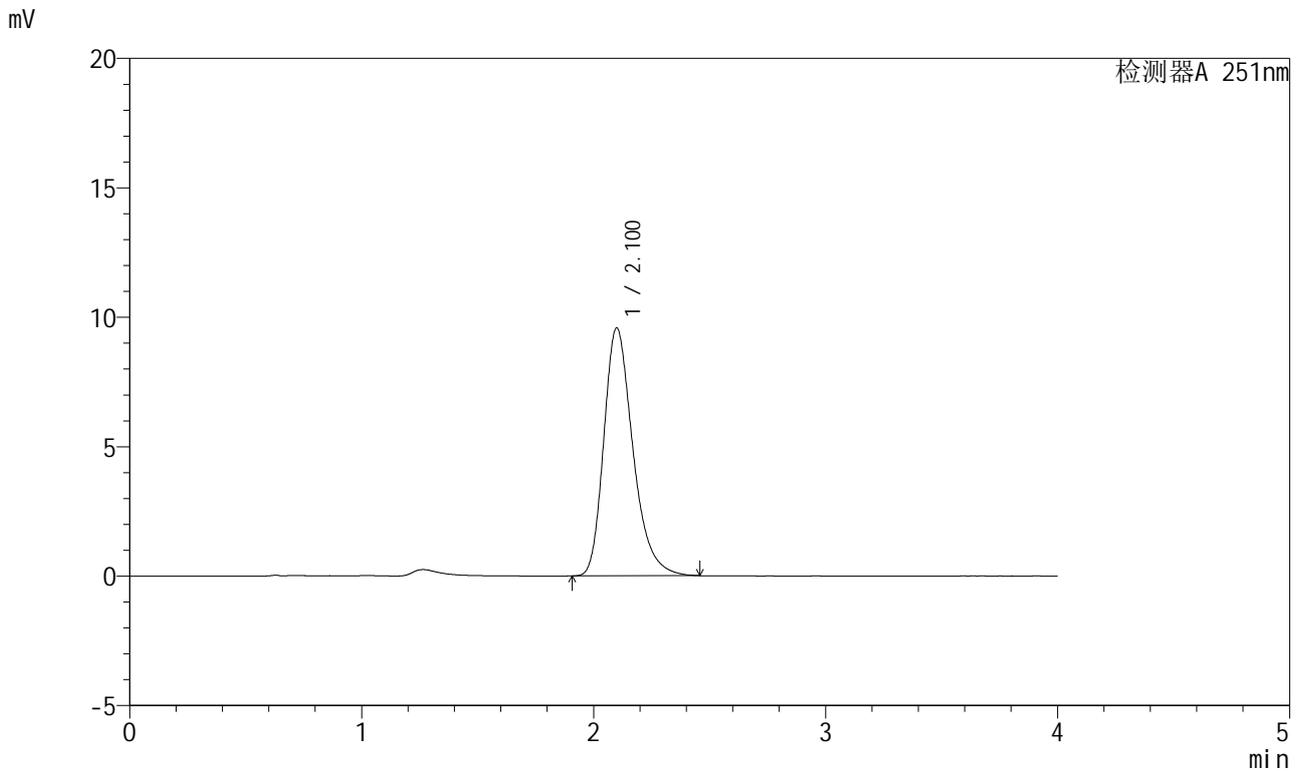

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	83606	100.000	9569	1395	1.298	--
总计		83606	100.000	9569			

图72 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3594-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:49:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

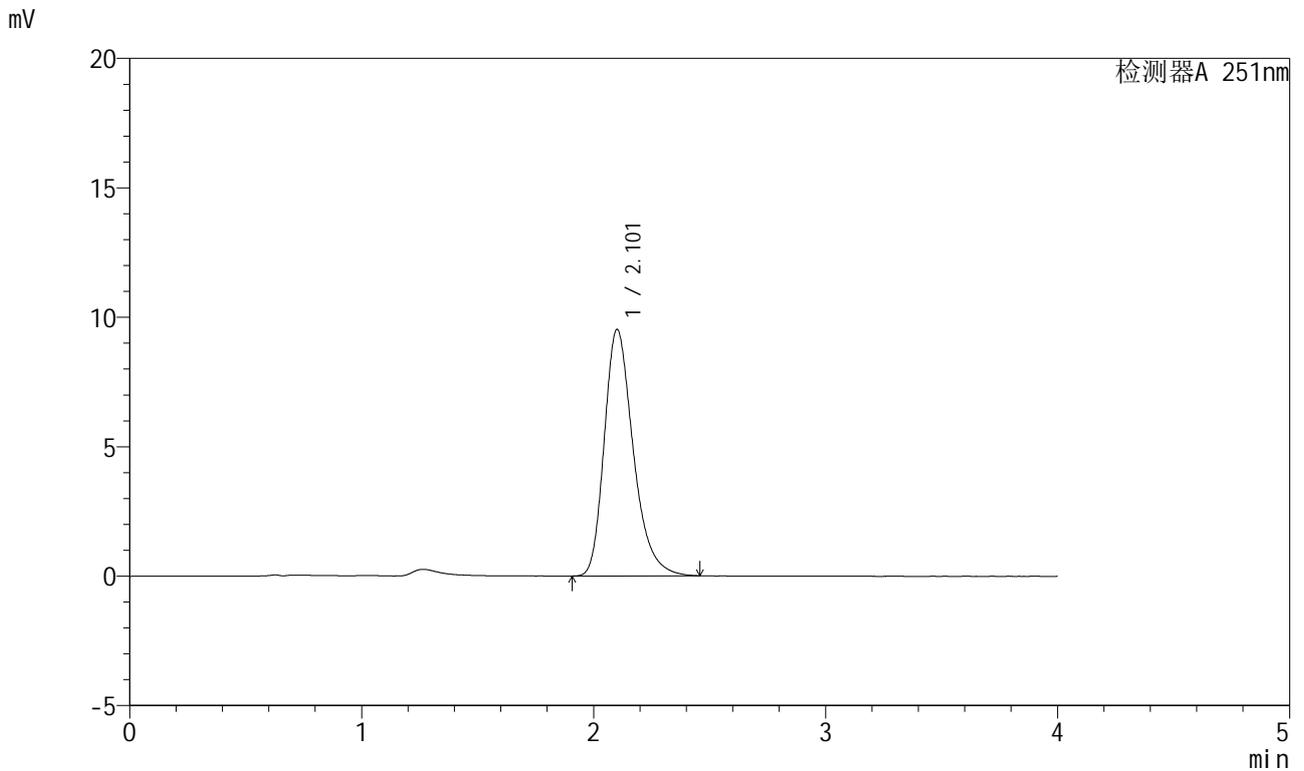

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	82705	100.000	9500	1412	1.299	--
总计		82705	100.000	9500			

图73 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3595-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:54:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

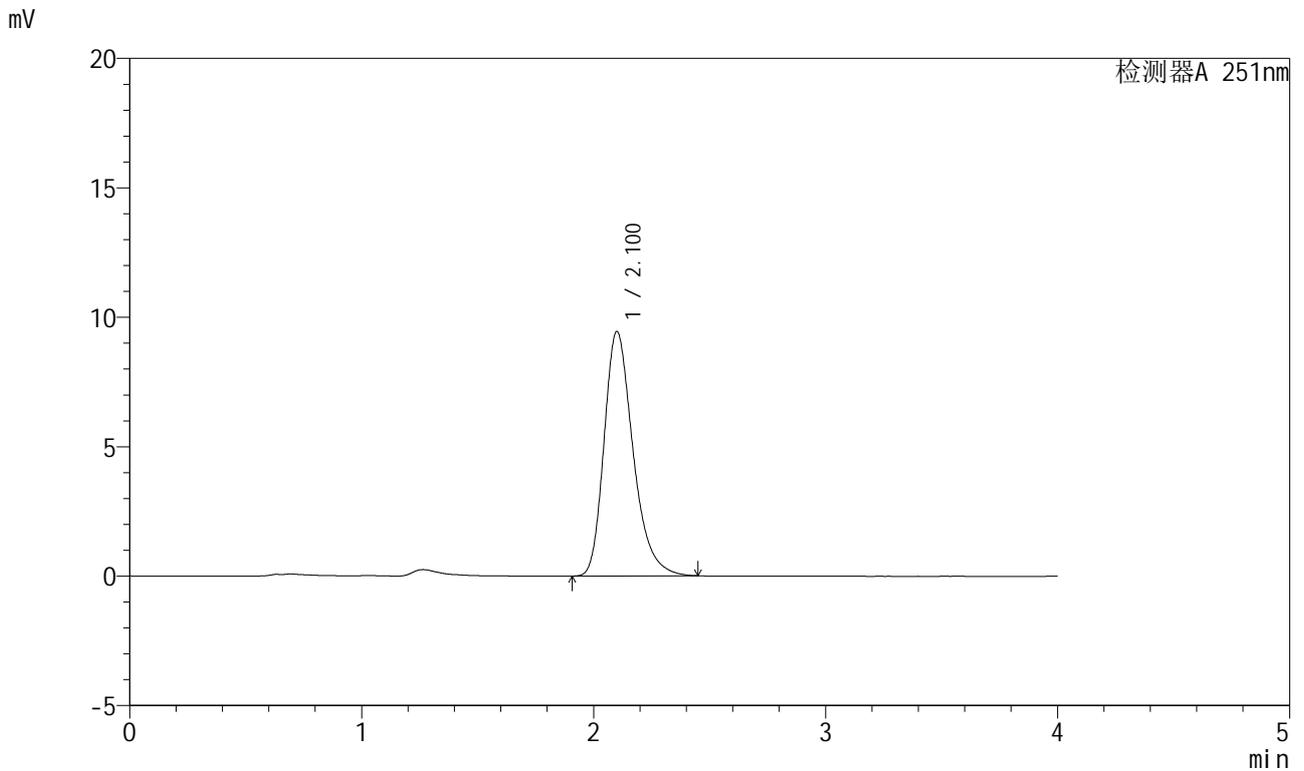

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	82102	100.000	9428	1409	1.297	--
总计		82102	100.000	9428			

图74 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3596-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 19:58:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

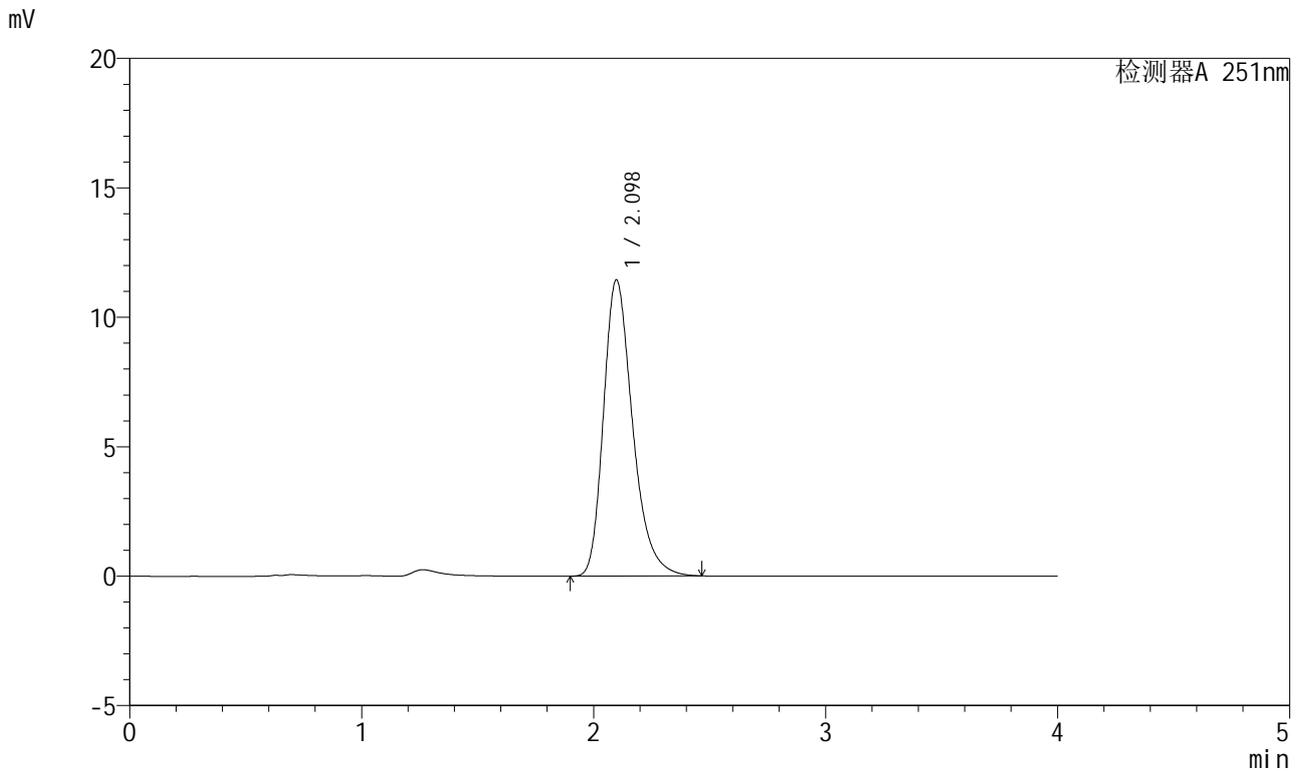

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	99884	100.000	11440	1395	1.298	--
总计		99884	100.000	11440			

图75 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3597-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:03:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

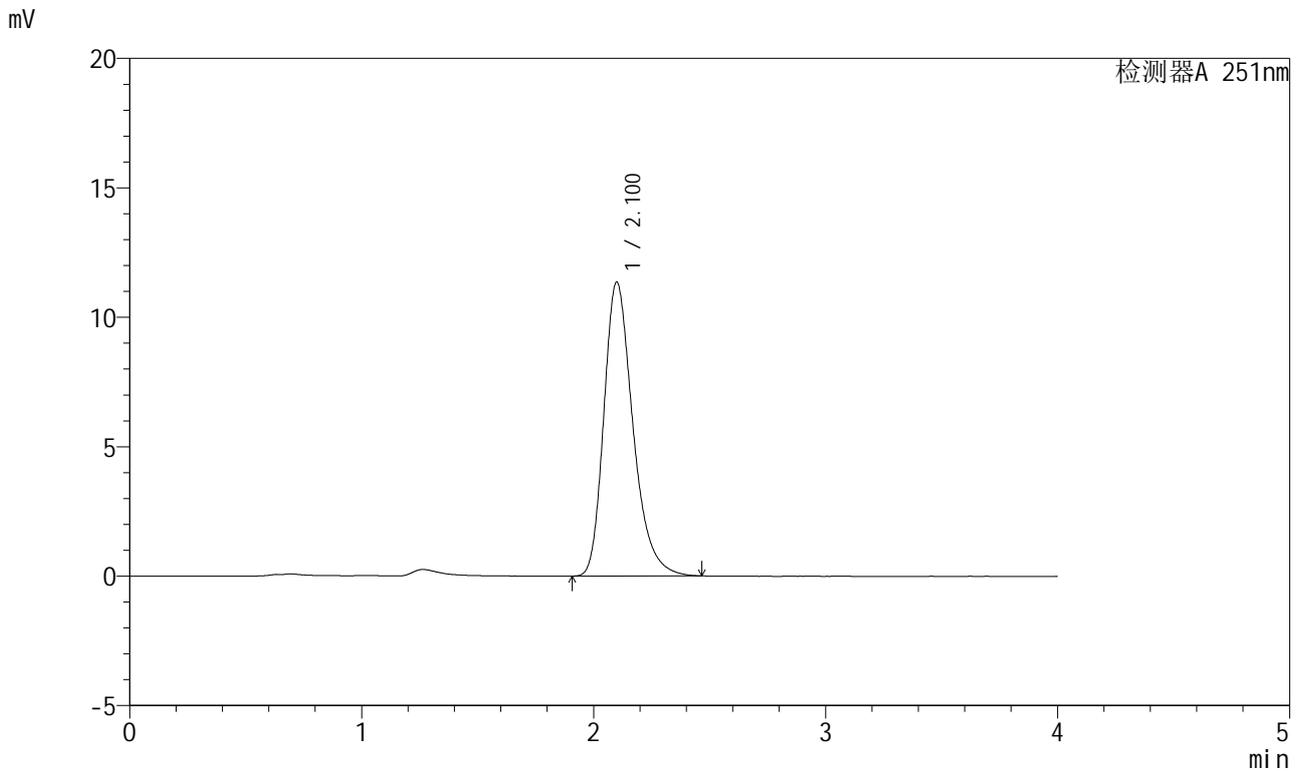

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	98964	100.000	11341	1399	1.299	--
总计		98964	100.000	11341			

图76 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3598-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:07:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

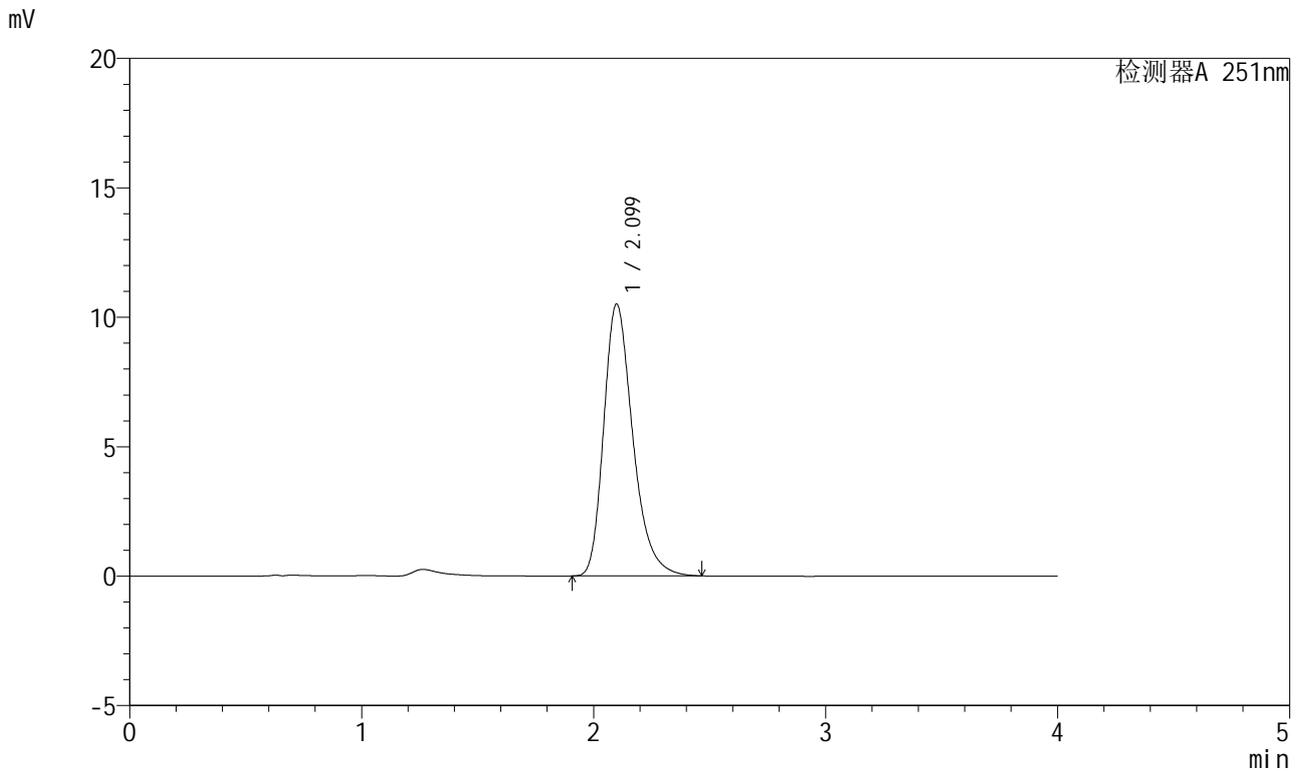

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	91740	100.000	10496	1393	1.298	--
总计		91740	100.000	10496			

图77 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3599-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:11:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

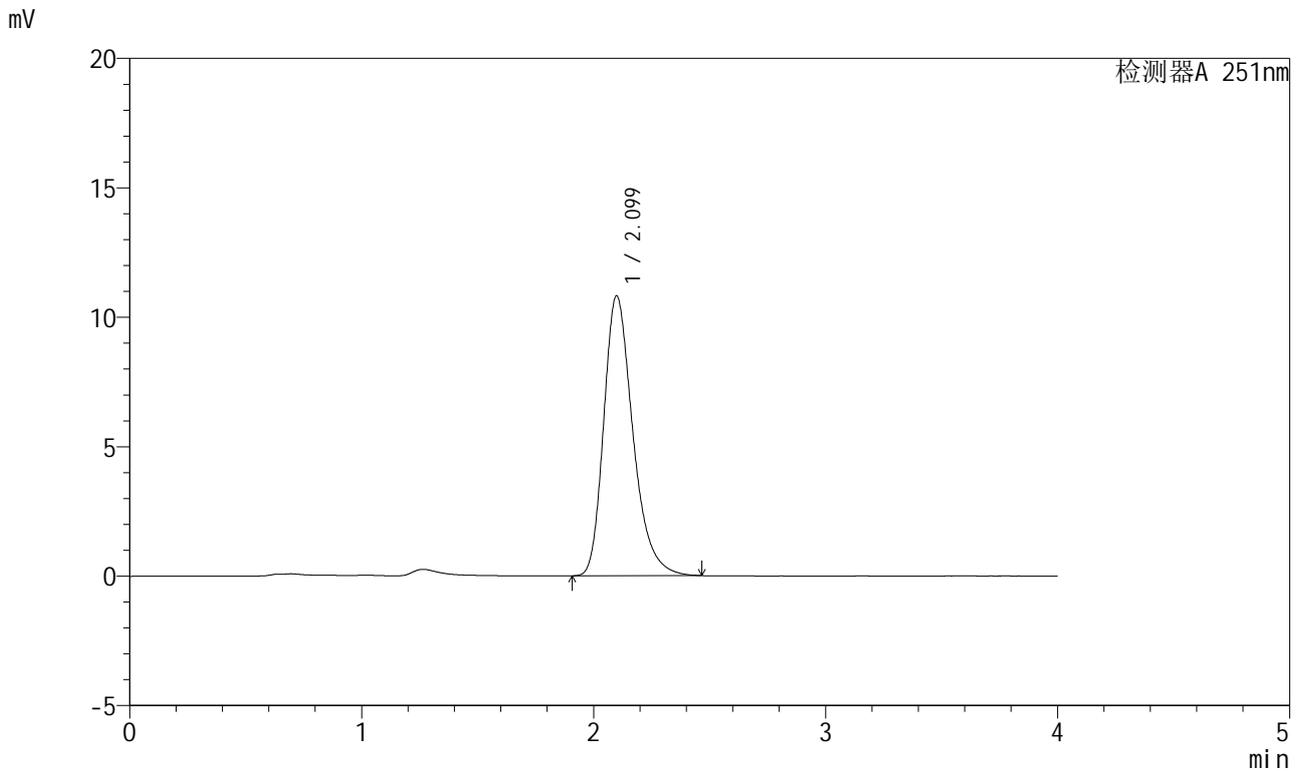

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	94520	100.000	10805	1391	1.301	--
总计		94520	100.000	10805			

图78 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3600-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:16:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

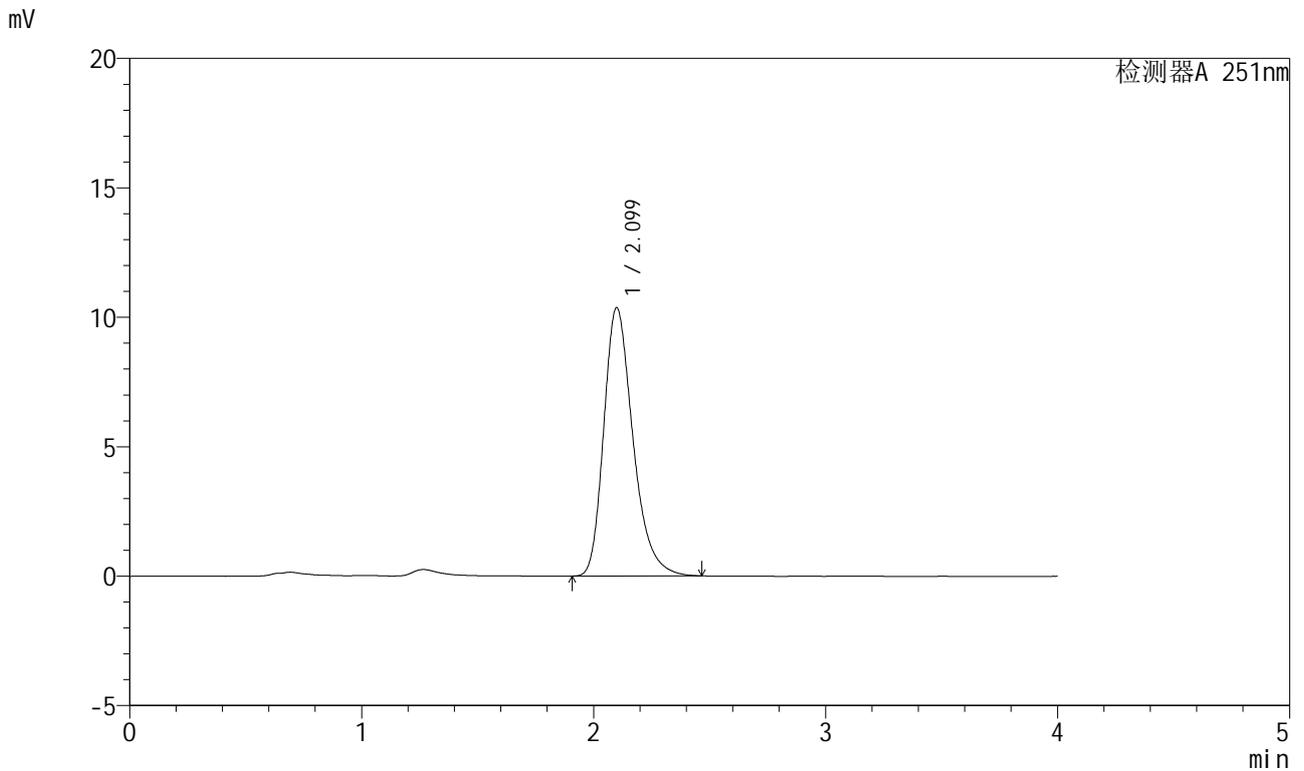

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	90751	100.000	10355	1384	1.297	--
总计		90751	100.000	10355			

图79 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3601-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:20:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

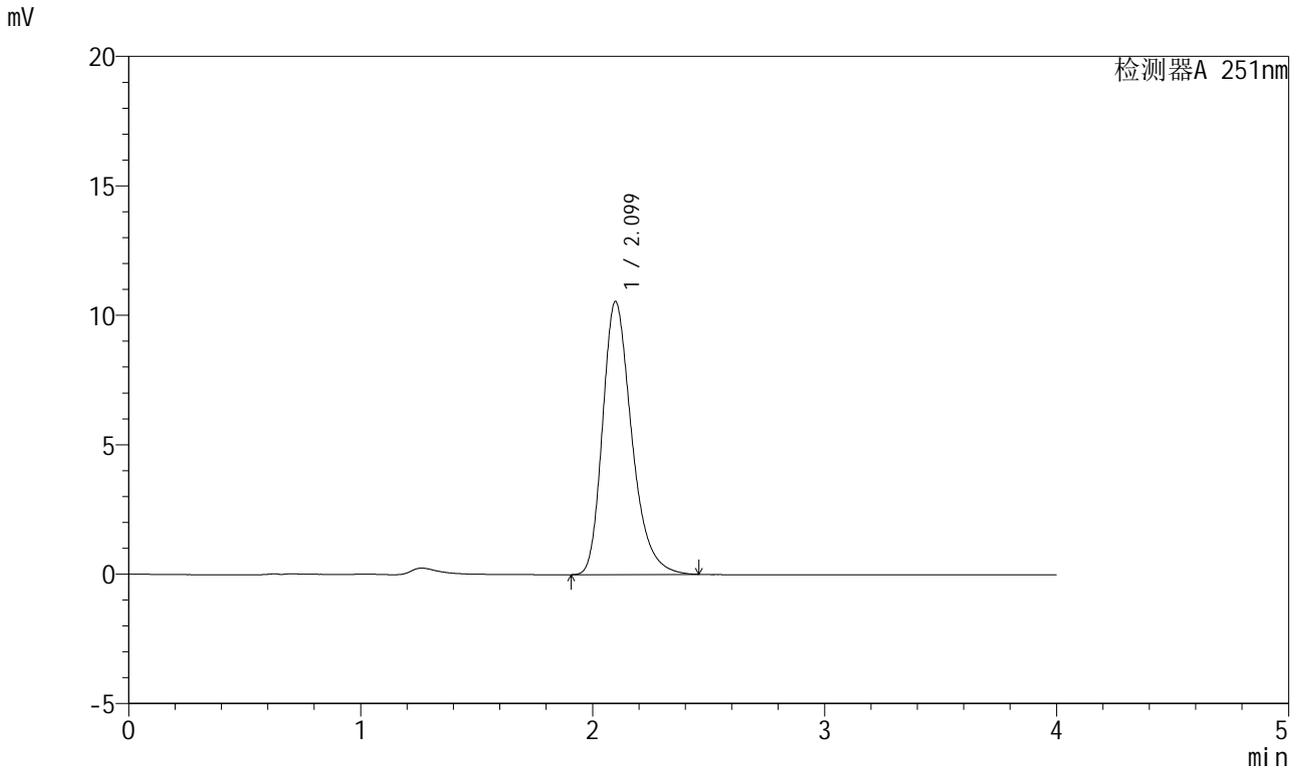

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	92048	100.000	10546	1395	1.296	--
总计		92048	100.000	10546			

图80 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3602-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:25:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

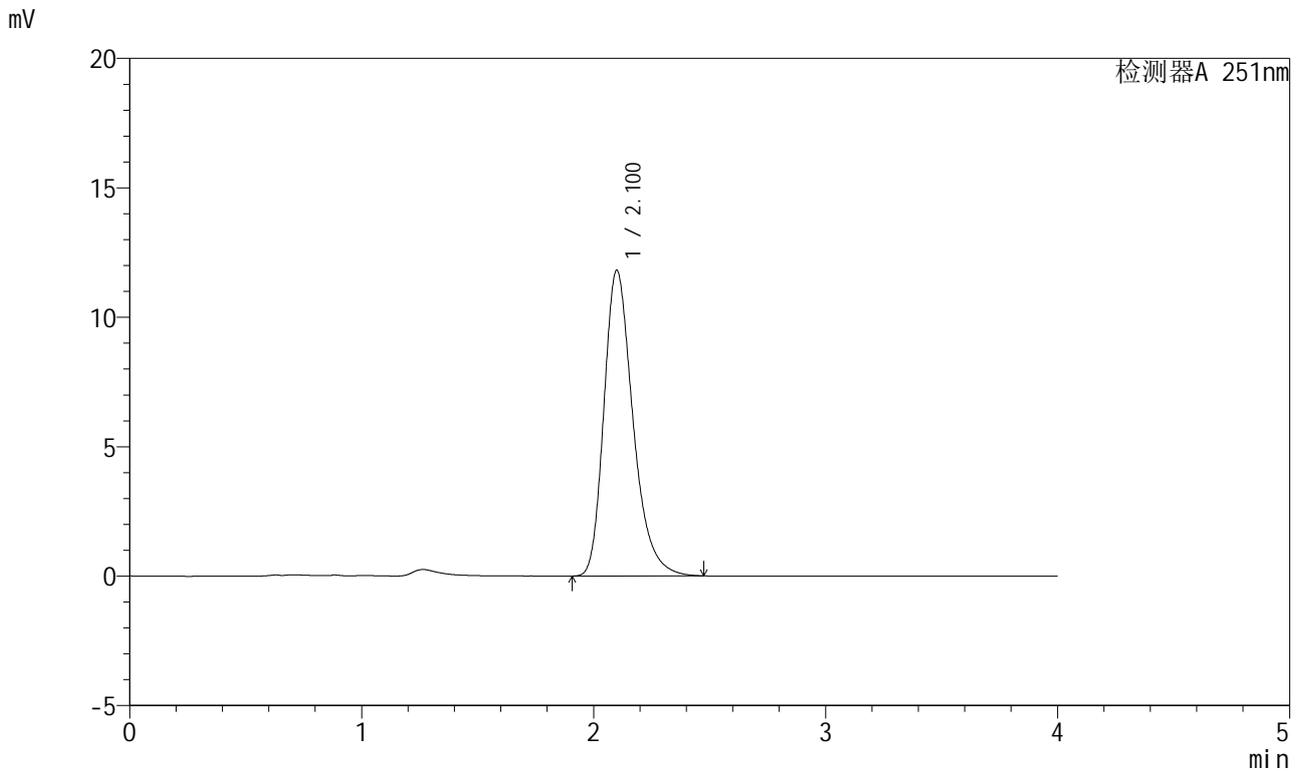

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	102929	100.000	11793	1403	1.299	--
总计		102929	100.000	11793			


图81 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3603-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:29:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

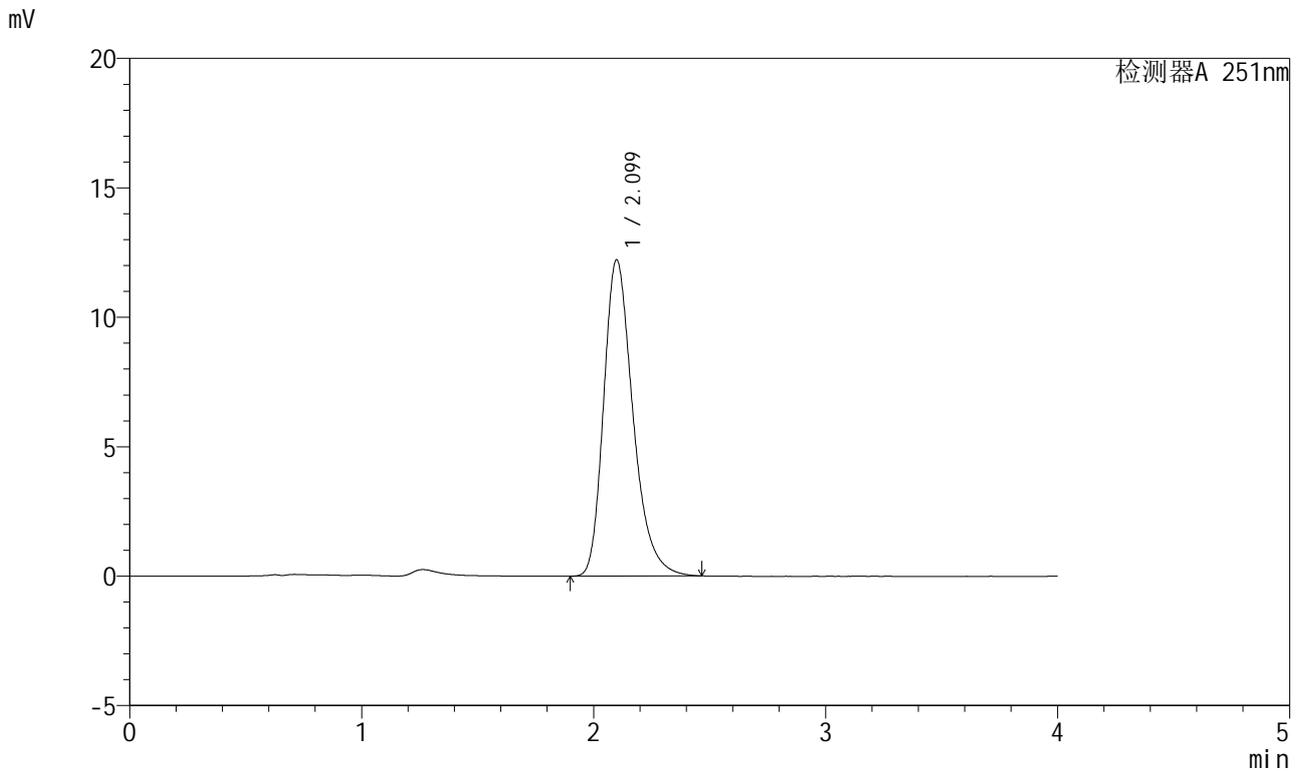

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	107473	100.000	12212	1374	1.297	--
总计		107473	100.000	12212			

图82 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3604-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:33:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

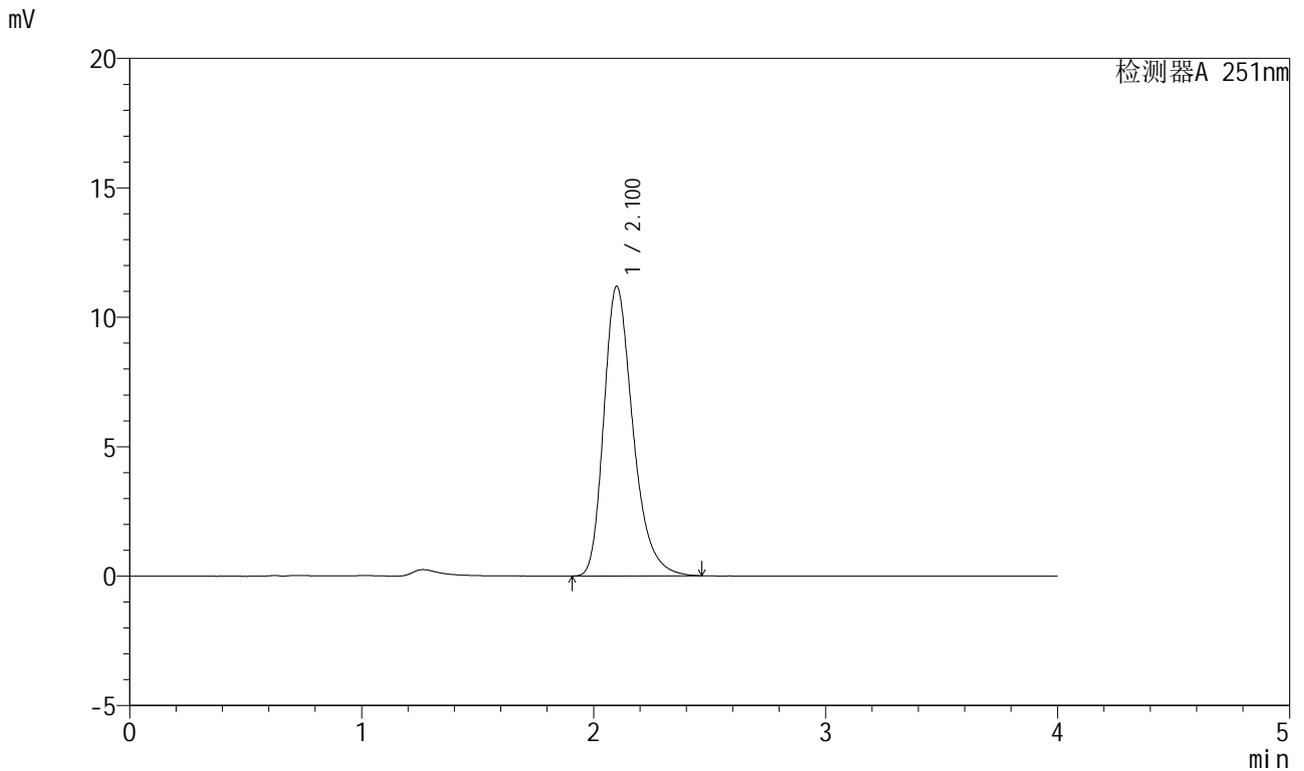

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	97706	100.000	11178	1395	1.299	--
总计		97706	100.000	11178			

图83 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3605-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:38:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

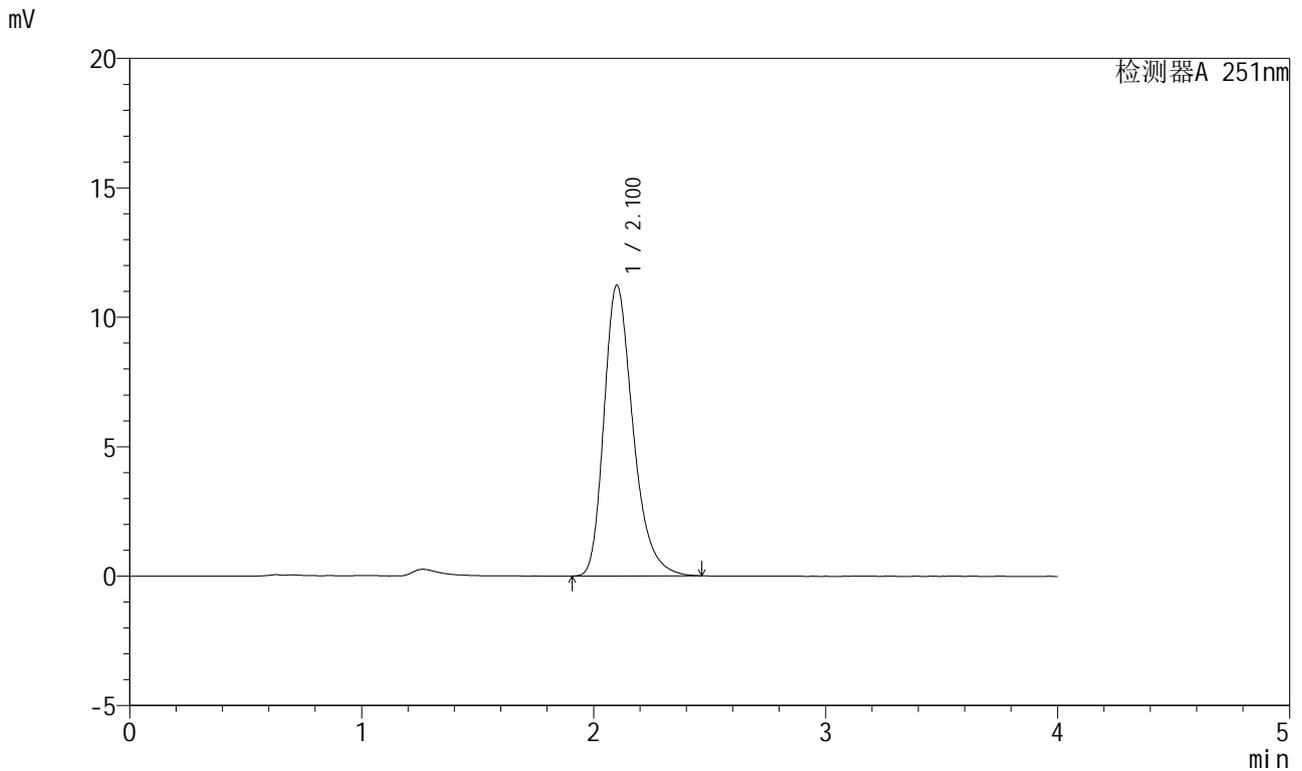

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	97712	100.000	11212	1409	1.299	--
总计		97712	100.000	11212			


图84 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3606-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:42:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:04:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

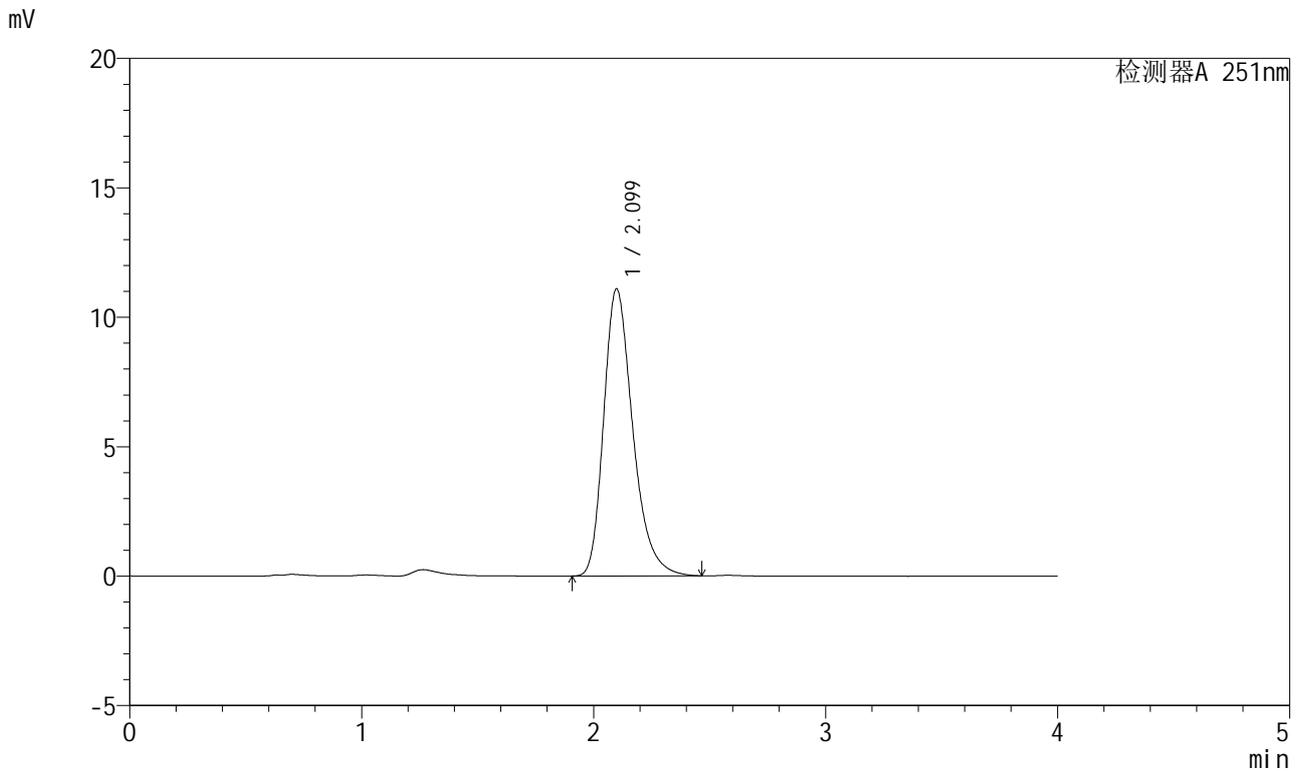

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	96767	100.000	11082	1396	1.301	--
总计		96767	100.000	11082			

图85 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3607-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:47:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

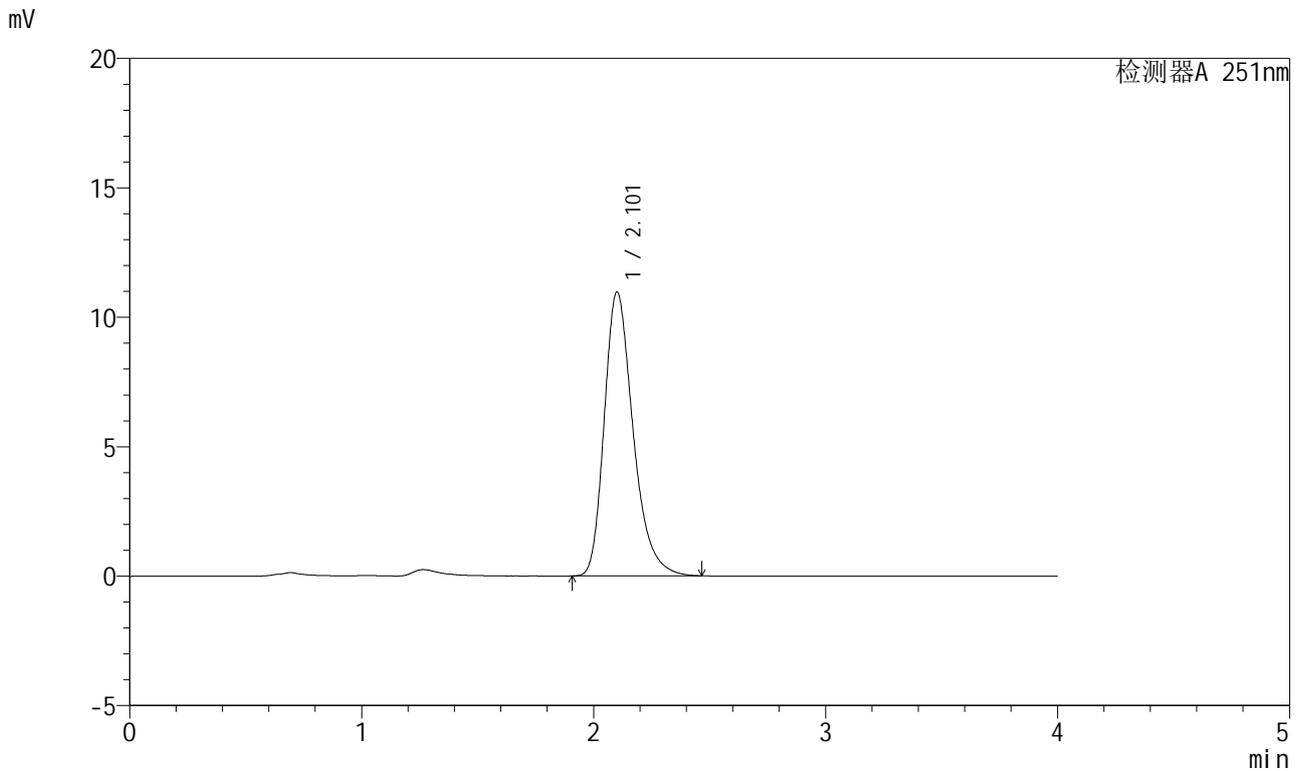

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	94938	100.000	10941	1424	1.301	--
总计		94938	100.000	10941			

图86 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3608-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:51:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

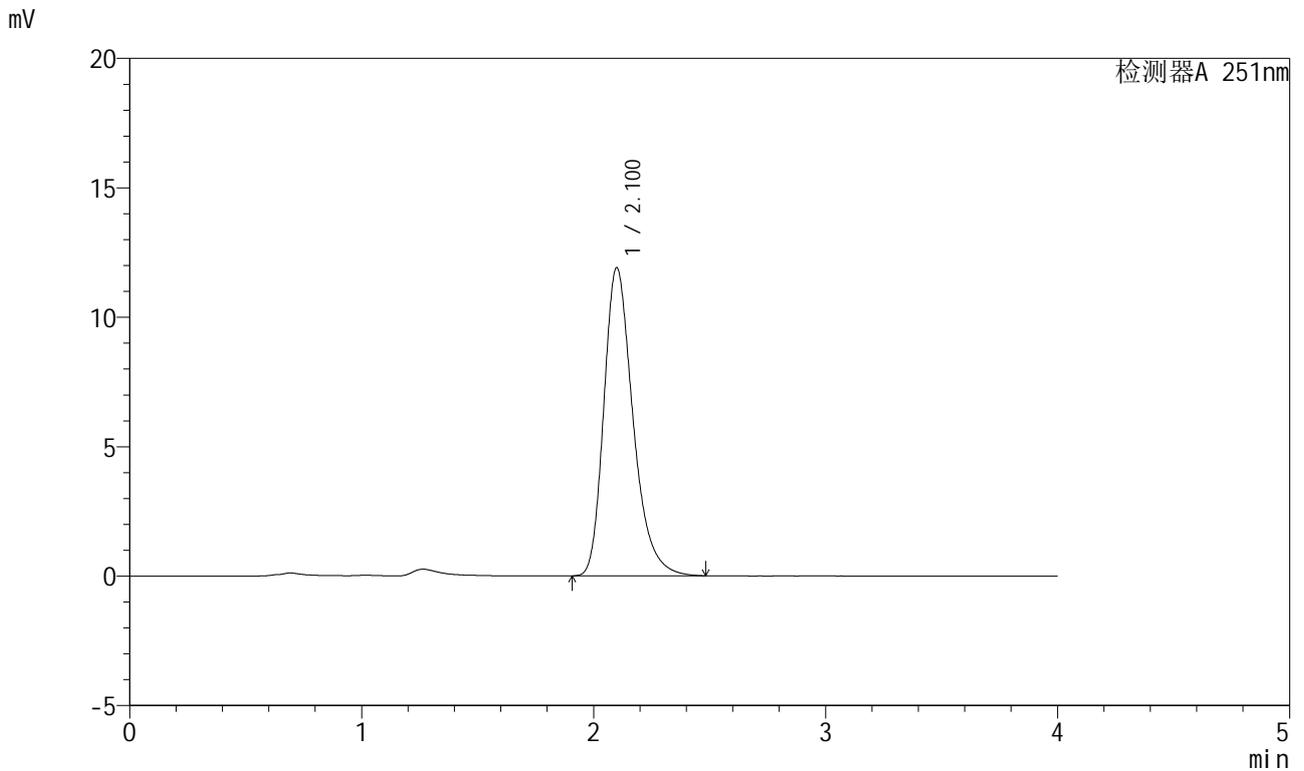

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	104177	100.000	11890	1392	1.302	--
总计		104177	100.000	11890			

图87 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3609-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 20:55:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

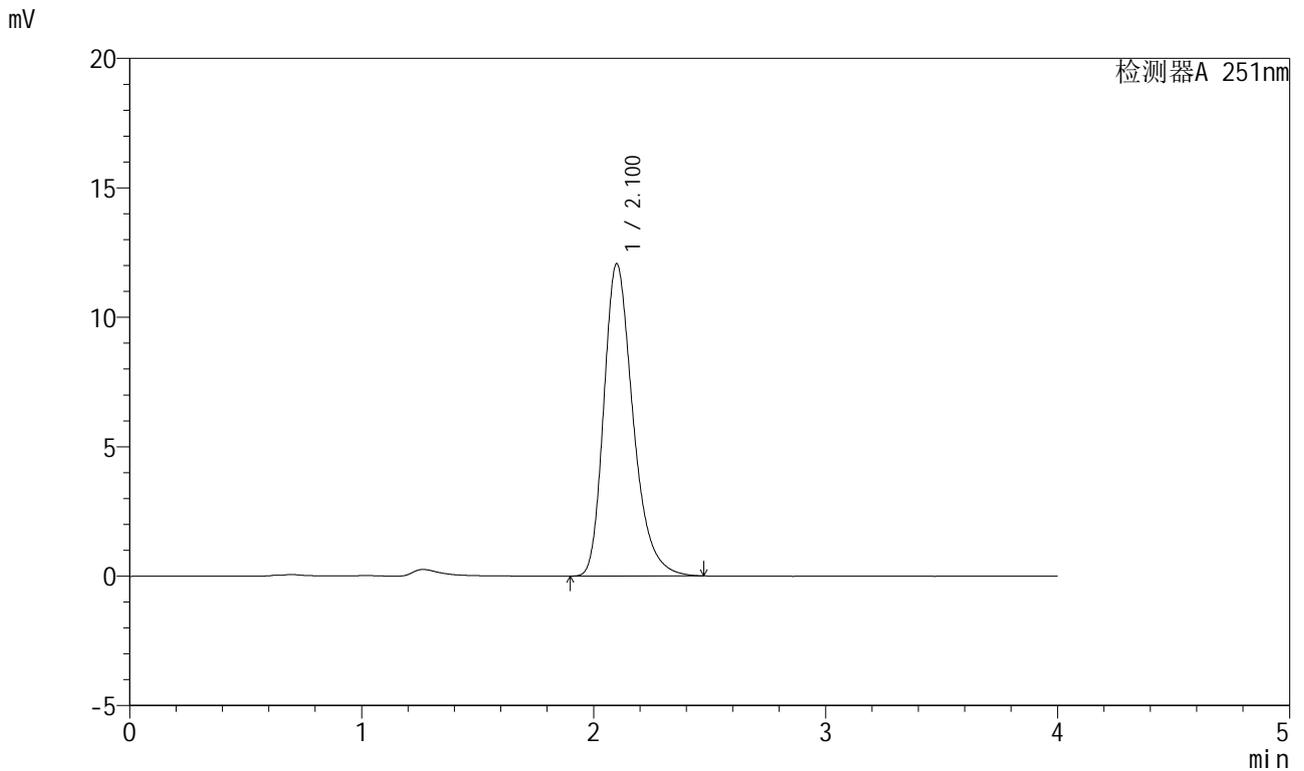

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	105602	100.000	12052	1390	1.300	--
总计		105602	100.000	12052			

图88 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3610-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:00:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

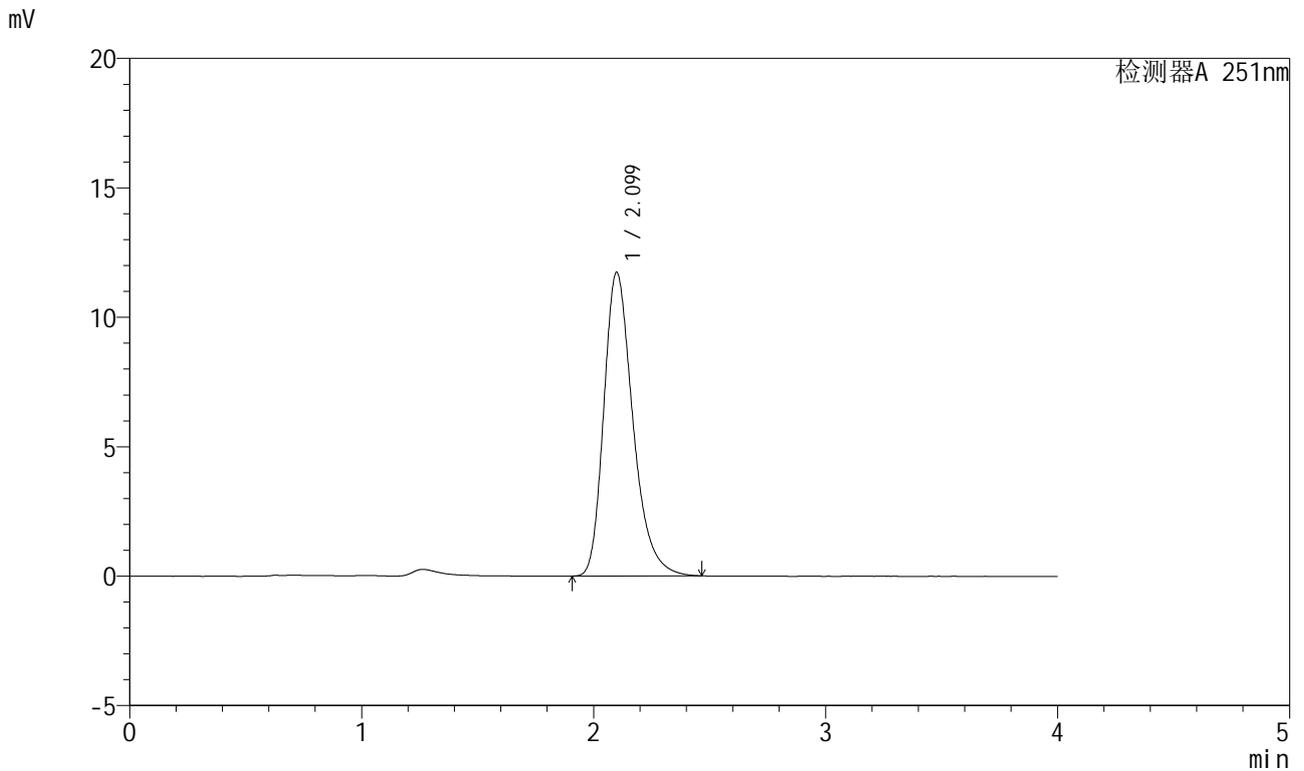

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	102480	100.000	11718	1393	1.299	--
总计		102480	100.000	11718			

图89 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3611-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:04:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

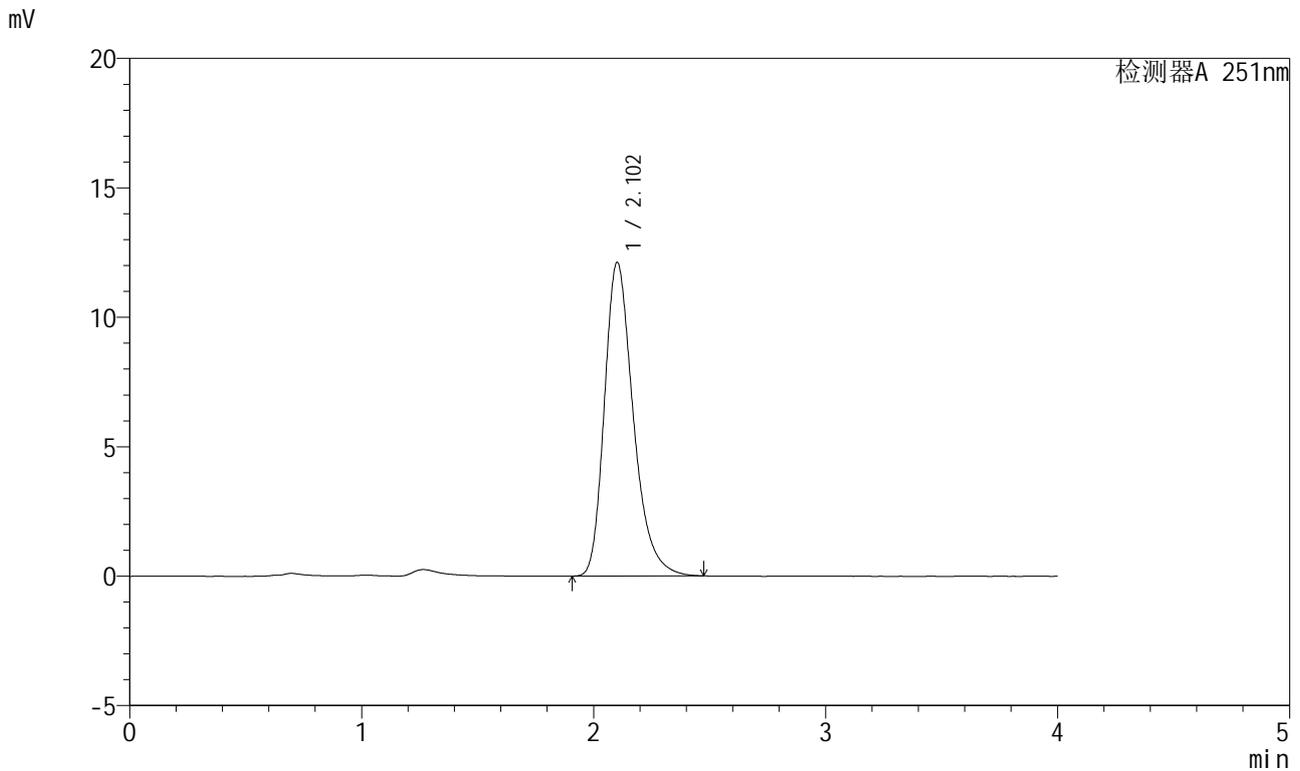

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	104913	100.000	12097	1424	1.300	--
总计		104913	100.000	12097			

图90 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3612-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:09:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

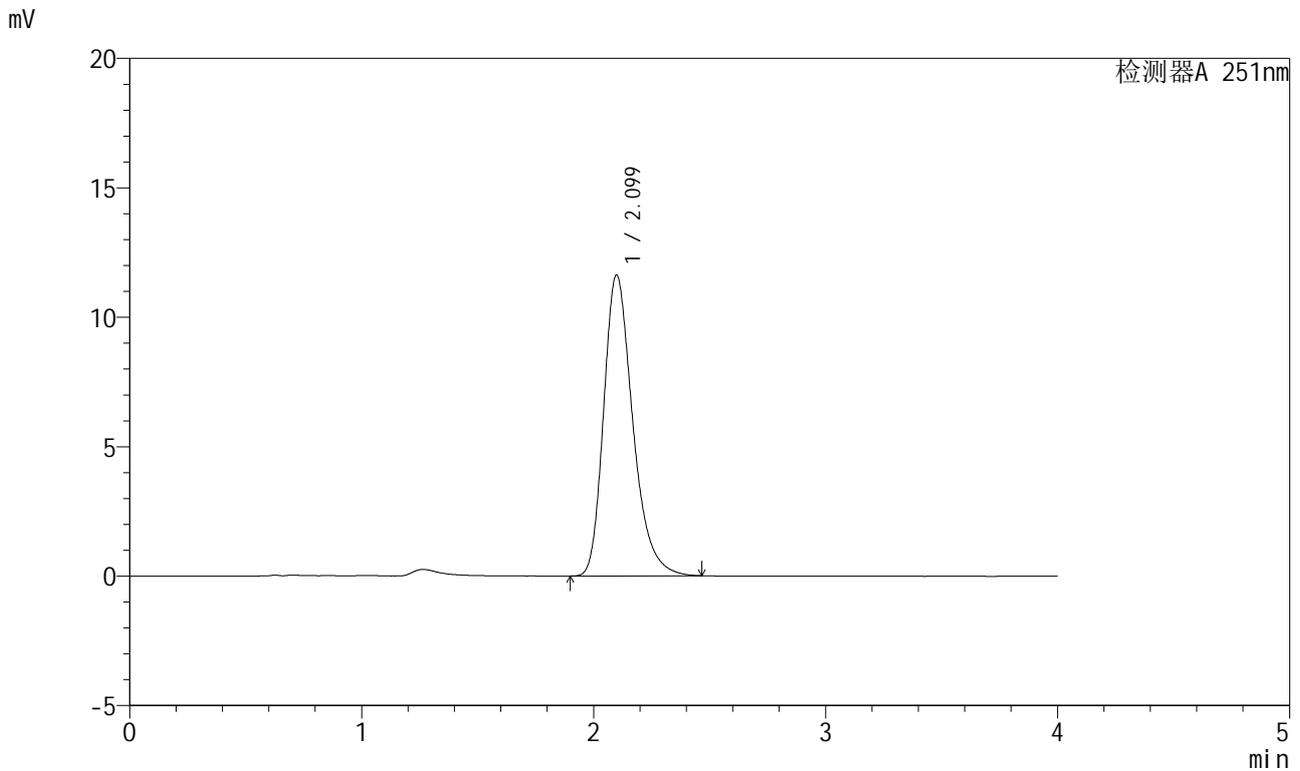

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	101510	100.000	11620	1395	1.300	--
总计		101510	100.000	11620			

图91 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3613-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:13:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

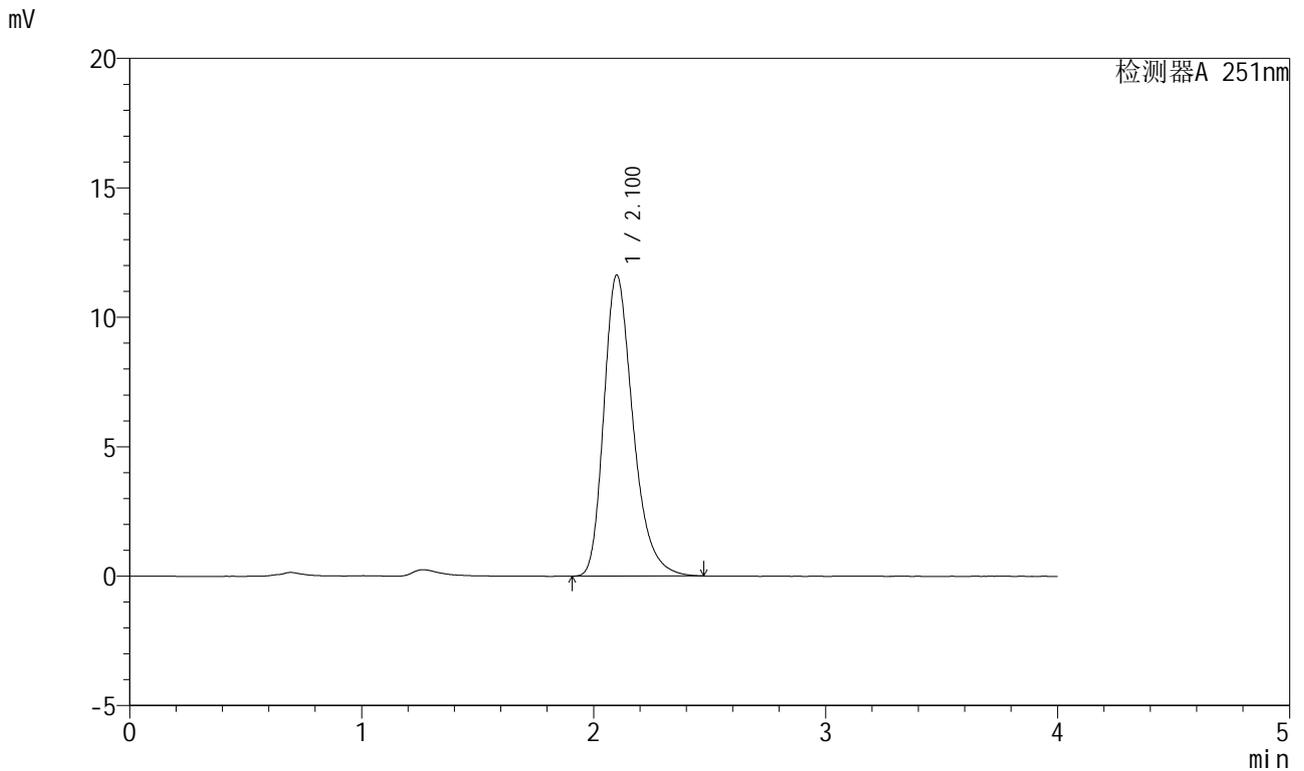

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	101683	100.000	11616	1393	1.301	--
总计		101683	100.000	11616			

图92 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3614-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:17:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

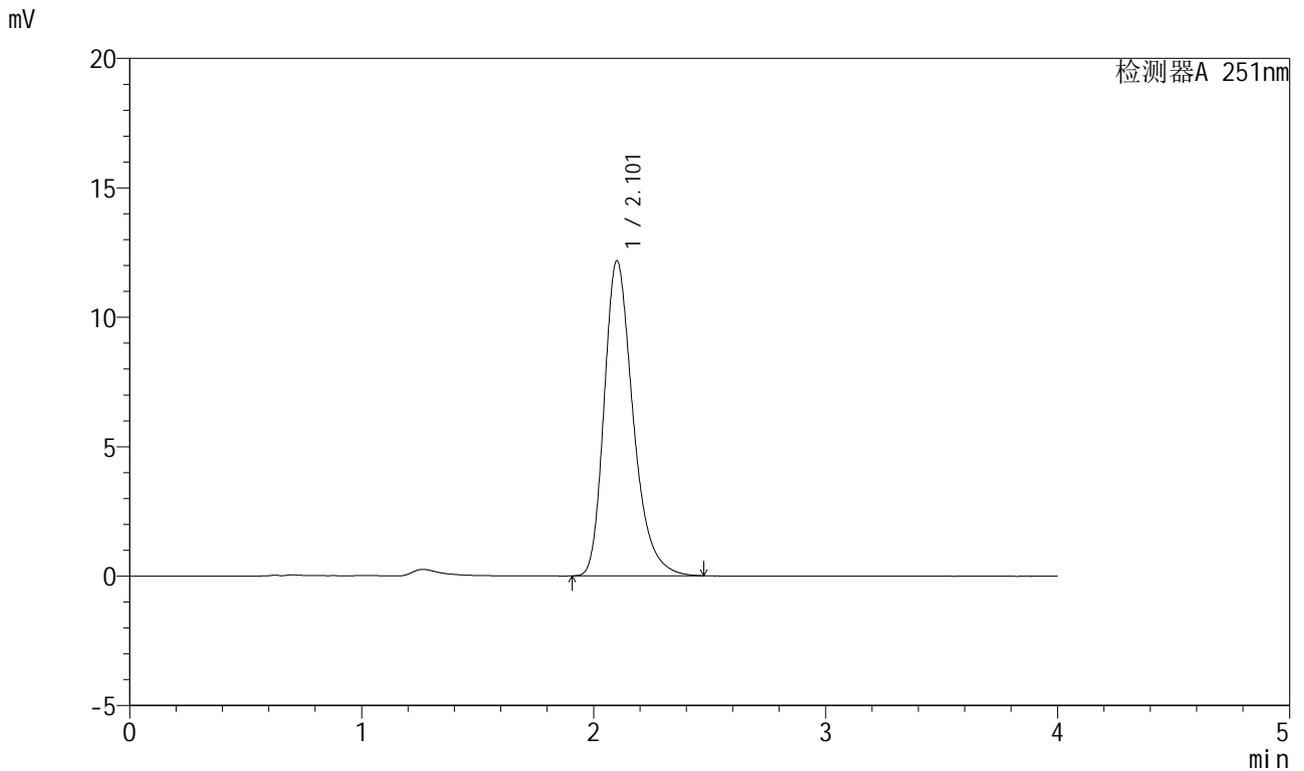

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	105396	100.000	12144	1424	1.303	--
总计		105396	100.000	12144			

图93 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3615-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:22:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

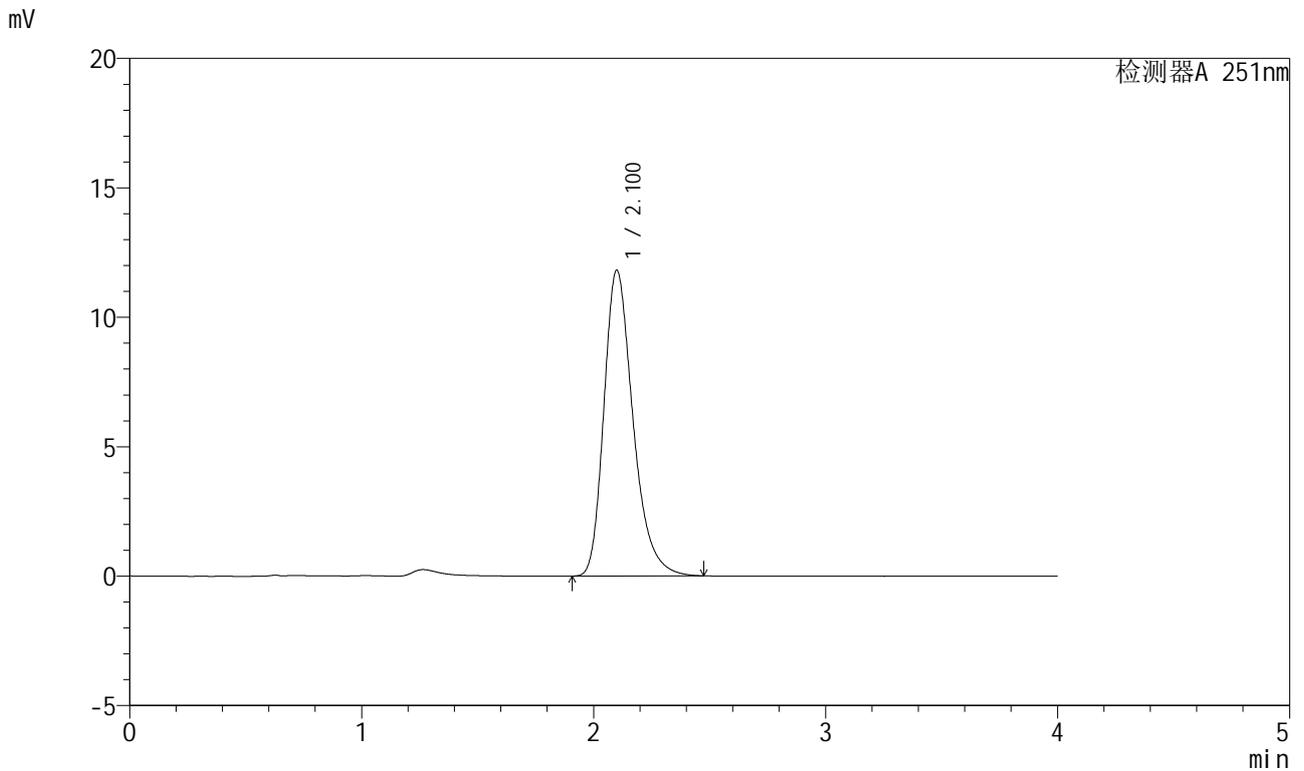

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	103113	100.000	11796	1398	1.301	--
总计		103113	100.000	11796			


图94 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3616-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:26:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

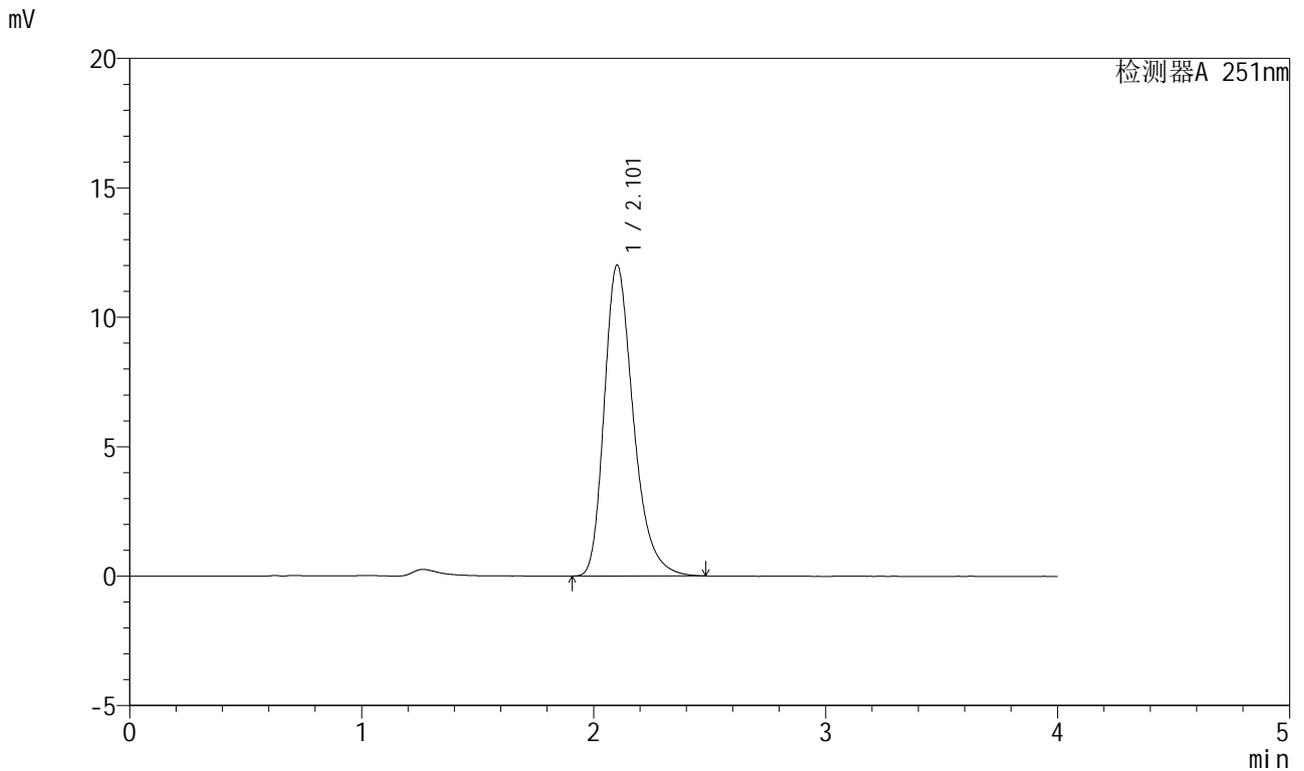

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	104746	100.000	11990	1404	1.301	--
总计		104746	100.000	11990			

图95 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3617-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:31:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

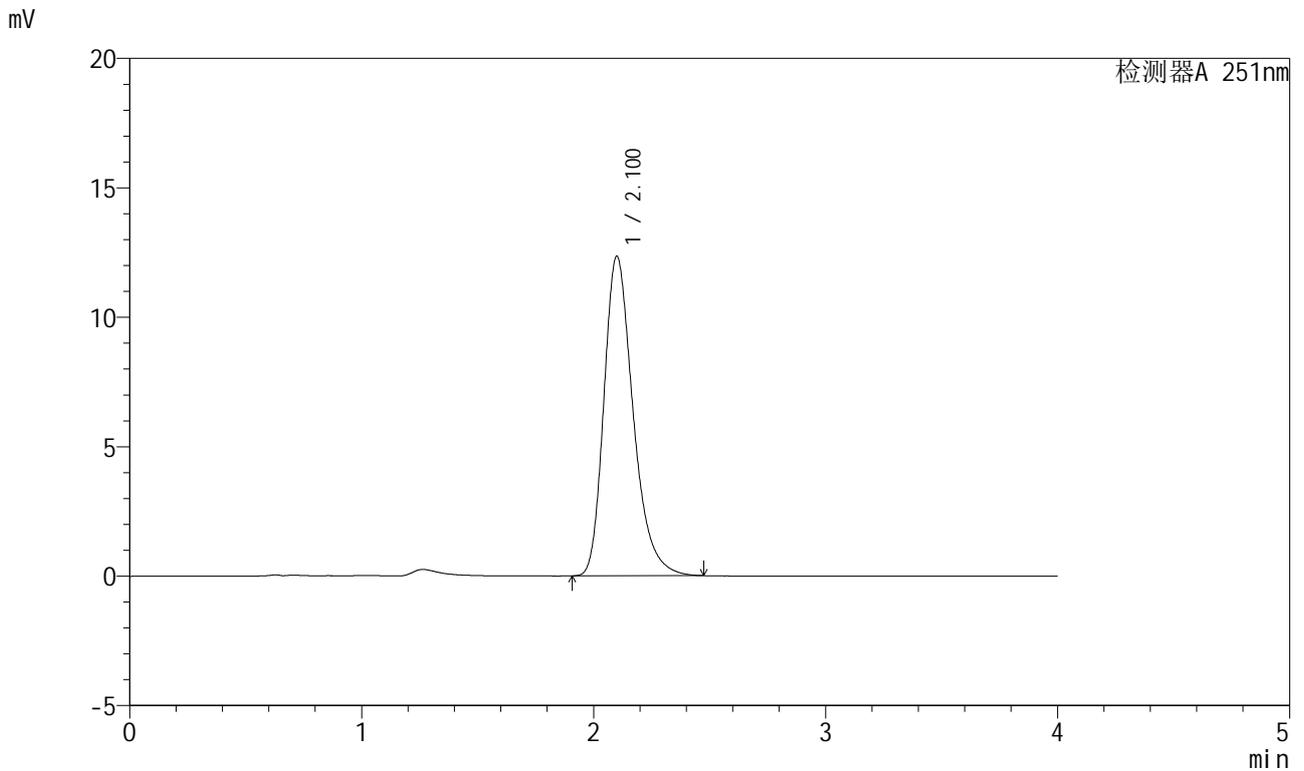

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	108159	100.000	12326	1387	1.299	--
总计		108159	100.000	12326			

图96 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3618-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:35:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

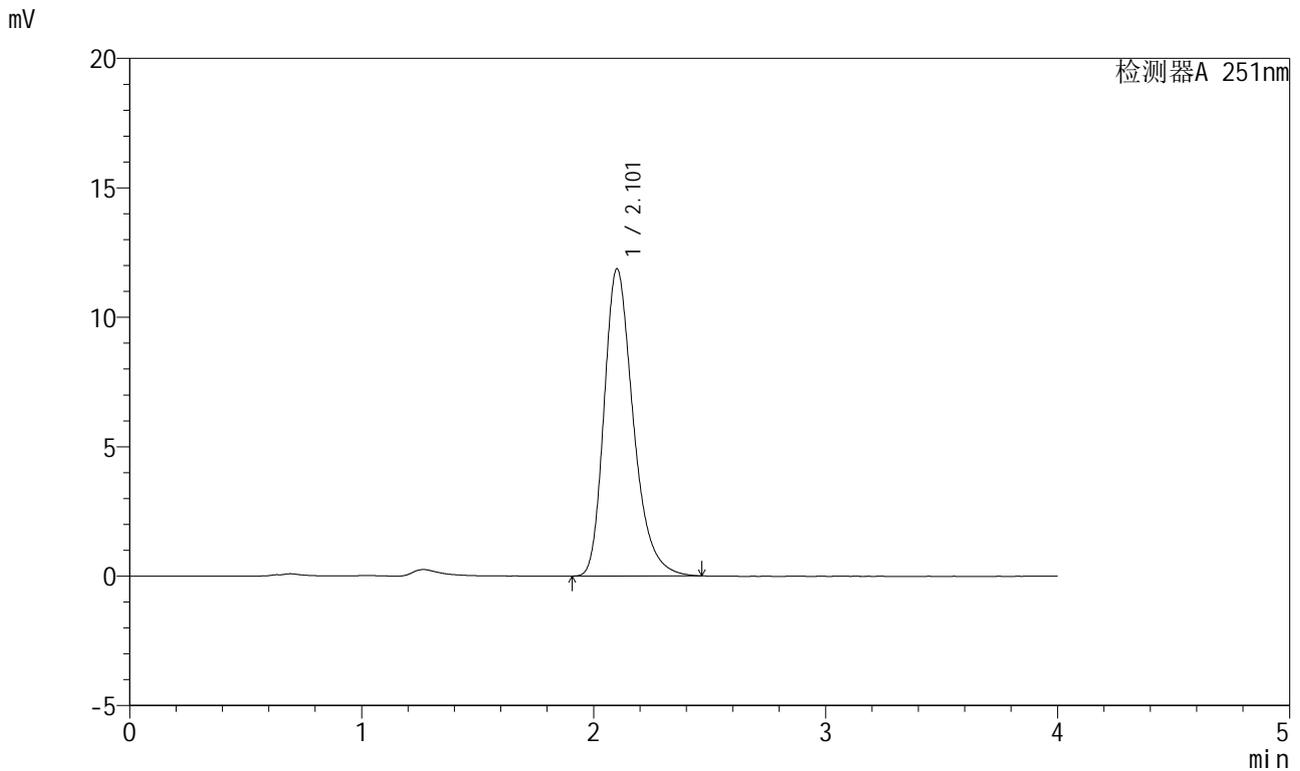

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	103546	100.000	11835	1398	1.300	--
总计		103546	100.000	11835			


图97 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3619-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:39:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

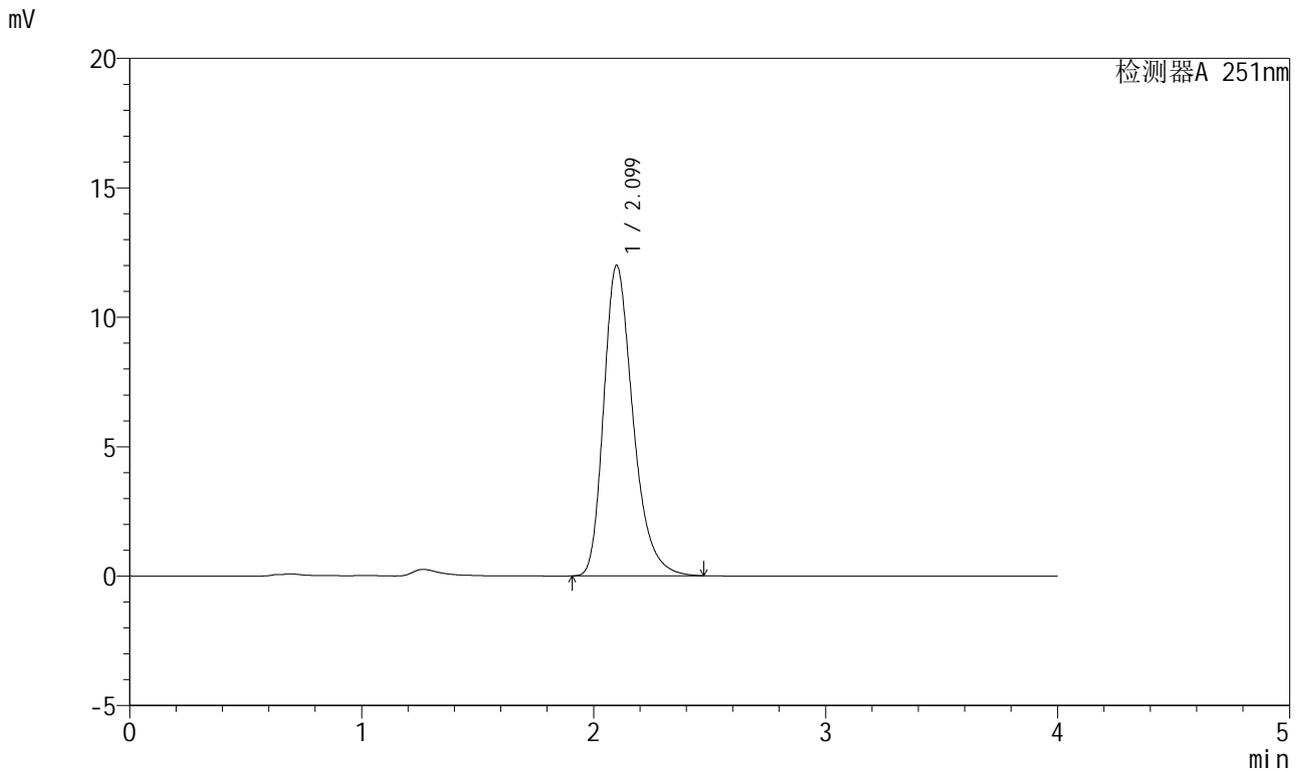

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	105317	100.000	11984	1379	1.299	--
总计		105317	100.000	11984			

图98 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3620-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:44:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

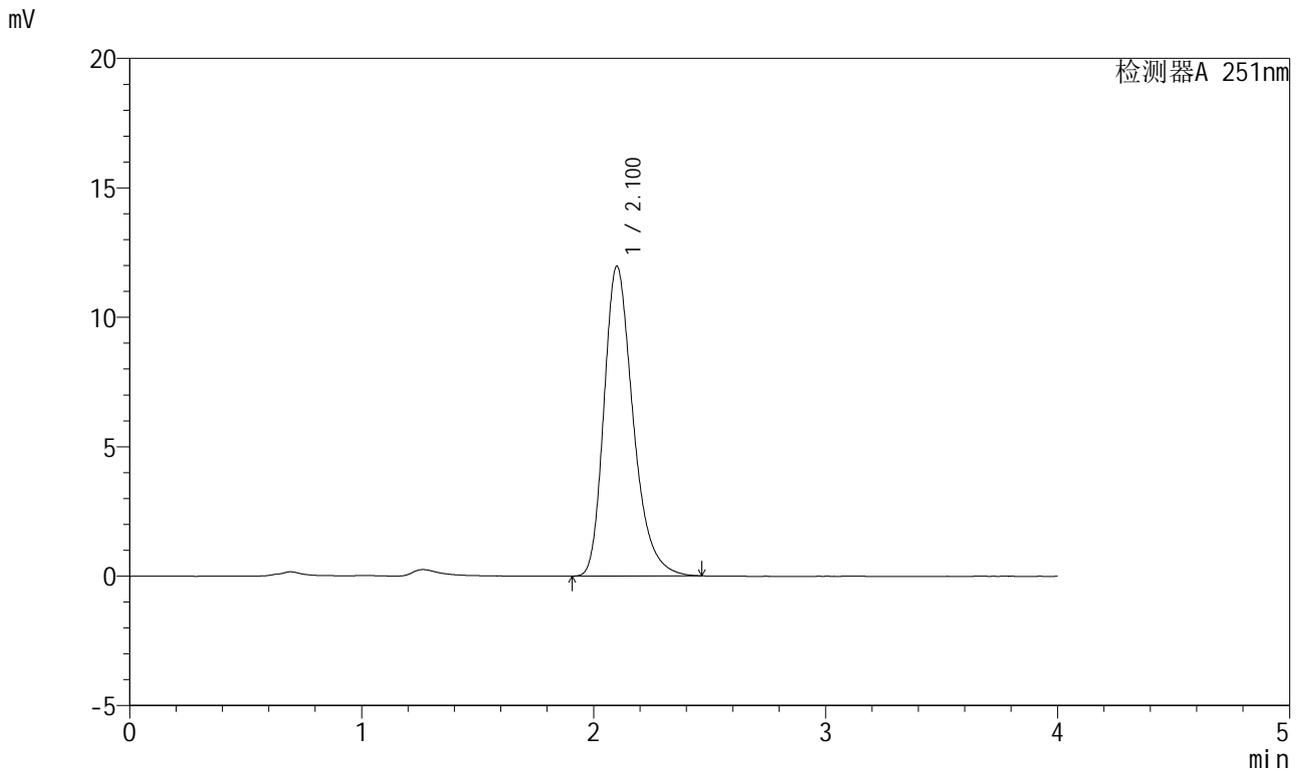

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	104442	100.000	11945	1399	1.299	--
总计		104442	100.000	11945			

图99 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
 自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3621-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:48:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

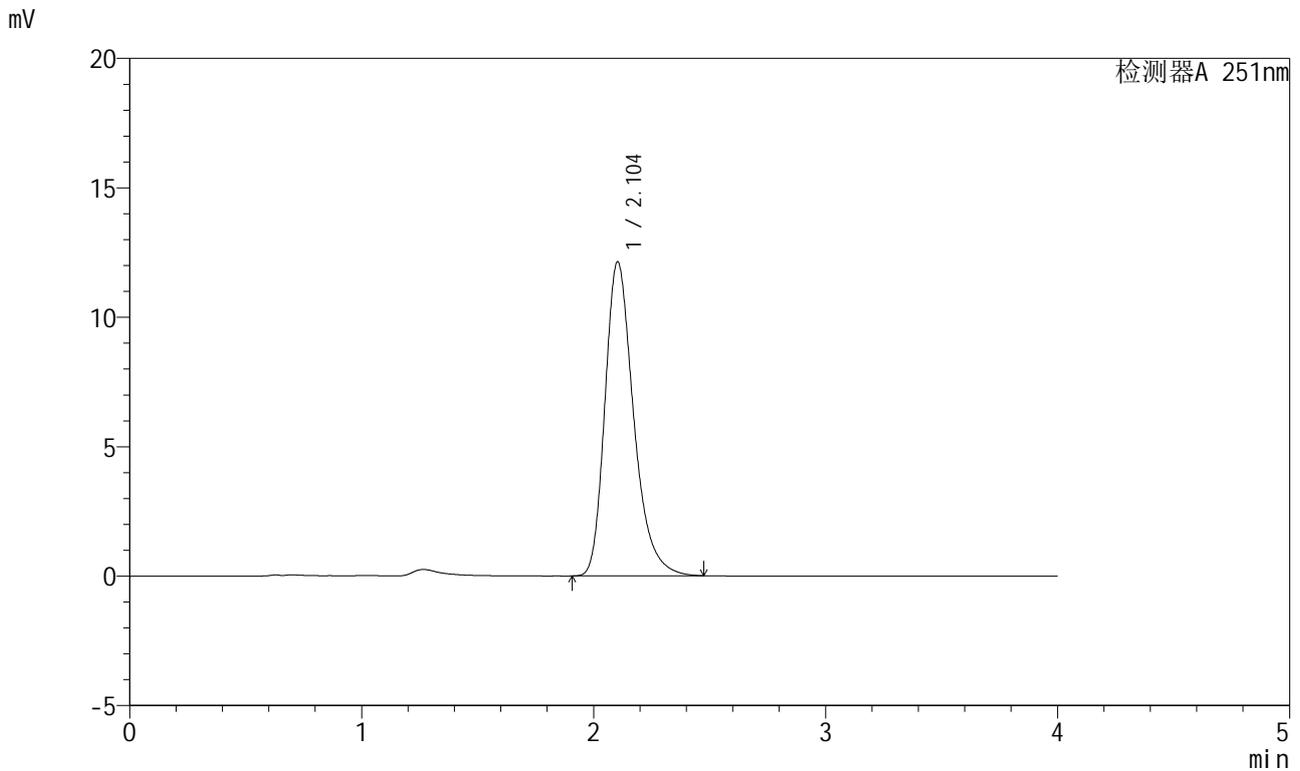

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	104383	100.000	12133	1449	1.301	--
总计		104383	100.000	12133			


图100 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3622-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:53:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

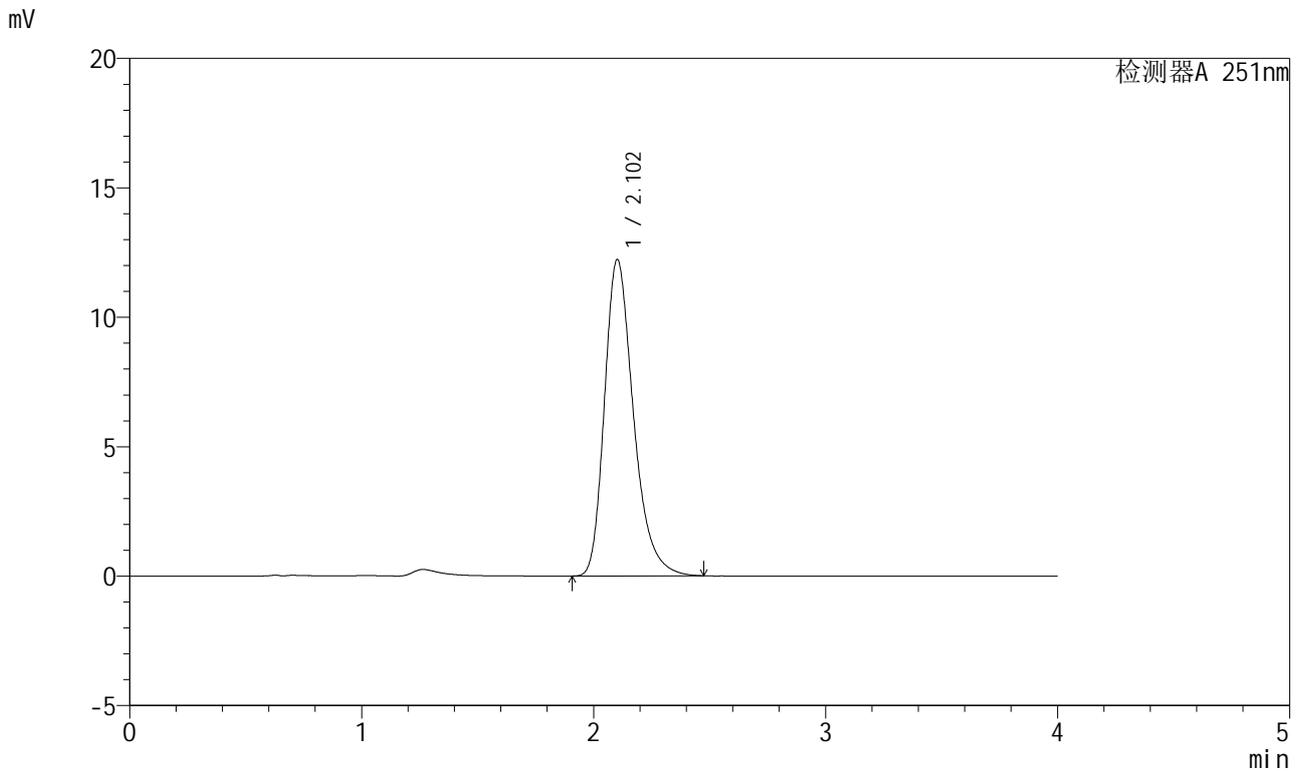

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	106228	100.000	12210	1414	1.302	--
总计		106228	100.000	12210			

图101 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3623-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 21:57:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

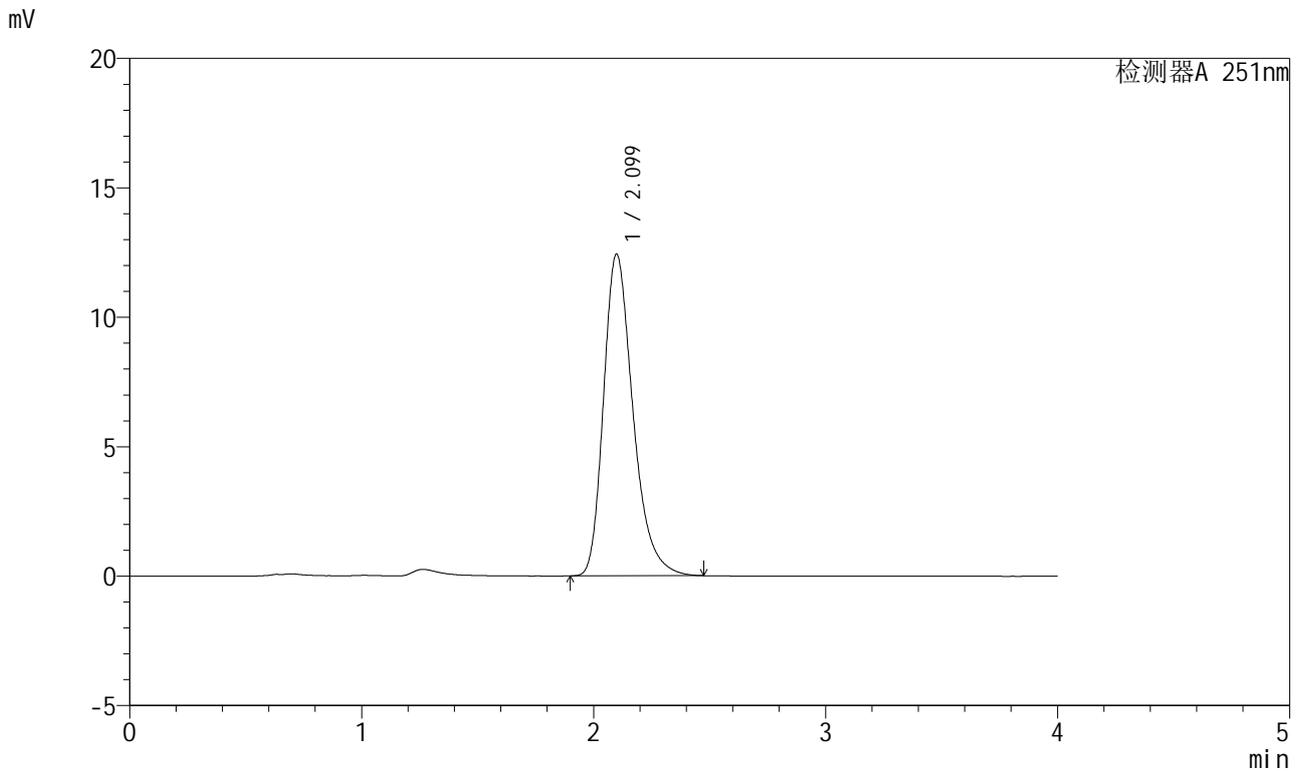

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	109644	100.000	12421	1365	1.304	--
总计		109644	100.000	12421			

图102 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3624-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:01:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

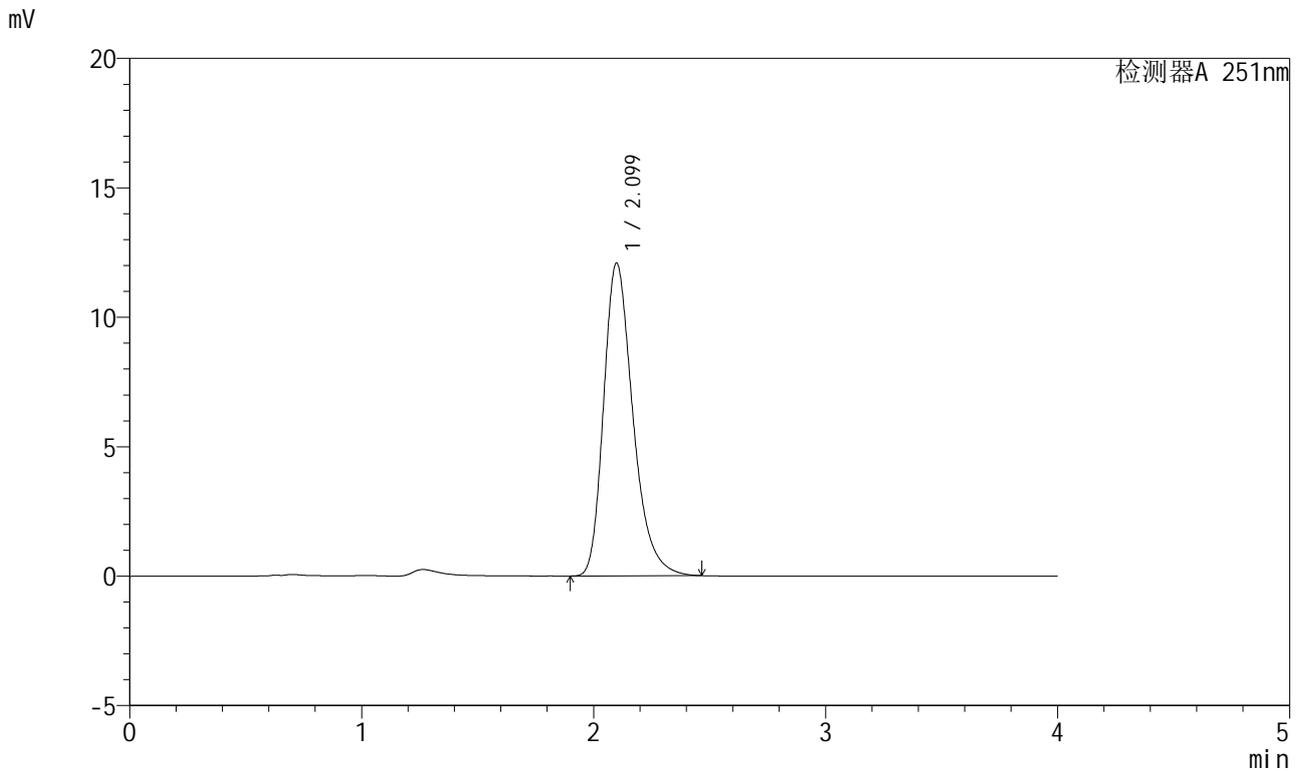

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	106306	100.000	12075	1372	1.300	--
总计		106306	100.000	12075			

图103 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3625-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:06:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

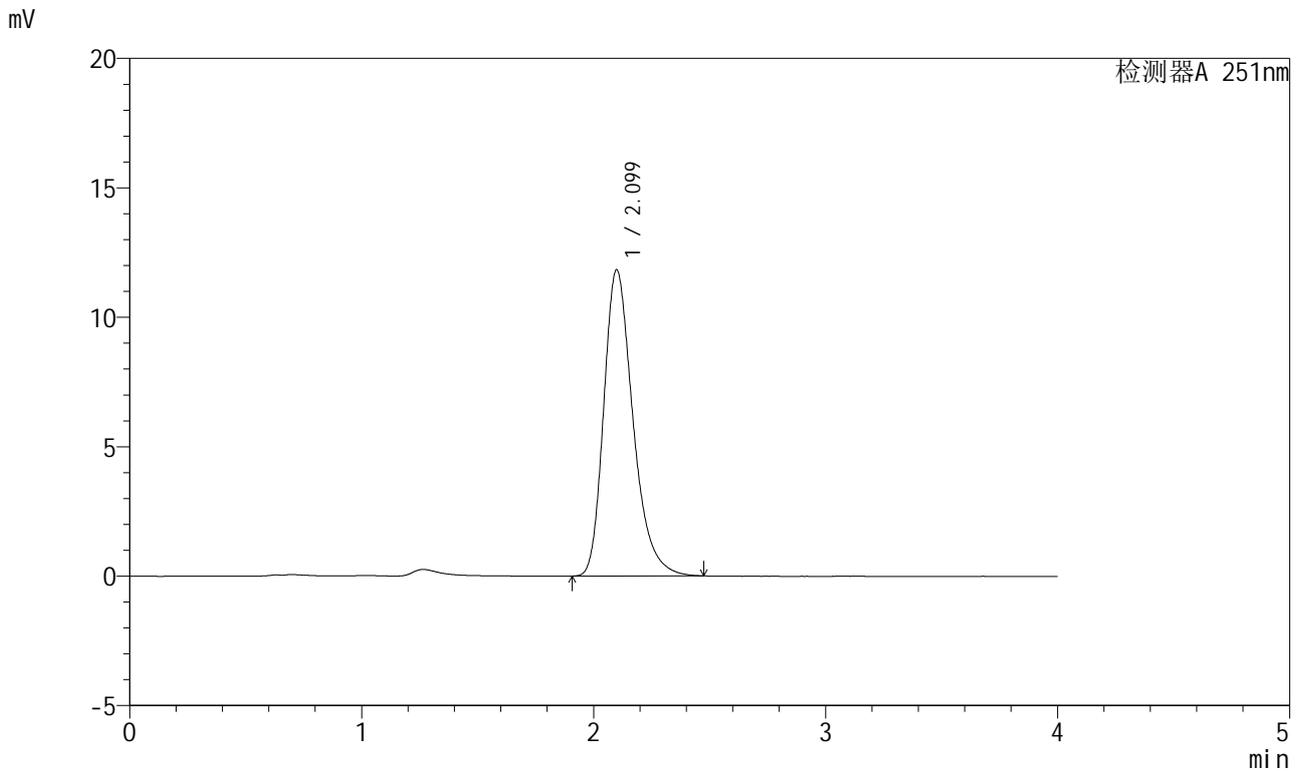

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	103801	100.000	11818	1381	1.302	--
总计		103801	100.000	11818			

图104 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3626-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:10:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

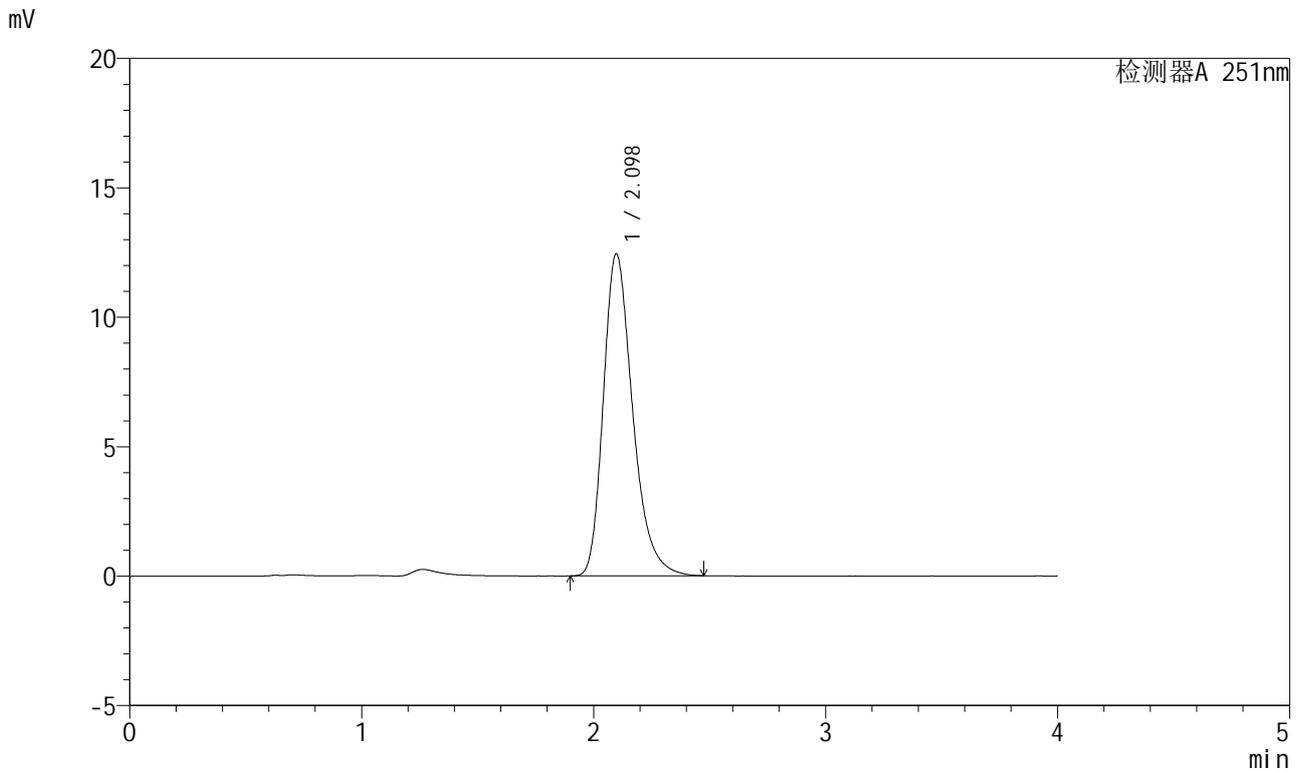

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	109436	100.000	12442	1372	1.301	--
总计		109436	100.000	12442			

图105 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3627-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:15:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

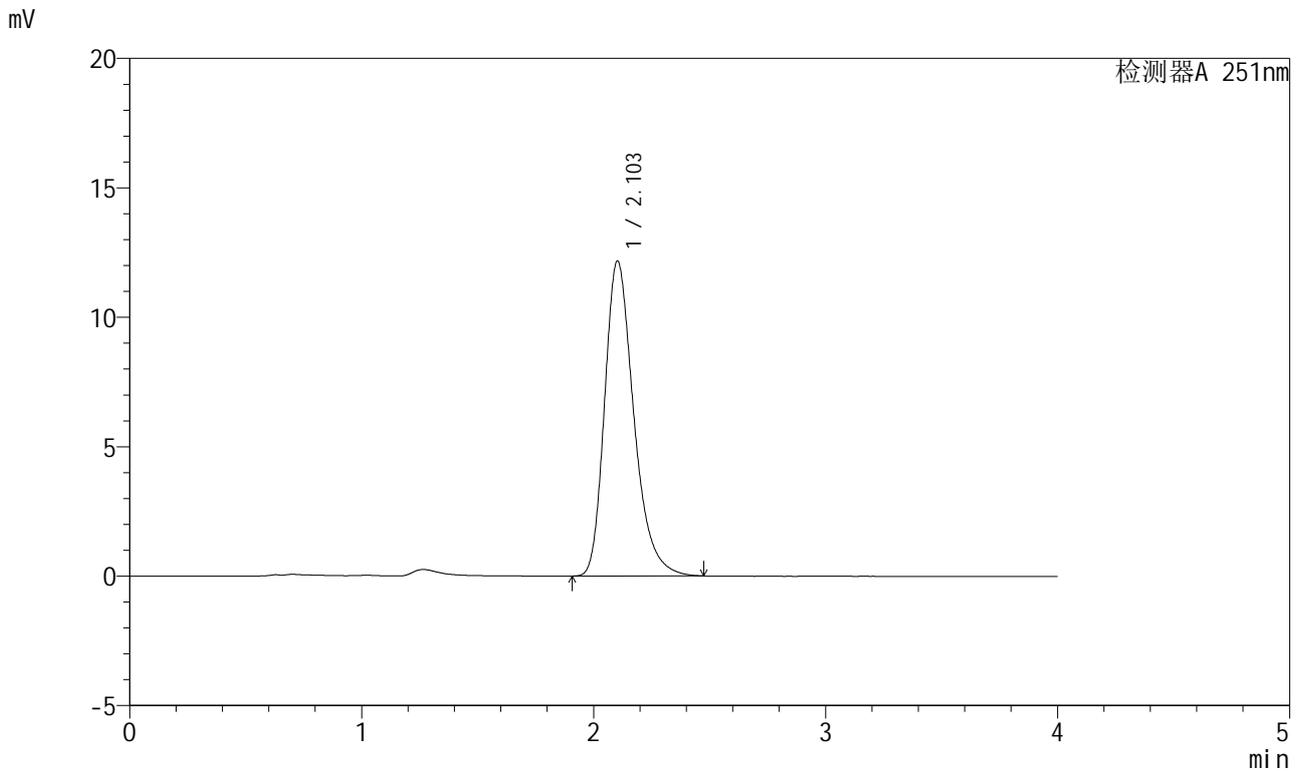

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	106512	100.000	12166	1392	1.301	--
总计		106512	100.000	12166			

图106 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3628-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:19:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

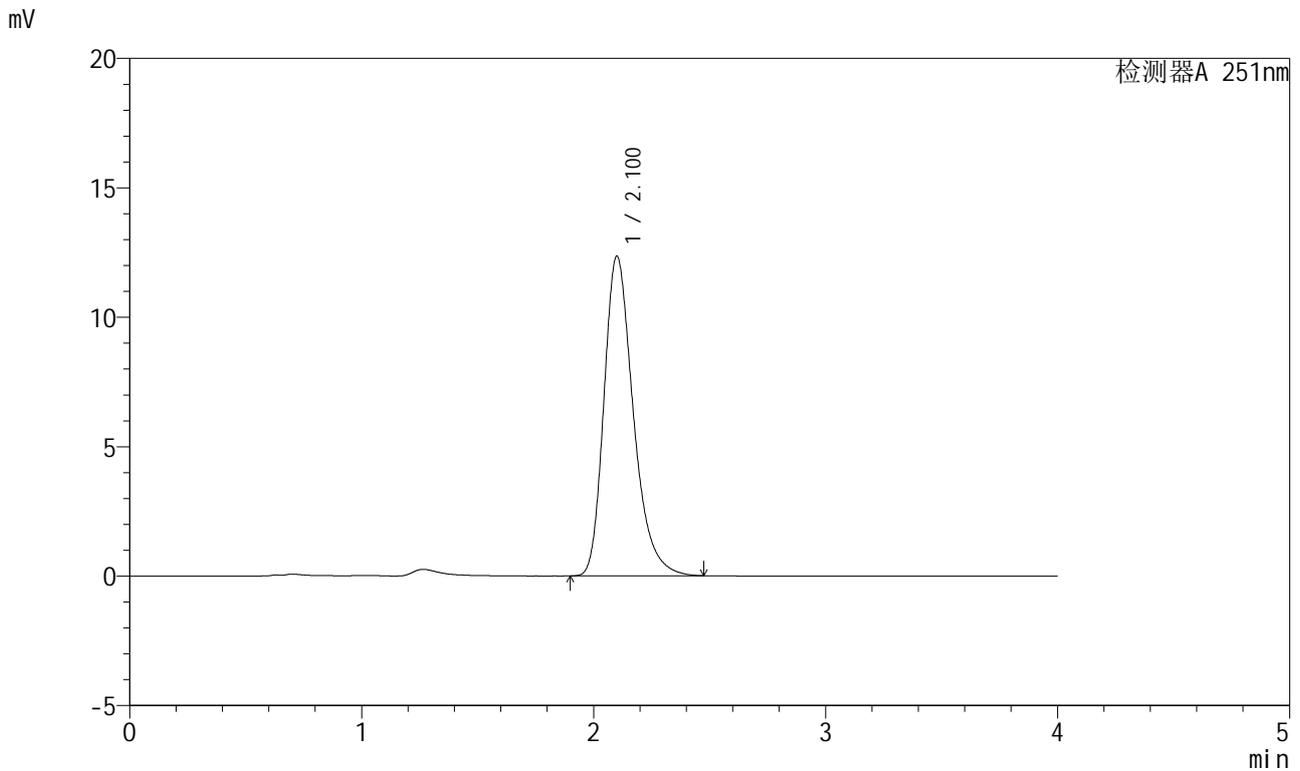

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	108619	100.000	12327	1377	1.303	--
总计		108619	100.000	12327			

图107 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3629-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:23:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

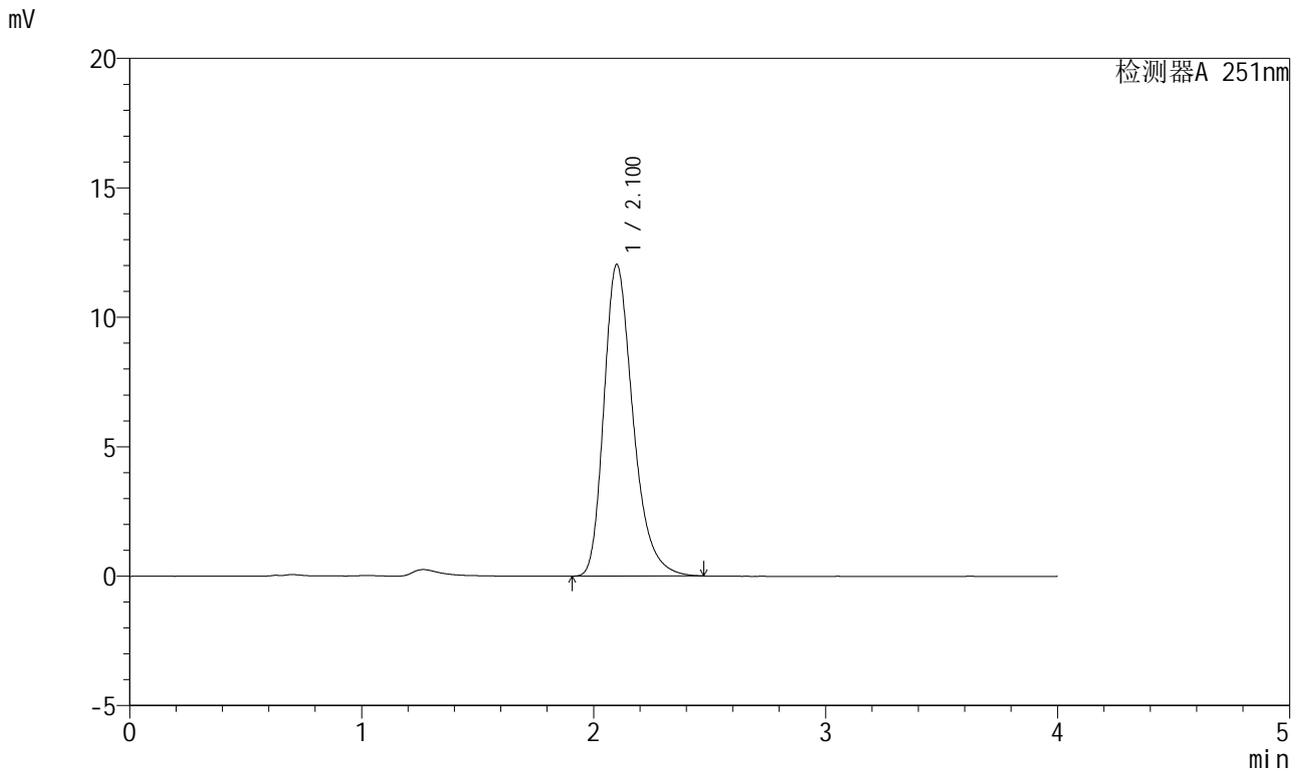

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	105093	100.000	12021	1398	1.302	--
总计		105093	100.000	12021			

图108 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3630-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:28:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:05:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

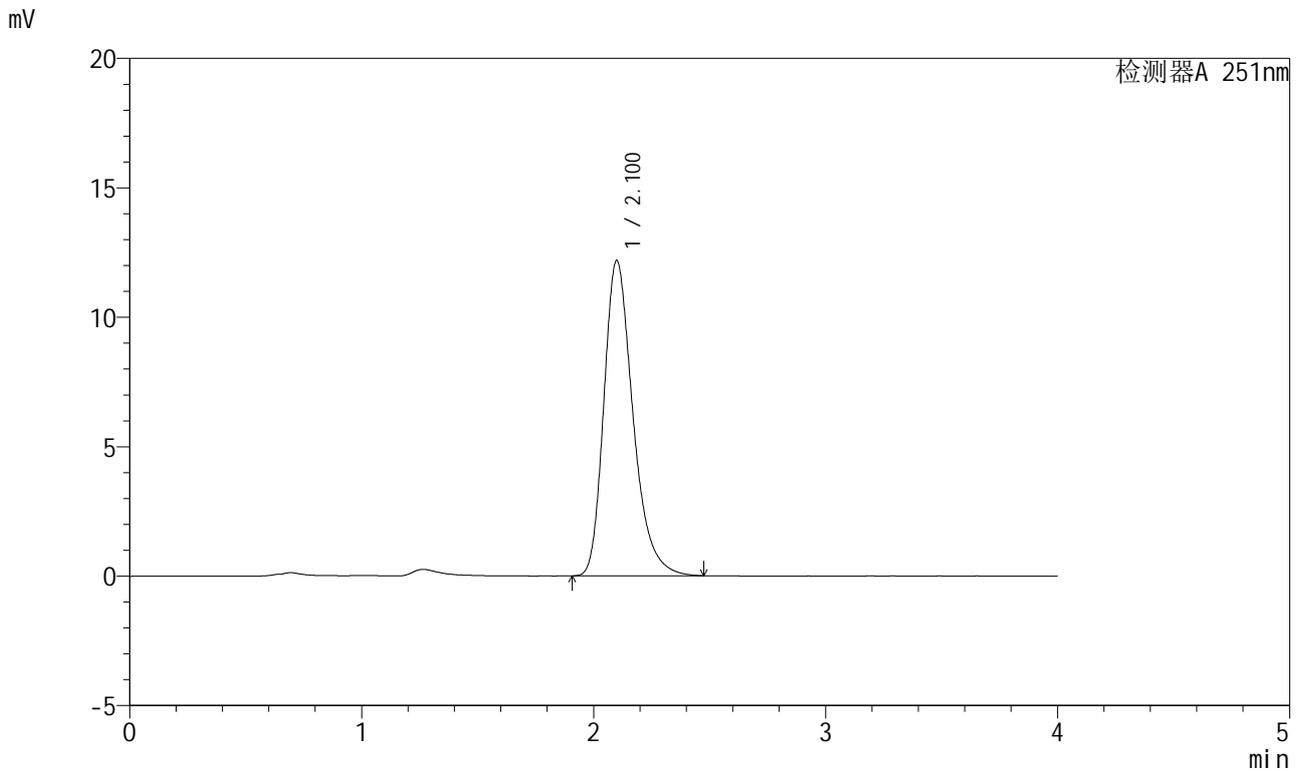

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	106271	100.000	12167	1399	1.302	--
总计		106271	100.000	12167			

图109 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3631-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:32:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

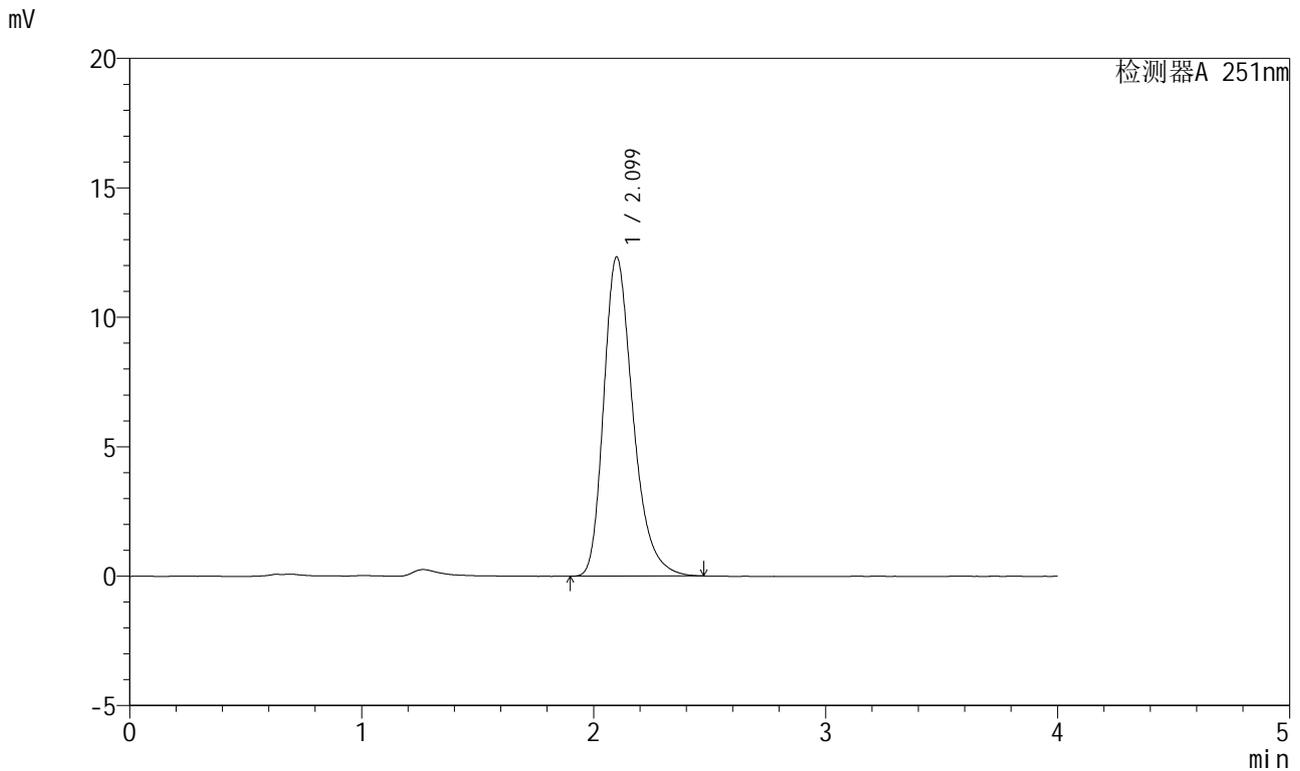

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	108147	100.000	12319	1384	1.301	--
总计		108147	100.000	12319			

图110 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3632-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:37:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

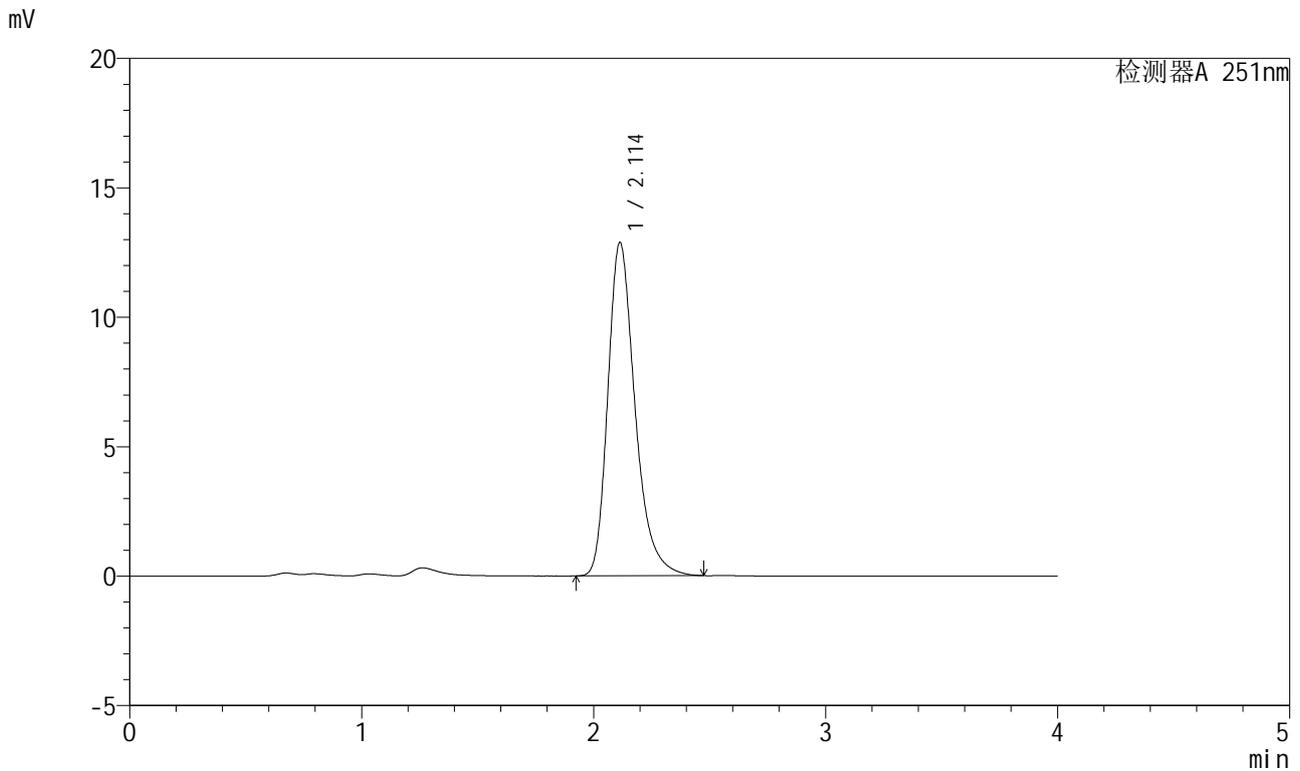

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	104990	100.000	12883	1642	1.301	--
总计		104990	100.000	12883			

图111 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3633-2 - zzp-2023111821p-jyx2-cq9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:41:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

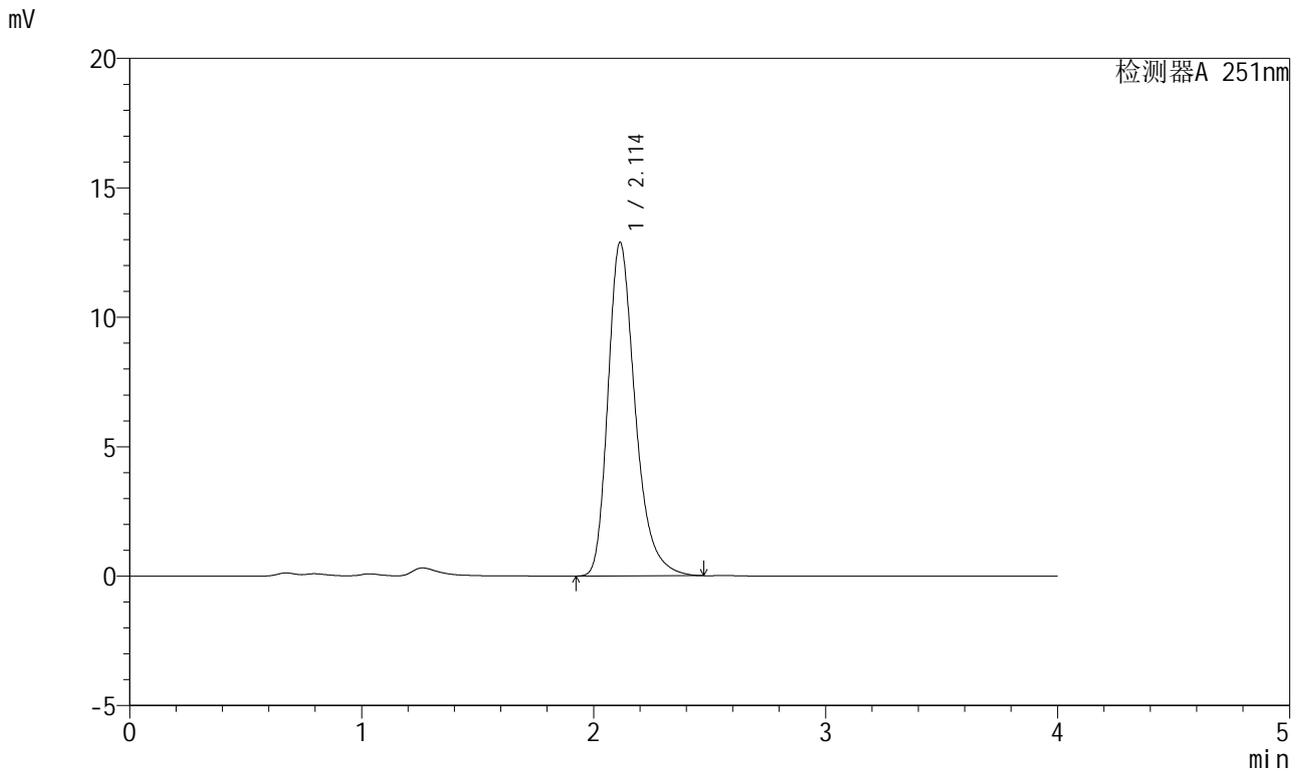

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	105052	100.000	12886	1640	1.302	--
总计		105052	100.000	12886			

图112 阿齐沙坦片溶出曲线测定长期9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3634-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:45:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

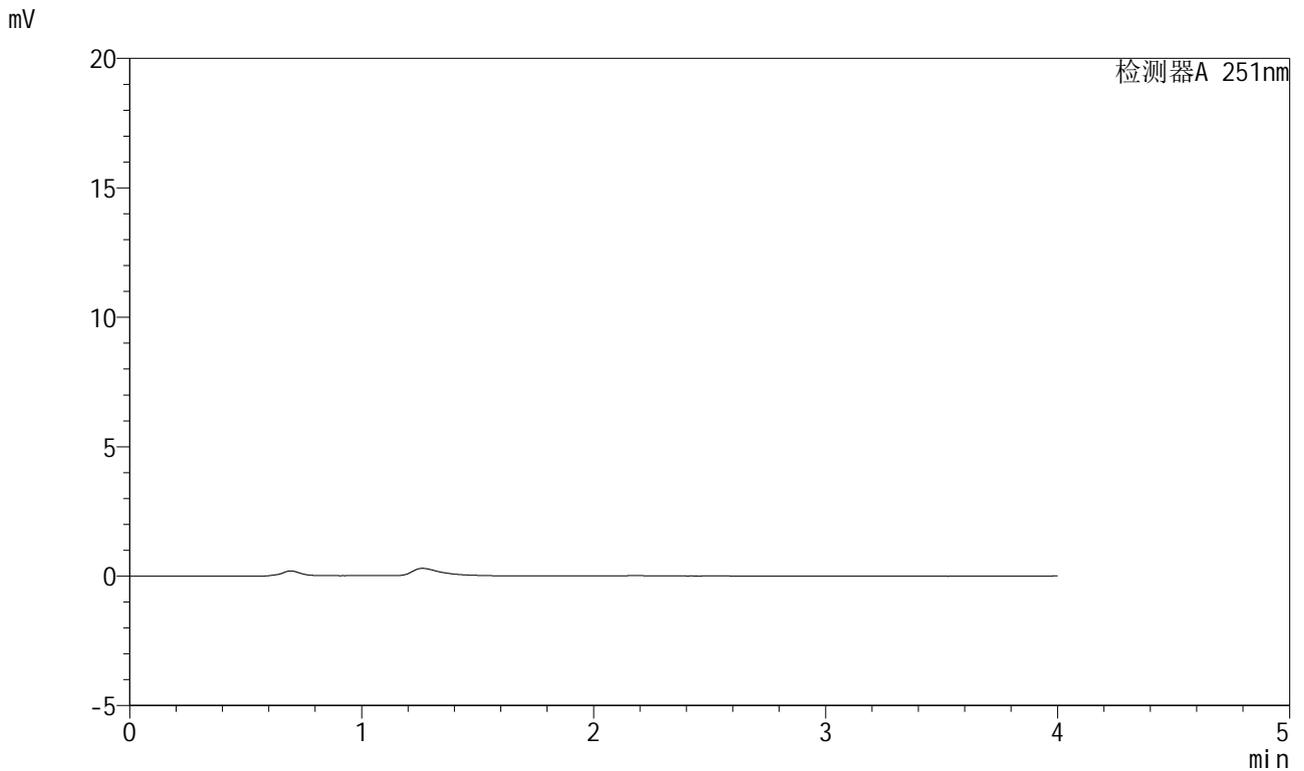

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3635-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:50:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

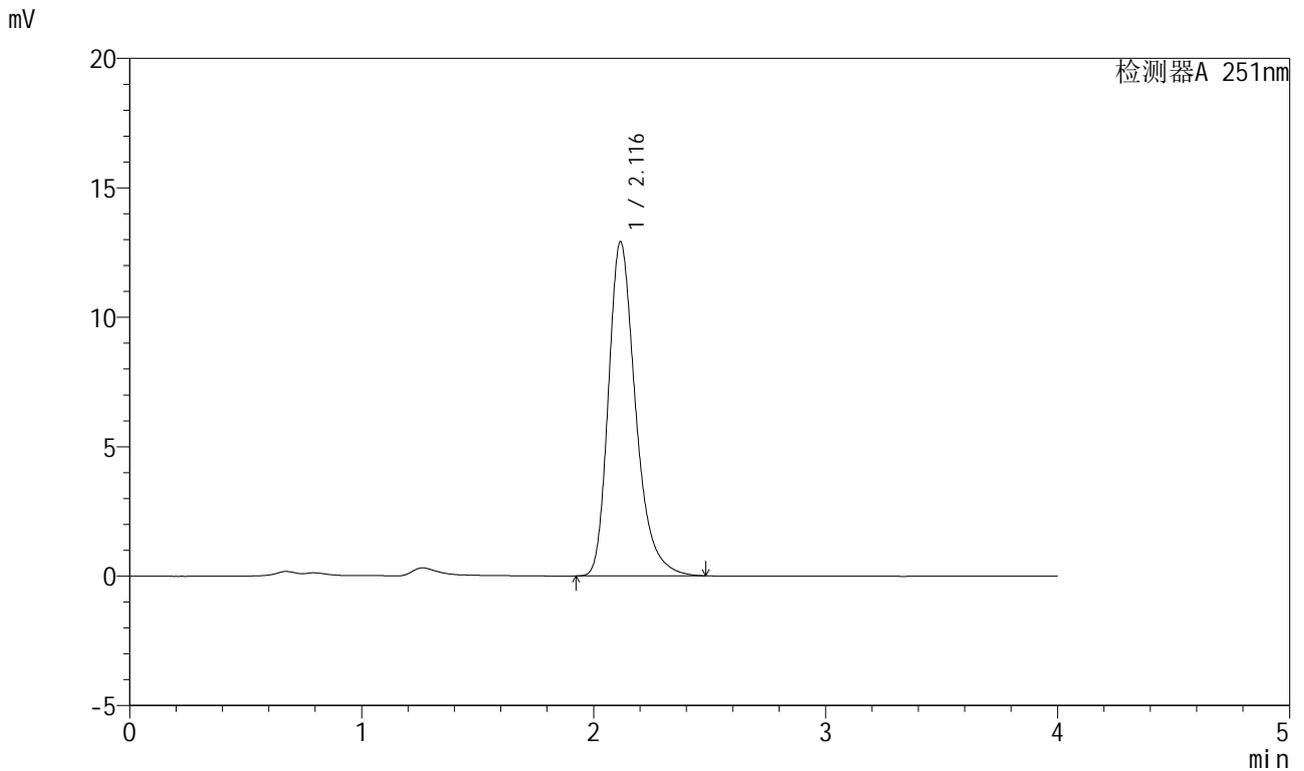

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	105108	100.000	12897	1652	1.301	--
总计		105108	100.000	12897			

图114 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3636-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:54:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

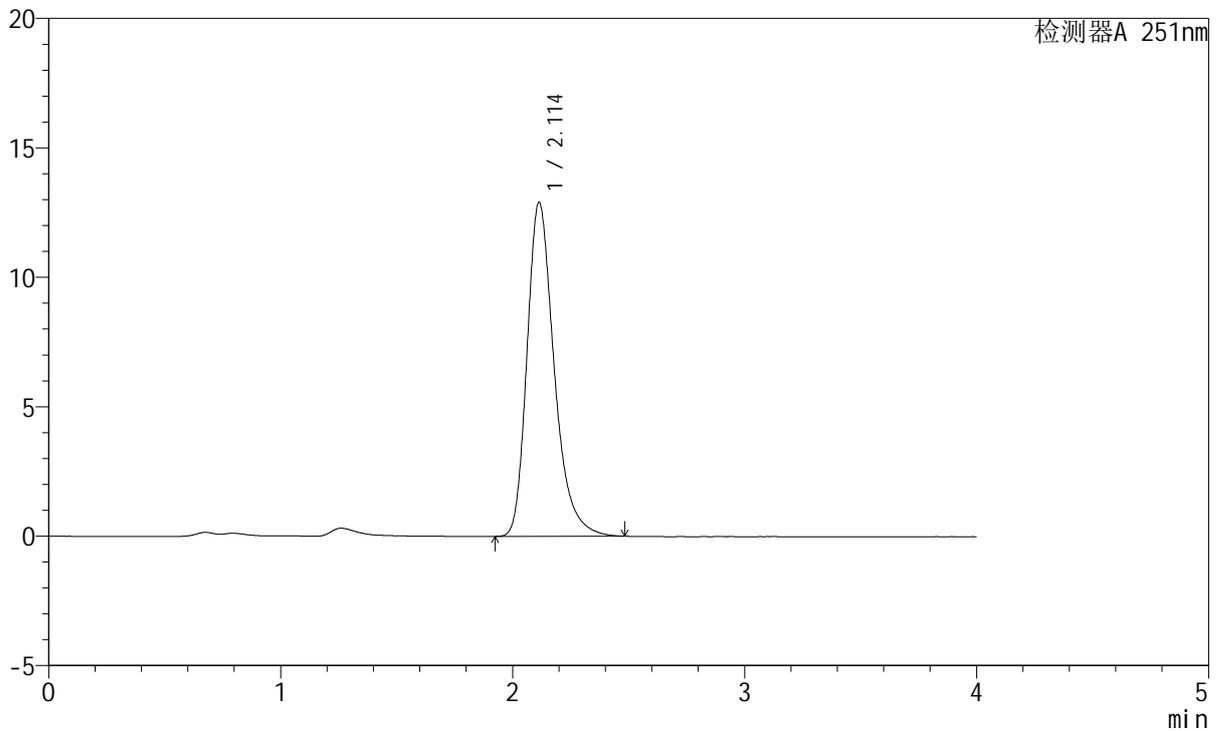

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	105075	100.000	12905	1646	1.303	--
总计		105075	100.000	12905			

图115 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3637-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 22:59:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

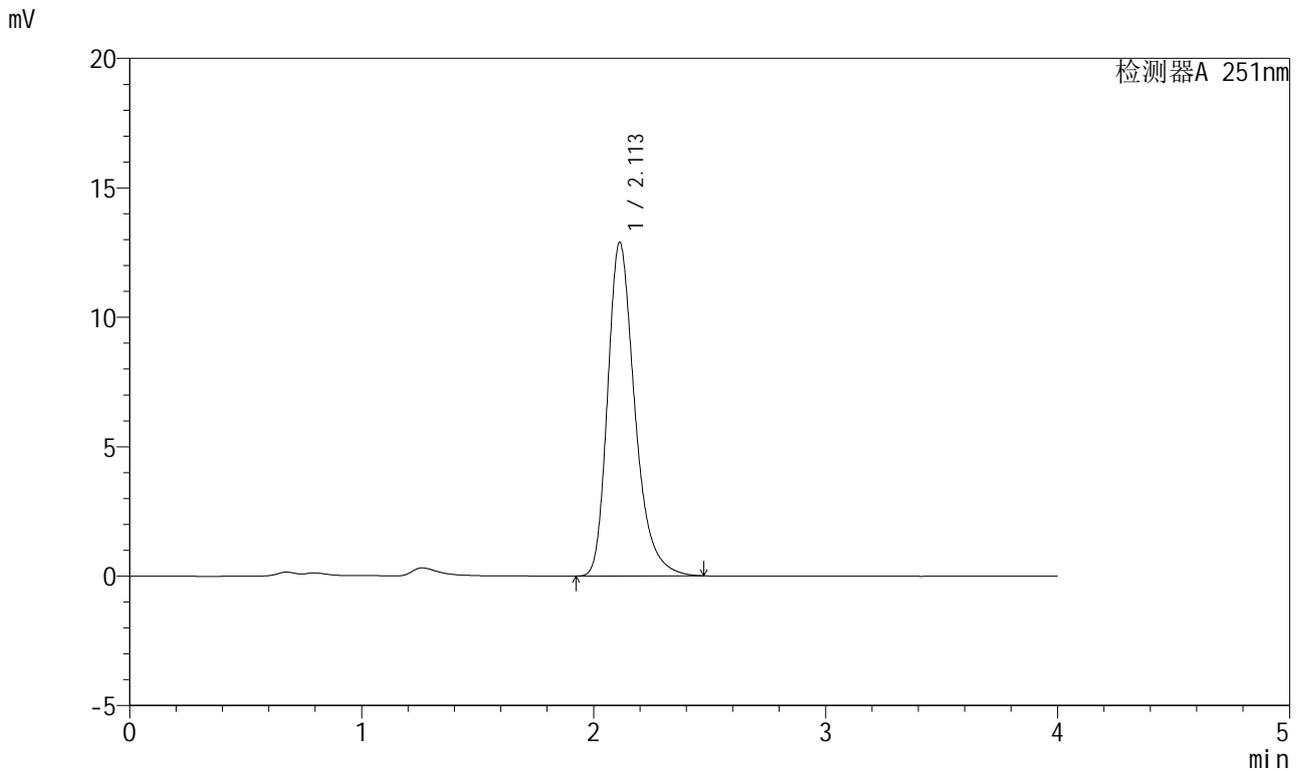

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	104973	100.000	12889	1643	1.303	--
总计		104973	100.000	12889			

图116 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3638-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:03:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

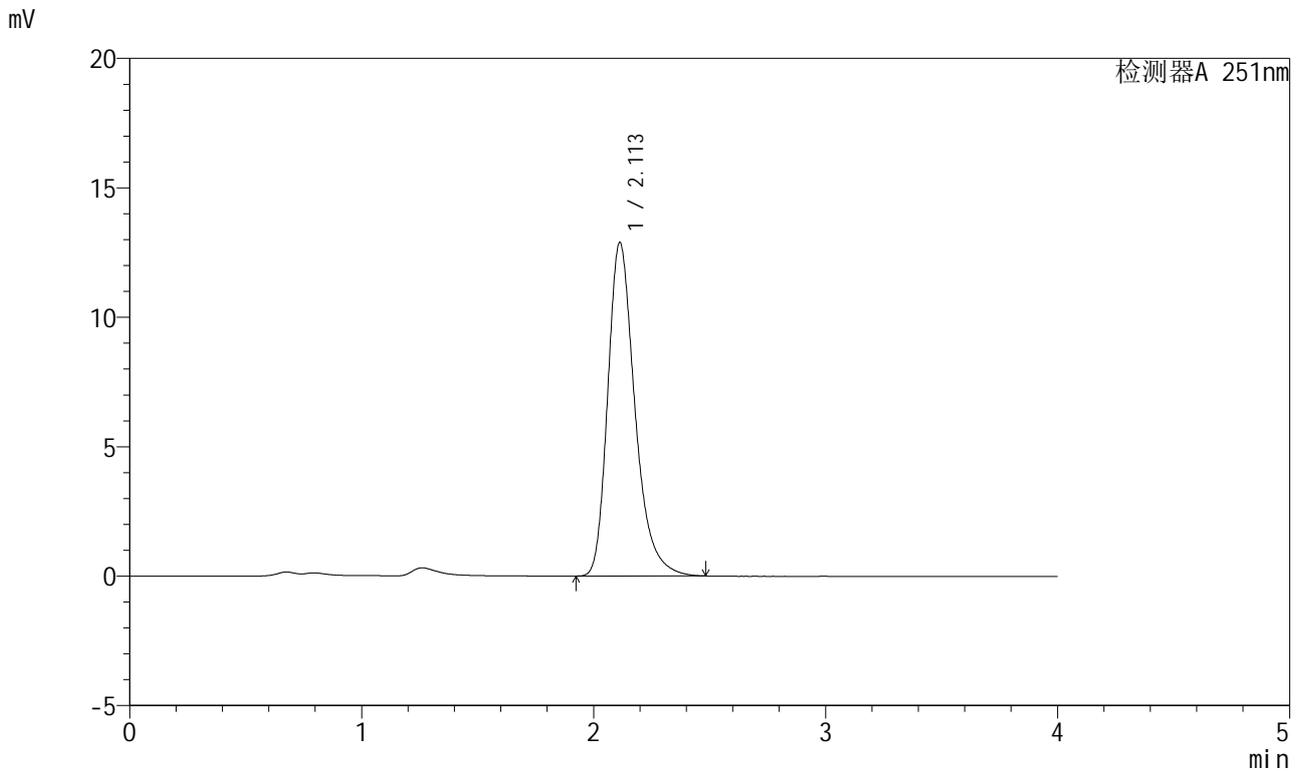

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	104959	100.000	12889	1645	1.303	--
总计		104959	100.000	12889			

图117 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3639-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:07:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

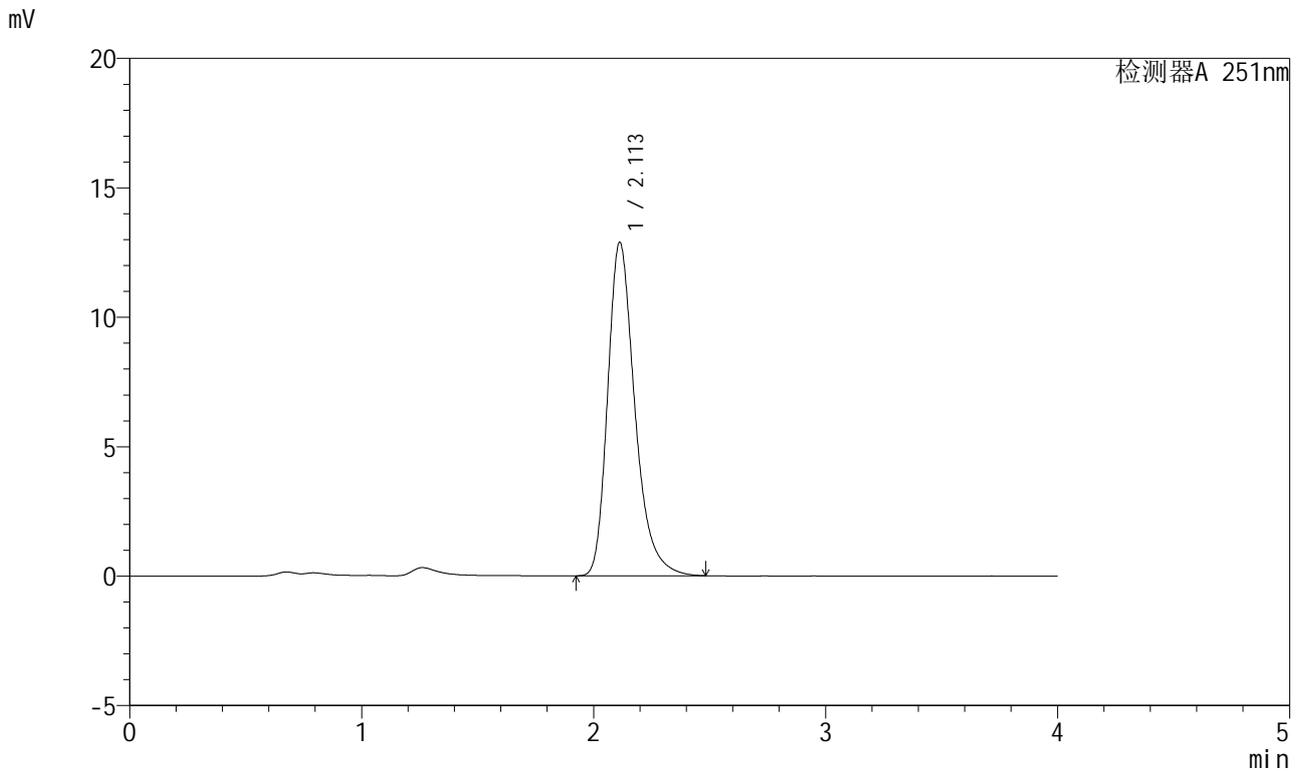

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	104980	100.000	12888	1645	1.303	--
总计		104980	100.000	12888			

图118 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3640-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:12:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

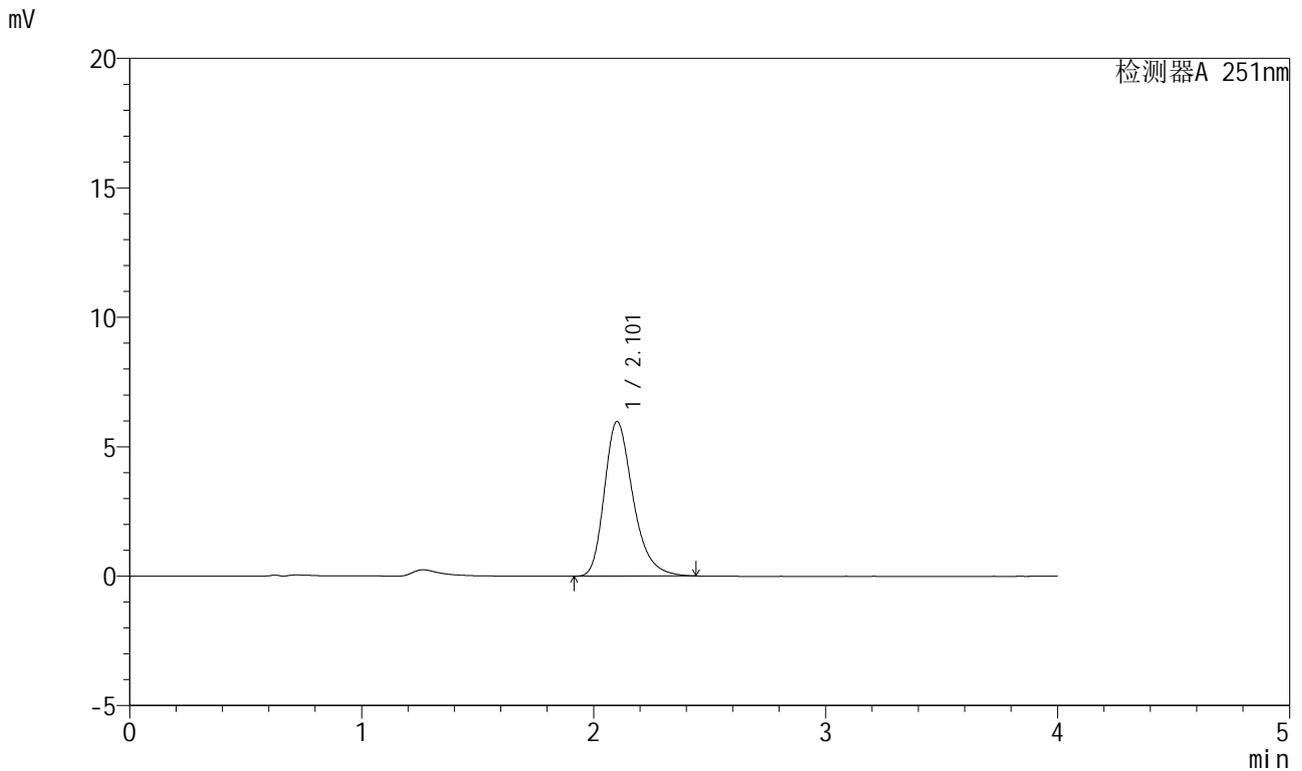

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	51265	100.000	5959	1447	1.299	--
总计		51265	100.000	5959			

图119 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3641-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:16:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

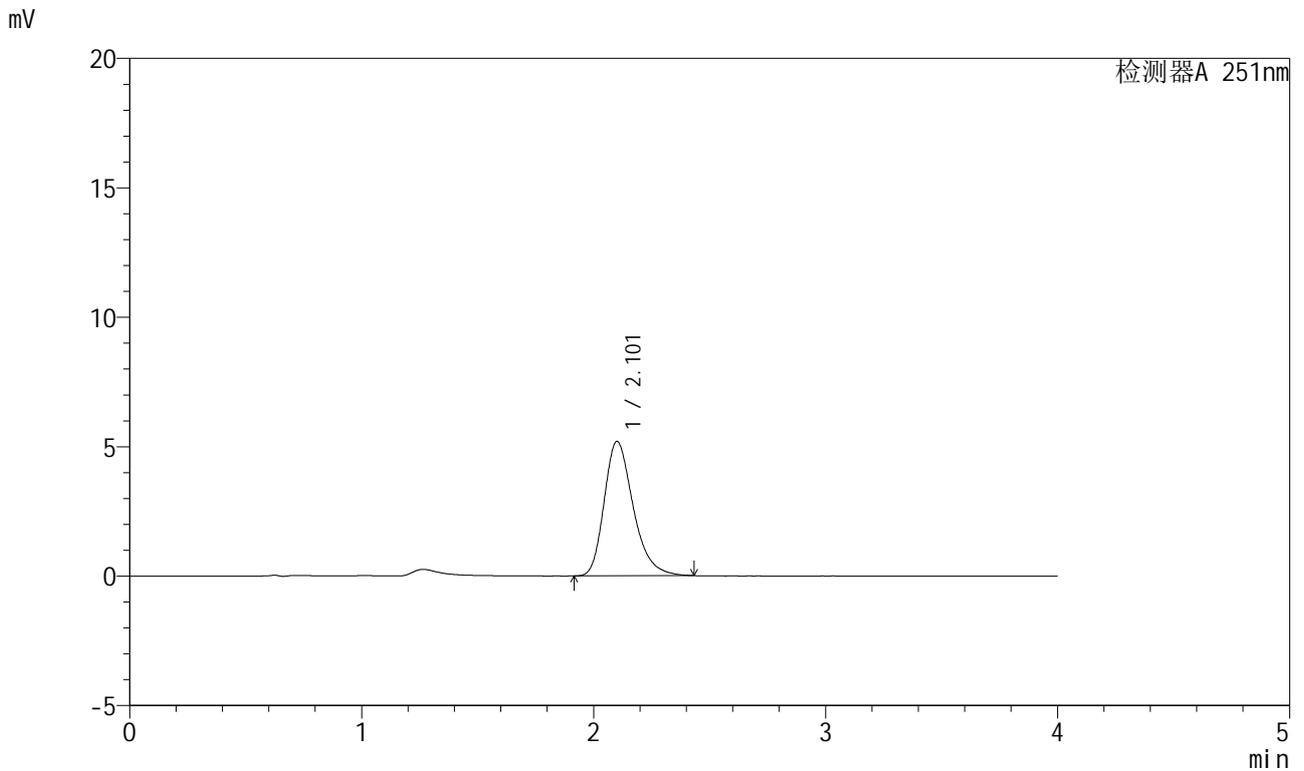

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	45275	100.000	5183	1396	1.295	--
总计		45275	100.000	5183			

图120 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3642-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:21:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

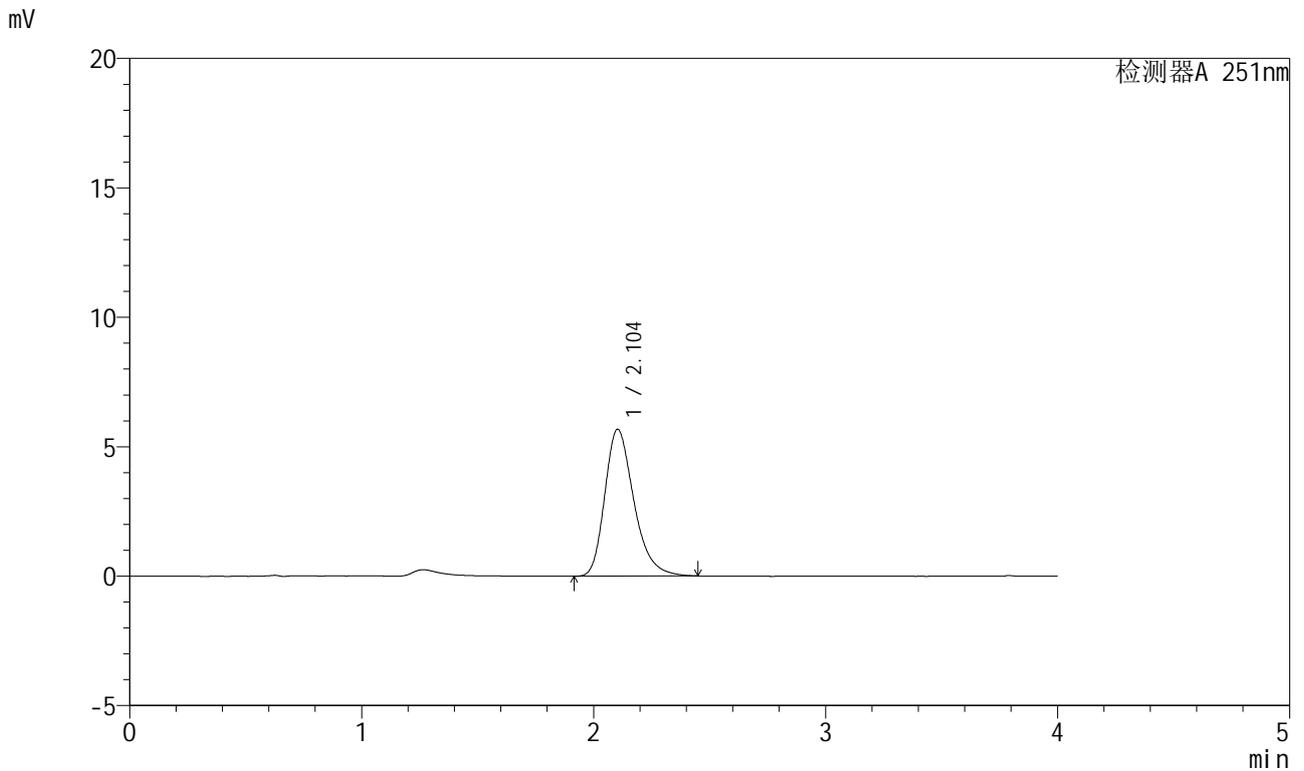

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	49553	100.000	5675	1400	1.294	--
总计		49553	100.000	5675			

图121 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3643-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:25:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

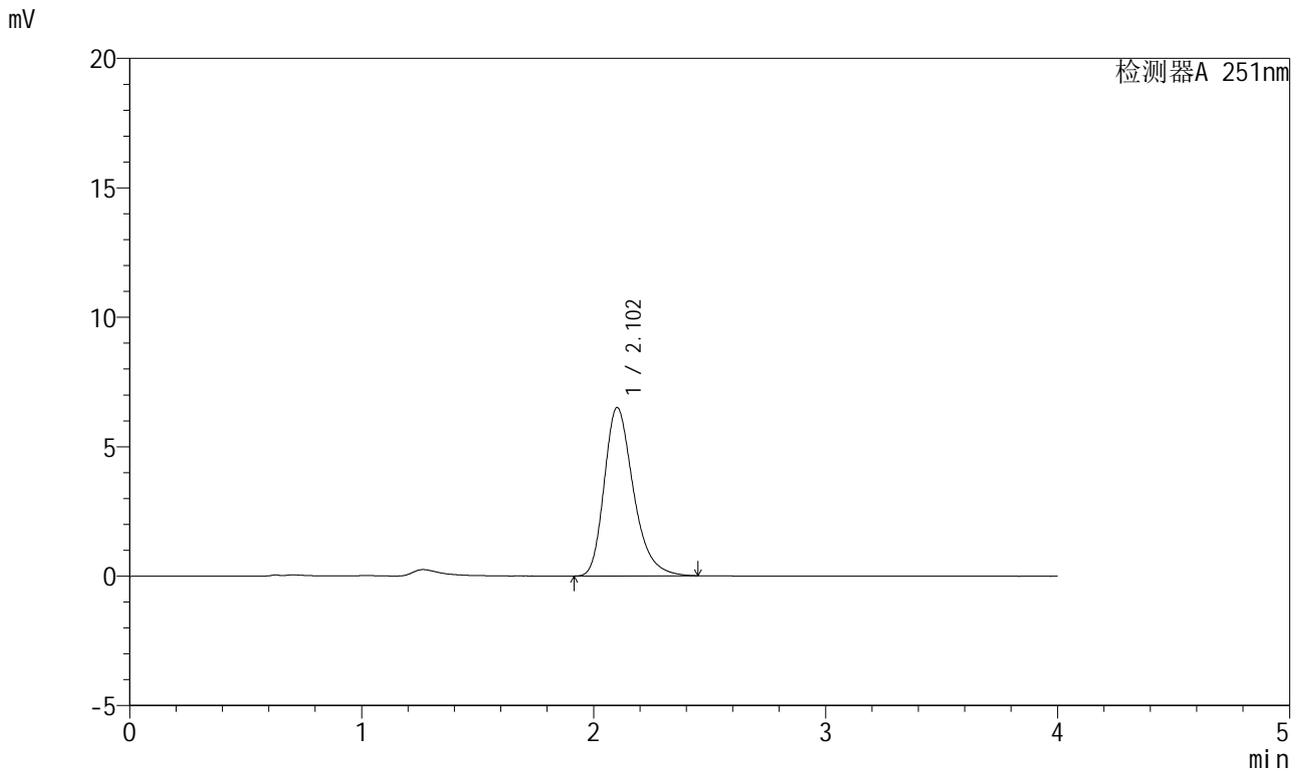

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	56818	100.000	6494	1393	1.297	--
总计		56818	100.000	6494			

图122 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3644-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:29:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

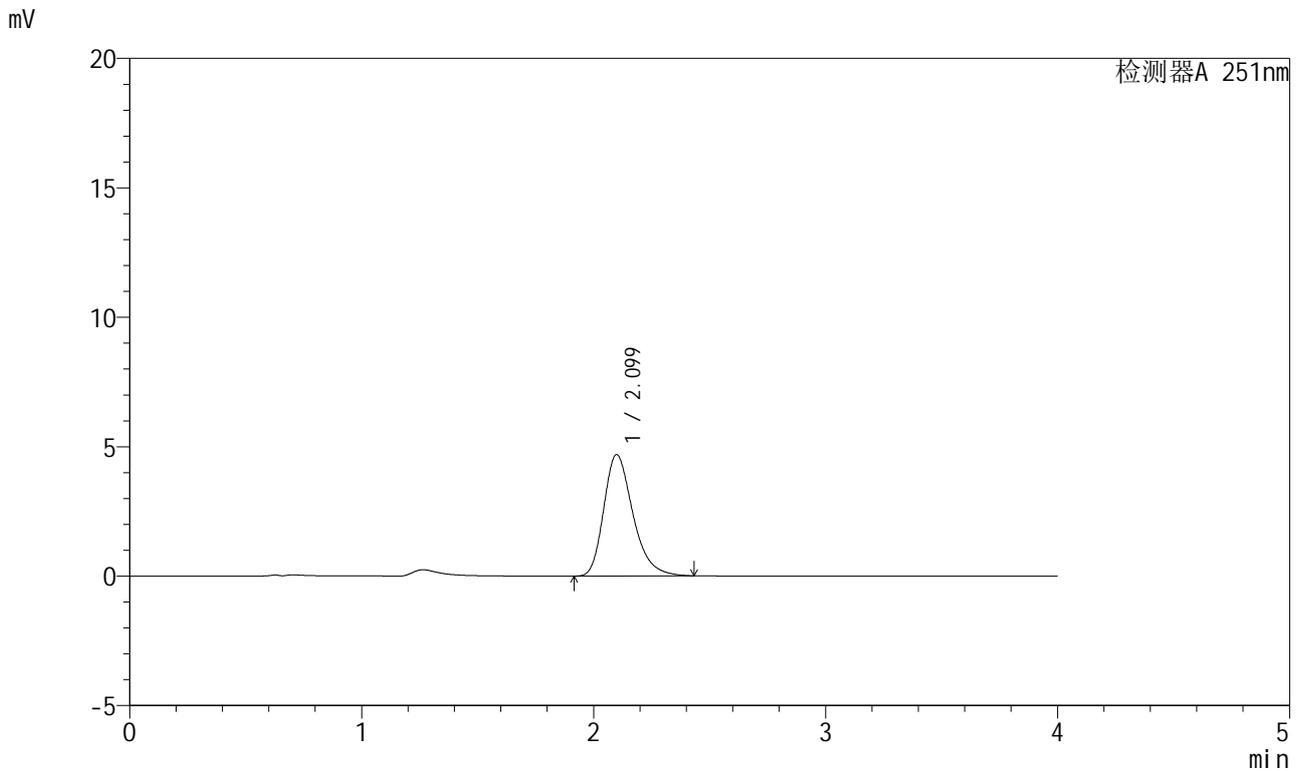

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	41035	100.000	4687	1385	1.299	--
总计		41035	100.000	4687			

图123 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3645-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:34:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

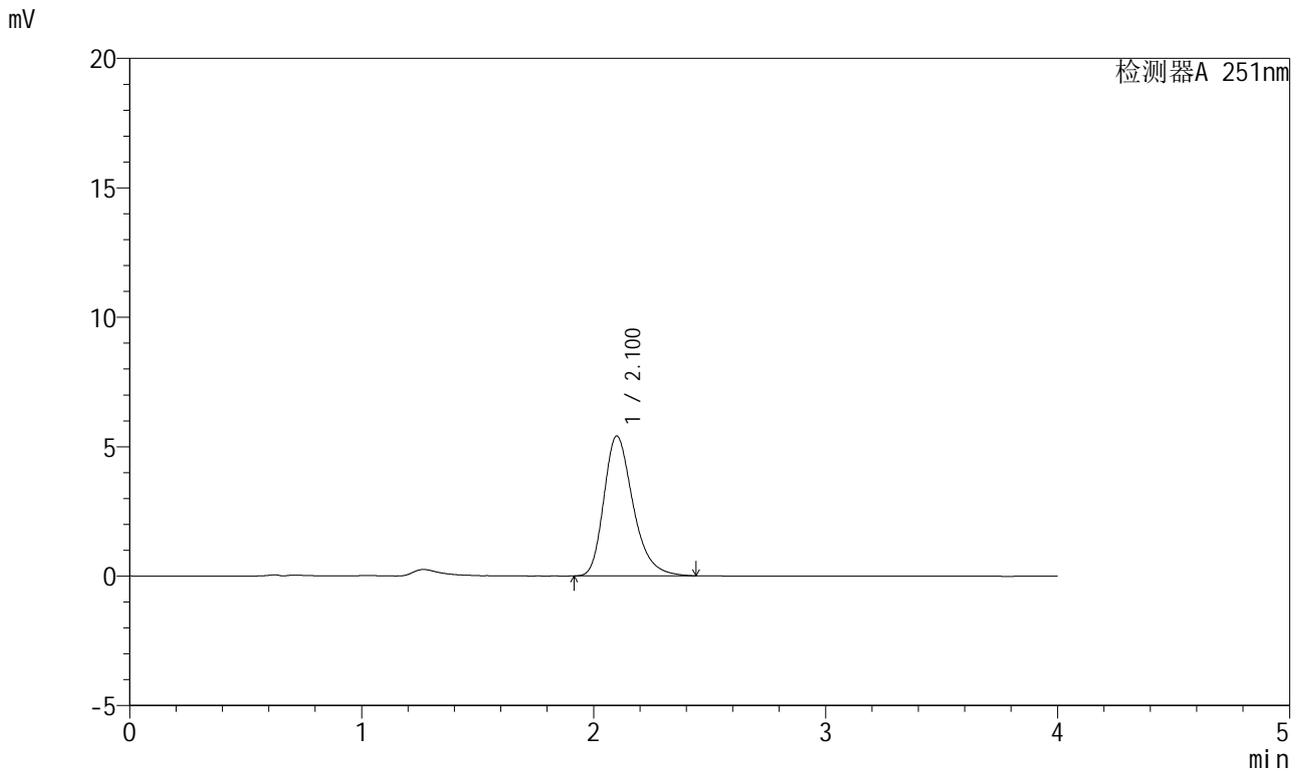

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	47297	100.000	5397	1386	1.300	--
总计		47297	100.000	5397			

图124 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3646-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:38:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

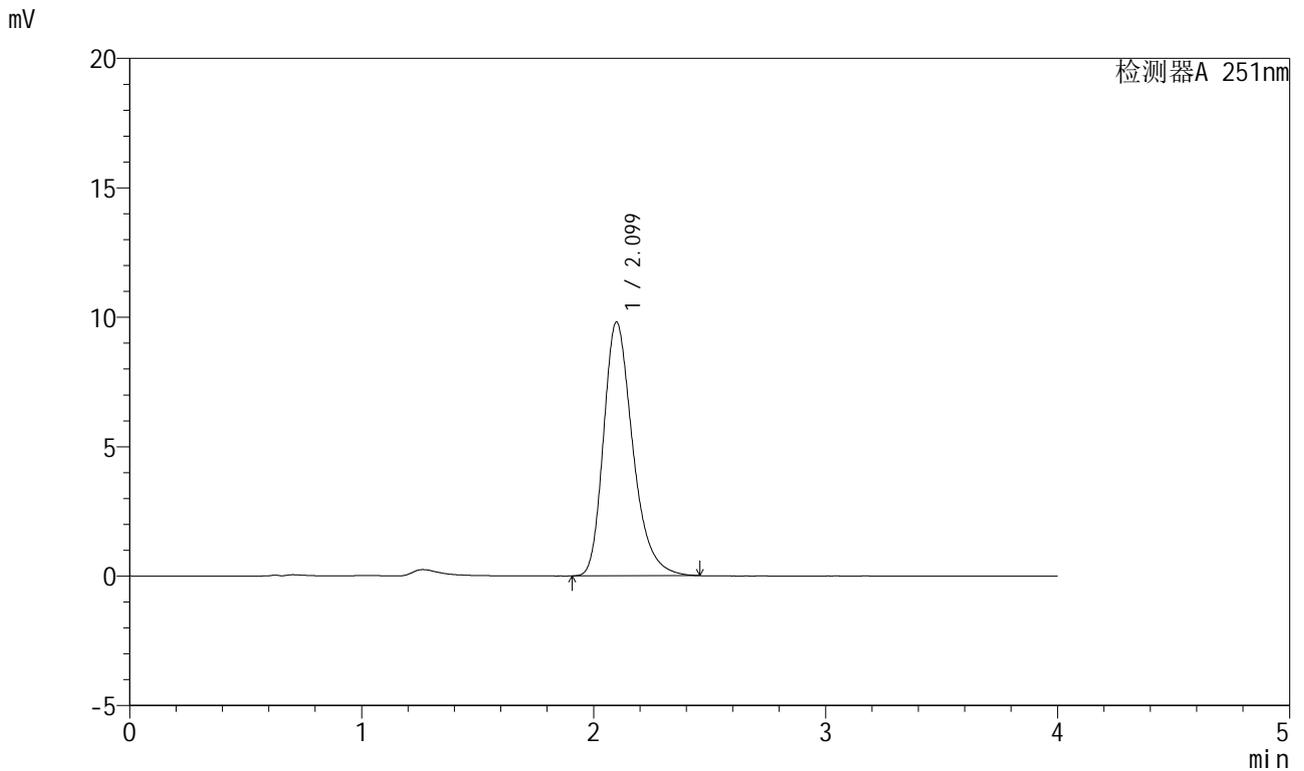

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	85749	100.000	9801	1389	1.299	--
总计		85749	100.000	9801			

图125 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3647-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:42:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

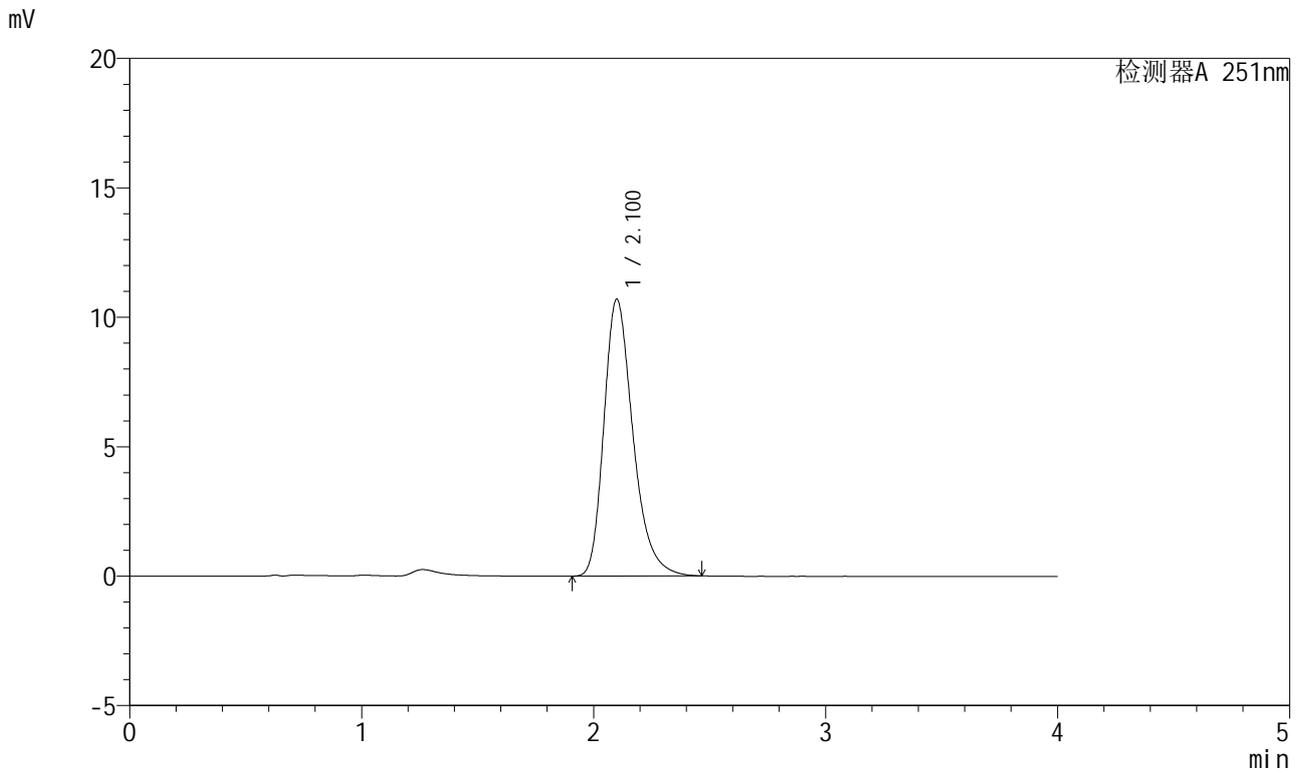

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	93339	100.000	10682	1399	1.300	--
总计		93339	100.000	10682			

图126 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3648-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:47:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

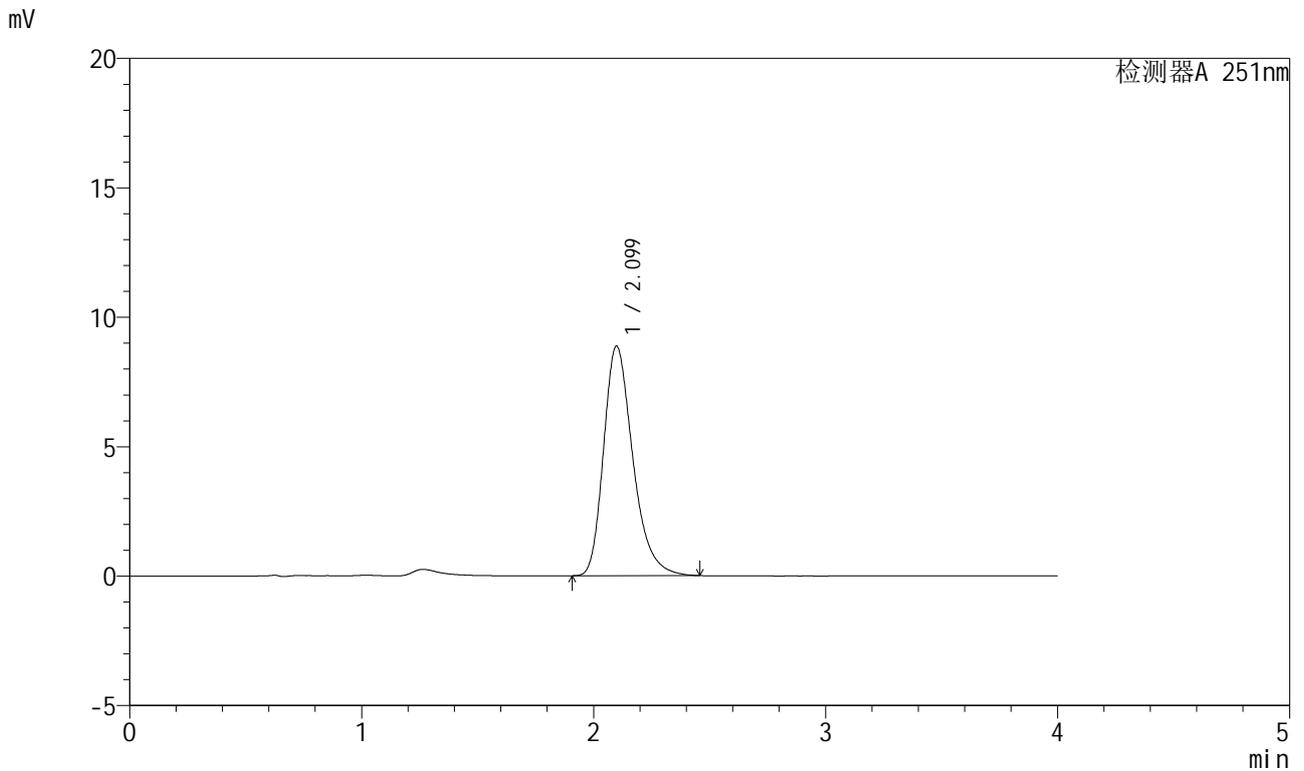

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	77807	100.000	8867	1380	1.298	--
总计		77807	100.000	8867			

图127 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3649-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:51:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

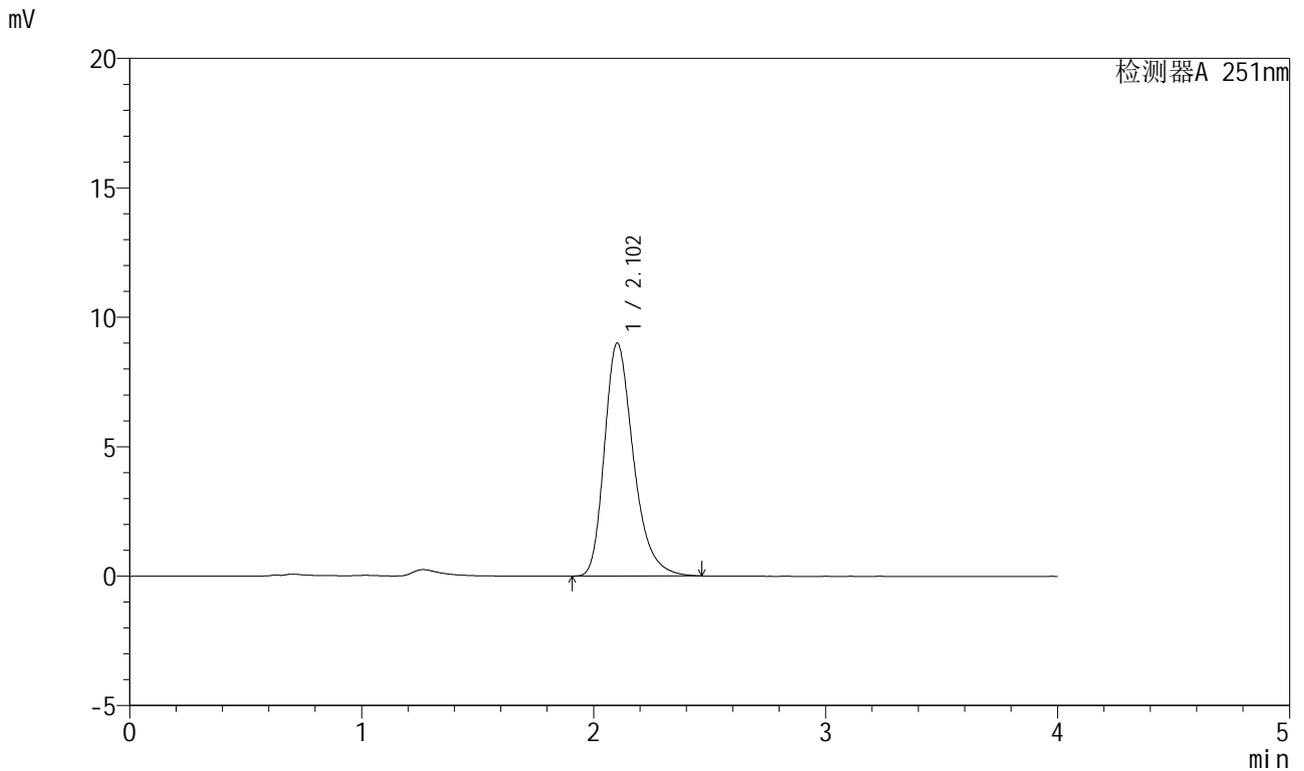

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	78232	100.000	8992	1415	1.300	--
总计		78232	100.000	8992			

图128 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3650-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/29 23:56:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

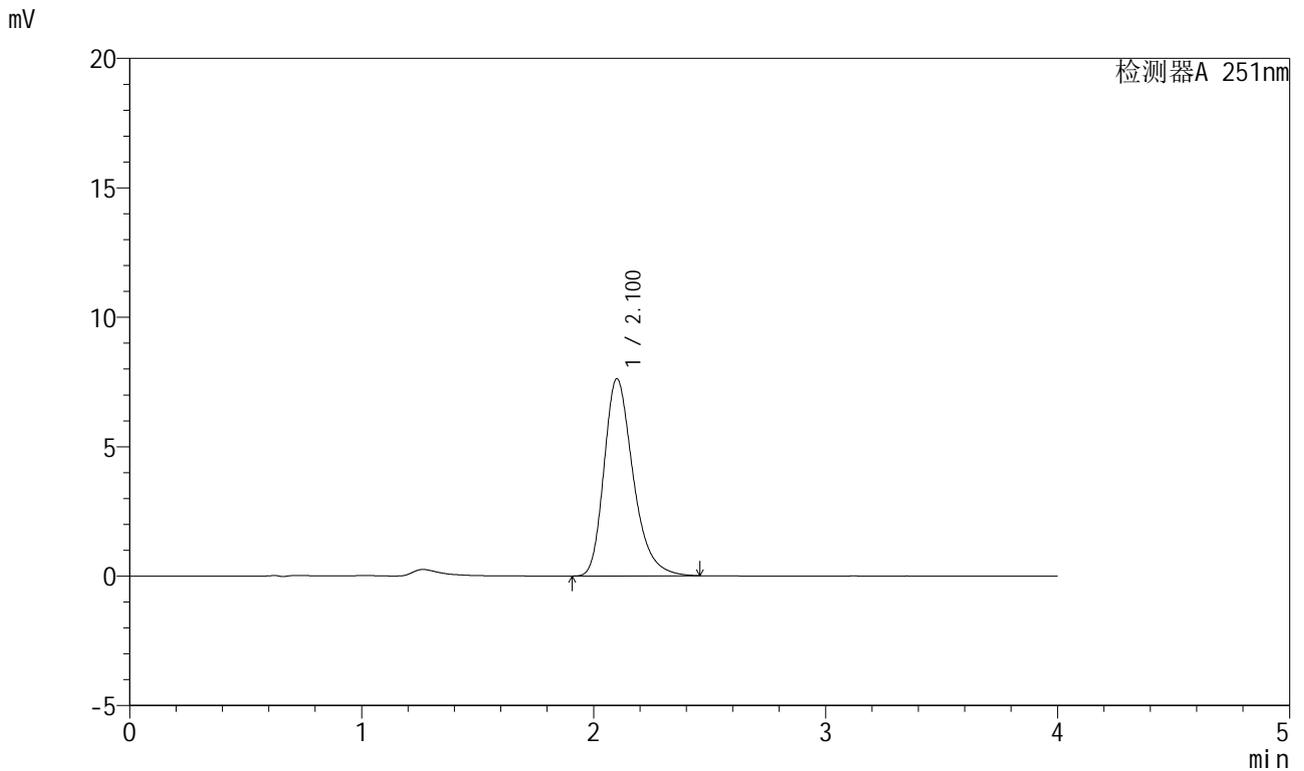

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	66375	100.000	7604	1404	1.300	--
总计		66375	100.000	7604			

图129 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3651-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:00:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

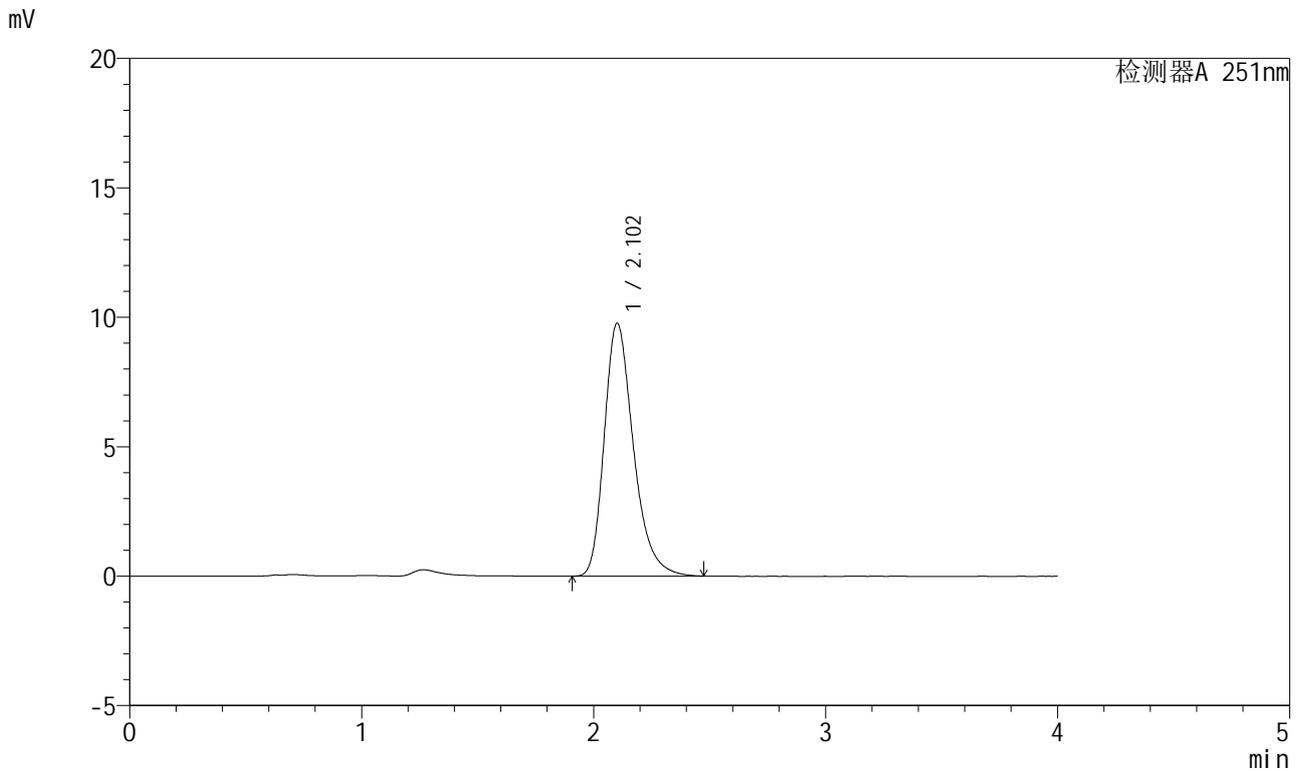

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	85457	100.000	9757	1398	1.302	--
总计		85457	100.000	9757			

图130 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3652-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:04:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

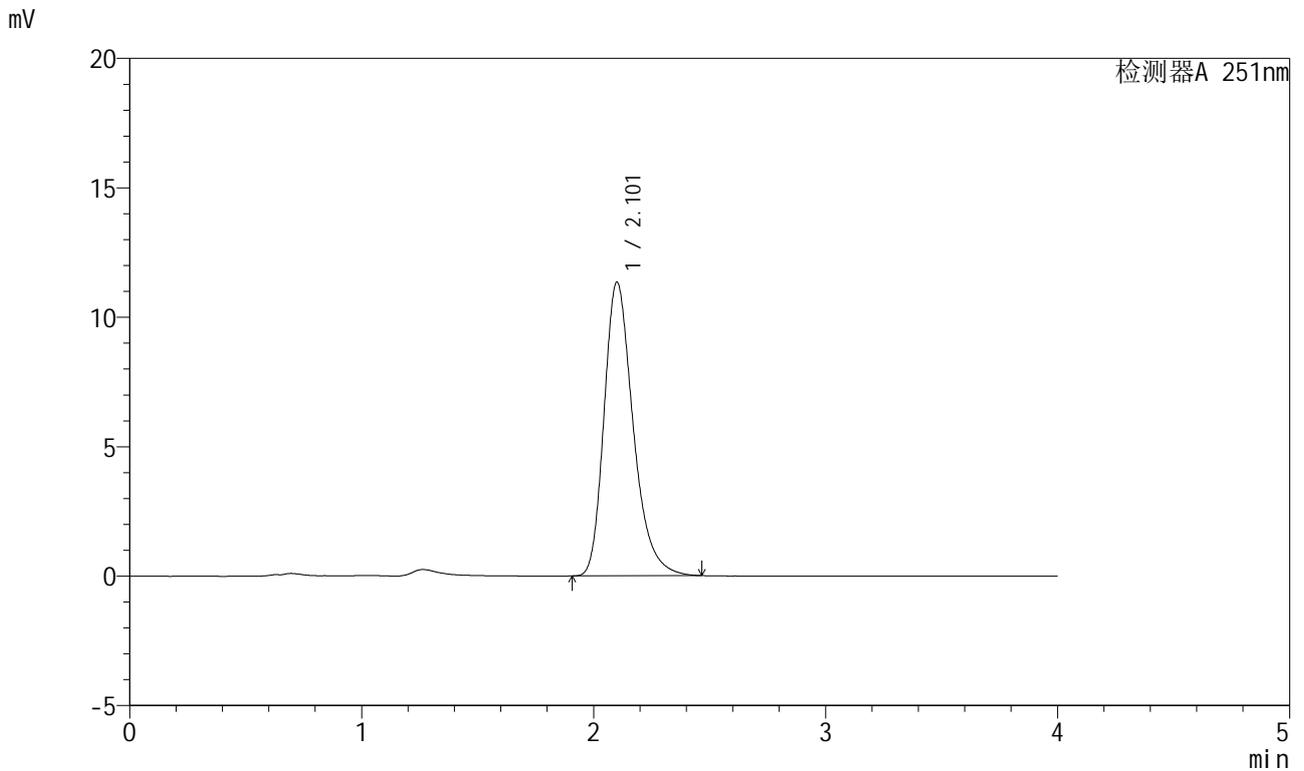

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	99002	100.000	11320	1399	1.300	--
总计		99002	100.000	11320			

图131 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3653-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:09:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

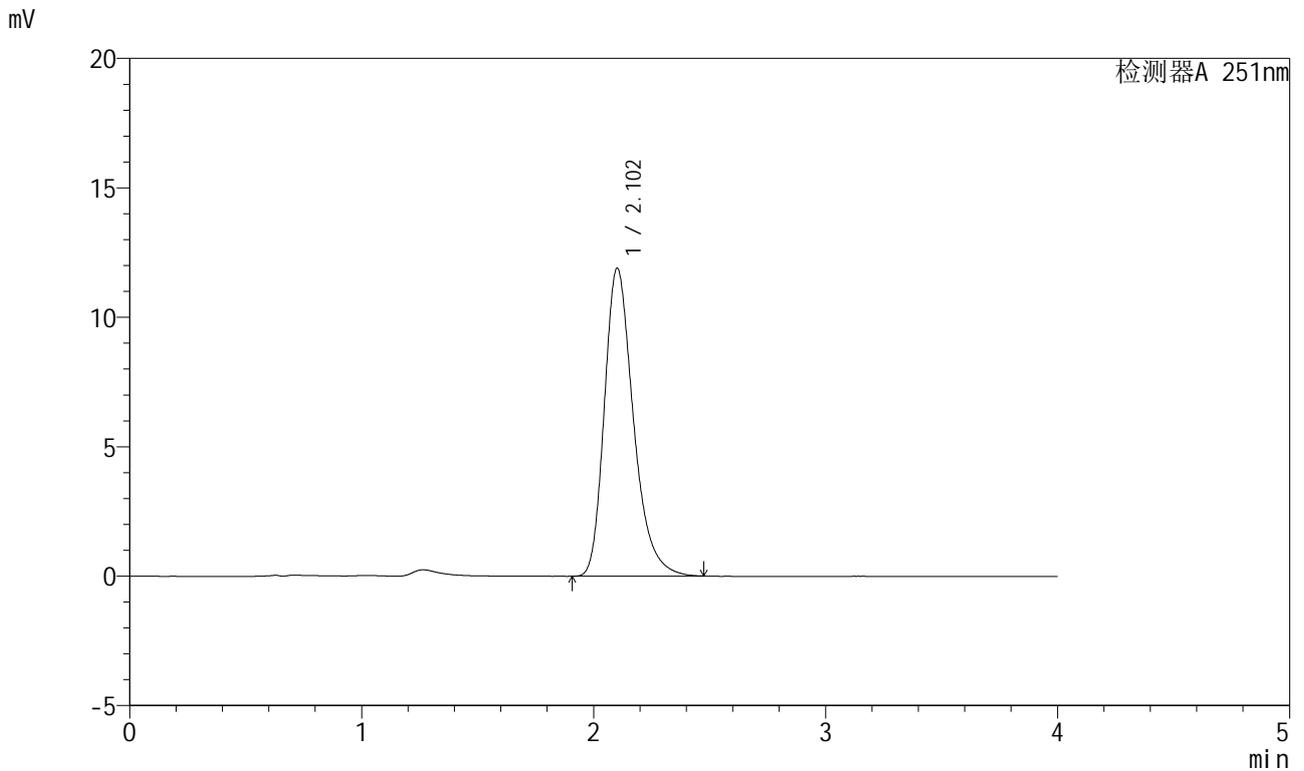

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	103663	100.000	11882	1407	1.301	--
总计		103663	100.000	11882			

图132 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3654-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:13:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:06:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

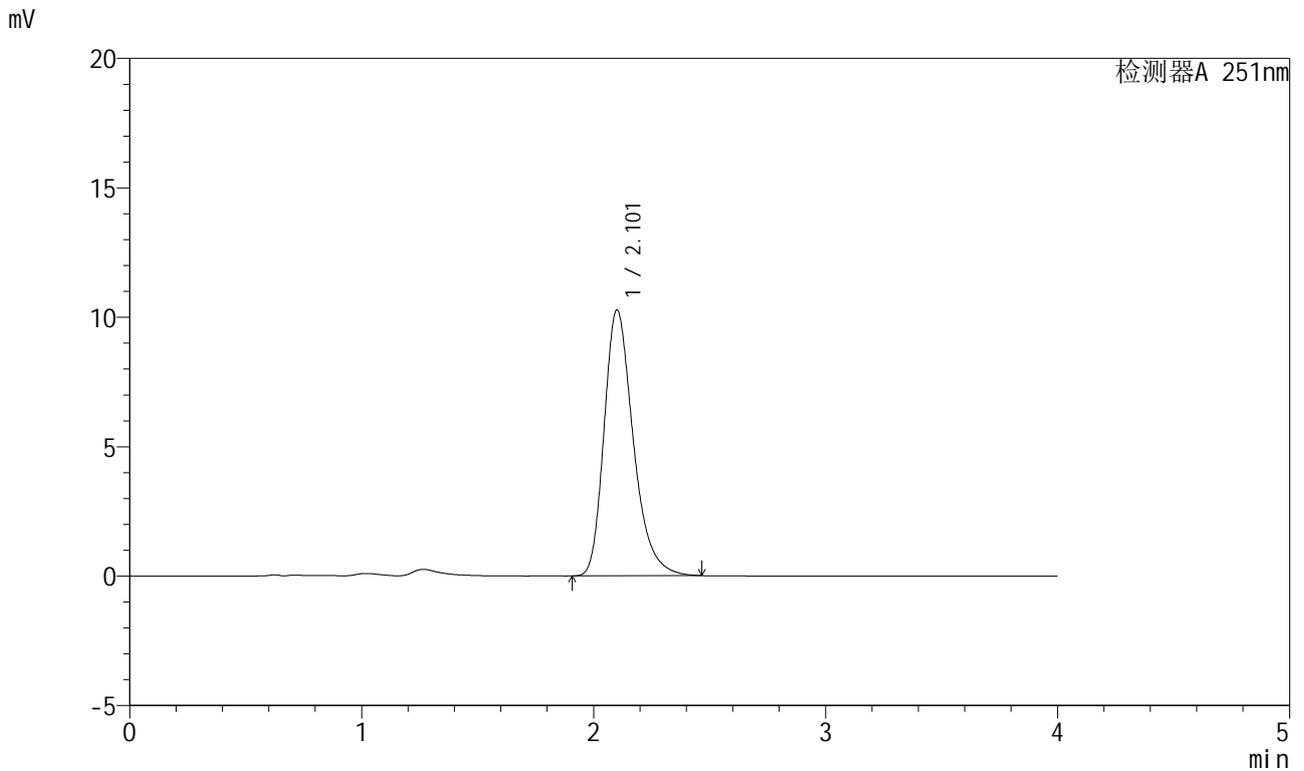

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	89846	100.000	10247	1393	1.302	--
总计		89846	100.000	10247			

图133 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3655-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:17:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

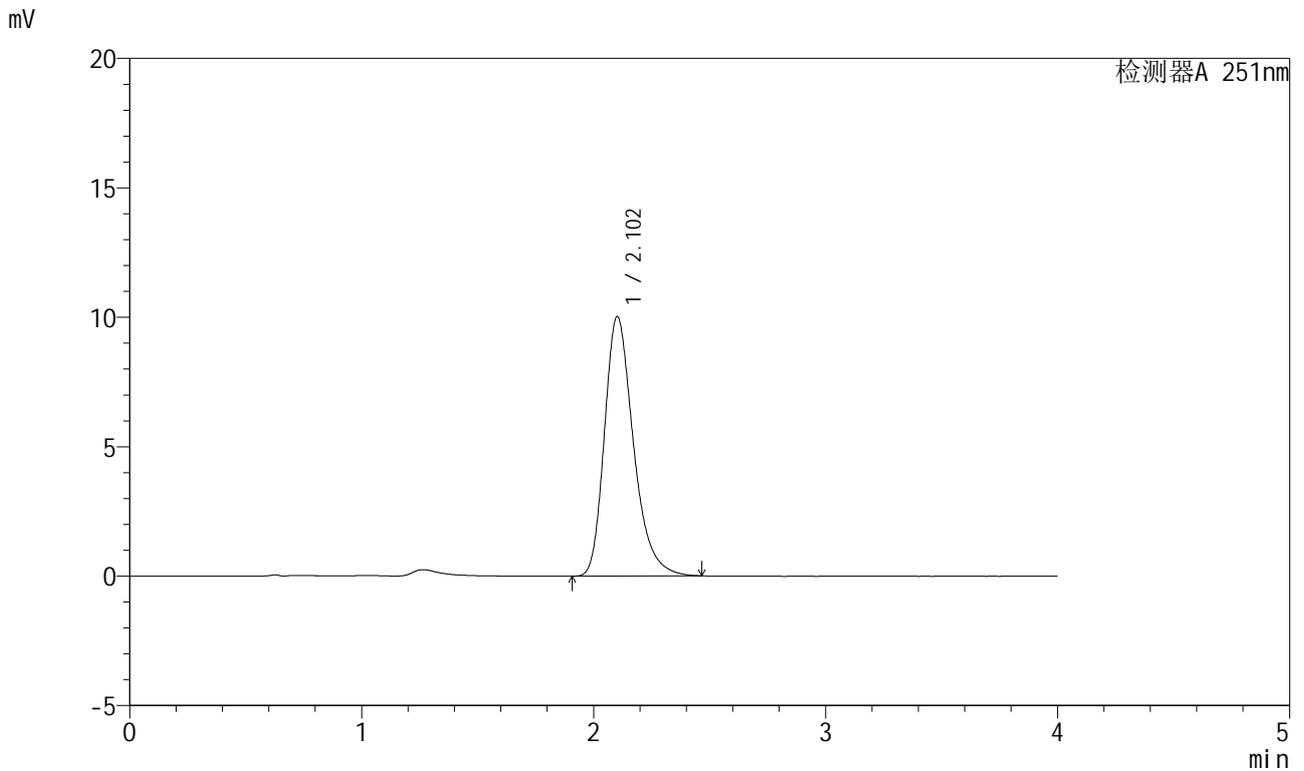

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	87111	100.000	10013	1416	1.301	--
总计		87111	100.000	10013			

图134 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3656-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:22:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

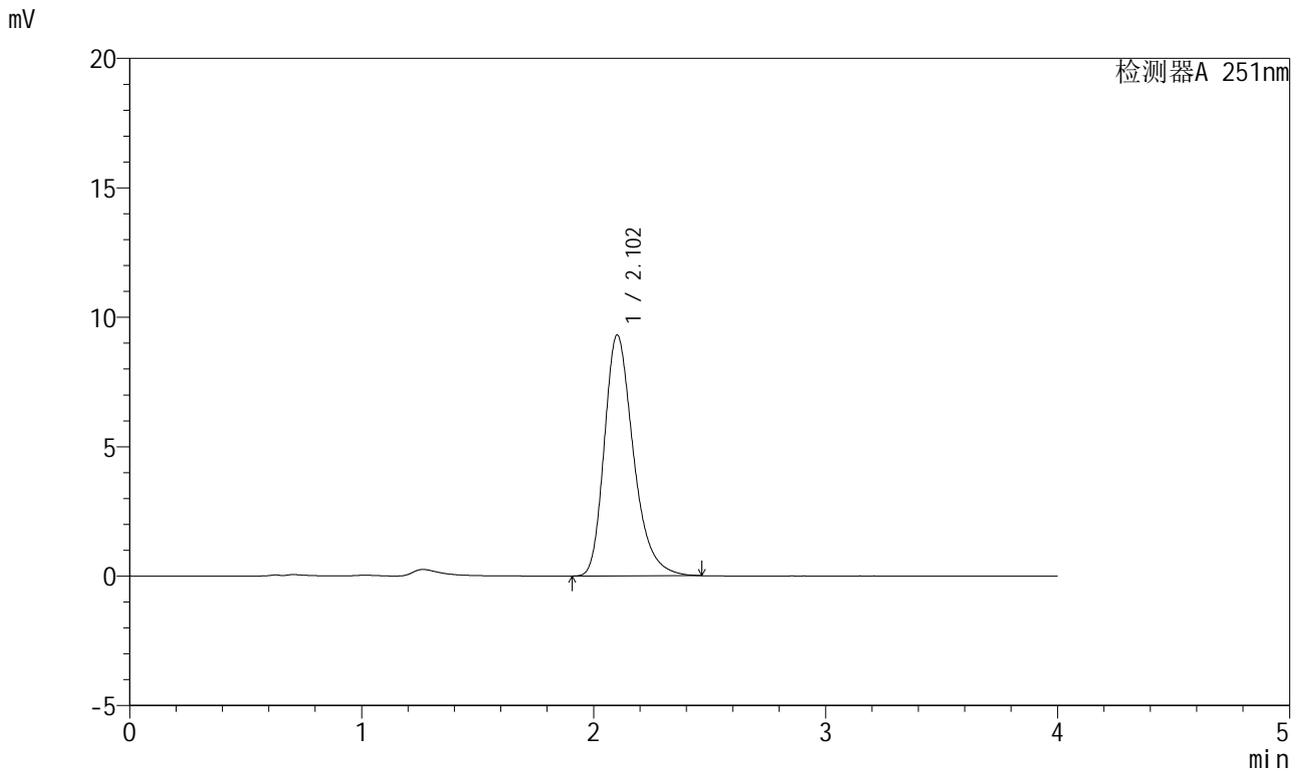

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	81035	100.000	9293	1407	1.302	--
总计		81035	100.000	9293			

图135 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3657-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:26:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

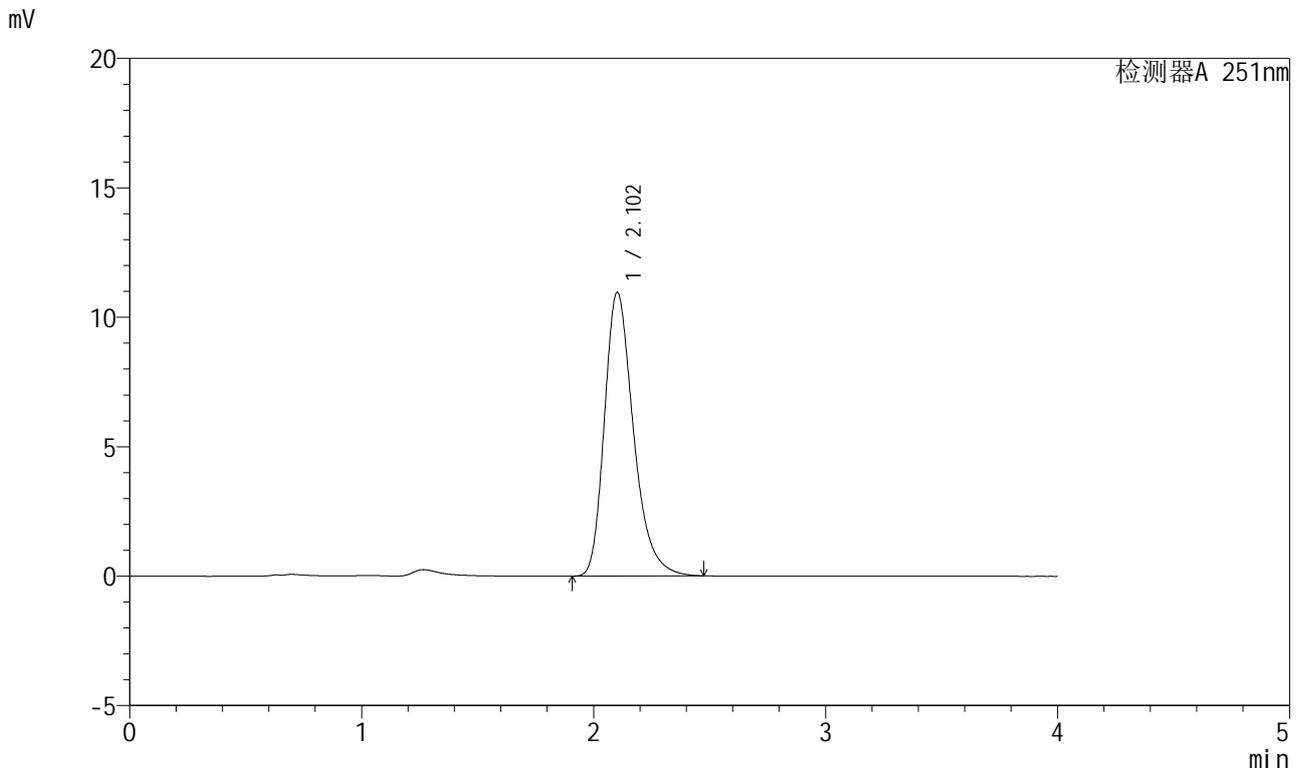

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	95551	100.000	10945	1405	1.300	--
总计		95551	100.000	10945			

图136 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3658-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:30:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

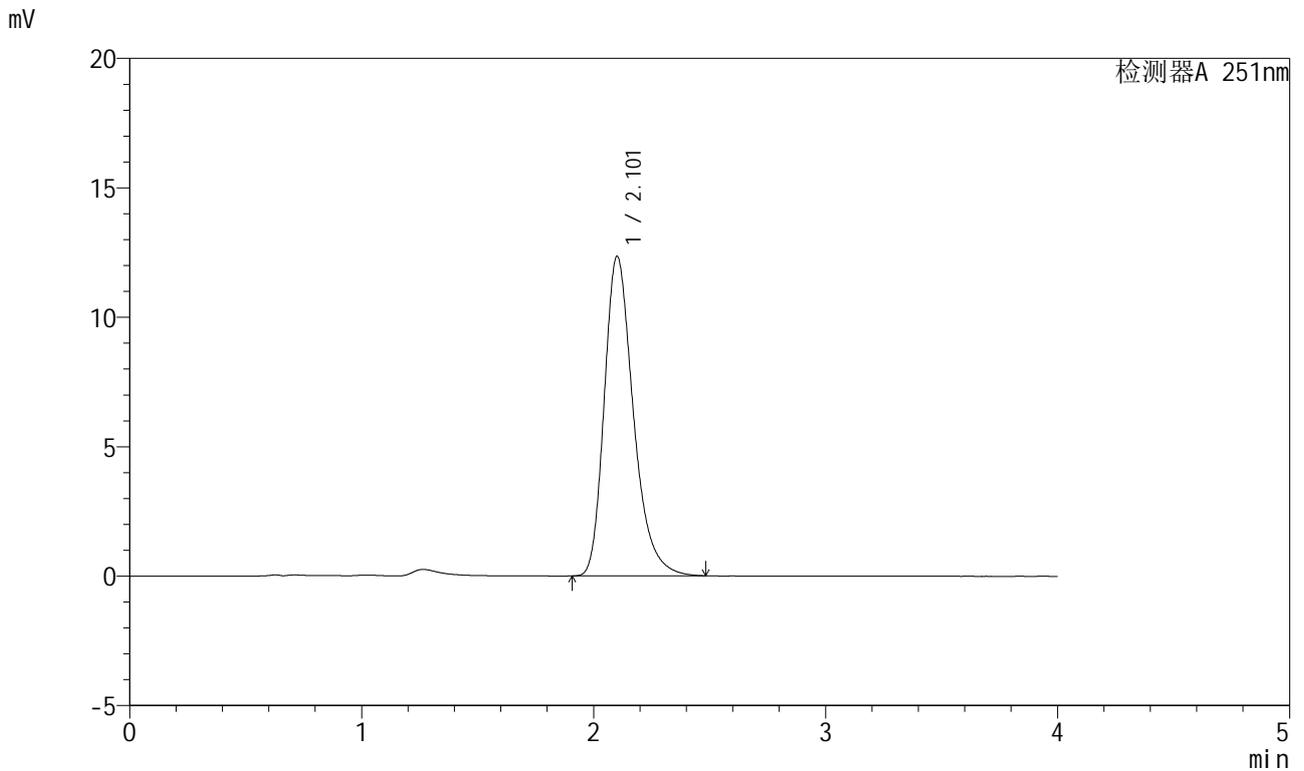

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	107767	100.000	12324	1403	1.302	--
总计		107767	100.000	12324			

图137 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3659-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:35:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

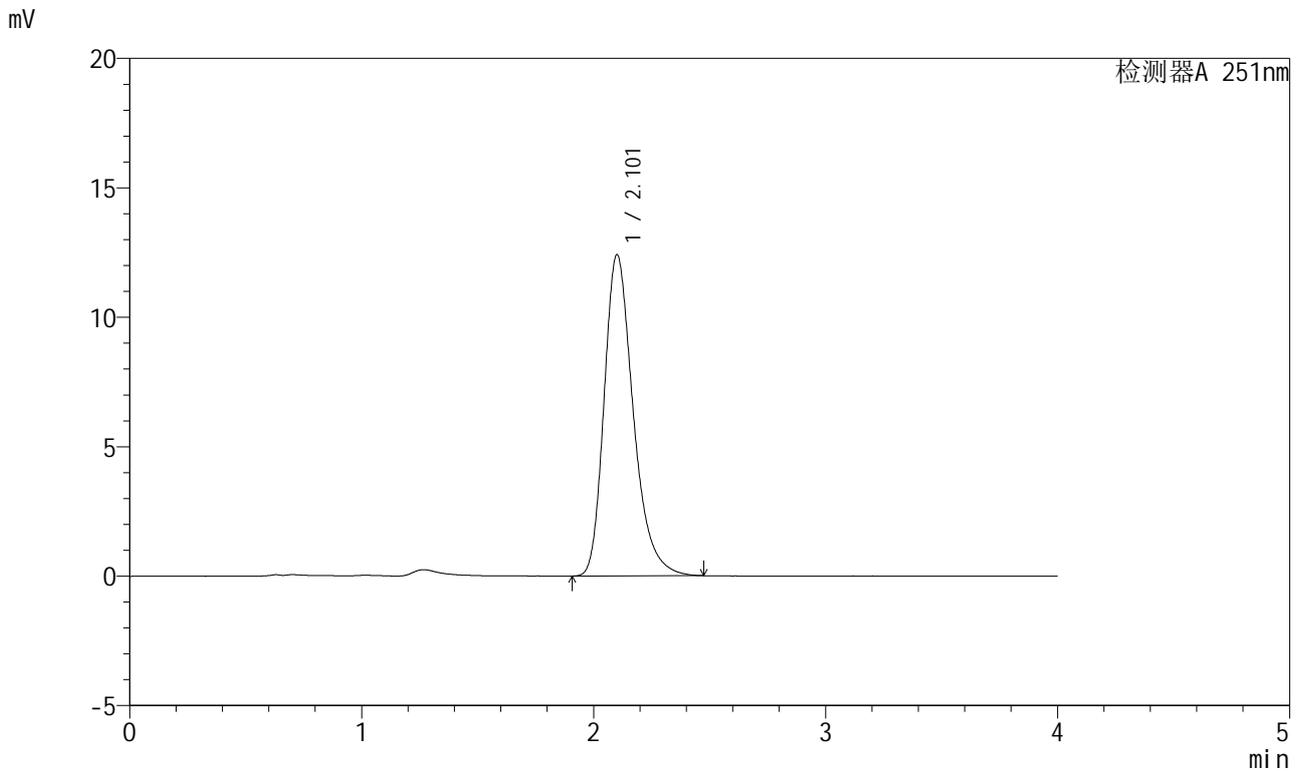

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	108327	100.000	12380	1400	1.302	--
总计		108327	100.000	12380			

图138 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3660-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:39:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

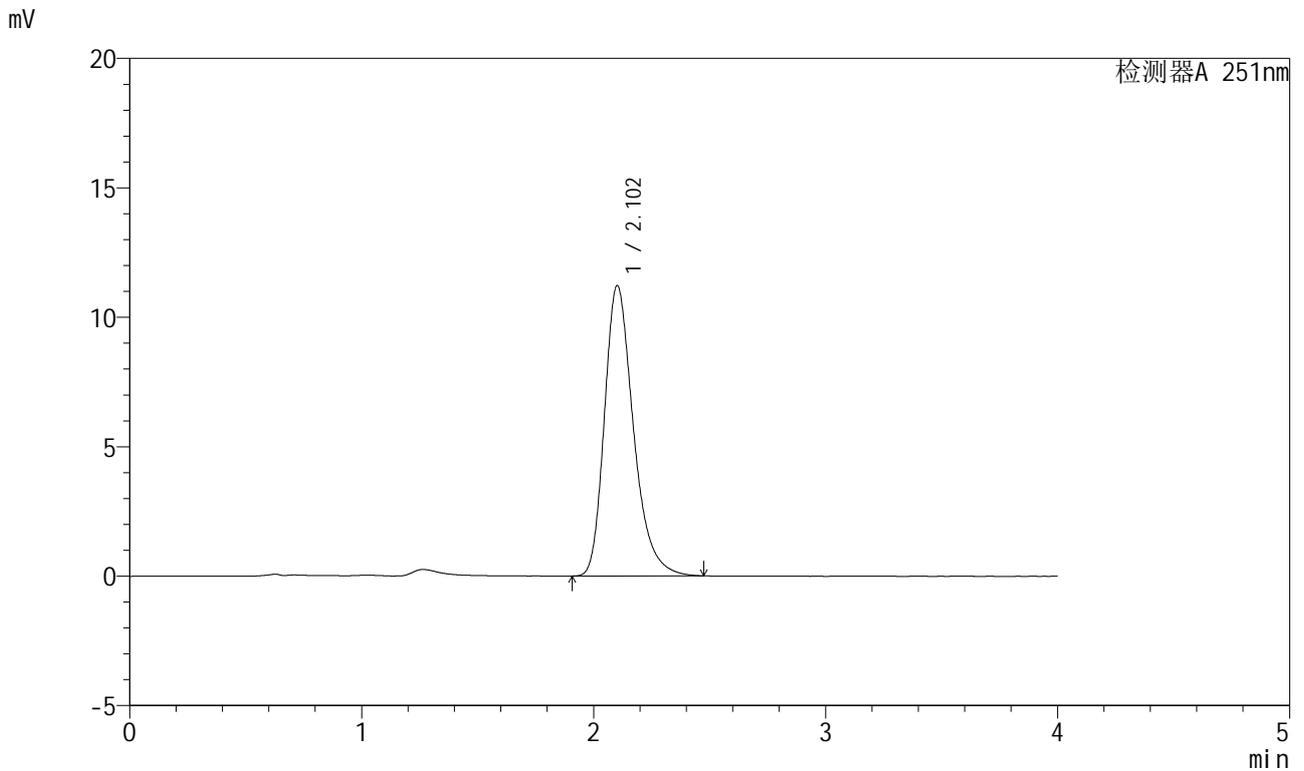

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	97410	100.000	11202	1420	1.301	--
总计		97410	100.000	11202			

图139 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3661-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:44:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

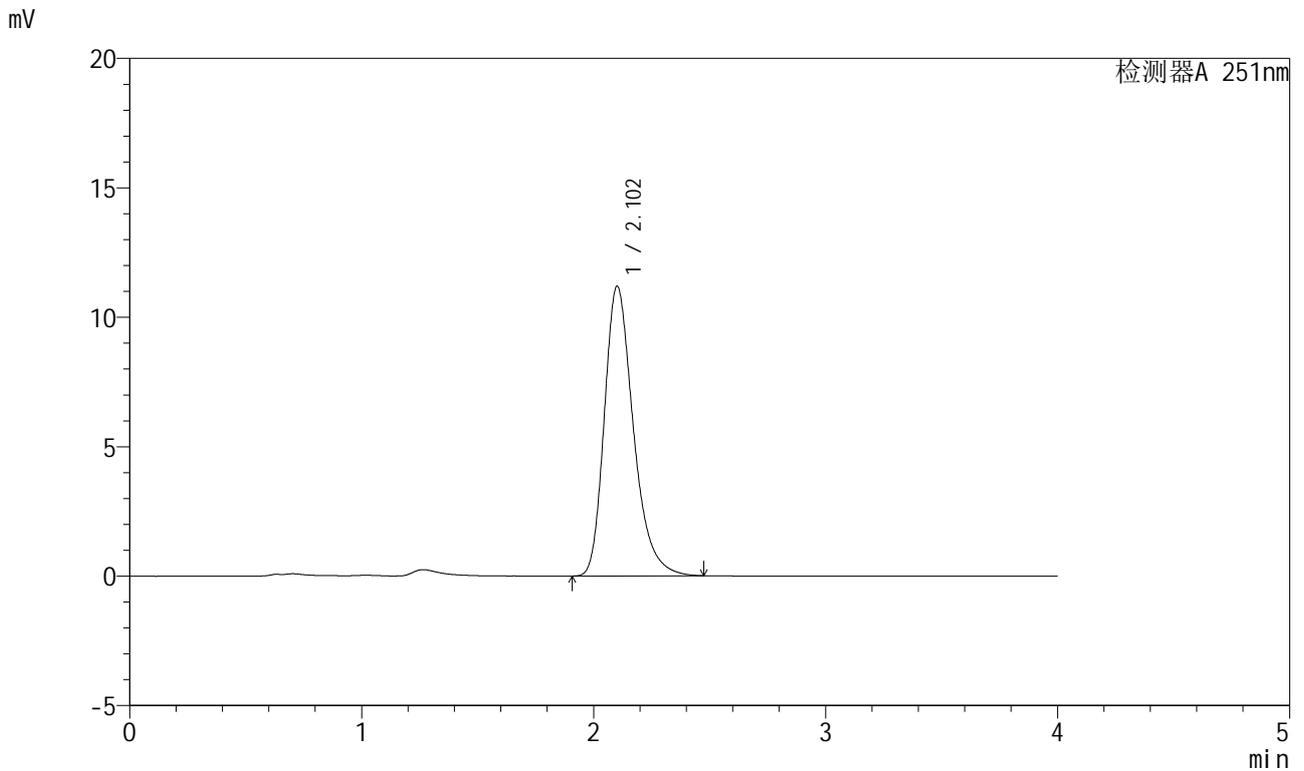

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	97463	100.000	11173	1409	1.303	--
总计		97463	100.000	11173			

图140 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3662-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:48:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

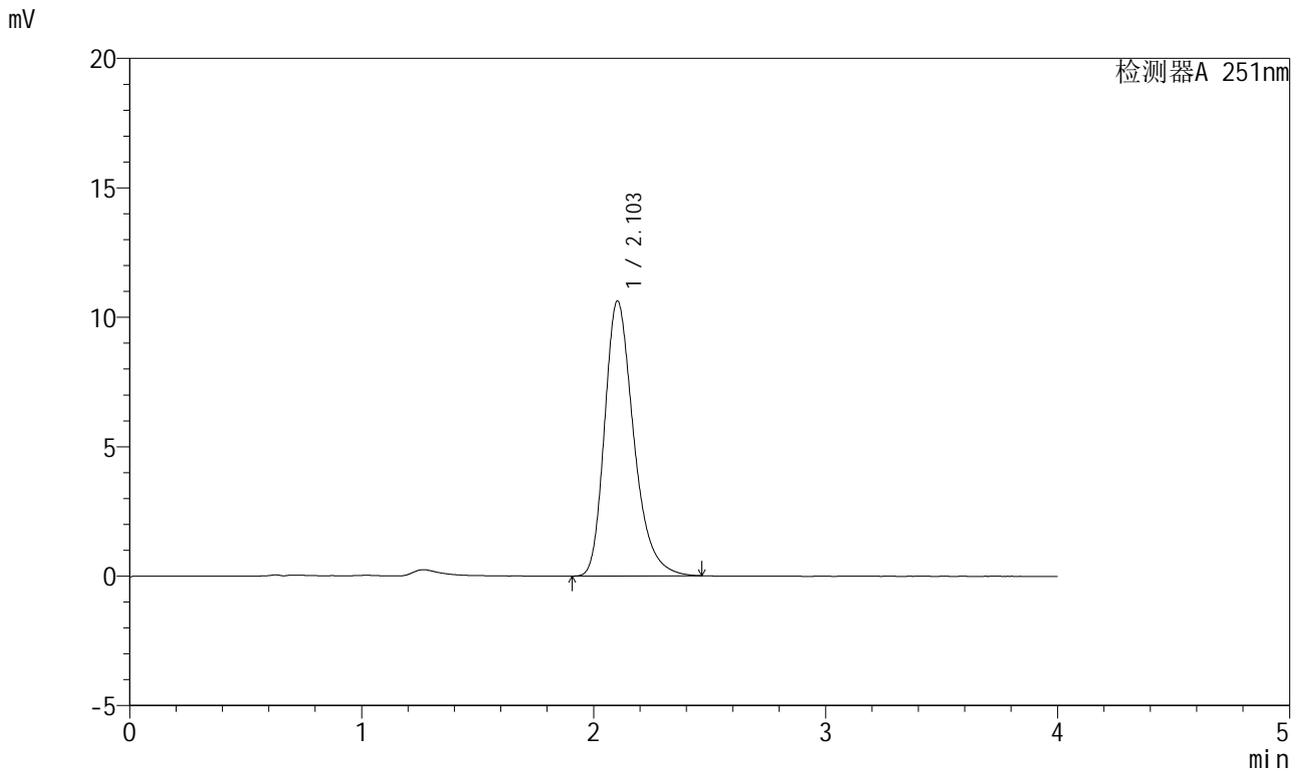

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	92504	100.000	10615	1408	1.301	--
总计		92504	100.000	10615			

图141 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3663-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:52:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

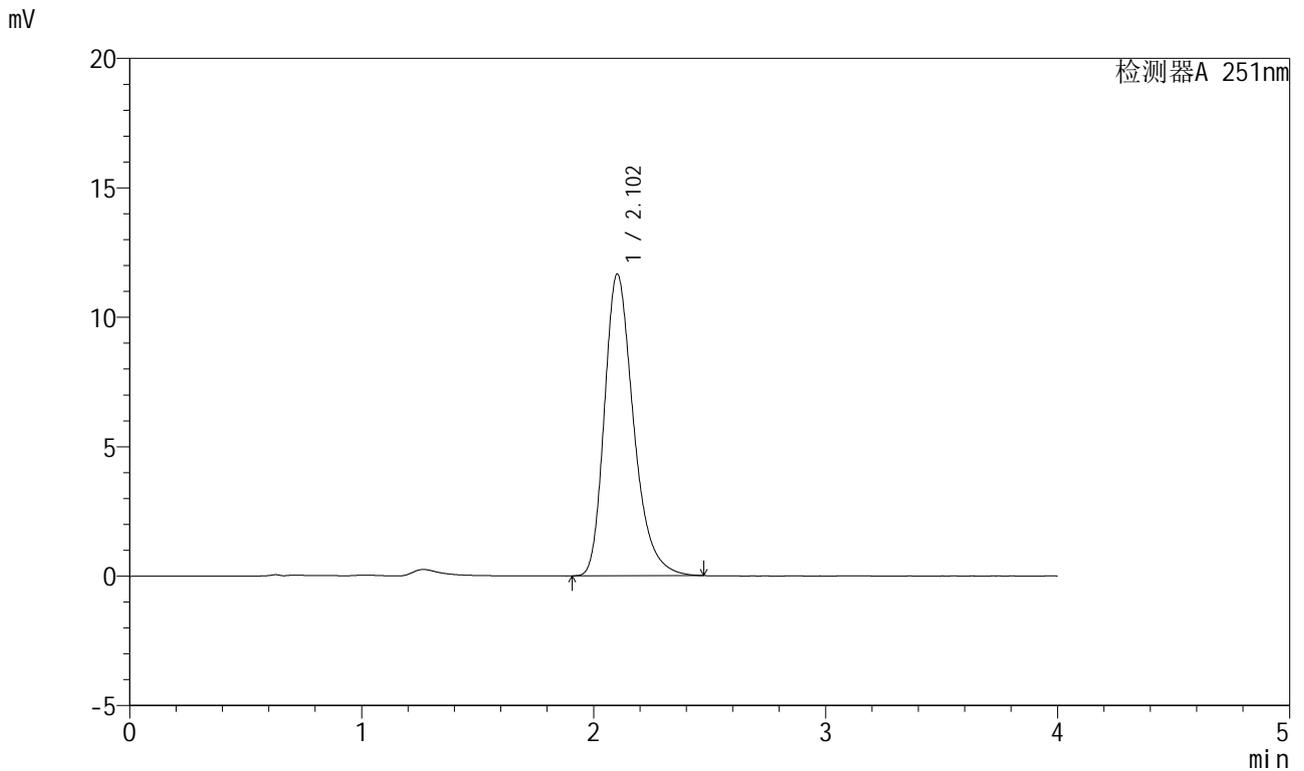

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	101593	100.000	11643	1406	1.303	--
总计		101593	100.000	11643			

图142 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3664-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 00:57:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

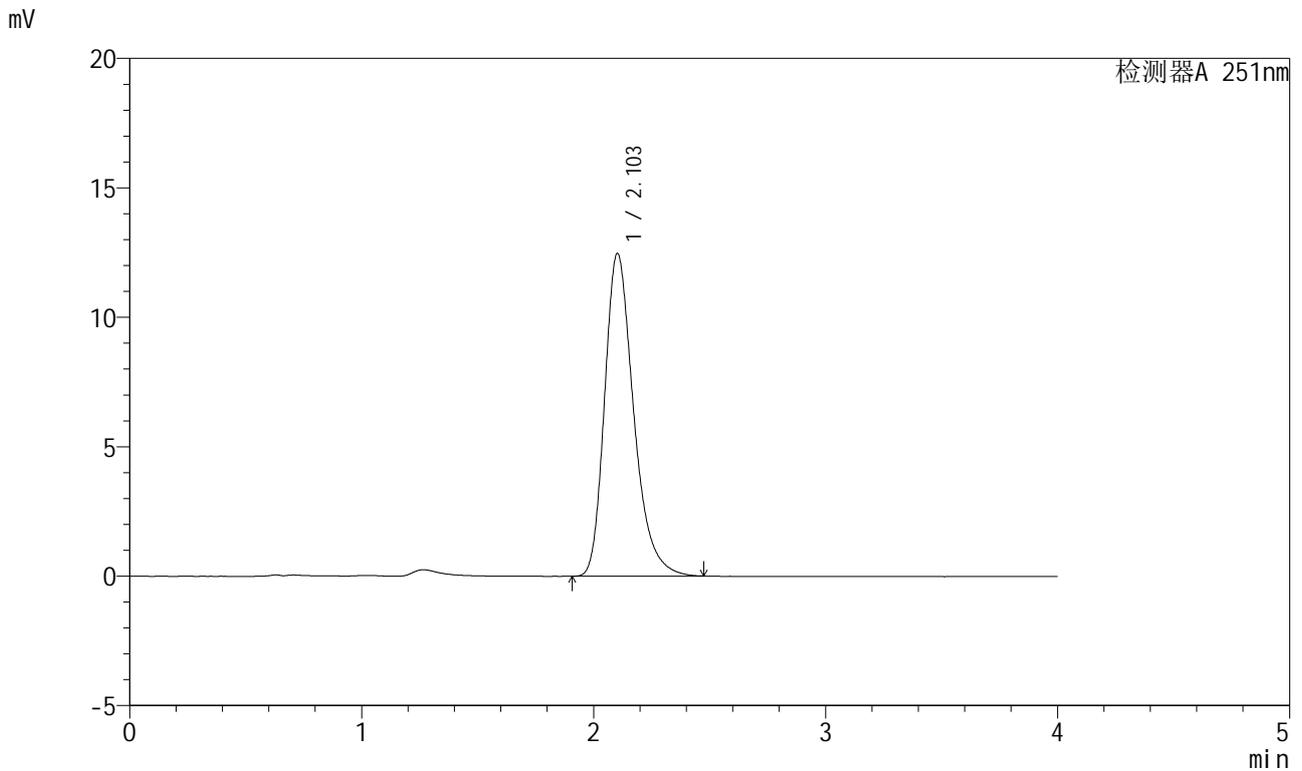

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	108553	100.000	12460	1410	1.301	--
总计		108553	100.000	12460			

图143 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3665-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:01:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

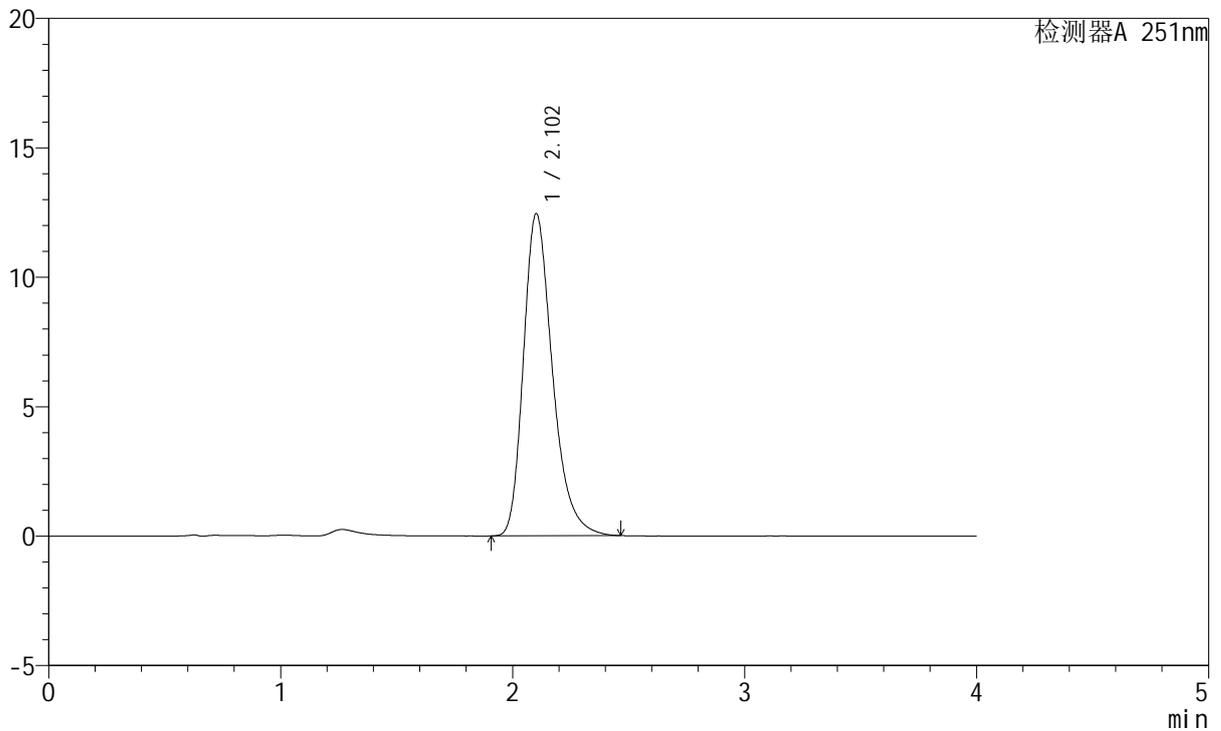

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	108317	100.000	12431	1409	1.300	--
总计		108317	100.000	12431			

图144 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3666-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:05:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

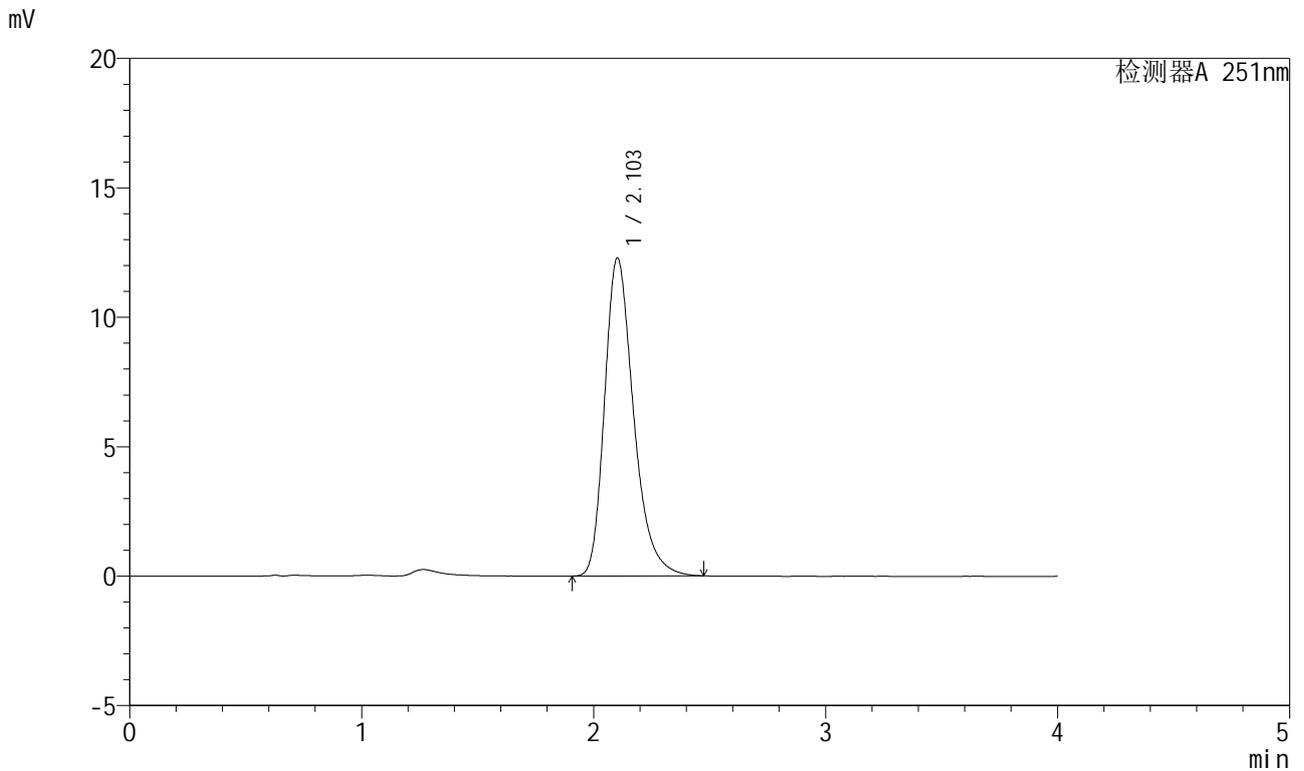

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	106928	100.000	12278	1411	1.301	--
总计		106928	100.000	12278			

图145 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3667-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:10:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

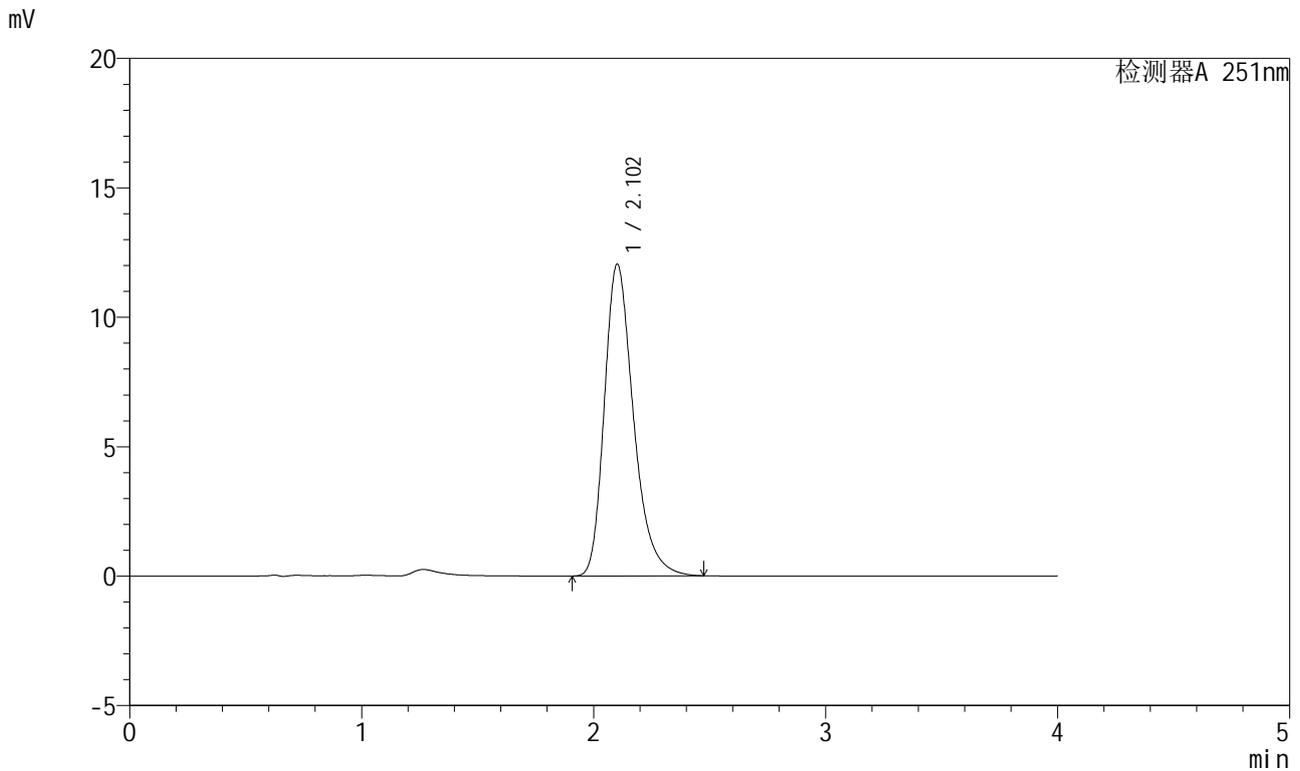

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	105323	100.000	12028	1398	1.302	--
总计		105323	100.000	12028			

图146 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3668-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:14:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

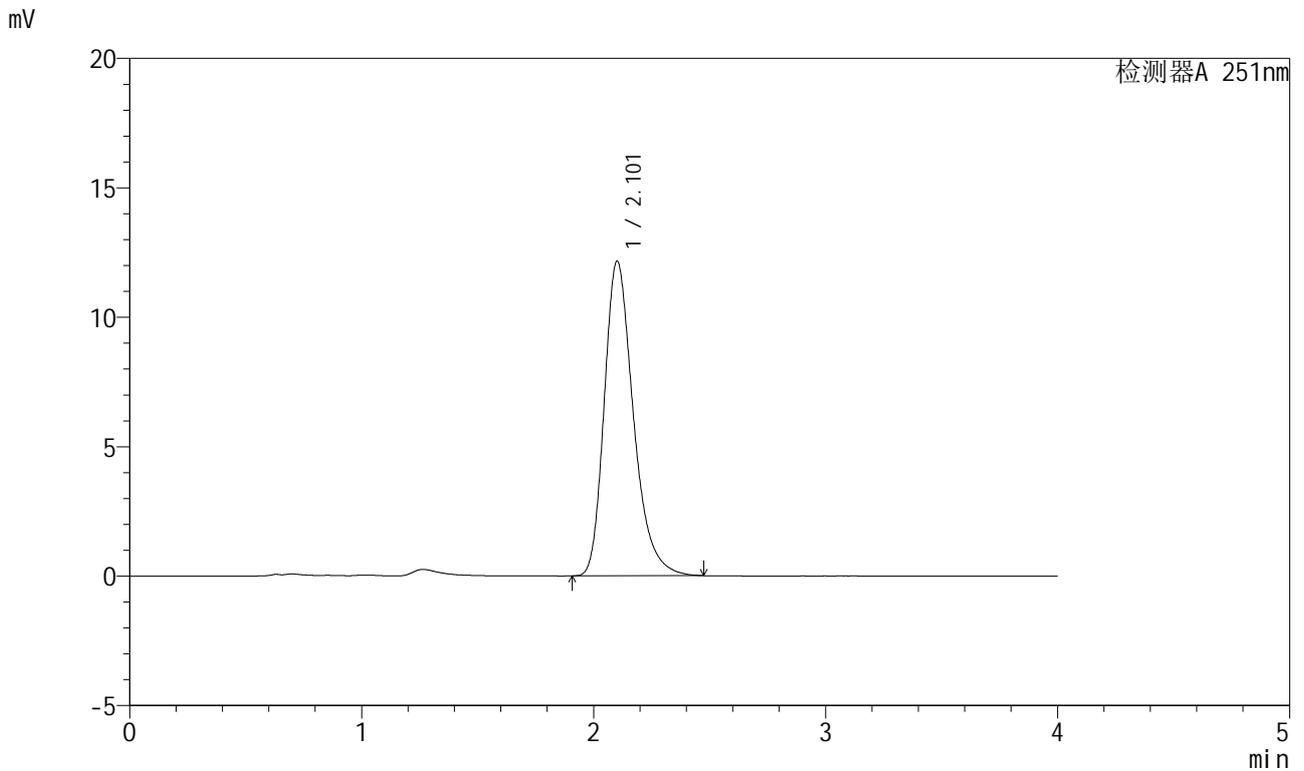

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	106089	100.000	12132	1401	1.301	--
总计		106089	100.000	12132			

图147 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3669-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:18:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

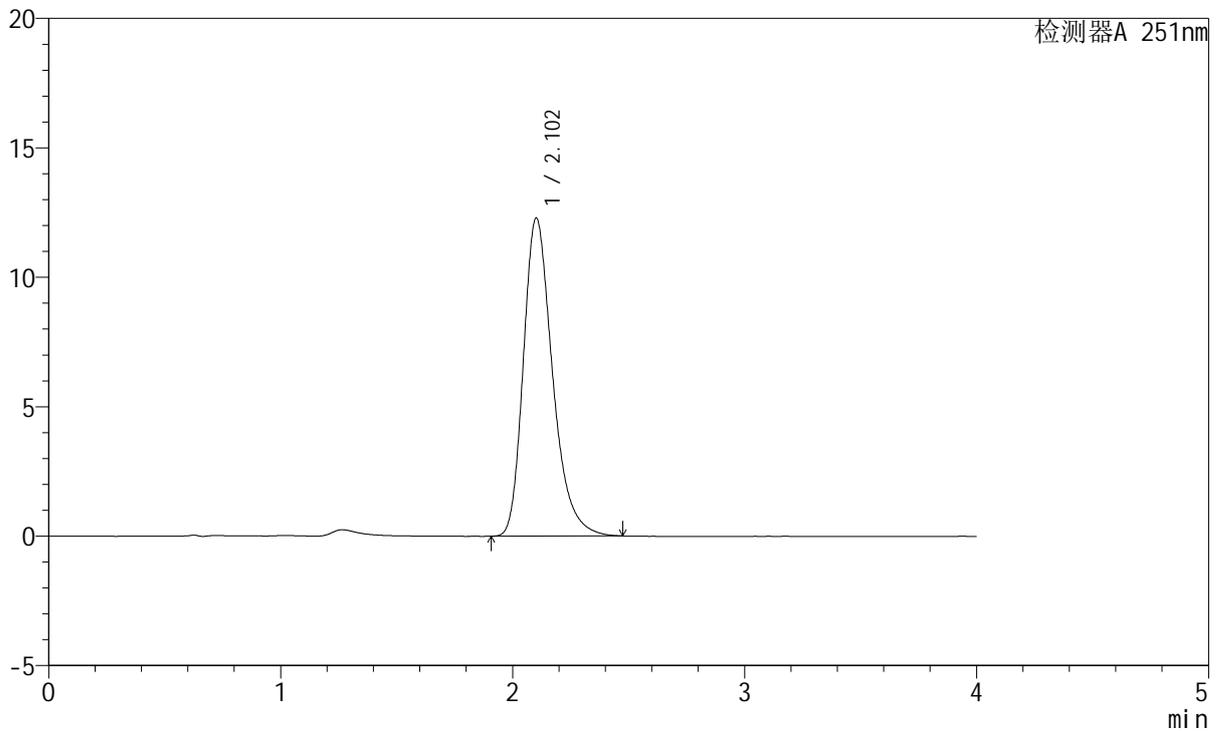

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	107452	100.000	12273	1397	1.302	--
总计		107452	100.000	12273			

图148 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3670-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:23:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

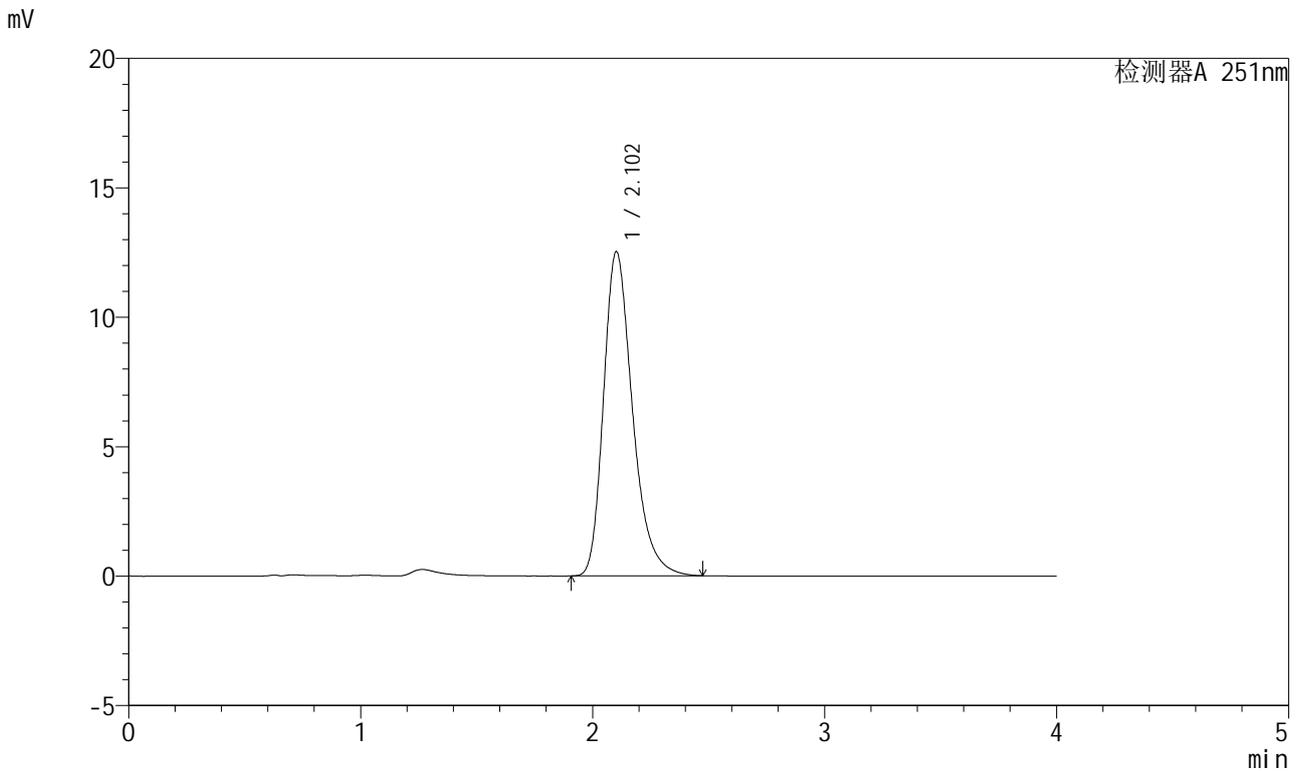

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	108823	100.000	12513	1418	1.302	--
总计		108823	100.000	12513			

图149 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3671-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:27:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

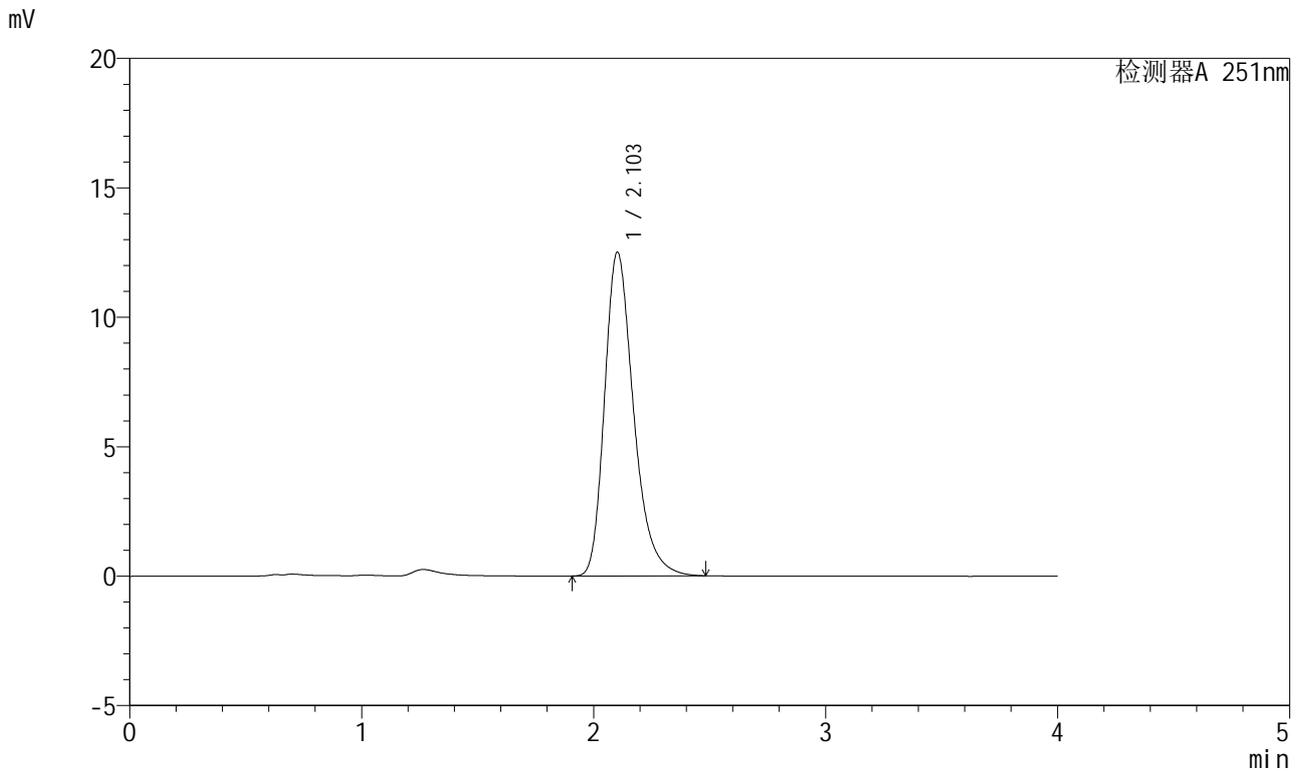

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	108873	100.000	12500	1412	1.301	--
总计		108873	100.000	12500			

图150 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3672-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:32:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

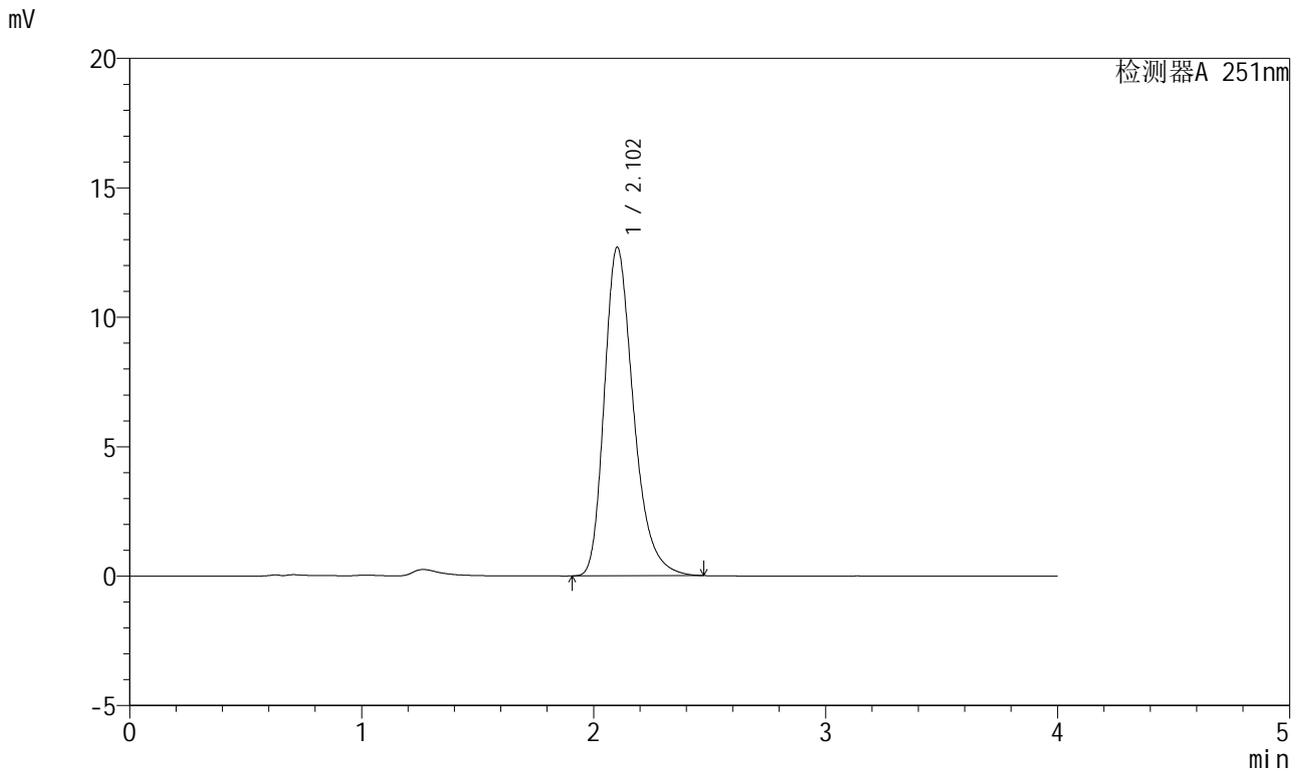

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	110930	100.000	12677	1397	1.300	--
总计		110930	100.000	12677			

图151 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3673-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:36:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

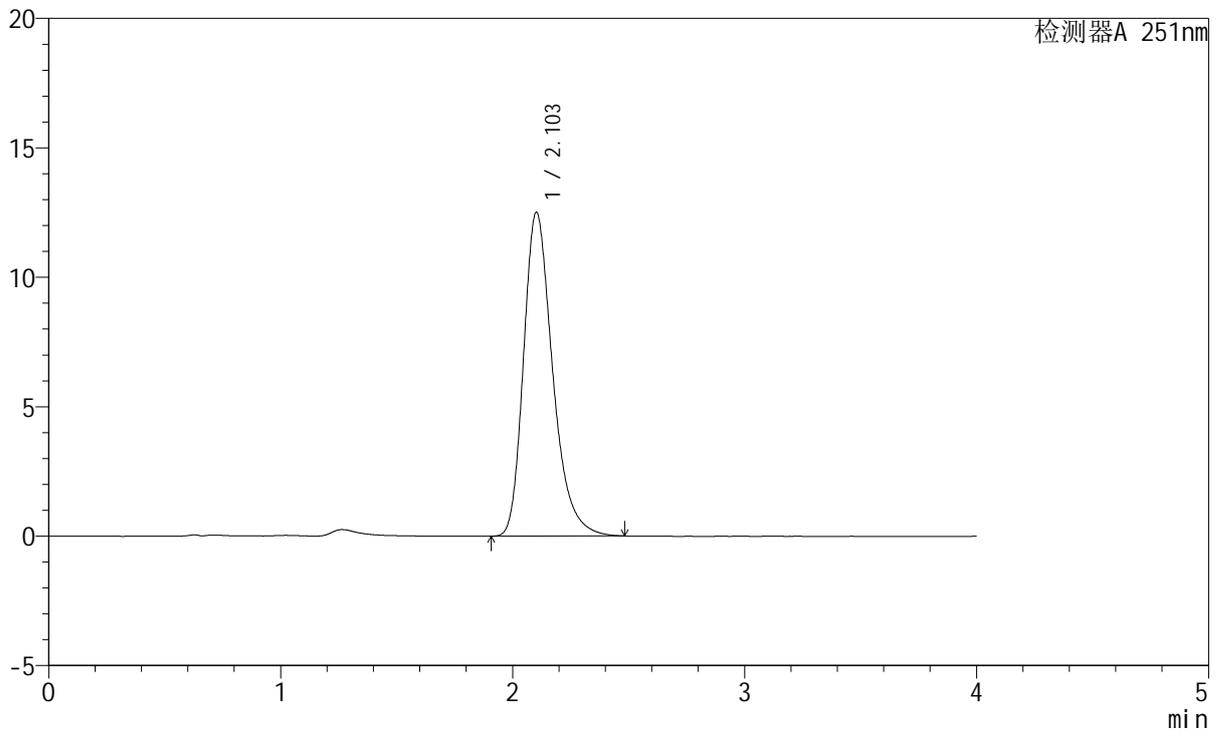

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	109188	100.000	12500	1404	1.302	--
总计		109188	100.000	12500			

图152 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3674-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:40:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

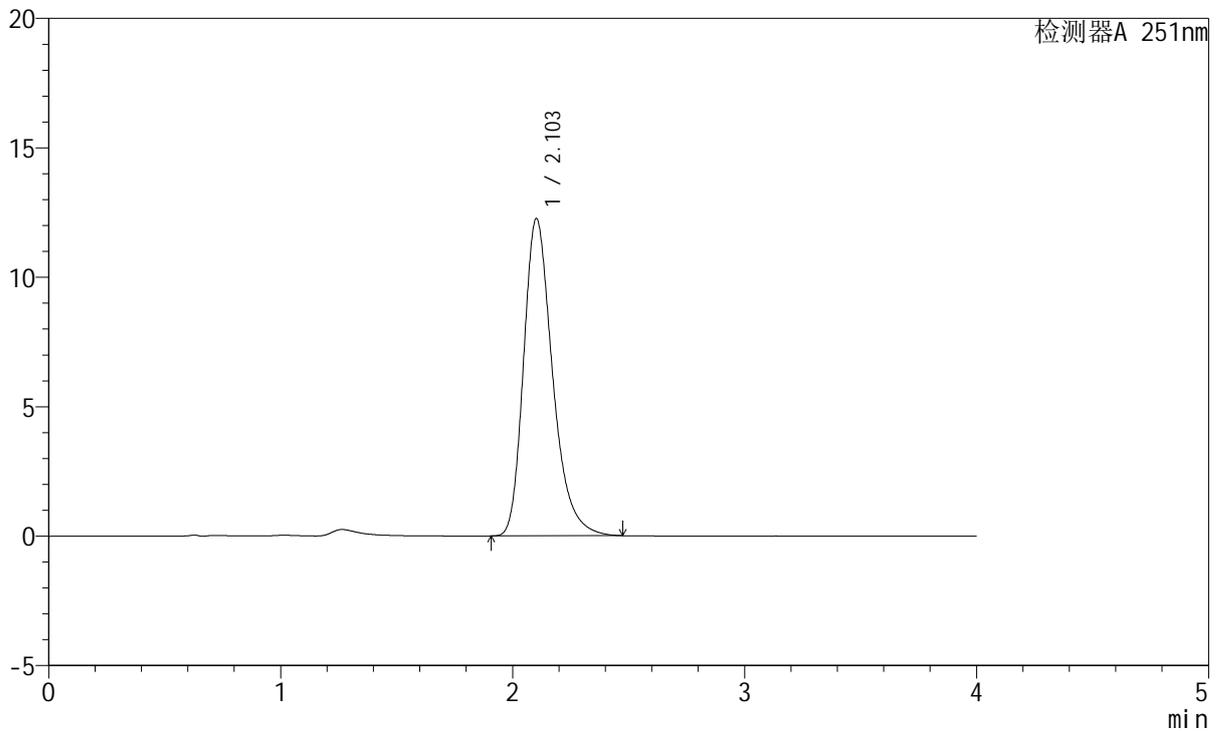

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	106536	100.000	12248	1417	1.300	--
总计		106536	100.000	12248			

图153 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3675-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:45:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

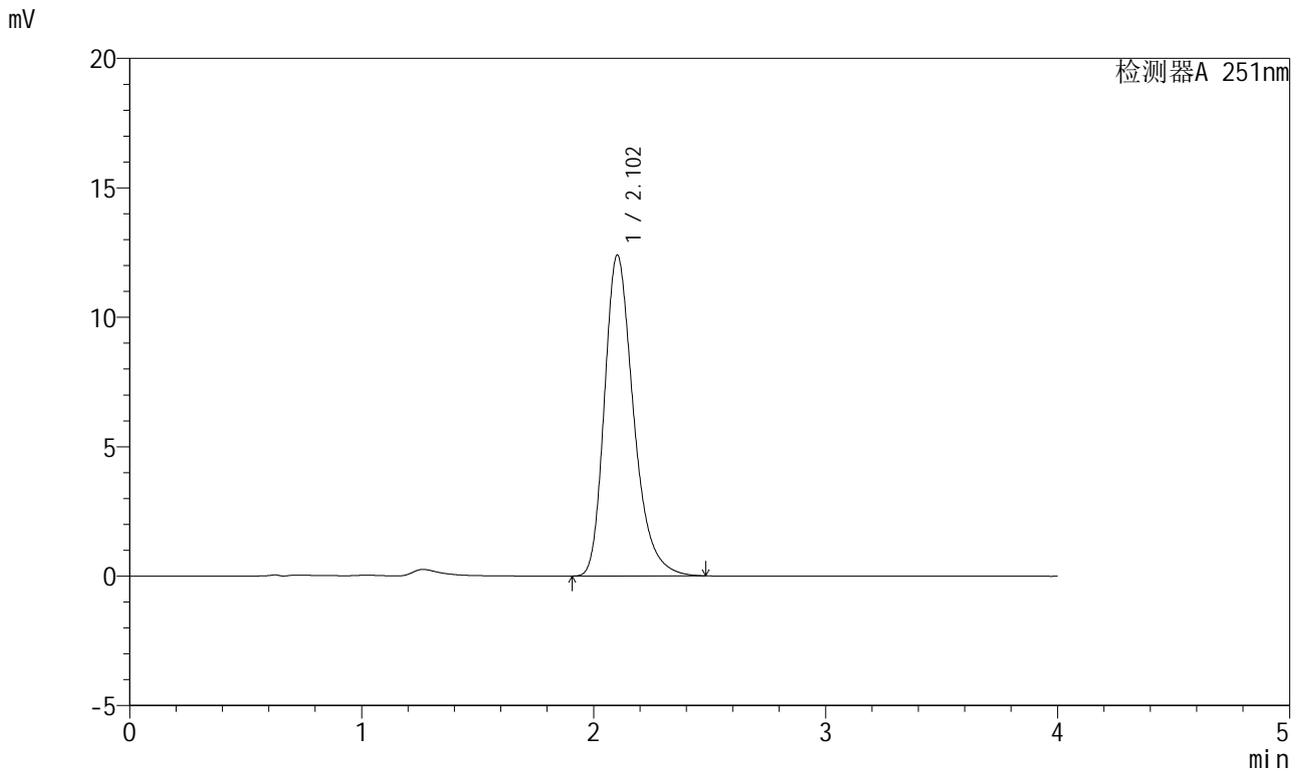

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	107985	100.000	12384	1411	1.302	--
总计		107985	100.000	12384			

图154 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3676-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:49:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

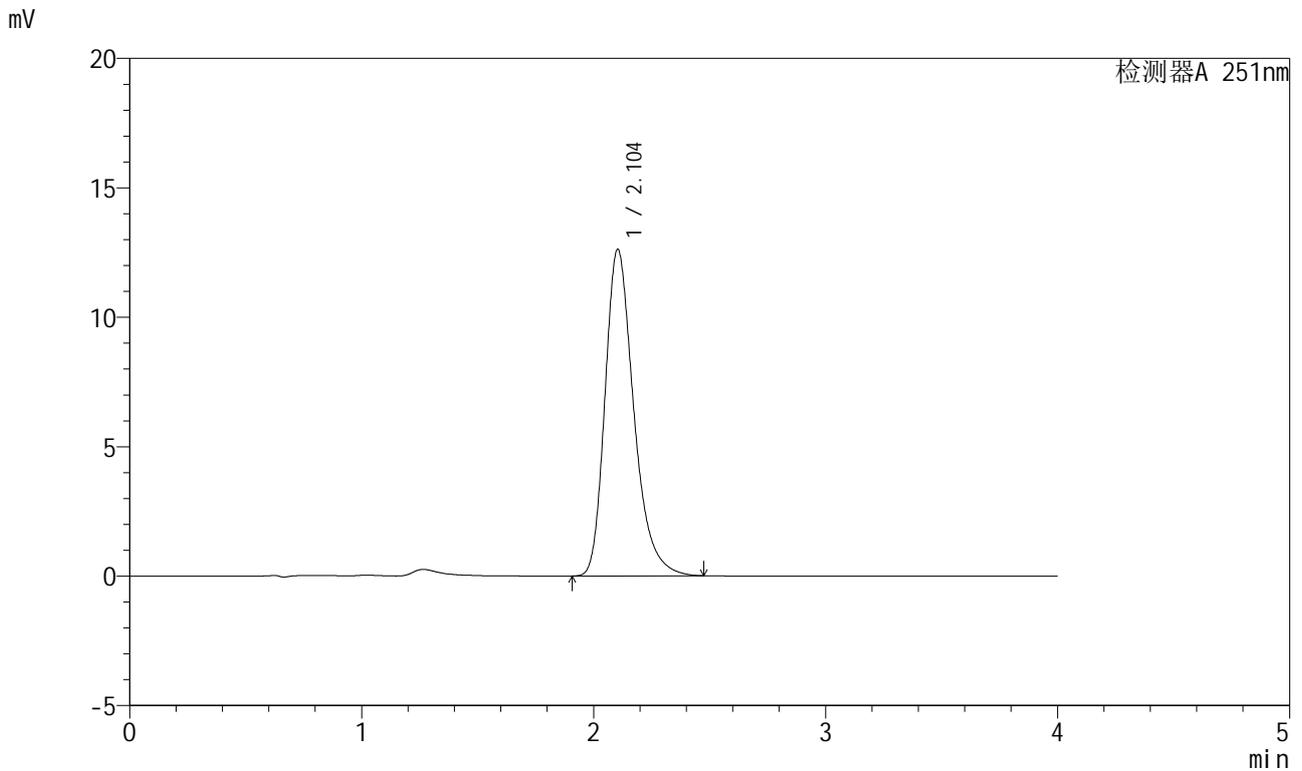

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	108787	100.000	12621	1444	1.302	--
总计		108787	100.000	12621			

图155 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3677-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:53:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

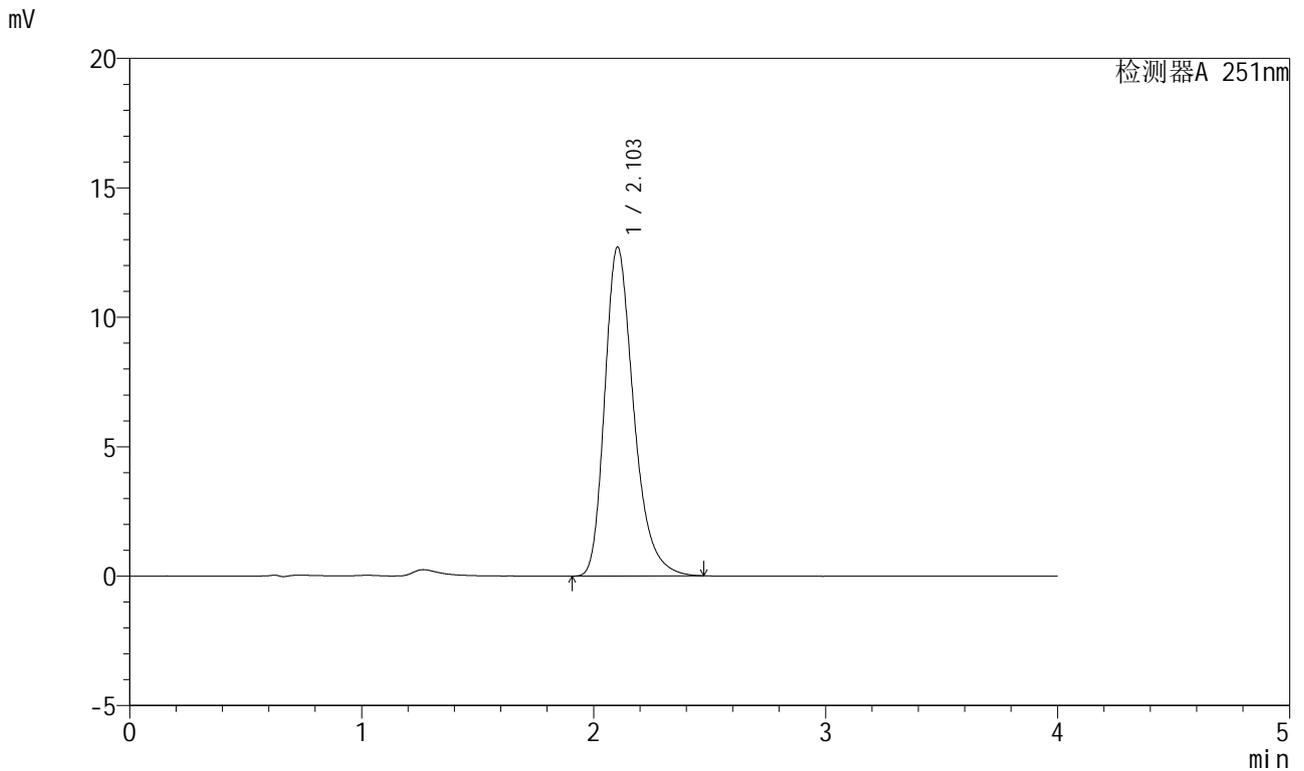

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	110161	100.000	12706	1425	1.299	--
总计		110161	100.000	12706			

图156 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3678-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 01:58:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:07:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

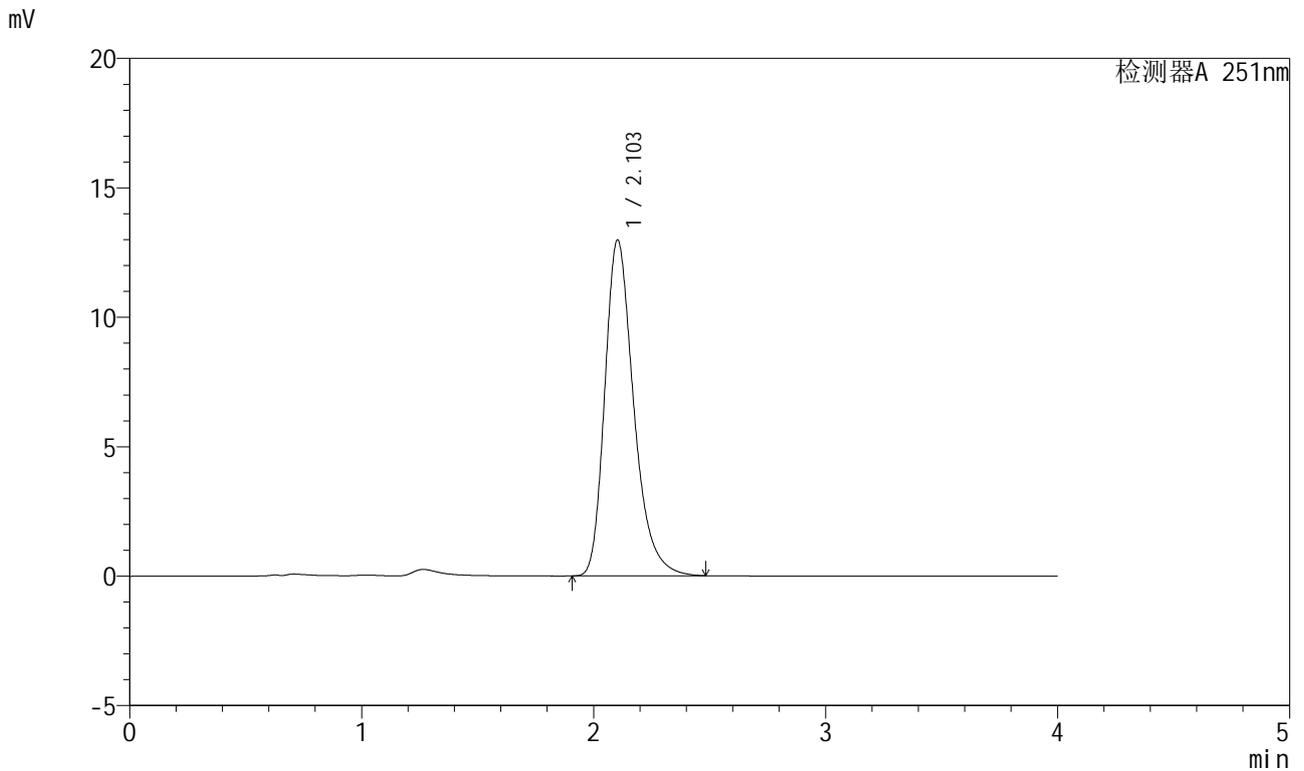

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	112505	100.000	12974	1427	1.301	--
总计		112505	100.000	12974			

图157 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3679-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:02:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

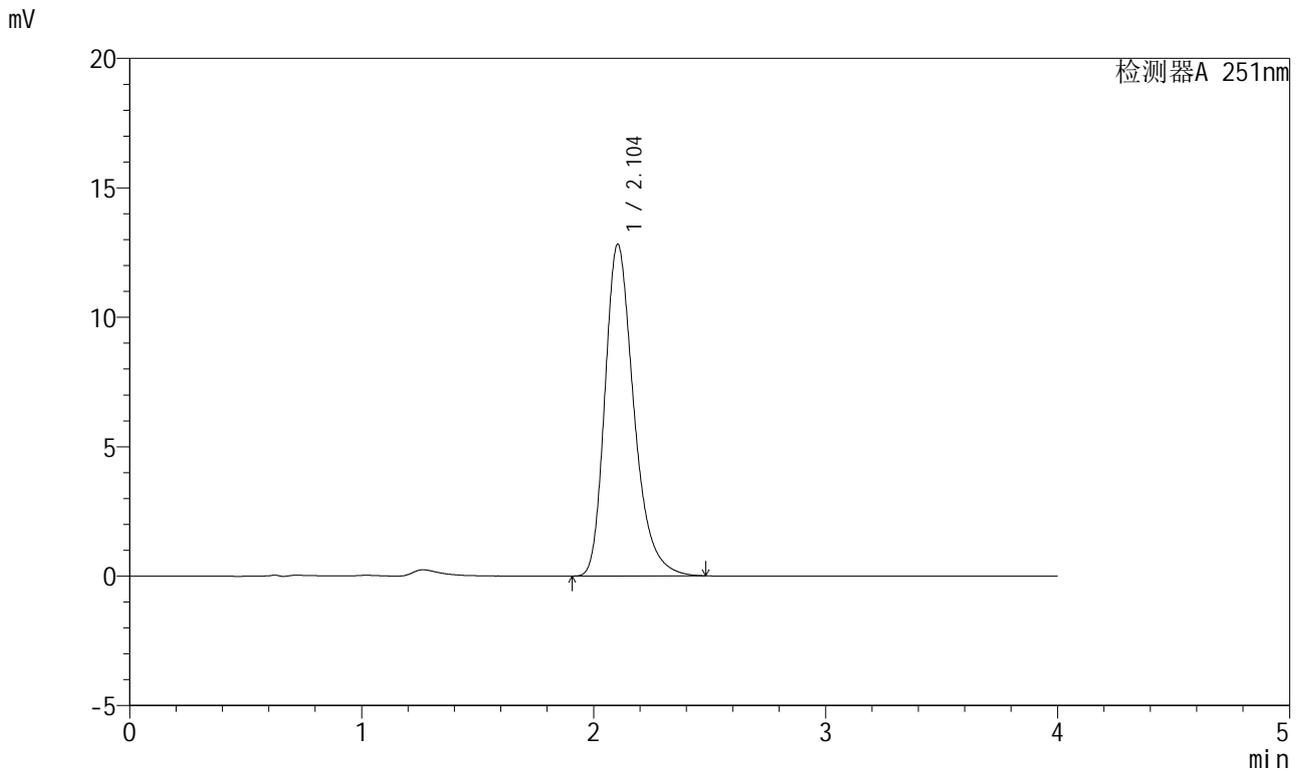

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	110989	100.000	12818	1431	1.302	--
总计		110989	100.000	12818			

图158 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3680-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:06:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

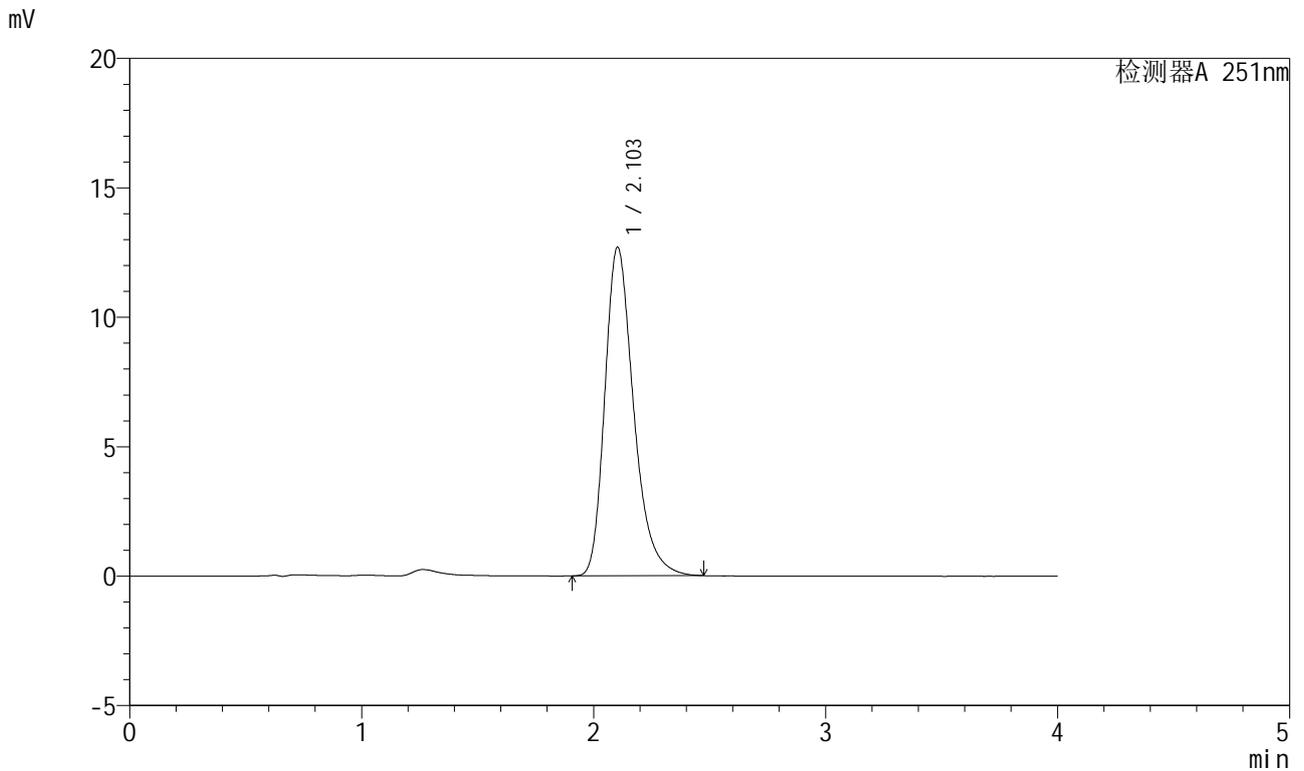

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	109838	100.000	12694	1432	1.302	--
总计		109838	100.000	12694			

图159 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3681-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:11:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

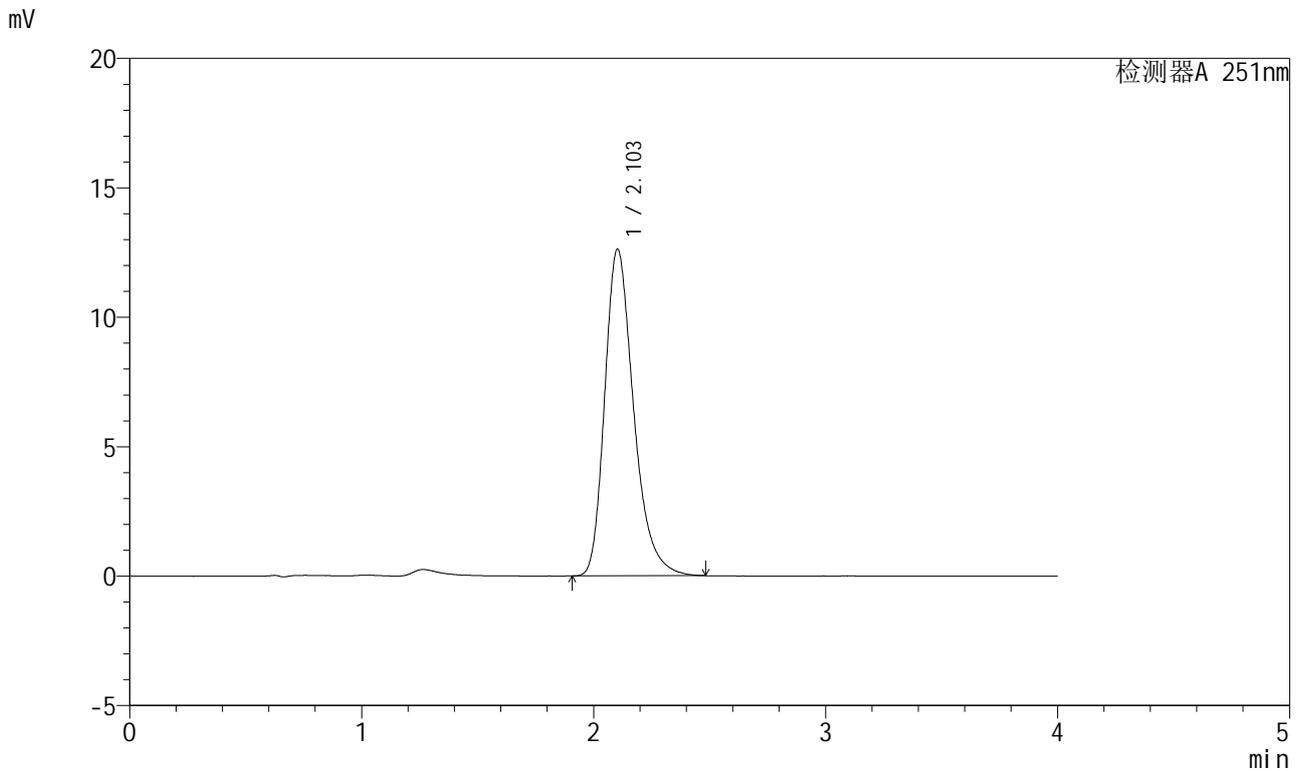

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	109495	100.000	12618	1424	1.302	--
总计		109495	100.000	12618			

图160 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3682-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:15:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

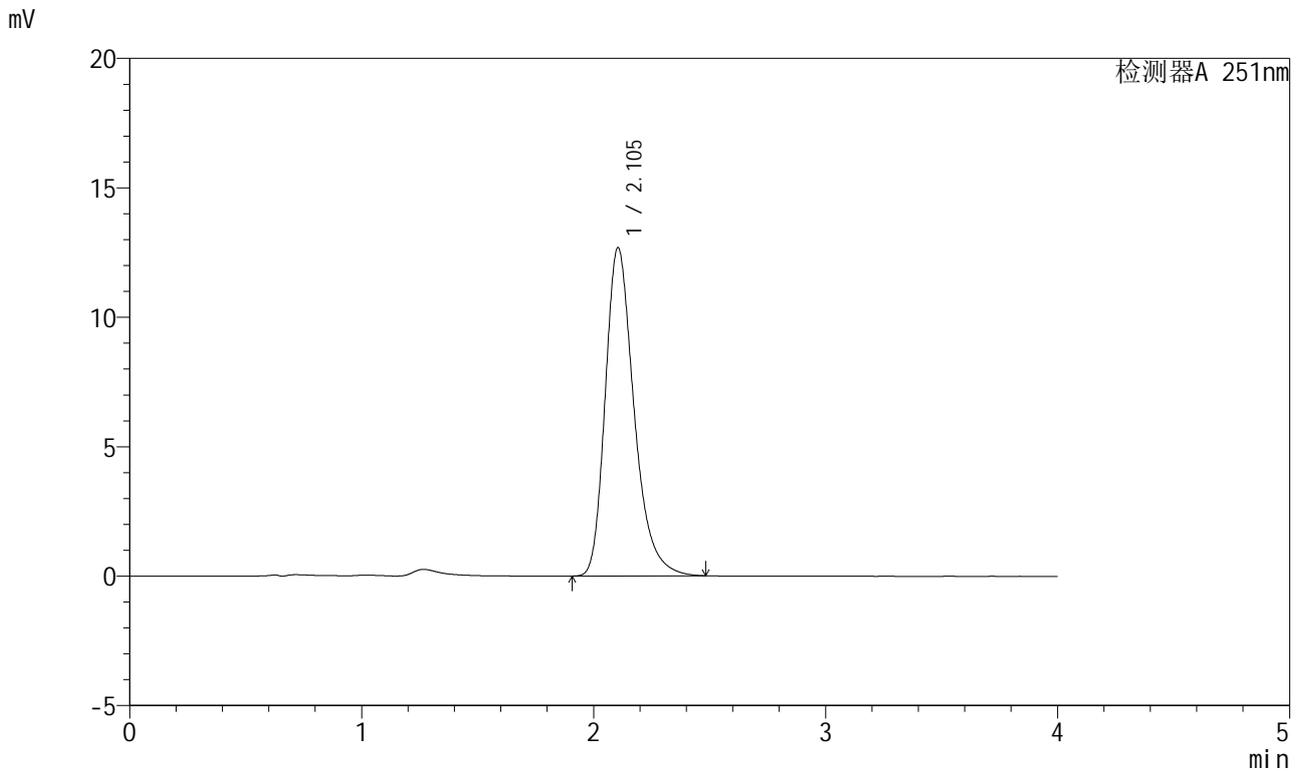

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	109478	100.000	12687	1444	1.301	--
总计		109478	100.000	12687			

图161 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3683-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:20:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

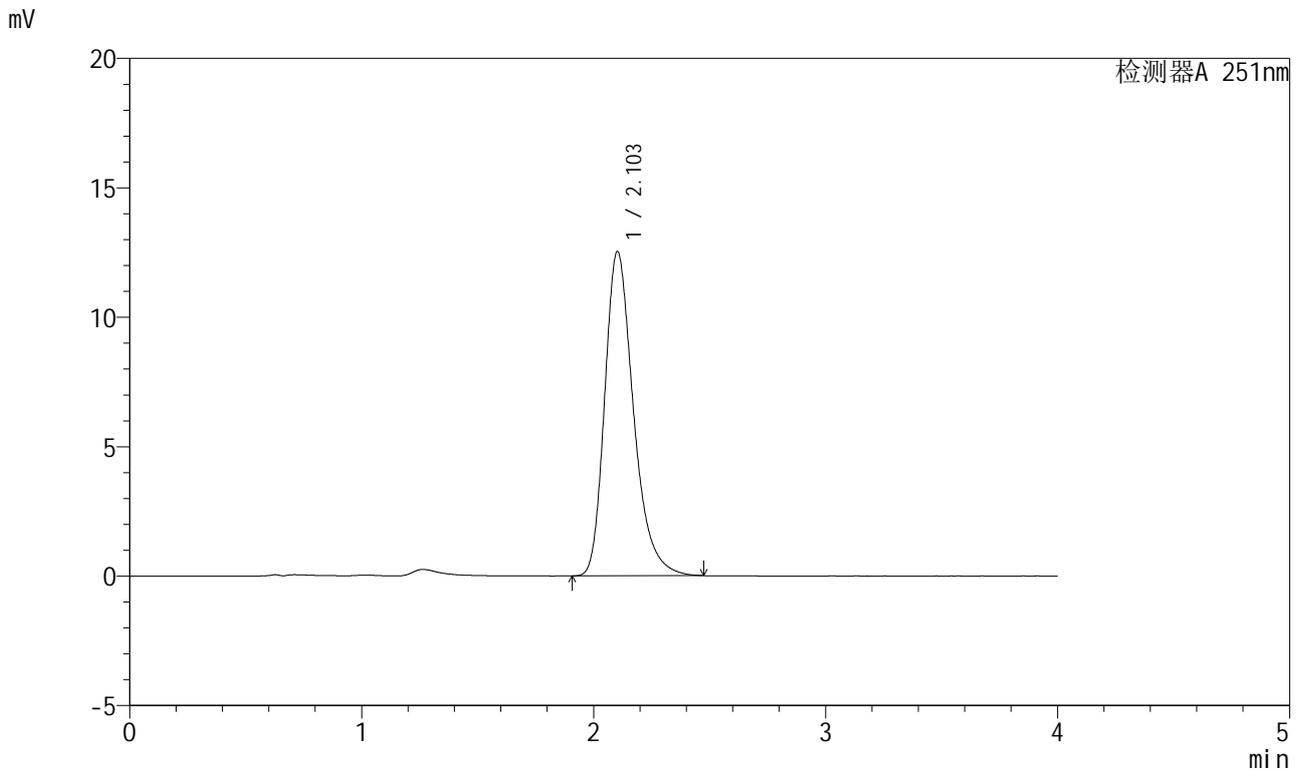

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	108139	100.000	12520	1438	1.301	--
总计		108139	100.000	12520			

图162 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3684-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:24:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

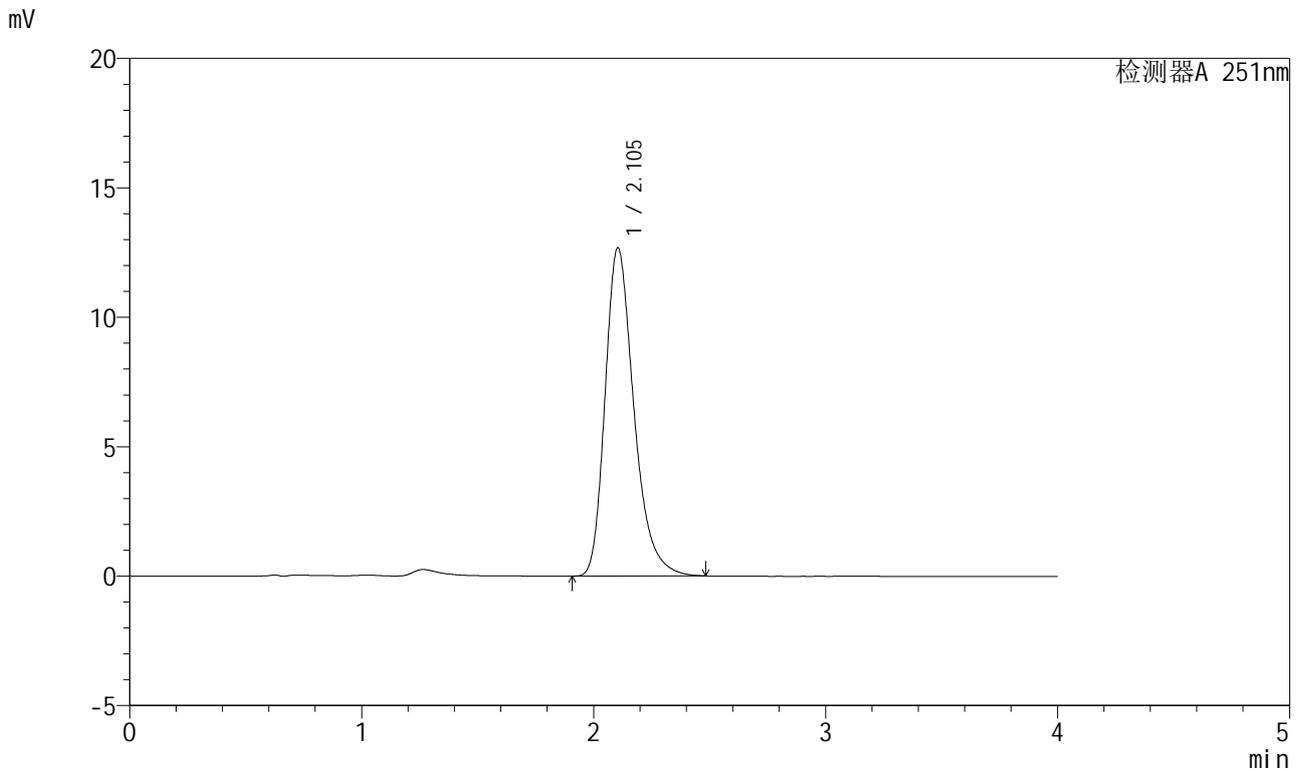

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	109682	100.000	12686	1437	1.300	--
总计		109682	100.000	12686			

图163 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3685-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:28:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

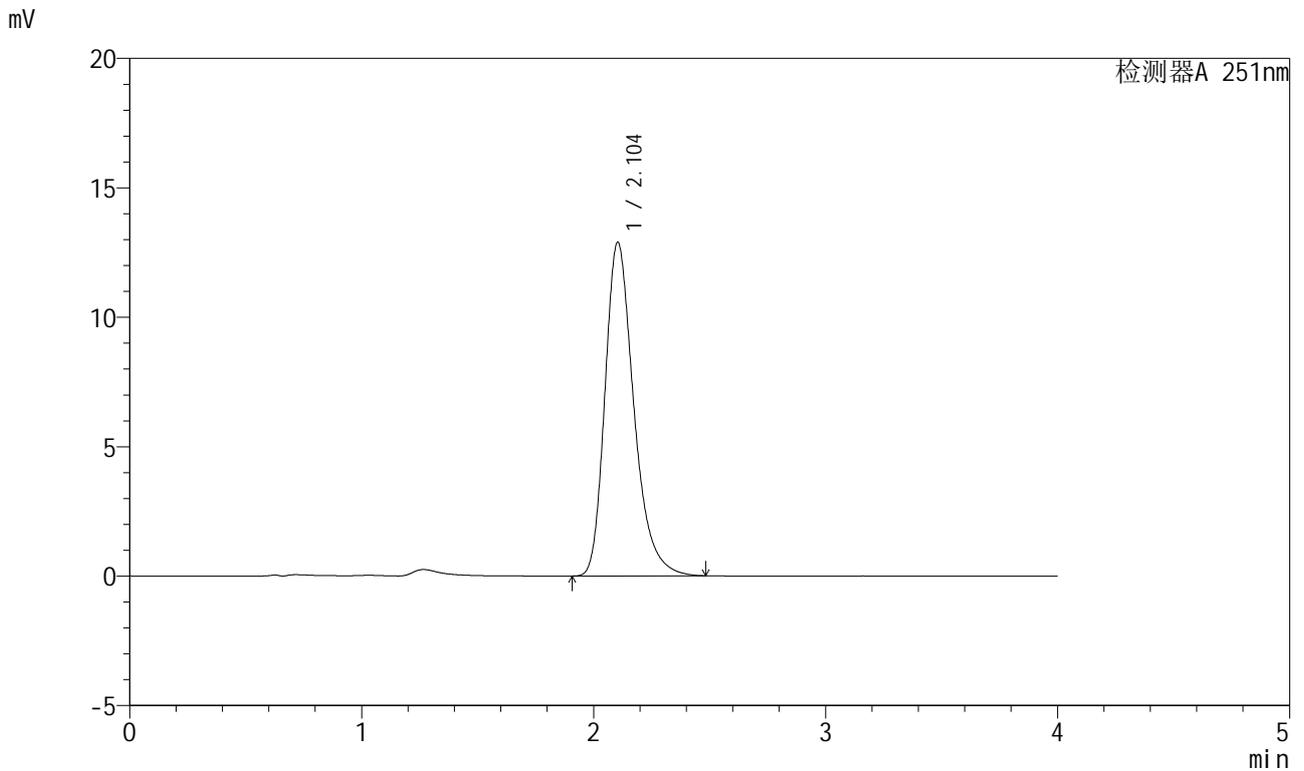

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	111509	100.000	12894	1437	1.302	--
总计		111509	100.000	12894			

图164 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3686-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:33:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

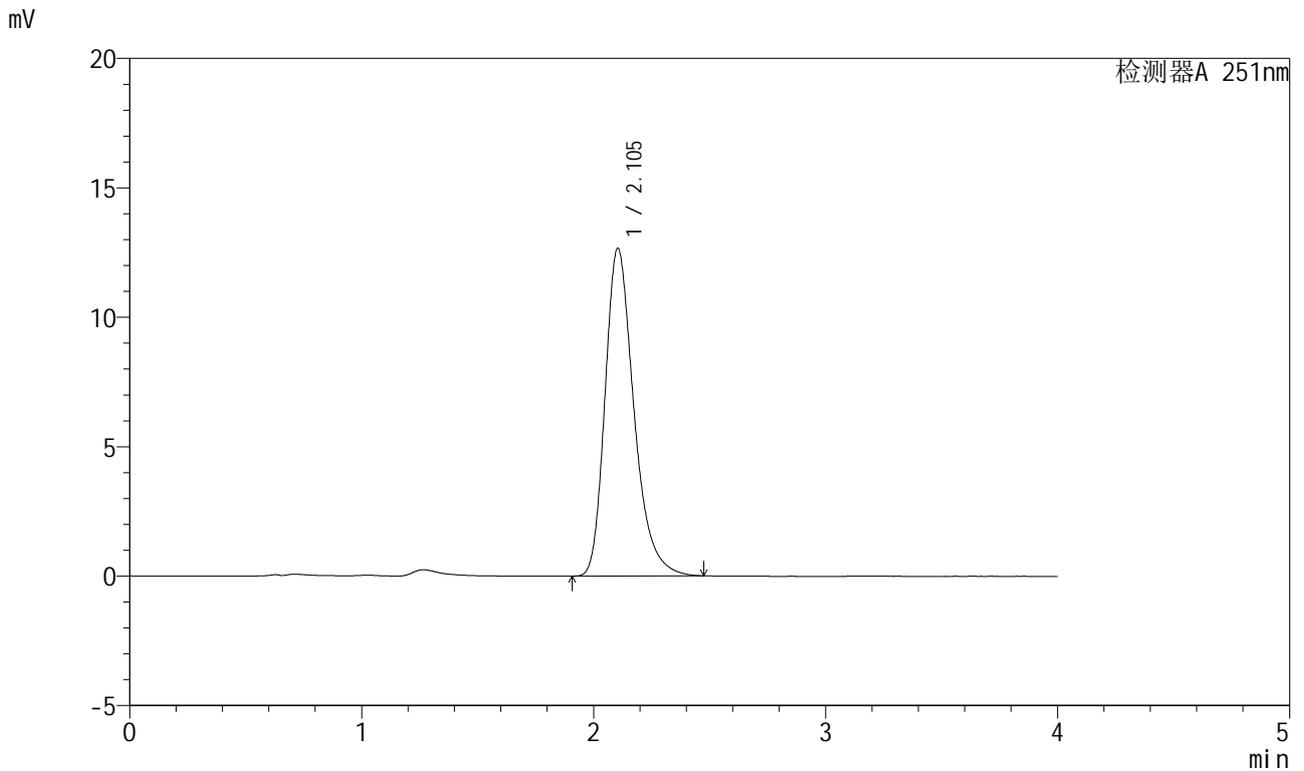

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	109611	100.000	12666	1432	1.301	--
总计		109611	100.000	12666			

图165 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3687-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:37:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

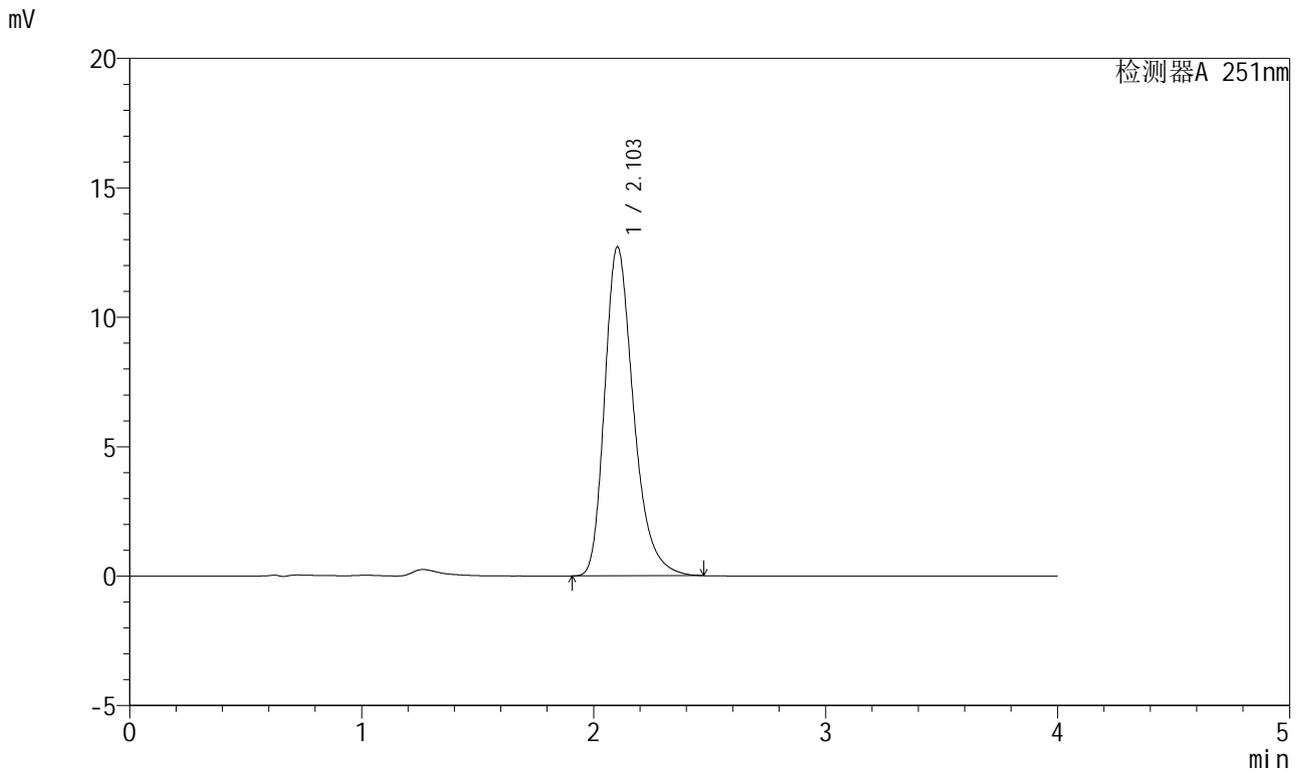

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	109994	100.000	12705	1431	1.302	--
总计		109994	100.000	12705			

图166 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3688-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:41:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

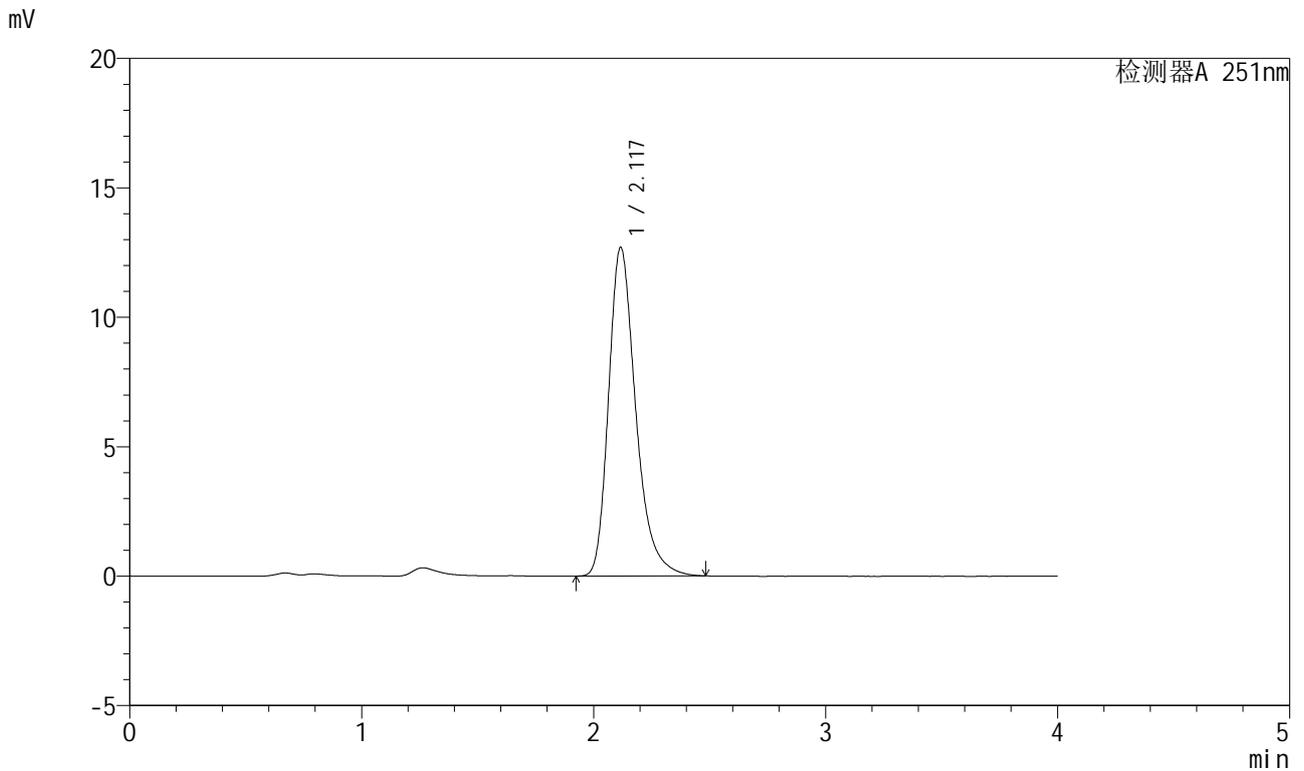

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	103490	100.000	12675	1651	1.305	--
总计		103490	100.000	12675			

图167 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3689-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:46:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

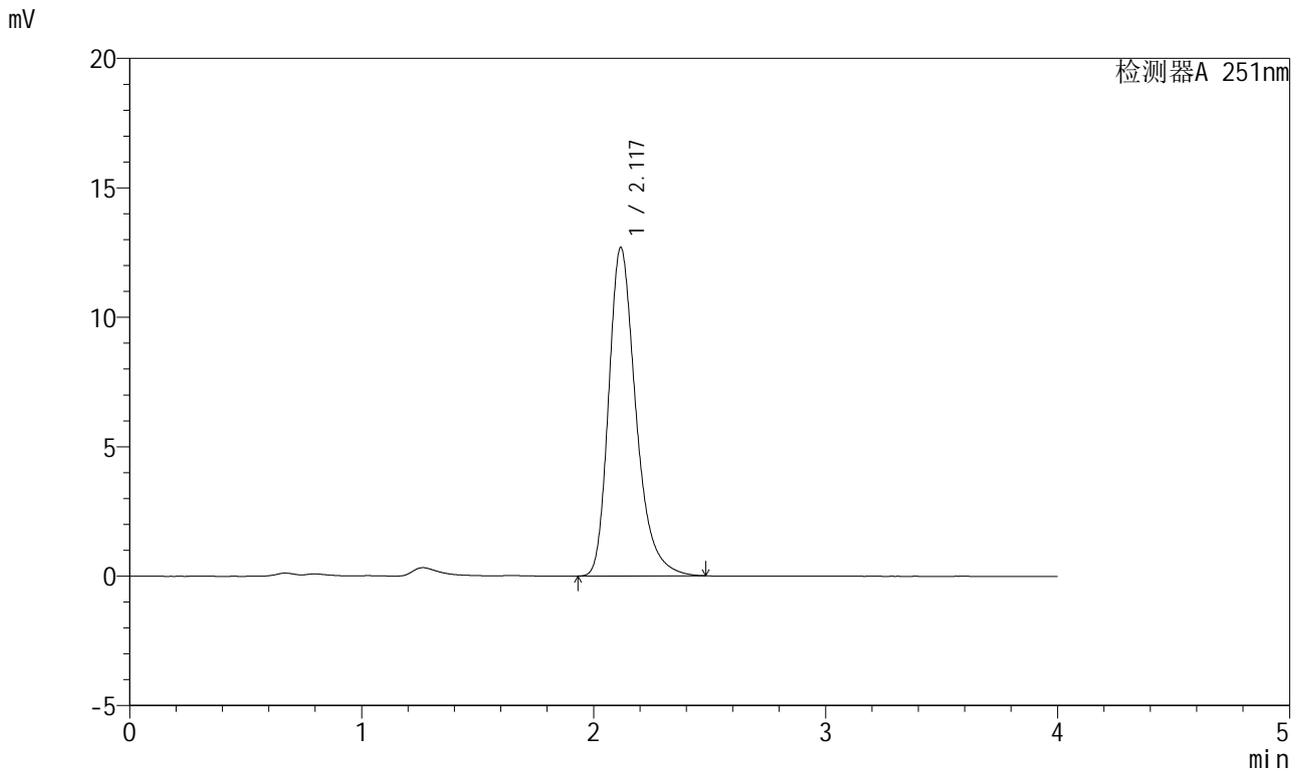

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	103480	100.000	12658	1648	1.305	--
总计		103480	100.000	12658			

图168 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3690-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:50:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

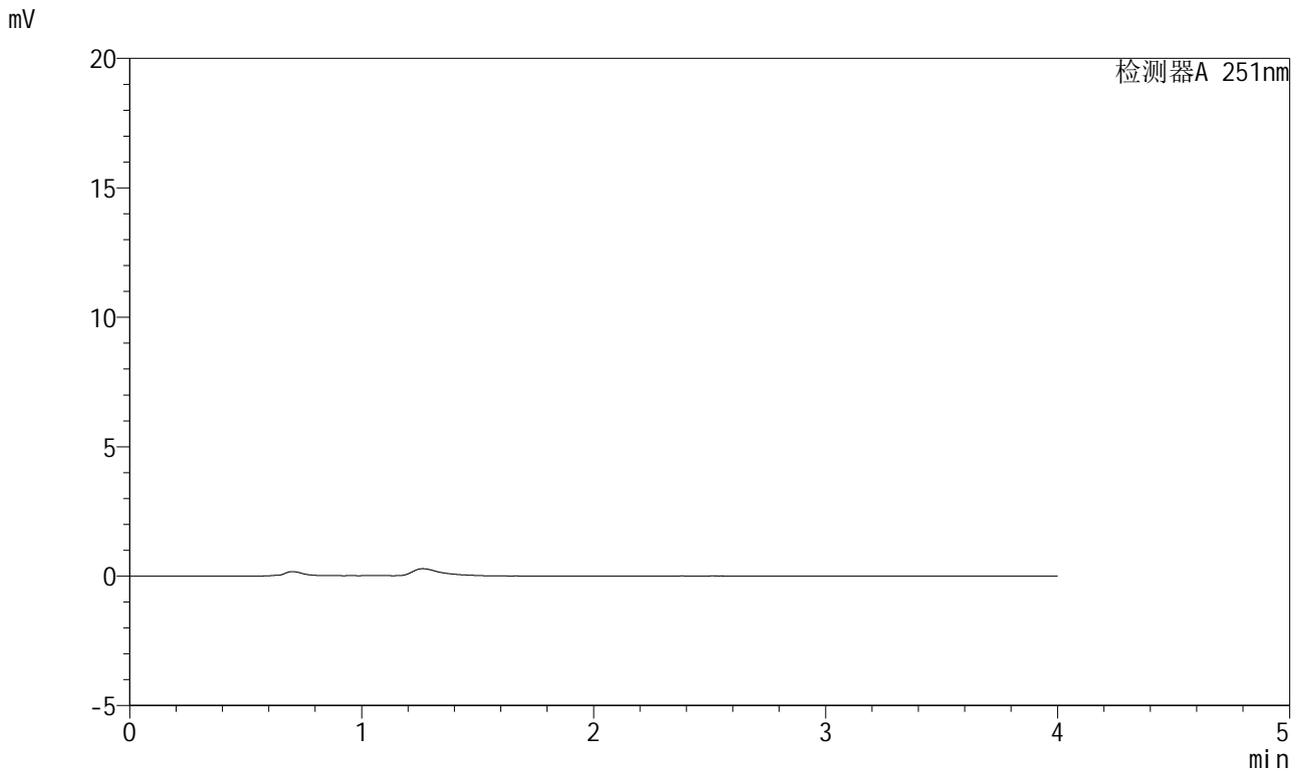

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3691-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:55:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

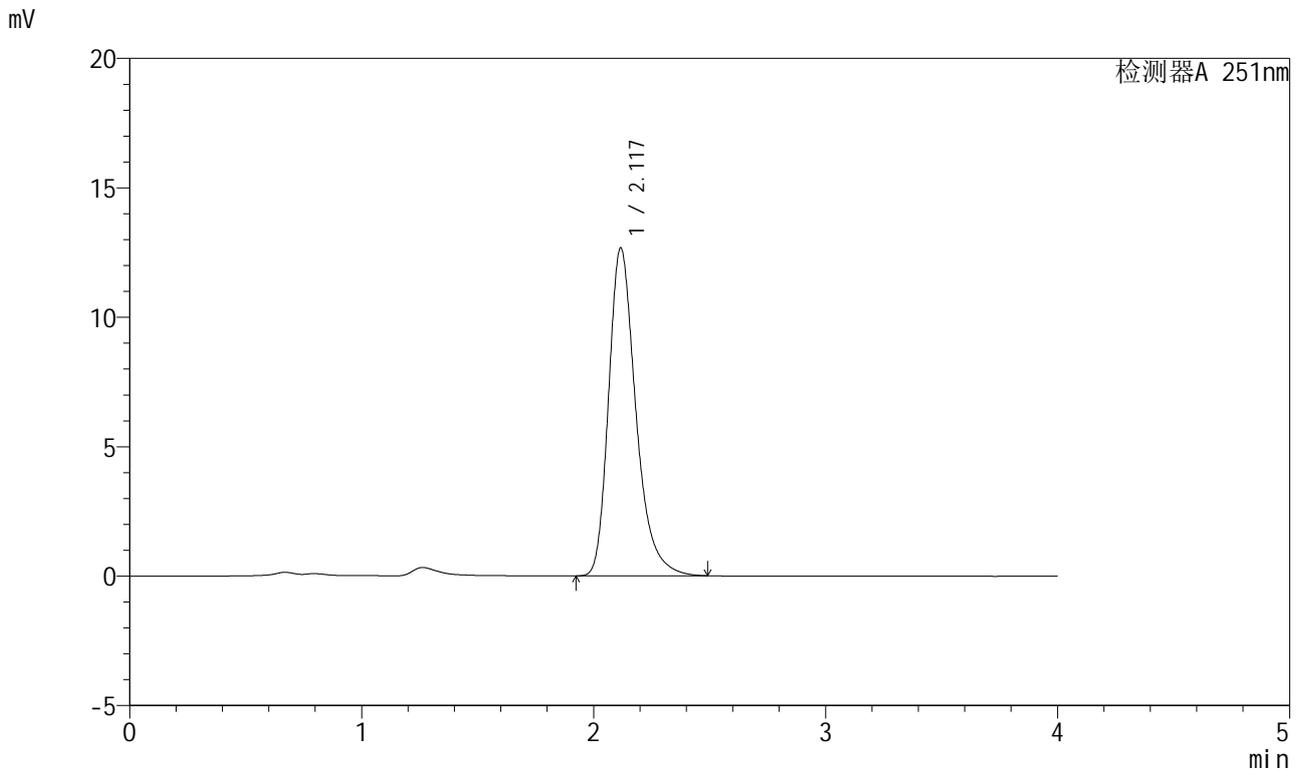

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	103507	100.000	12645	1644	1.306	--
总计		103507	100.000	12645			

图170 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3692-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 02:59:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

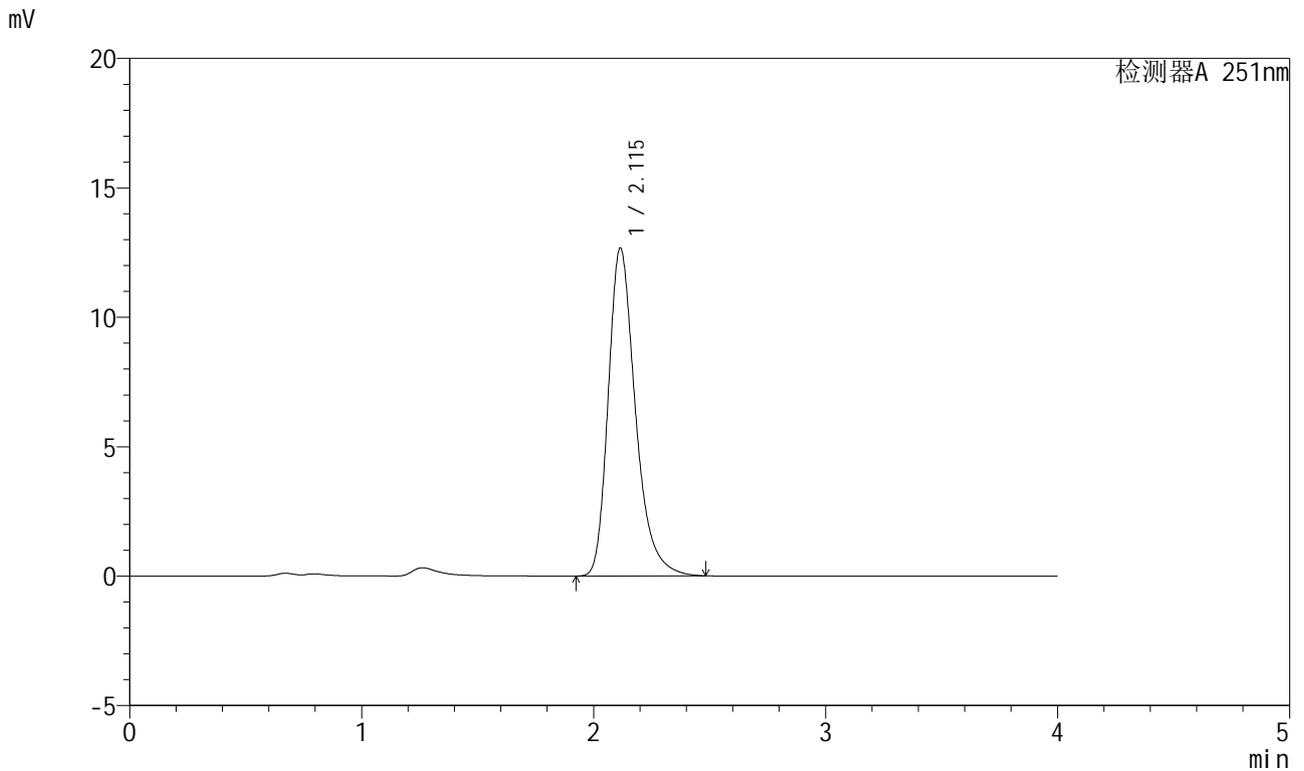

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	103410	100.000	12665	1645	1.305	--
总计		103410	100.000	12665			

图171 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3693-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:03:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

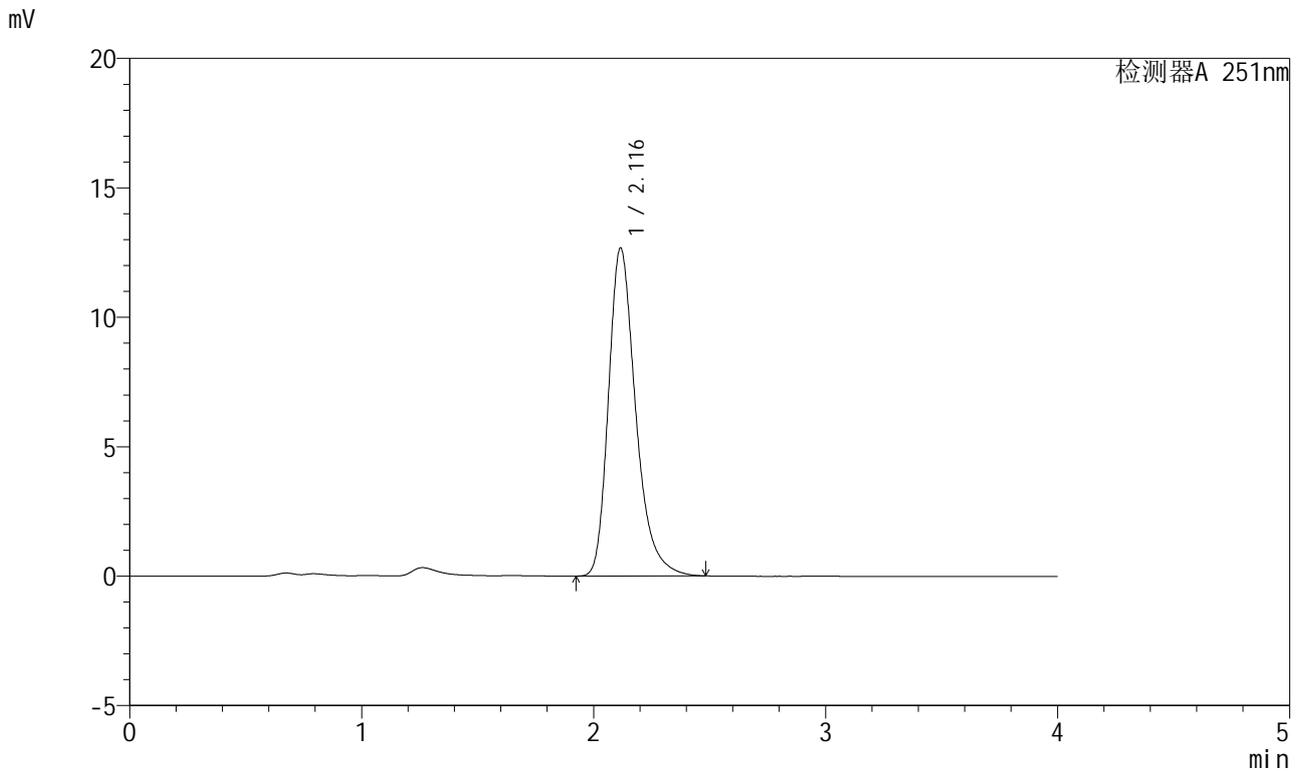

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	103430	100.000	12656	1644	1.306	--
总计		103430	100.000	12656			

图172 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3694-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:08:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

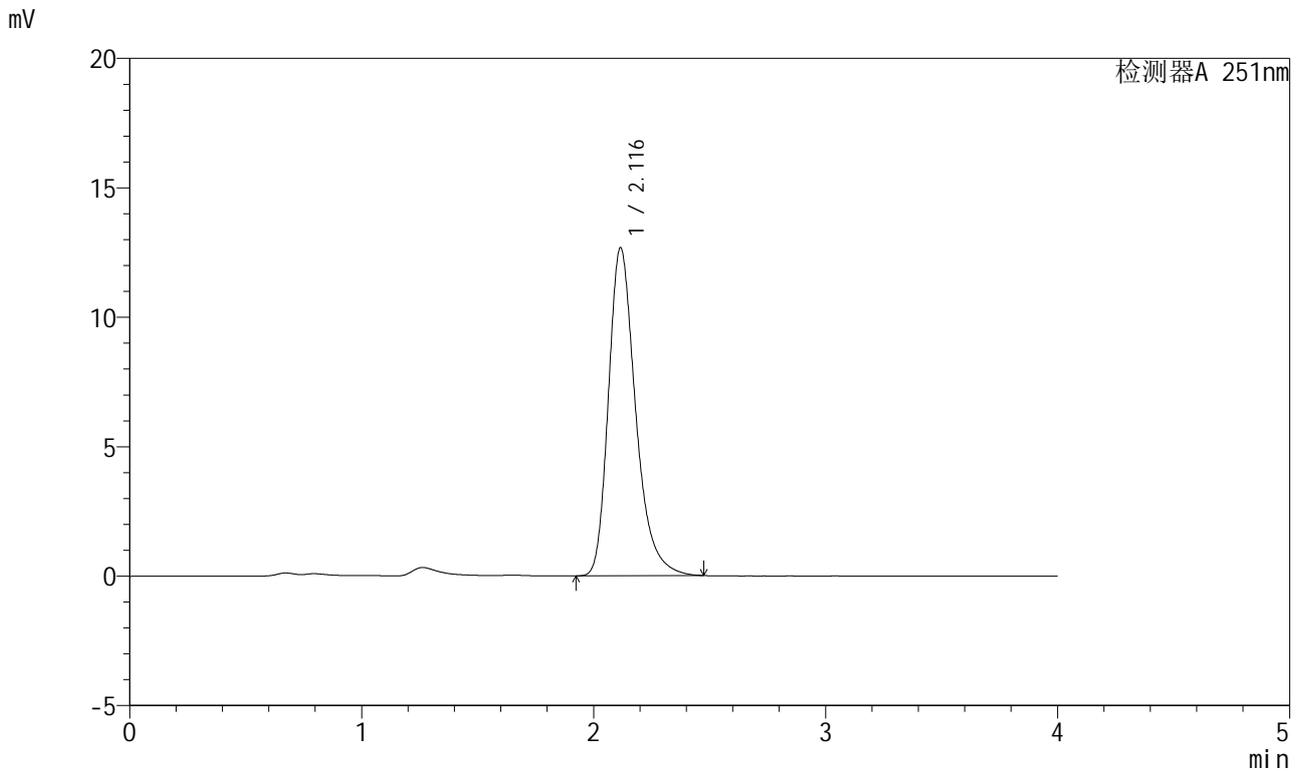

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	103291	100.000	12657	1646	1.304	--
总计		103291	100.000	12657			

图173 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3695-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:12:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

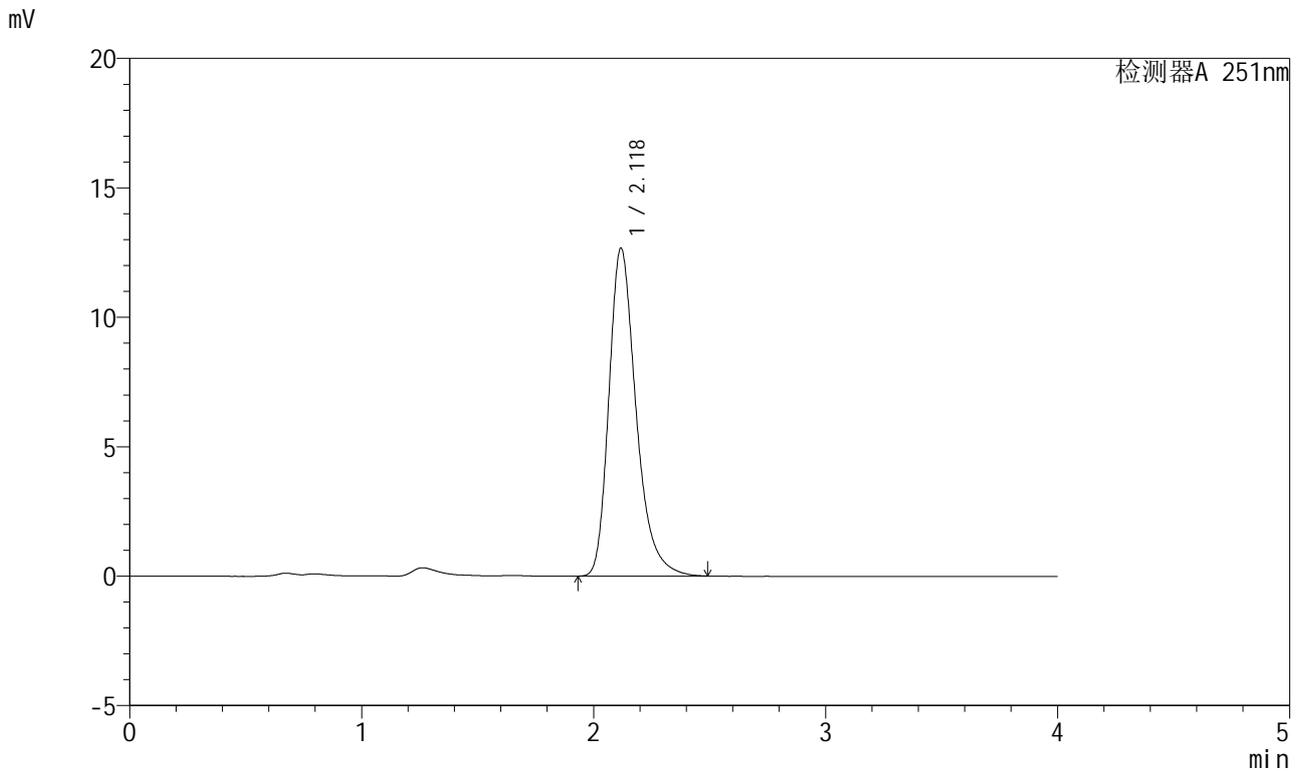

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	103387	100.000	12641	1647	1.306	--
总计		103387	100.000	12641			

图174 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3696-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:17:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

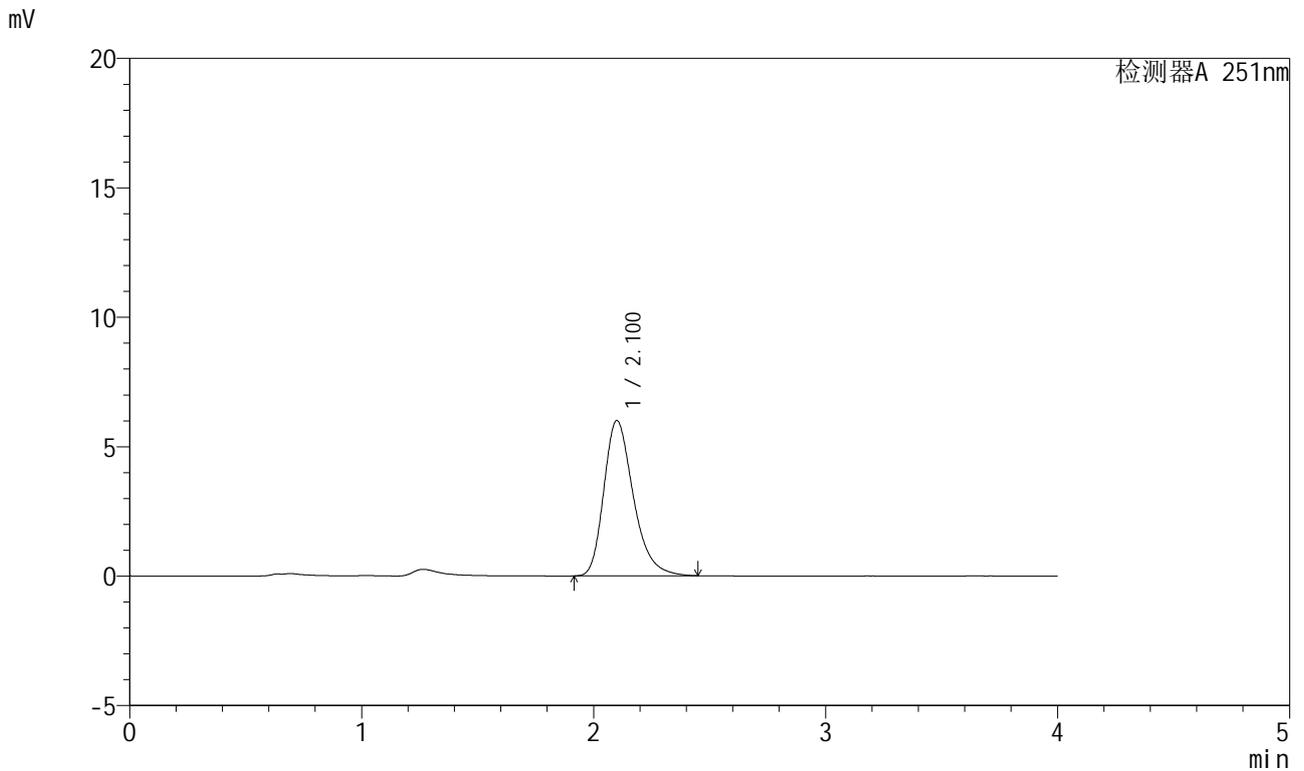

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	53102	100.000	5991	1358	1.300	--
总计		53102	100.000	5991			

图175 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3697-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:21:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

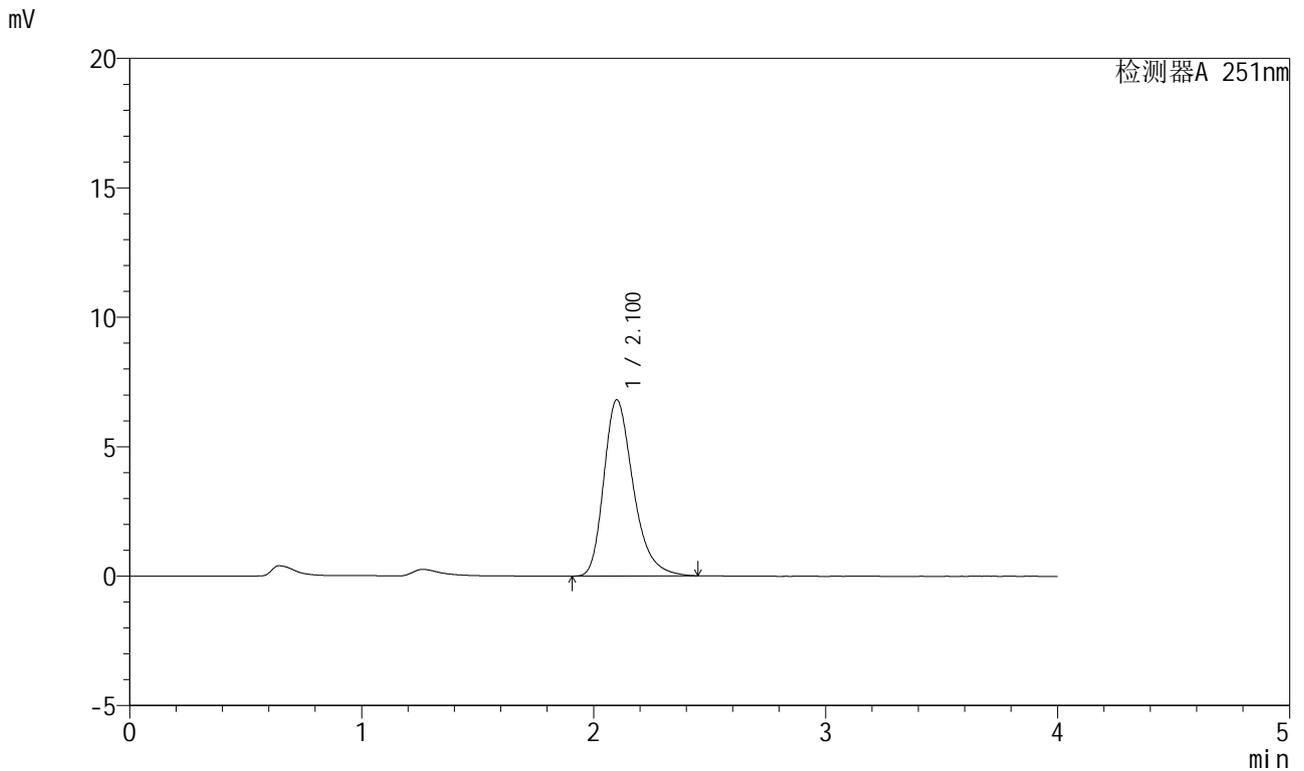

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	59984	100.000	6794	1369	1.308	--
总计		59984	100.000	6794			

图176 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3698-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:25:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

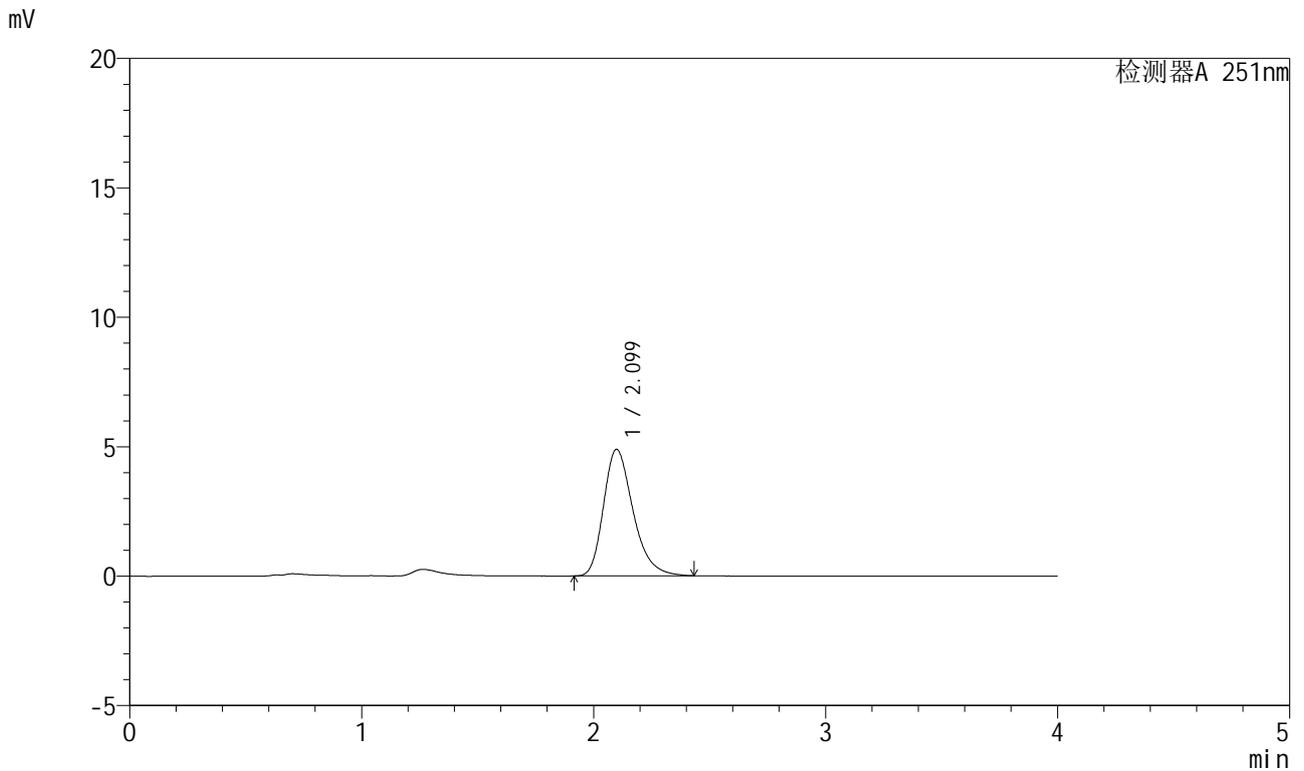

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	43269	100.000	4885	1349	1.295	--
总计		43269	100.000	4885			

图177 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3699-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:30:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

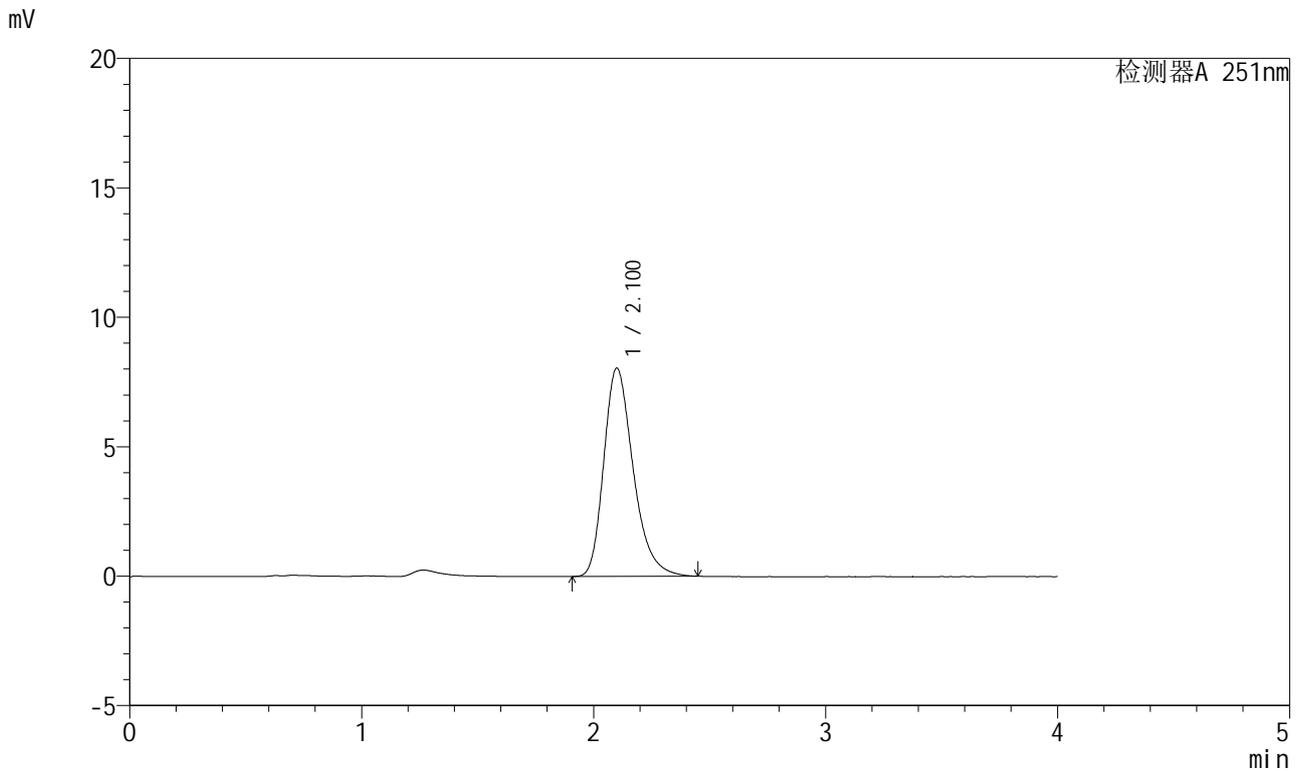

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	71080	100.000	8035	1358	1.299	--
总计		71080	100.000	8035			

图178 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3700-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:35:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

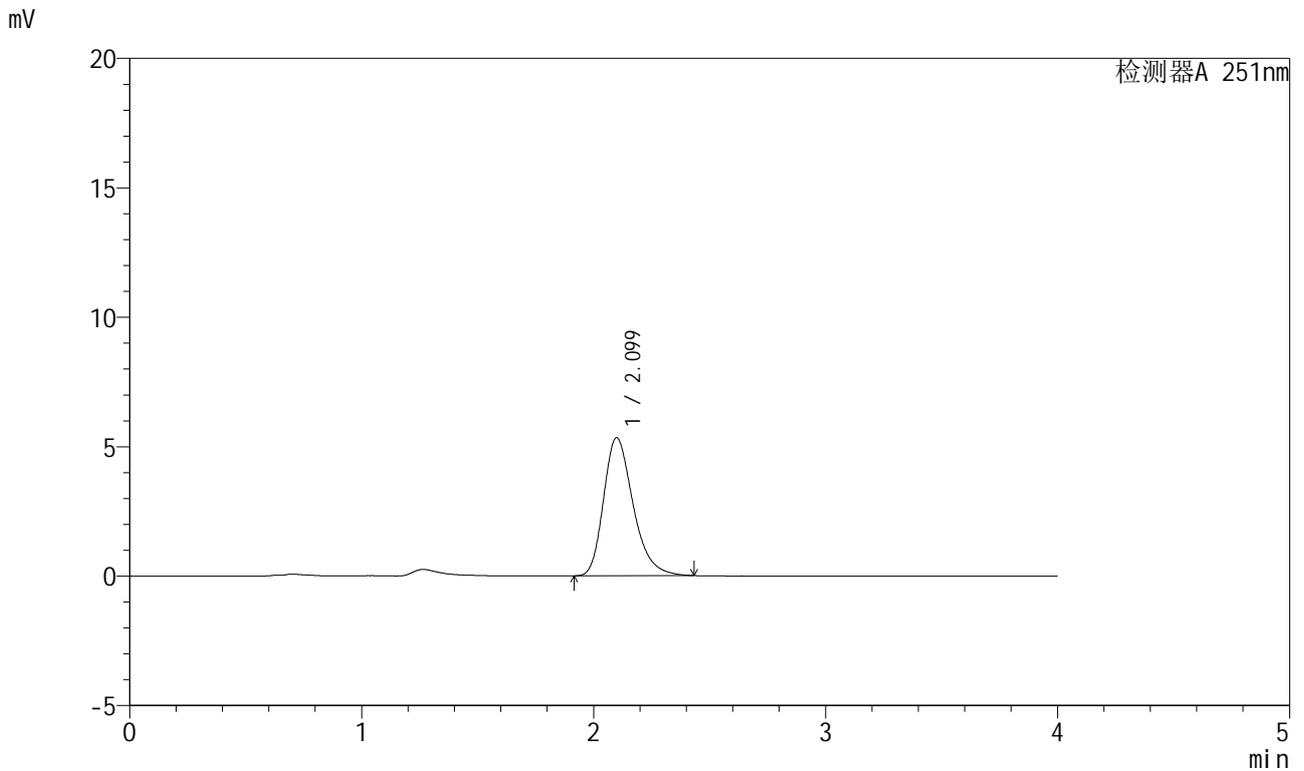

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	47266	100.000	5331	1345	1.293	--
总计		47266	100.000	5331			

图179 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3701-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:39:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

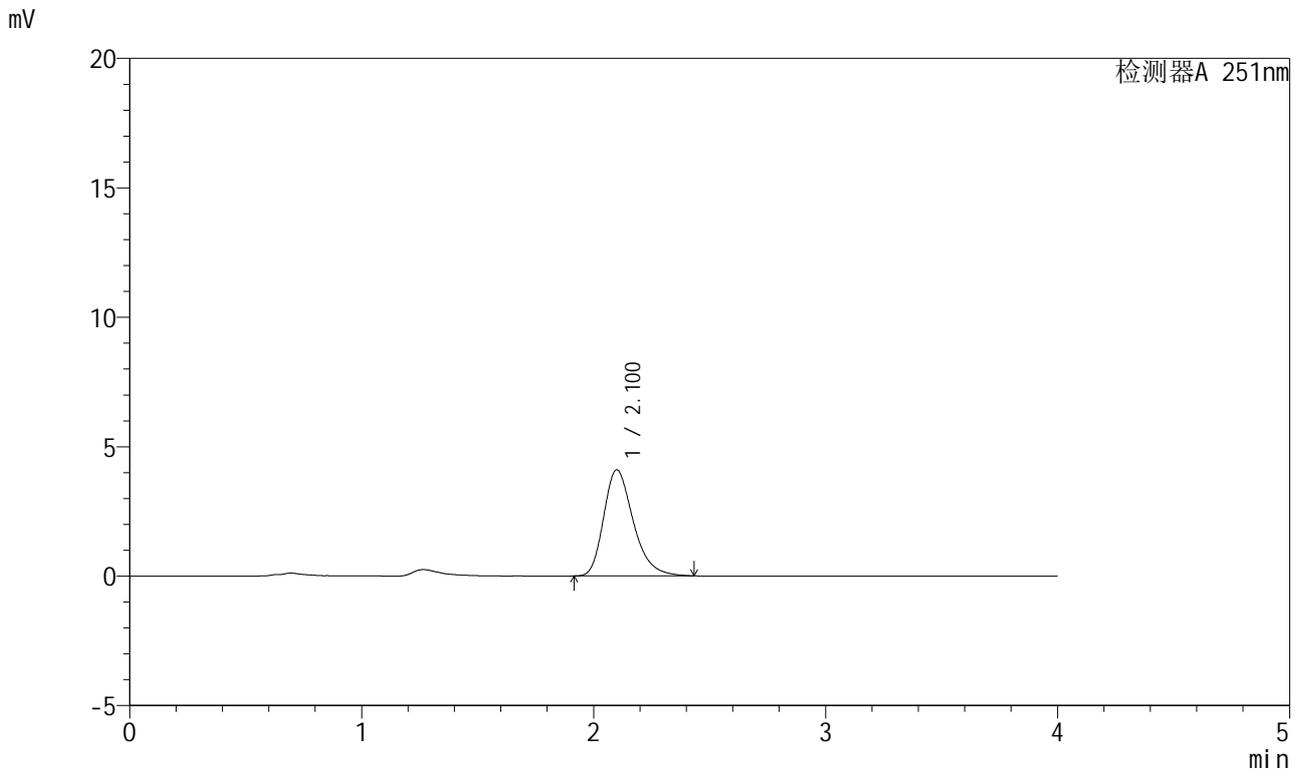

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	36378	100.000	4094	1339	1.296	--
总计		36378	100.000	4094			

图180 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3702-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:44:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:08:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

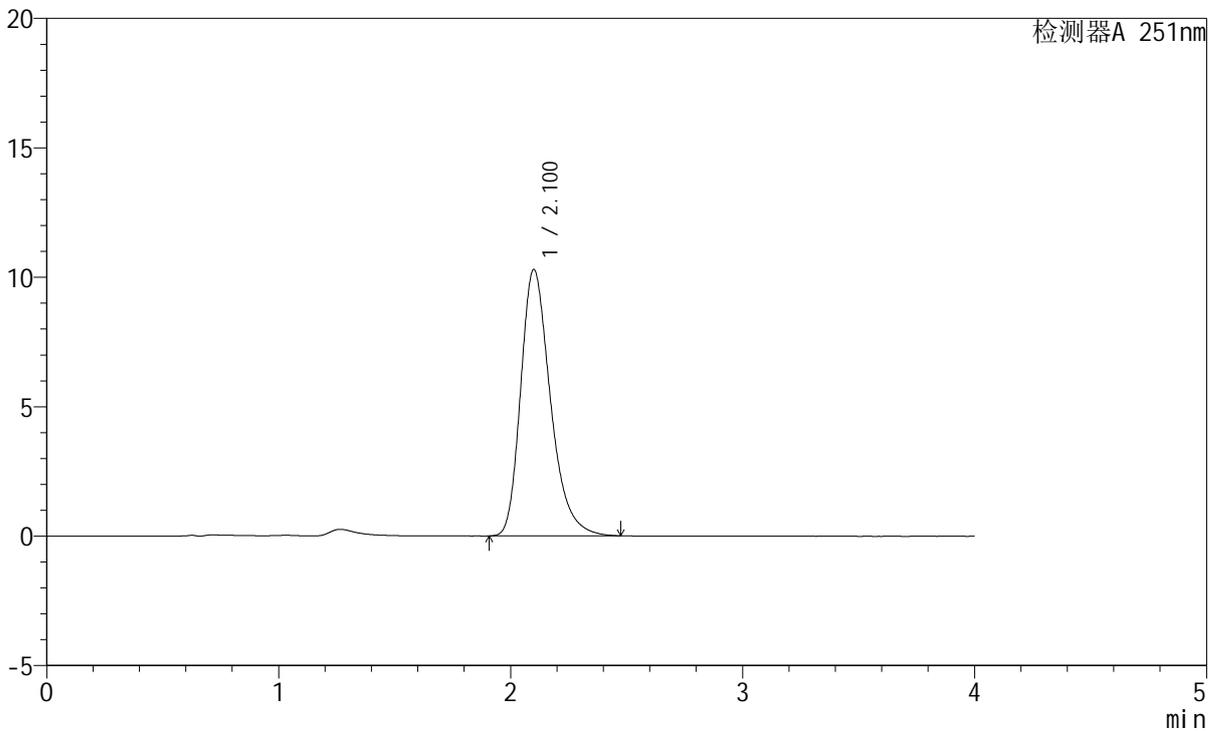

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	91761	100.000	10278	1337	1.300	--
总计		91761	100.000	10278			

图181 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3703-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:48:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

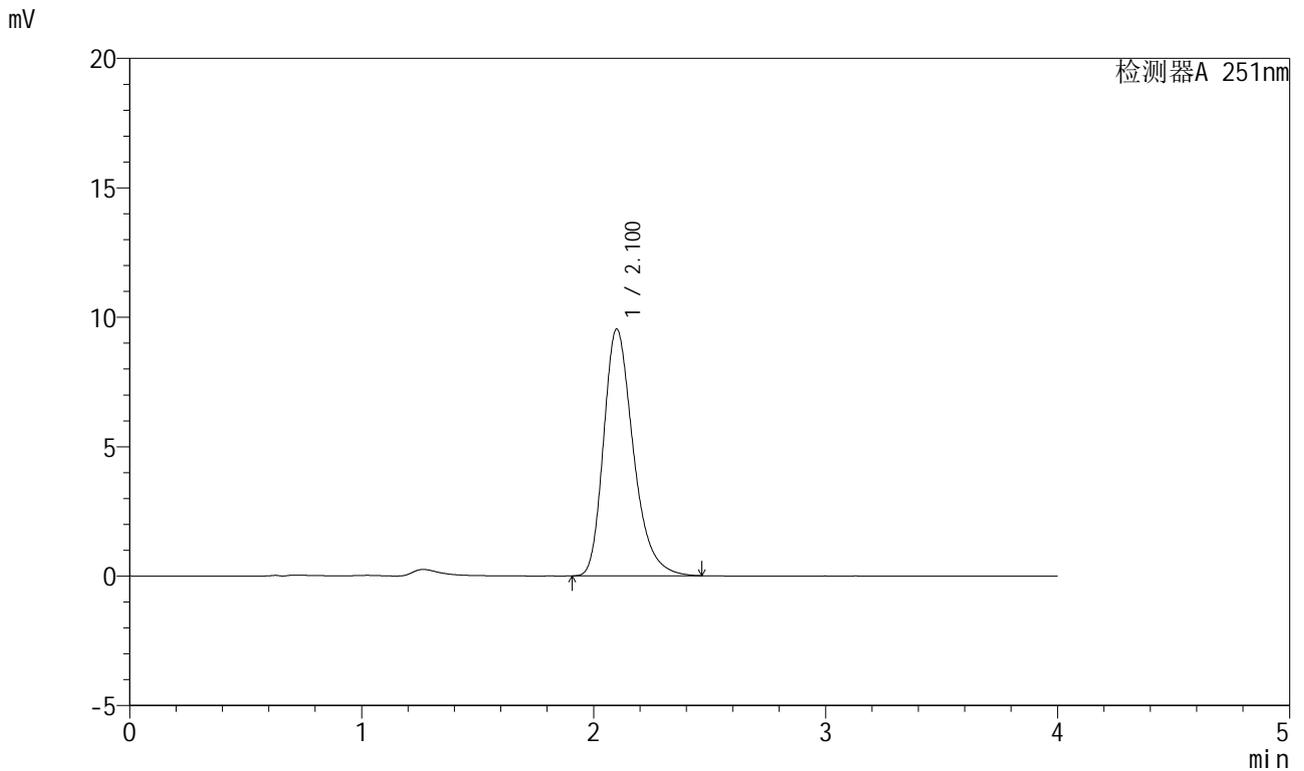

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	84809	100.000	9524	1341	1.302	--
总计		84809	100.000	9524			

图182 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3704-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:52:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

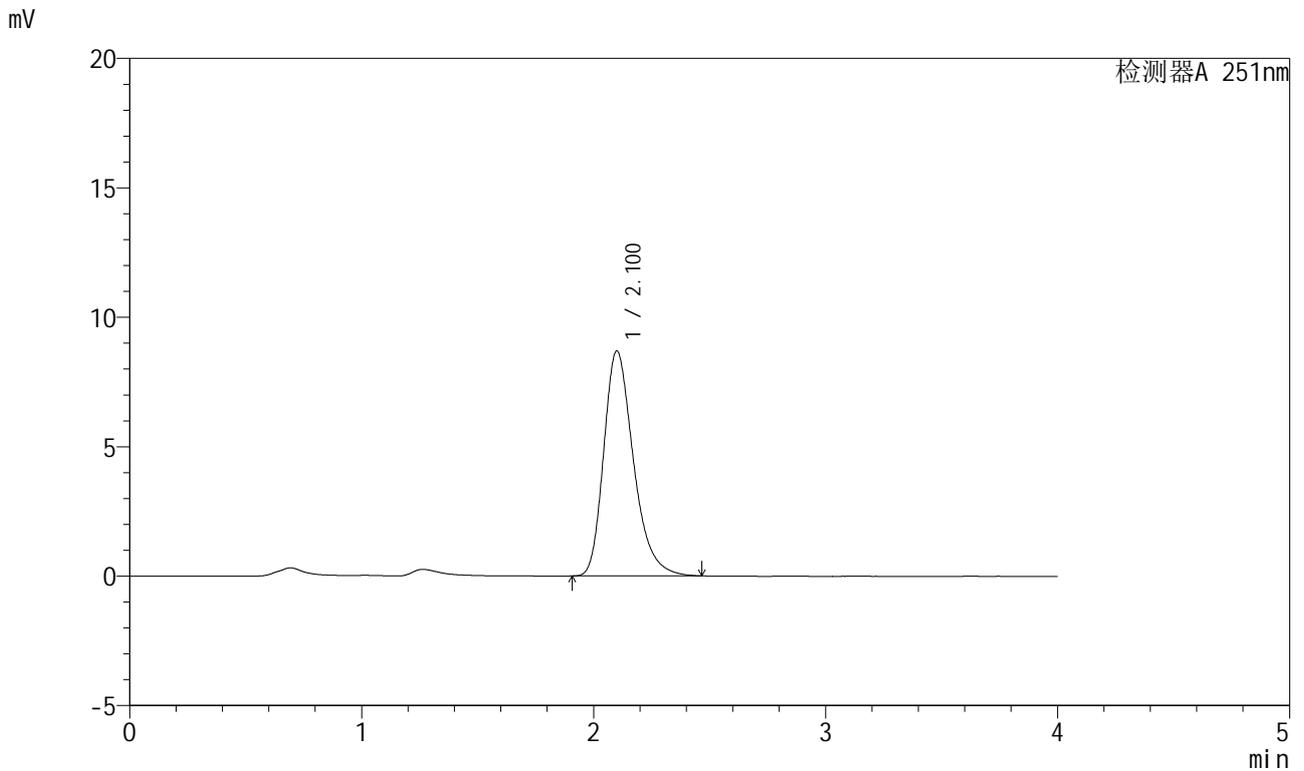

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	77426	100.000	8679	1336	1.300	--
总计		77426	100.000	8679			

图183 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3705-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 03:57:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

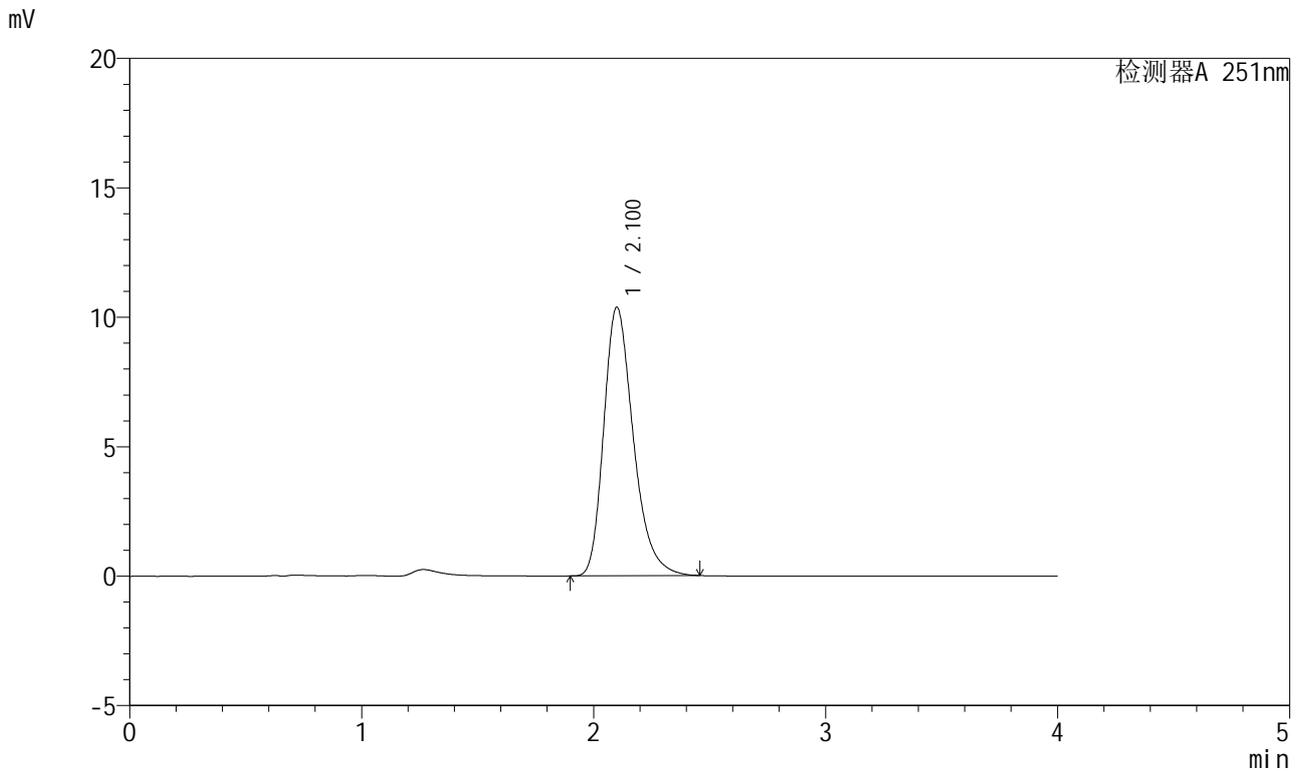

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	92138	100.000	10359	1342	1.296	--
总计		92138	100.000	10359			

图184 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3706-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:01:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

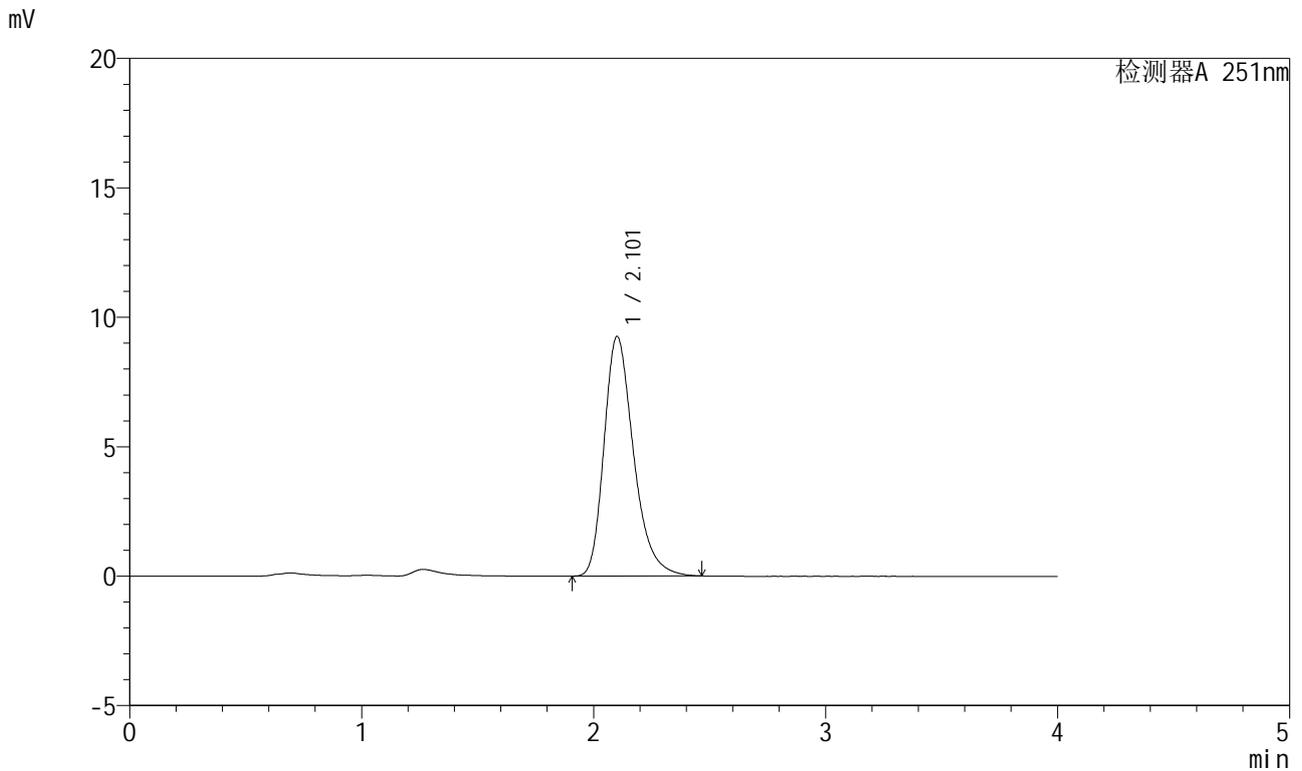

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	81858	100.000	9236	1361	1.301	--
总计		81858	100.000	9236			

图185 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3707-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:05:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

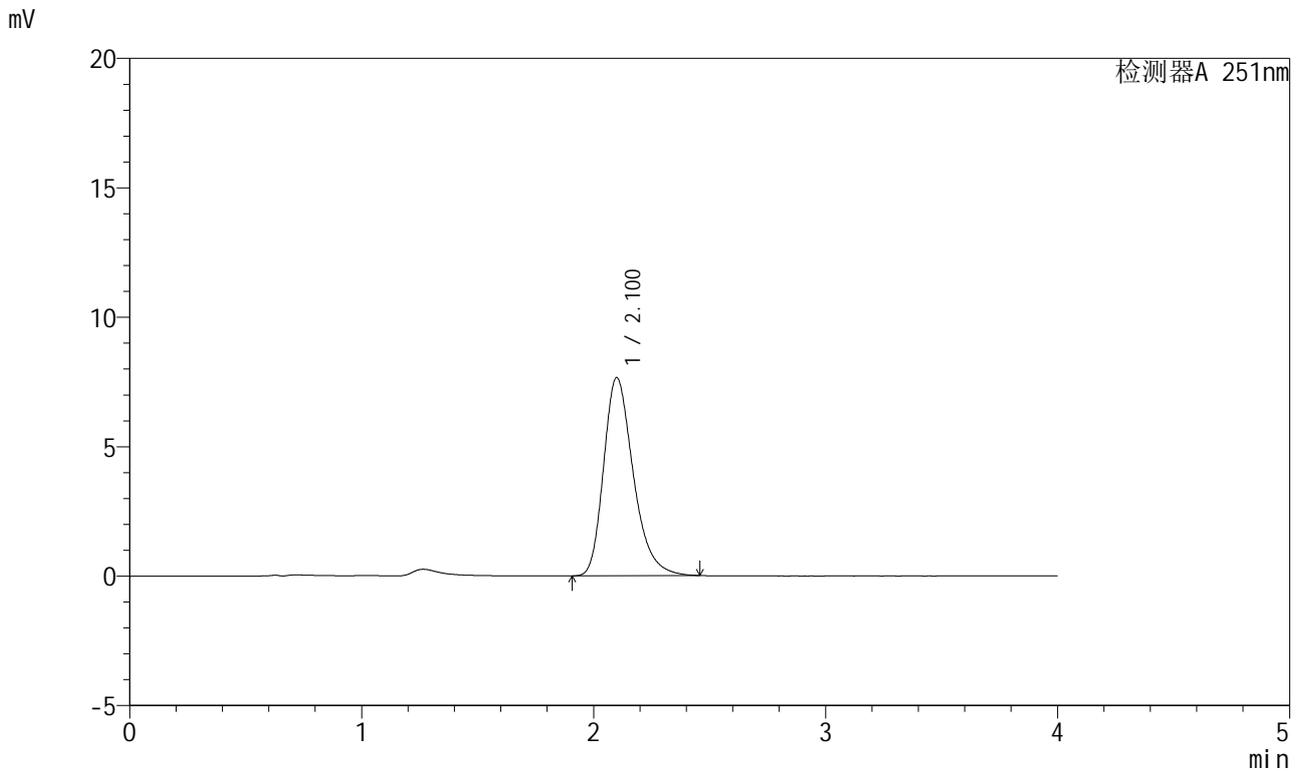

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	68108	100.000	7646	1339	1.299	--
总计		68108	100.000	7646			

图186 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3708-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:10:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

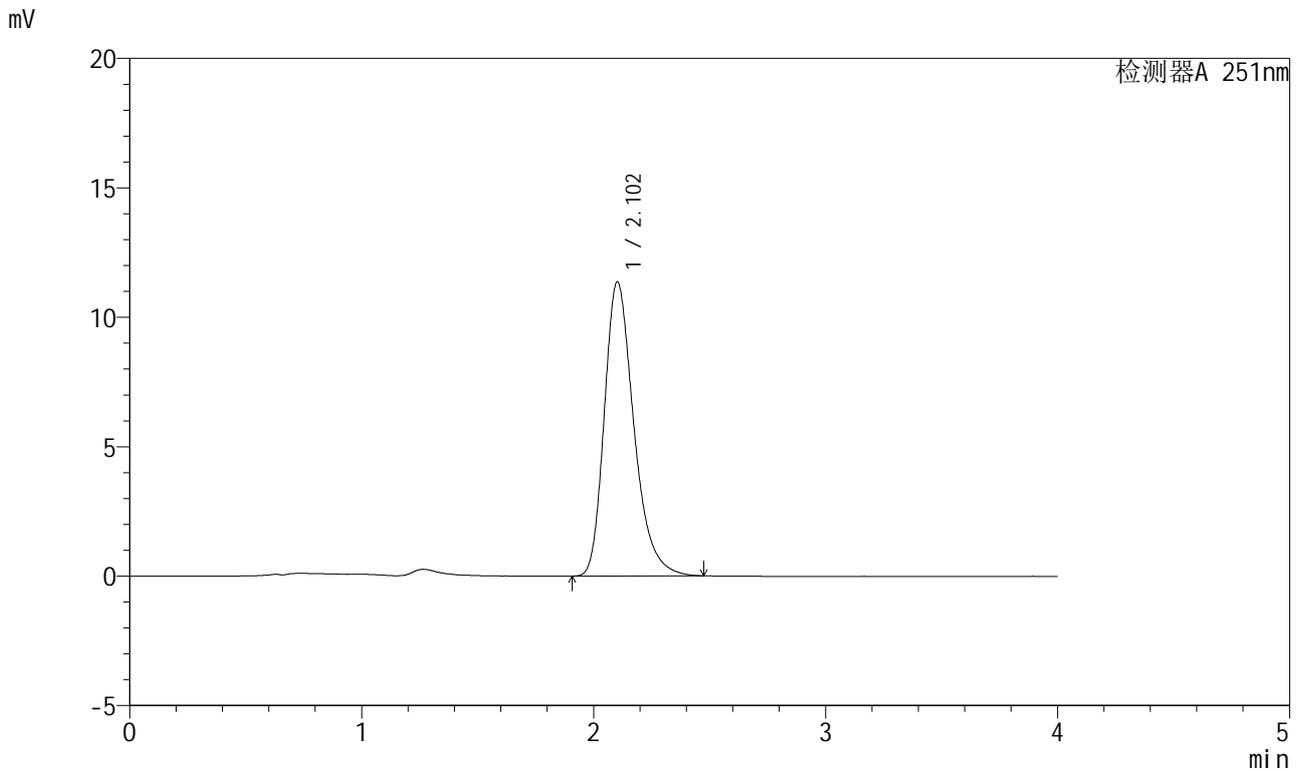

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	100599	100.000	11353	1359	1.301	--
总计		100599	100.000	11353			

图187 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3709-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:14:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

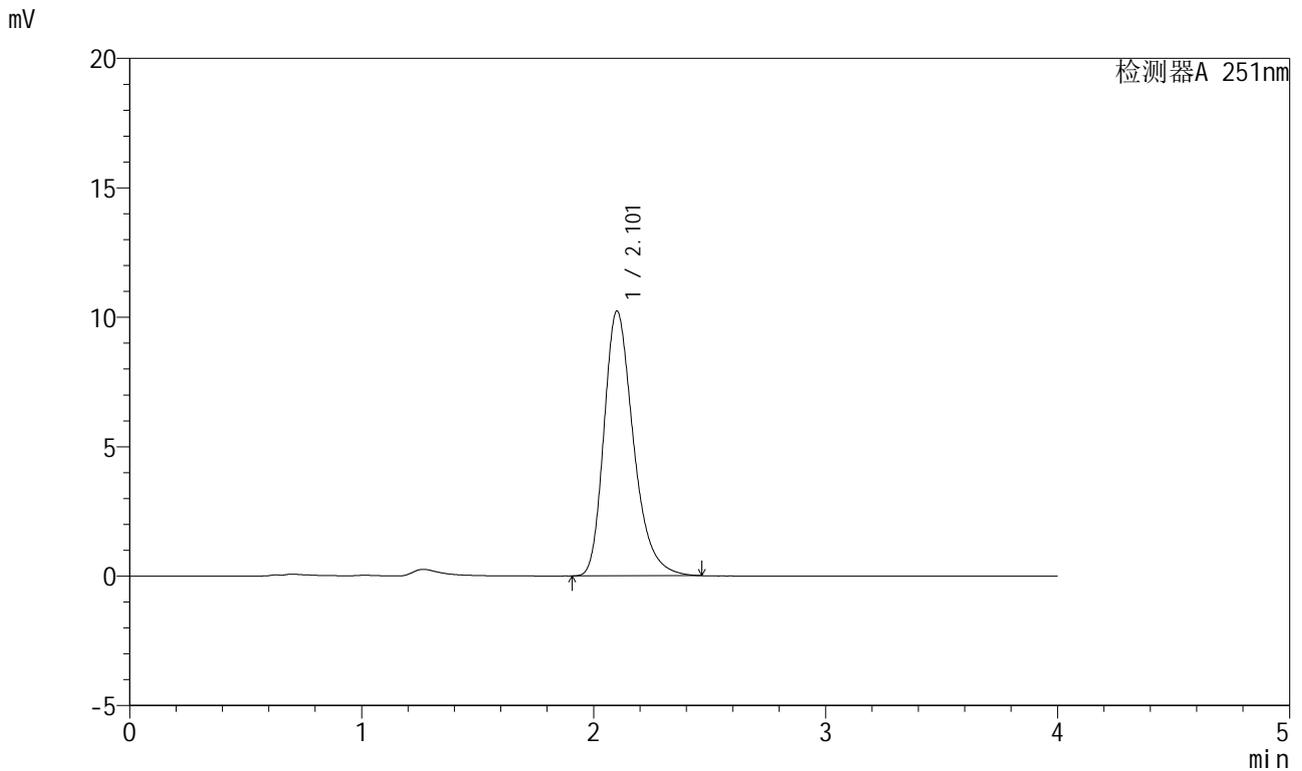

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	90178	100.000	10203	1369	1.302	--
总计		90178	100.000	10203			

图188 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3710-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:19:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

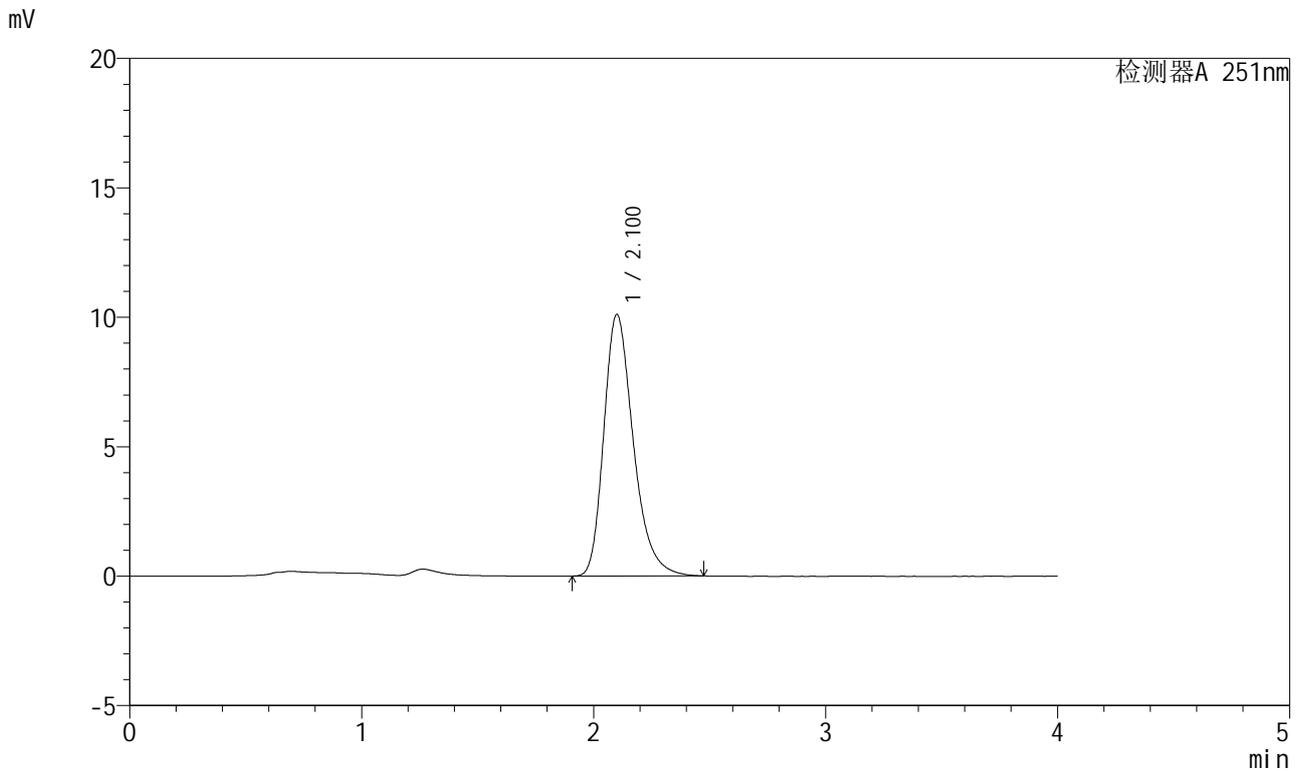

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	89411	100.000	10089	1359	1.301	--
总计		89411	100.000	10089			

图189 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3711-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:23:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

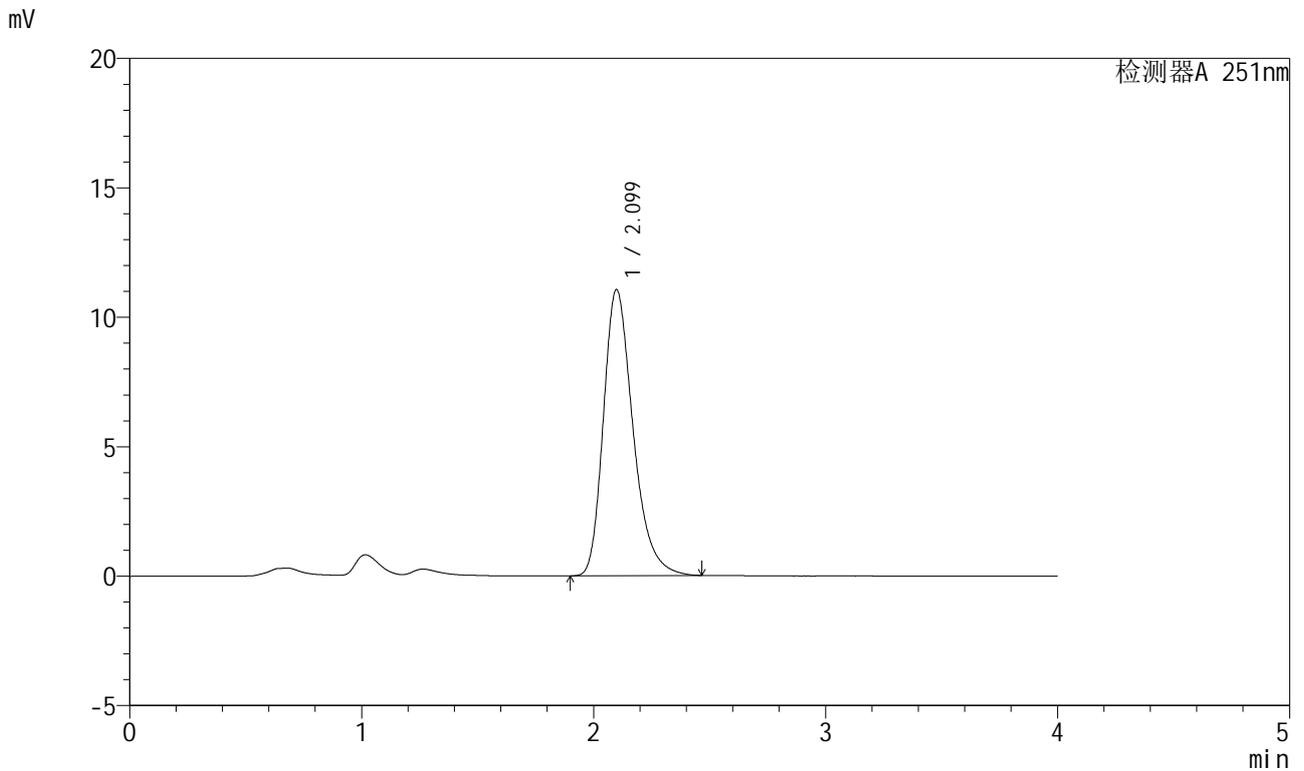

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	98300	100.000	11050	1342	1.301	--
总计		98300	100.000	11050			

图190 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3712-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:27:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

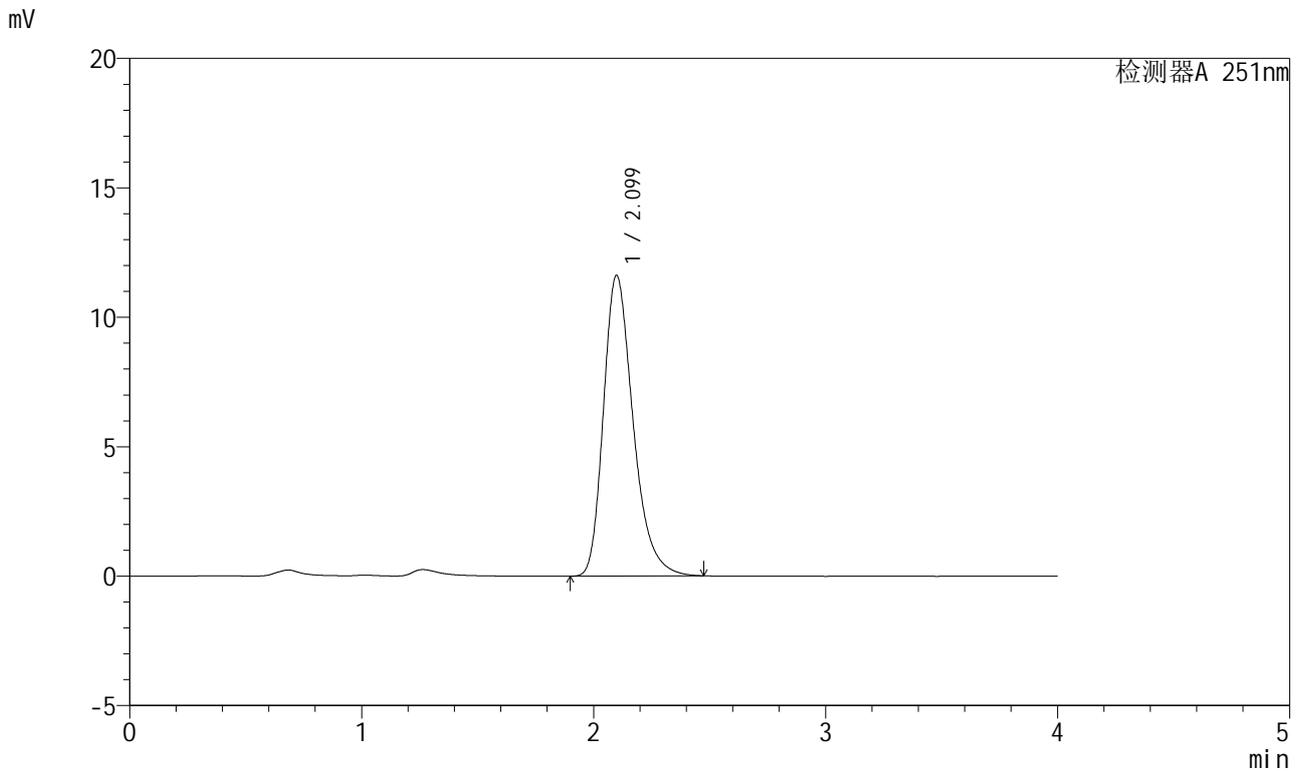

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	103403	100.000	11612	1341	1.301	--
总计		103403	100.000	11612			

图191 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3713-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:32:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

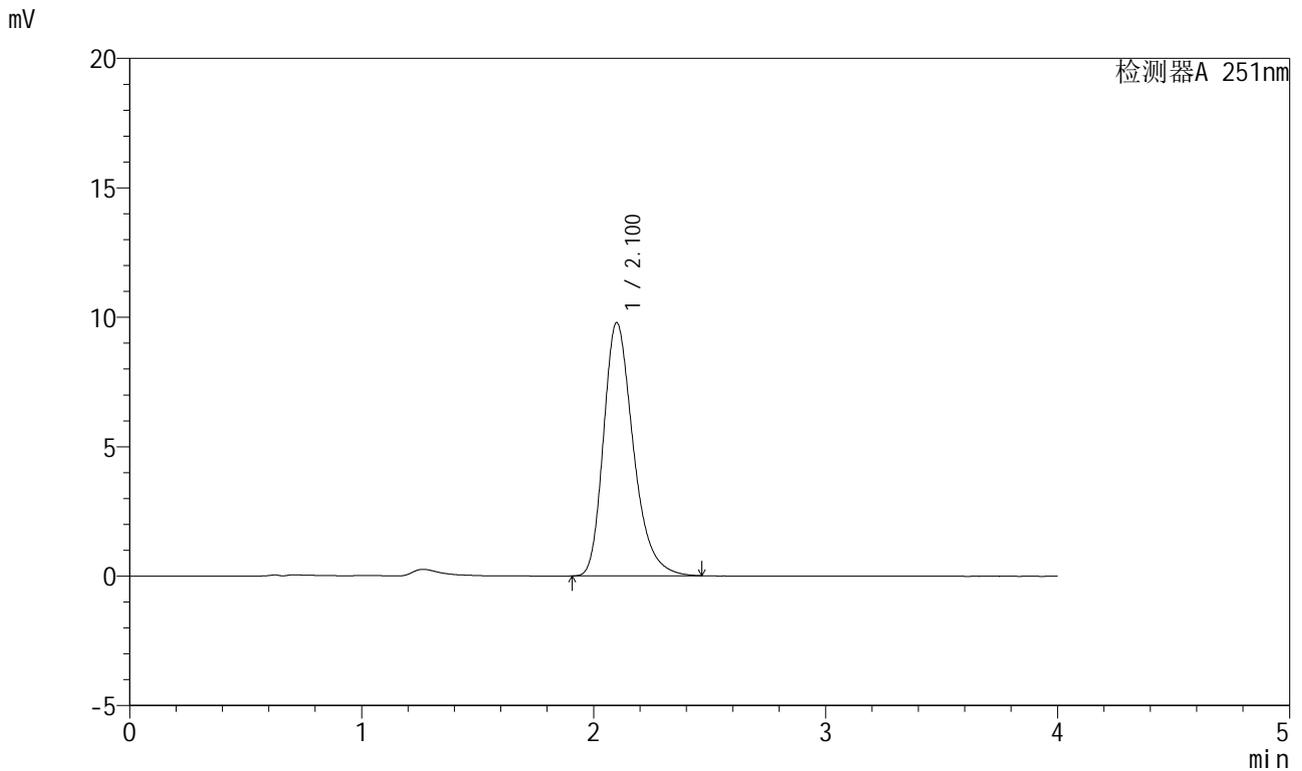

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	87136	100.000	9775	1340	1.298	--
总计		87136	100.000	9775			

图192 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3714-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:36:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

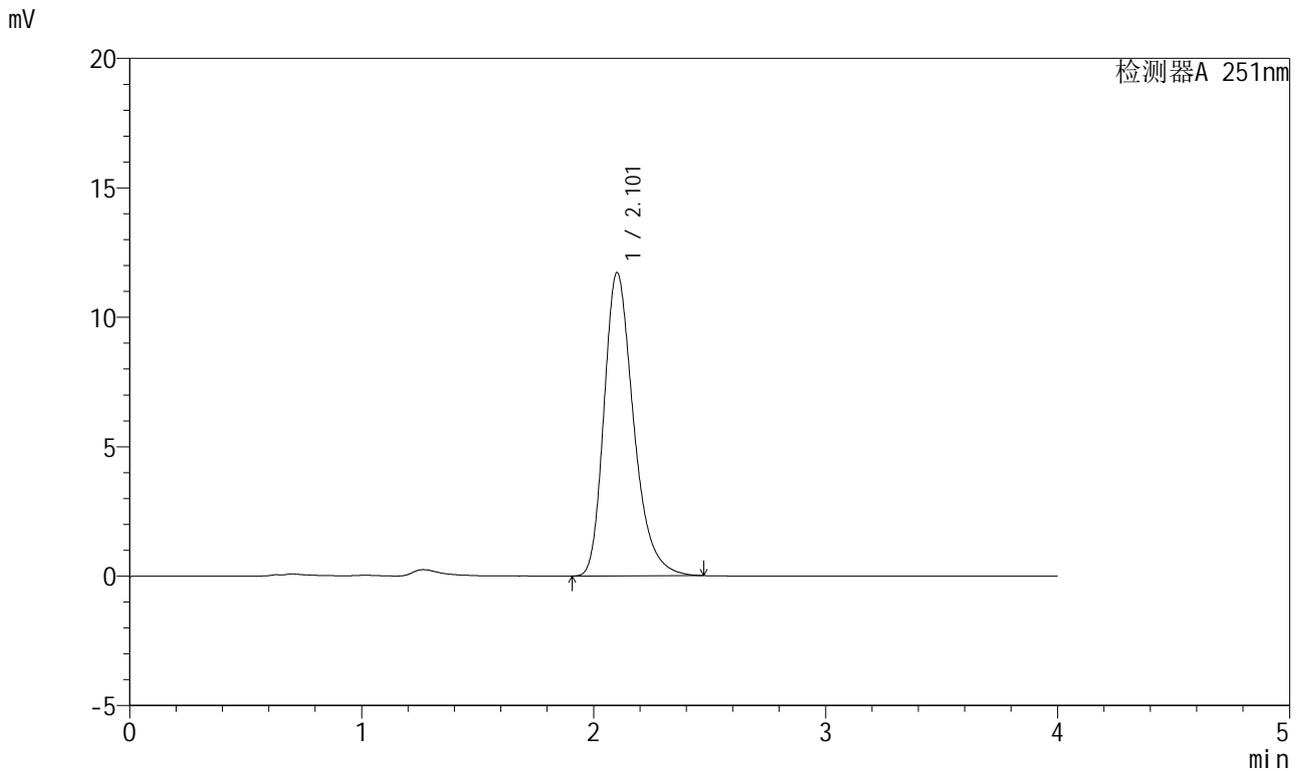

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	103623	100.000	11690	1360	1.301	--
总计		103623	100.000	11690			

图193 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3715-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:41:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

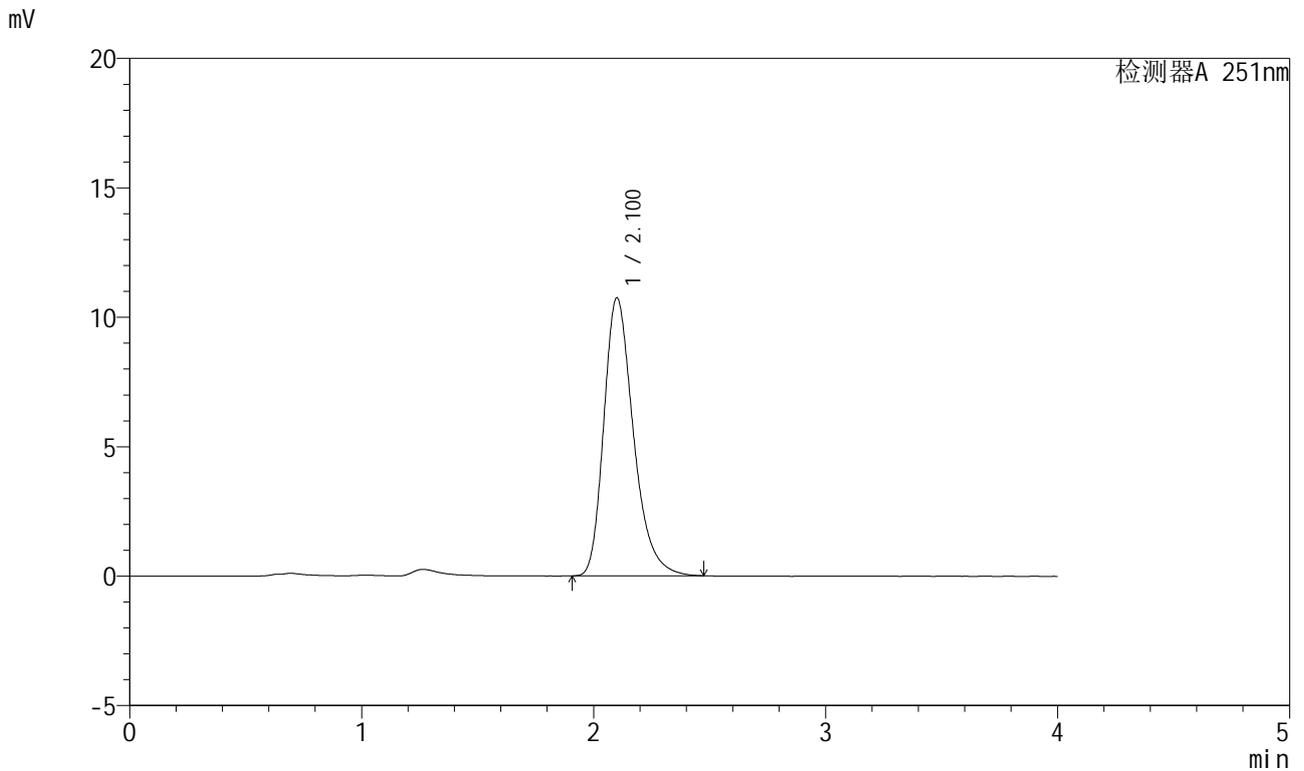

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	95465	100.000	10722	1347	1.300	--
总计		95465	100.000	10722			

图194 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3716-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:45:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

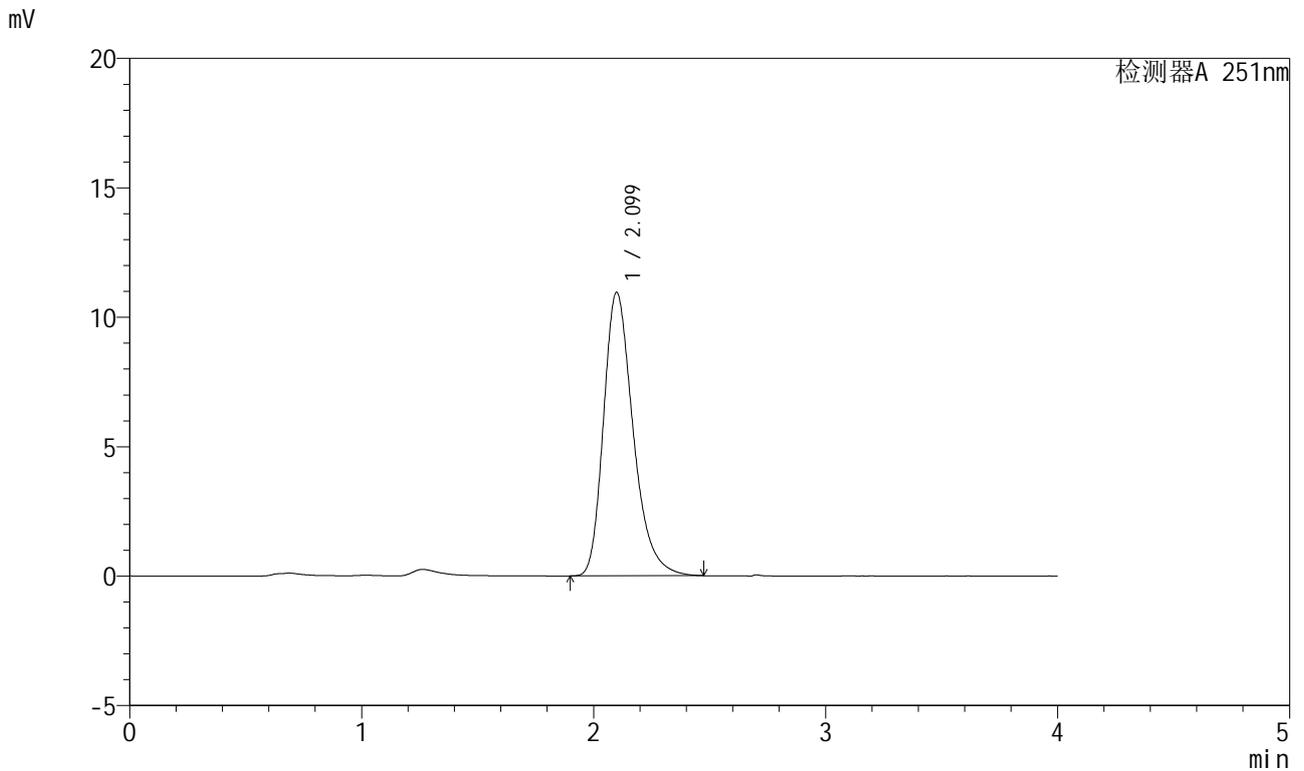

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	97337	100.000	10944	1346	1.300	--
总计		97337	100.000	10944			

图195 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3717-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:49:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

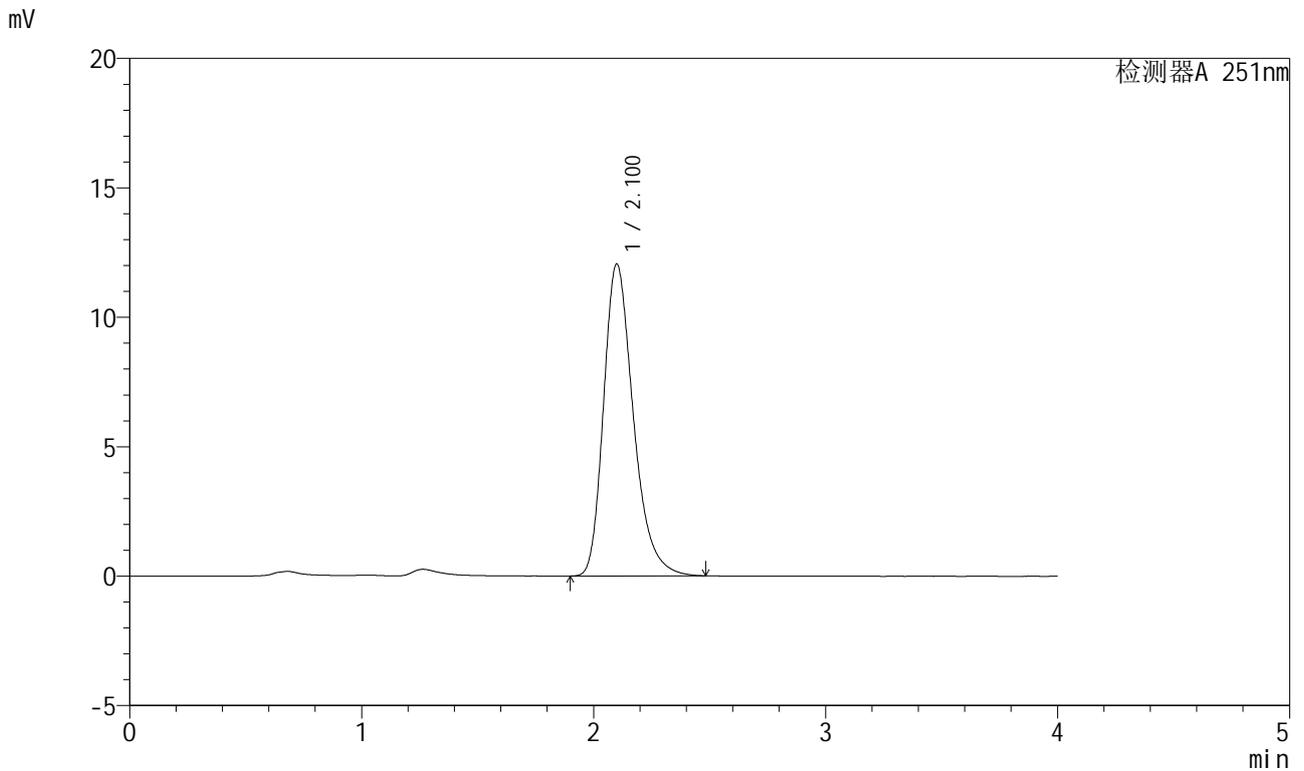

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	107606	100.000	12037	1333	1.298	--
总计		107606	100.000	12037			

图196 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3718-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:54:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

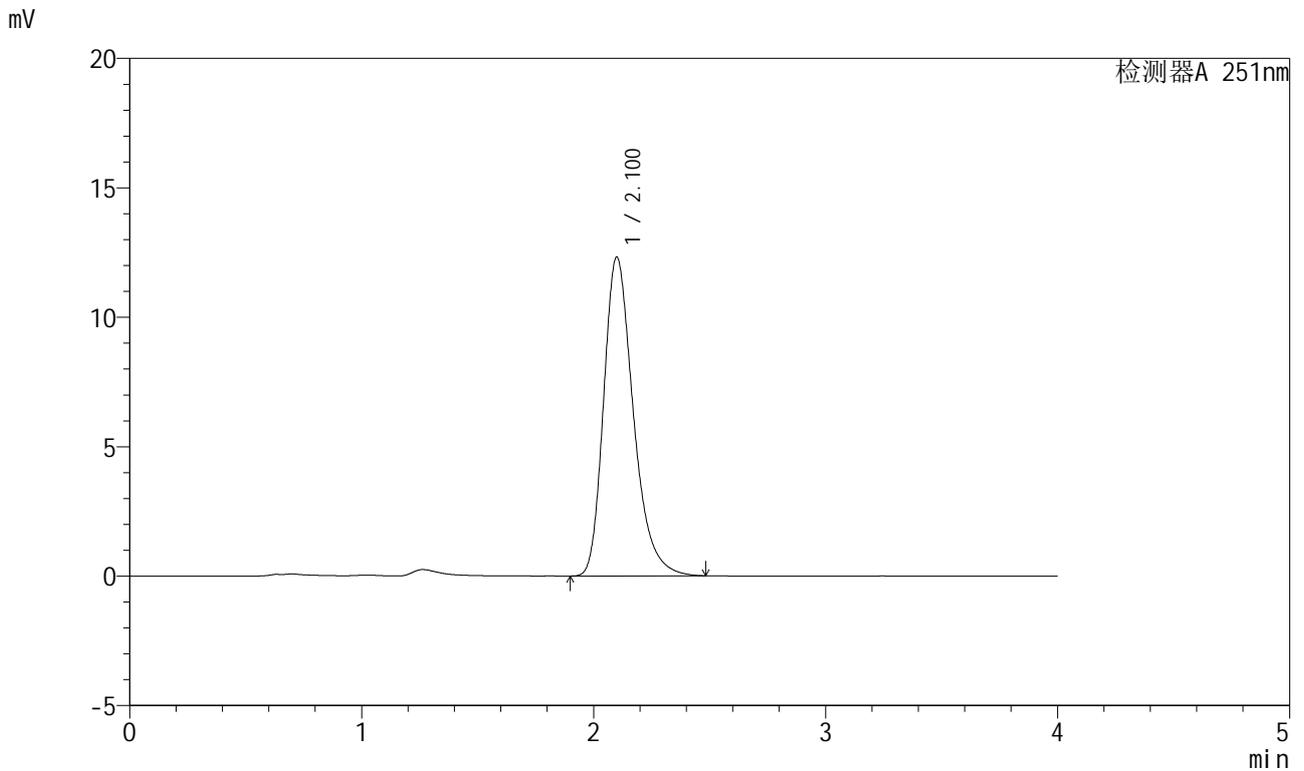

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	109750	100.000	12305	1342	1.302	--
总计		109750	100.000	12305			

图197 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3719-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 04:58:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

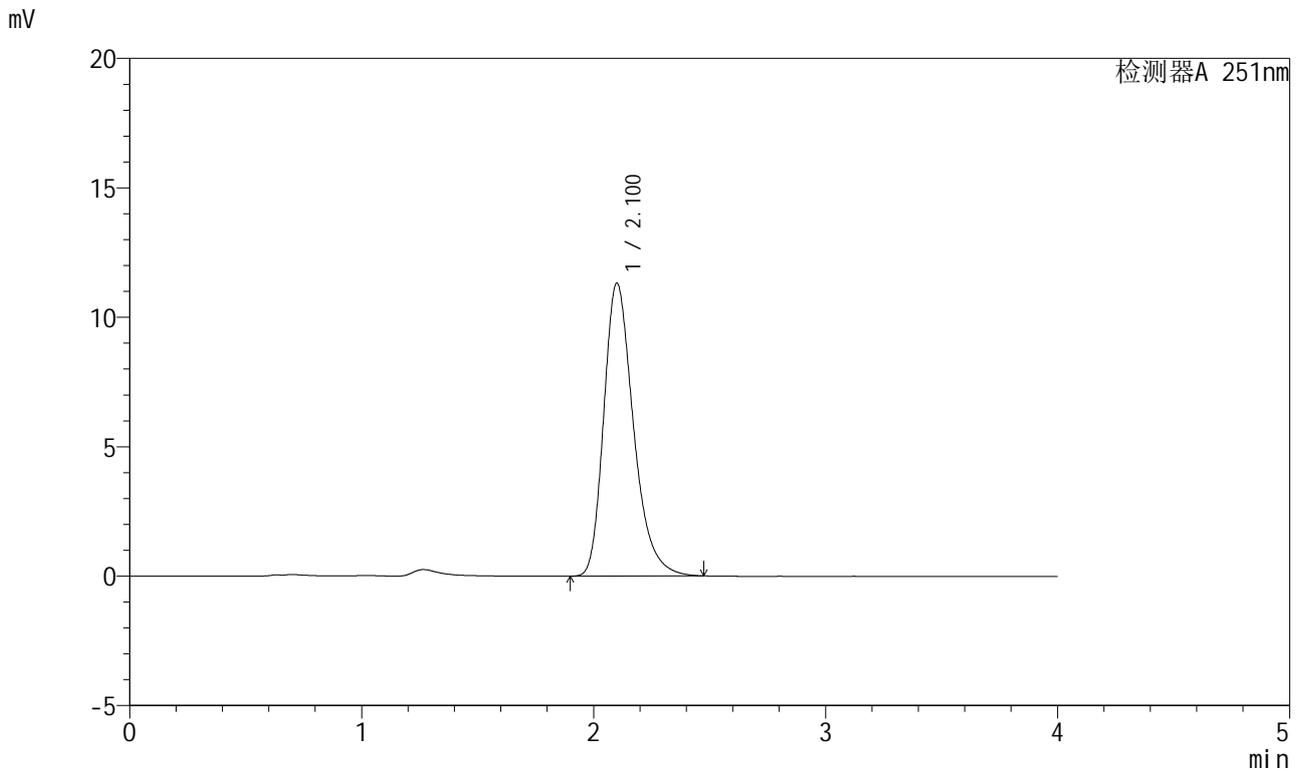

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	100760	100.000	11296	1341	1.302	--
总计		100760	100.000	11296			

图198 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3720-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:02:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

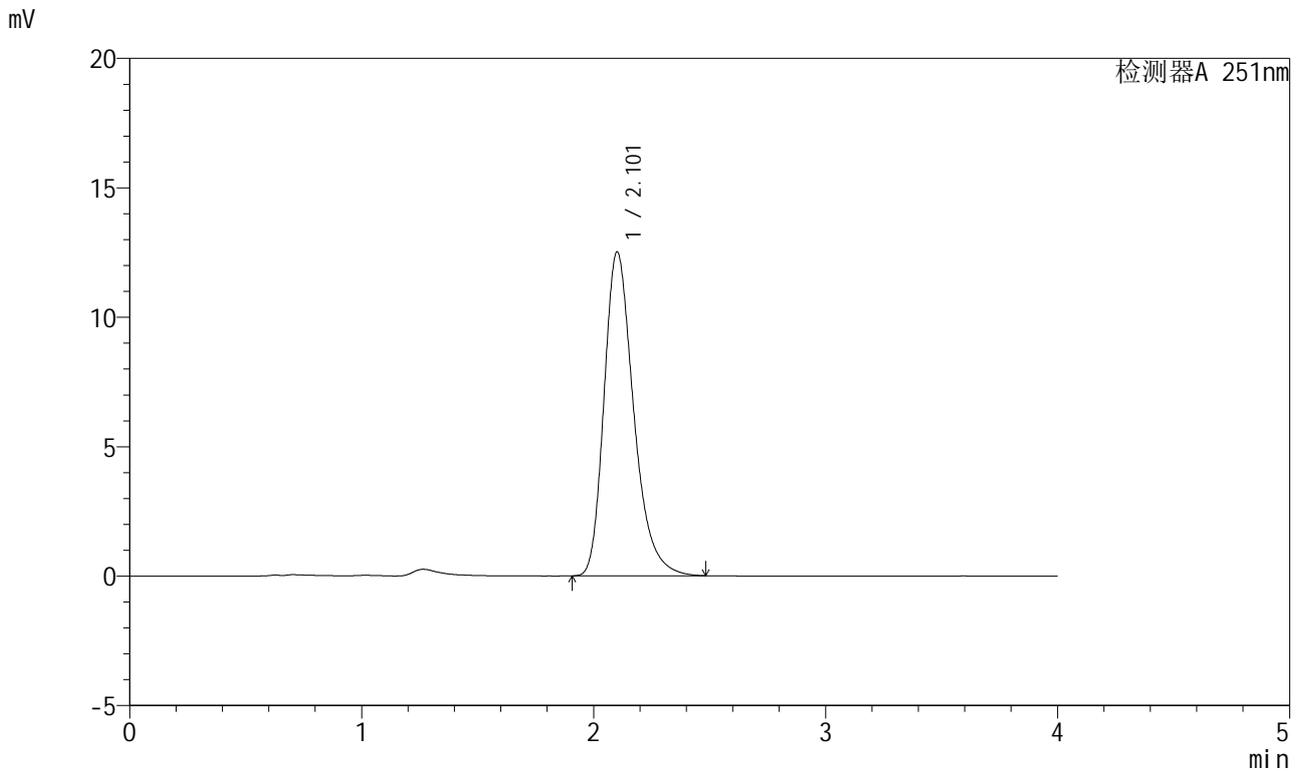

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	111067	100.000	12492	1353	1.302	--
总计		111067	100.000	12492			

图199 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3721-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:07:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

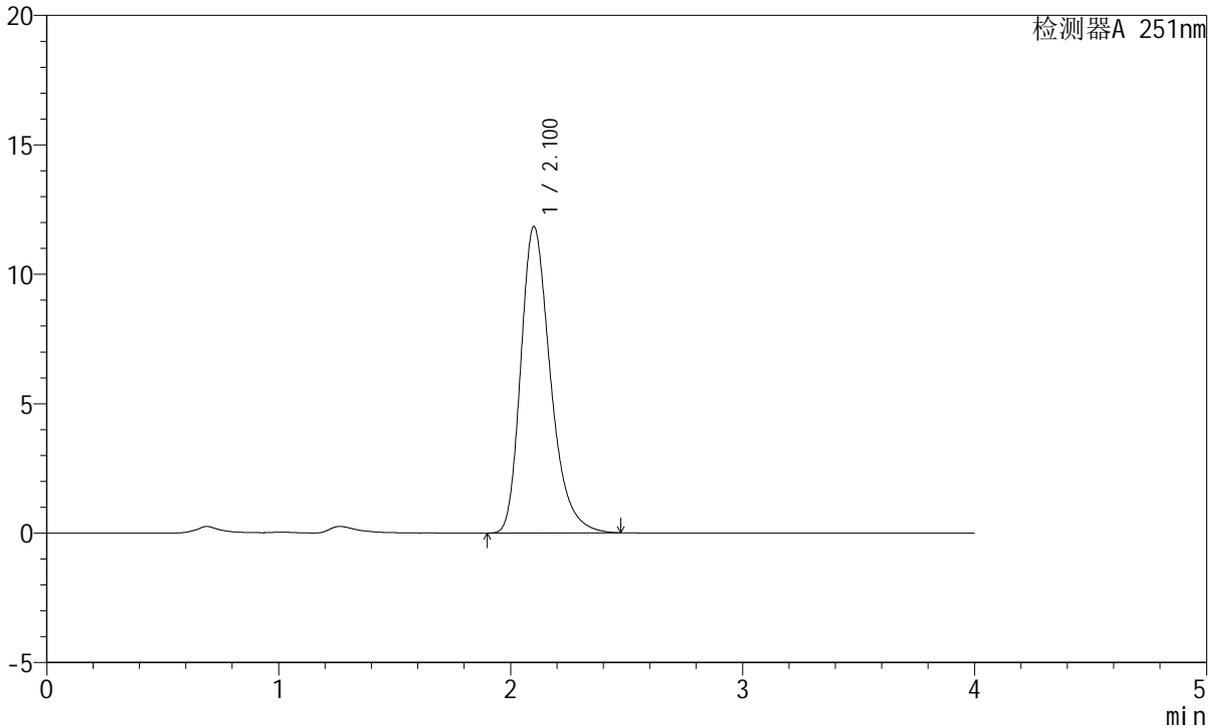

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	105170	100.000	11815	1347	1.302	--
总计		105170	100.000	11815			

图200 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3722-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:11:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

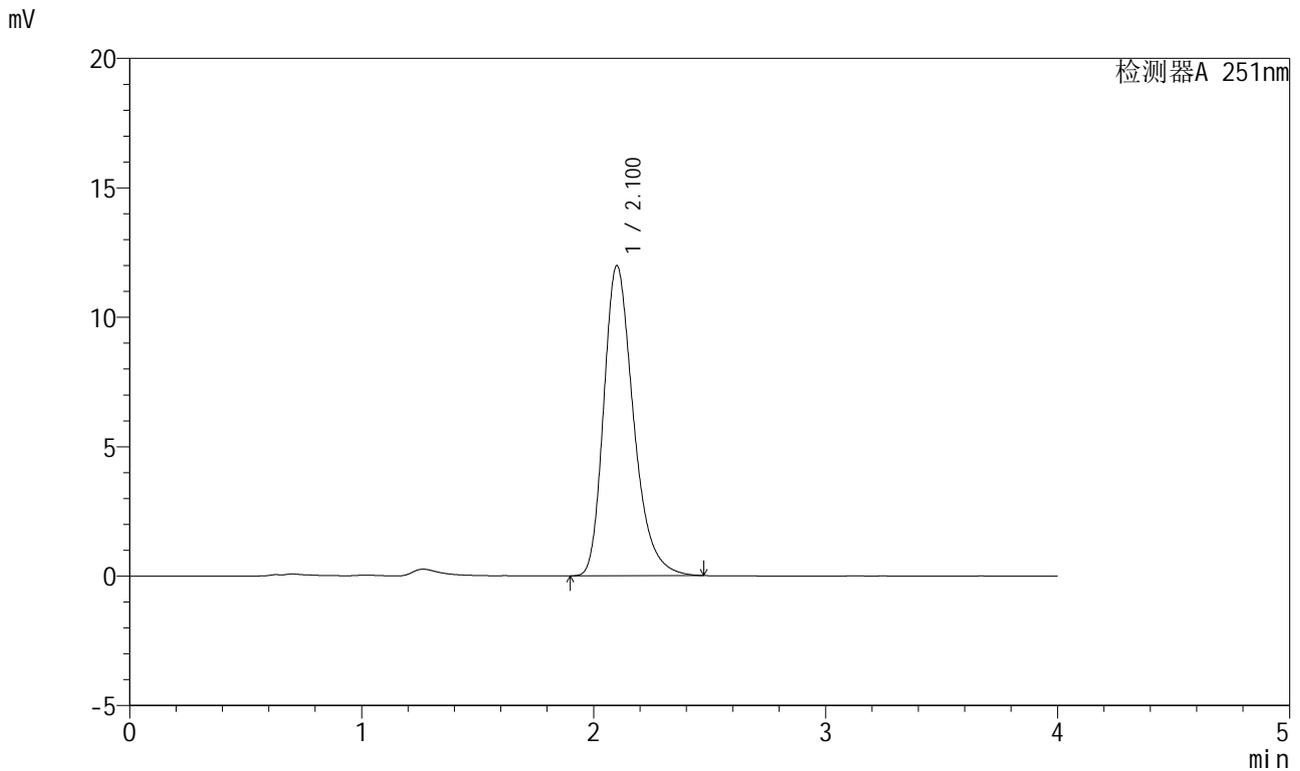

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	106750	100.000	11960	1338	1.300	--
总计		106750	100.000	11960			

图201 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3723-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:16:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

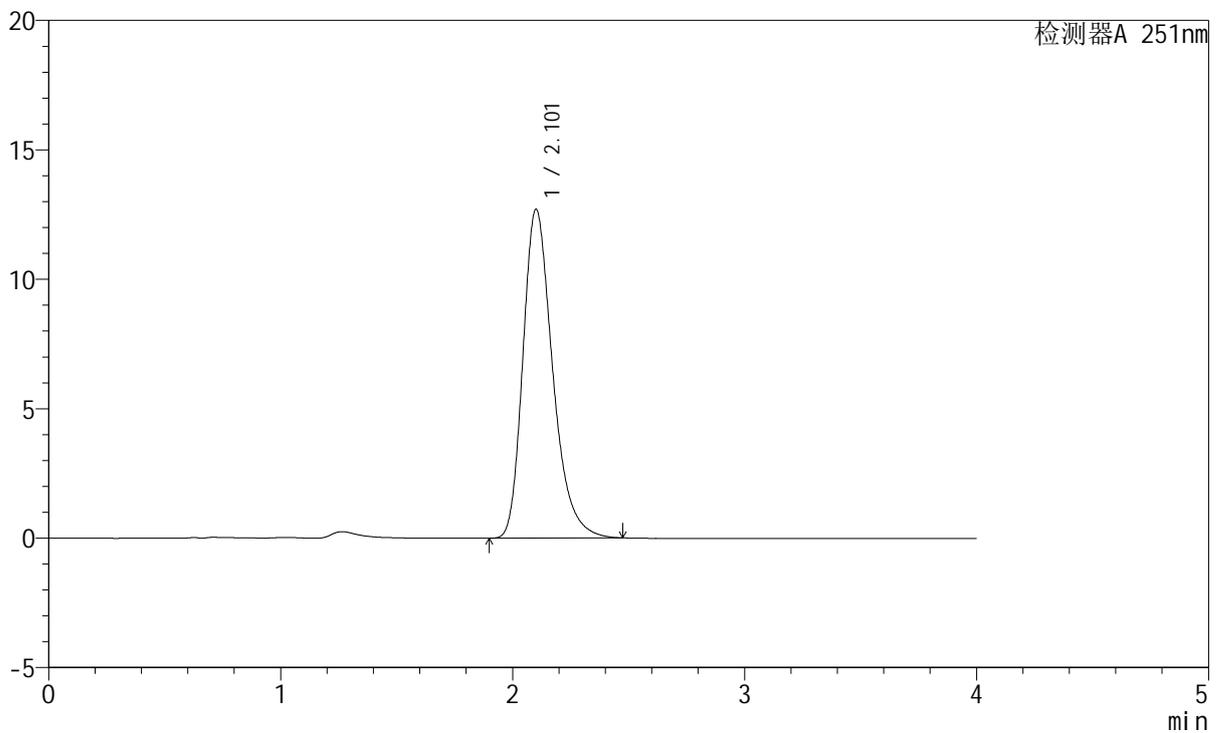

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	113225	100.000	12680	1339	1.299	--
总计		113225	100.000	12680			

图202 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3724-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:20:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

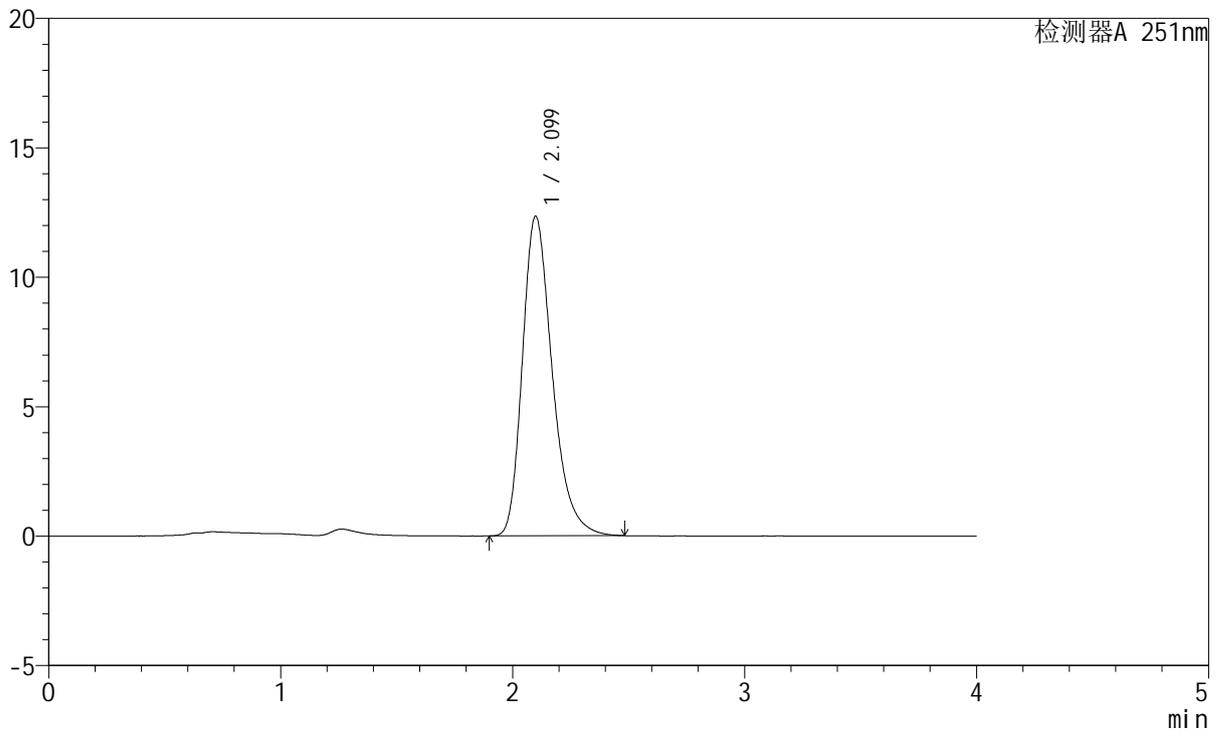

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	110414	100.000	12340	1330	1.300	--
总计		110414	100.000	12340			

图203 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3725-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:24:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:09:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

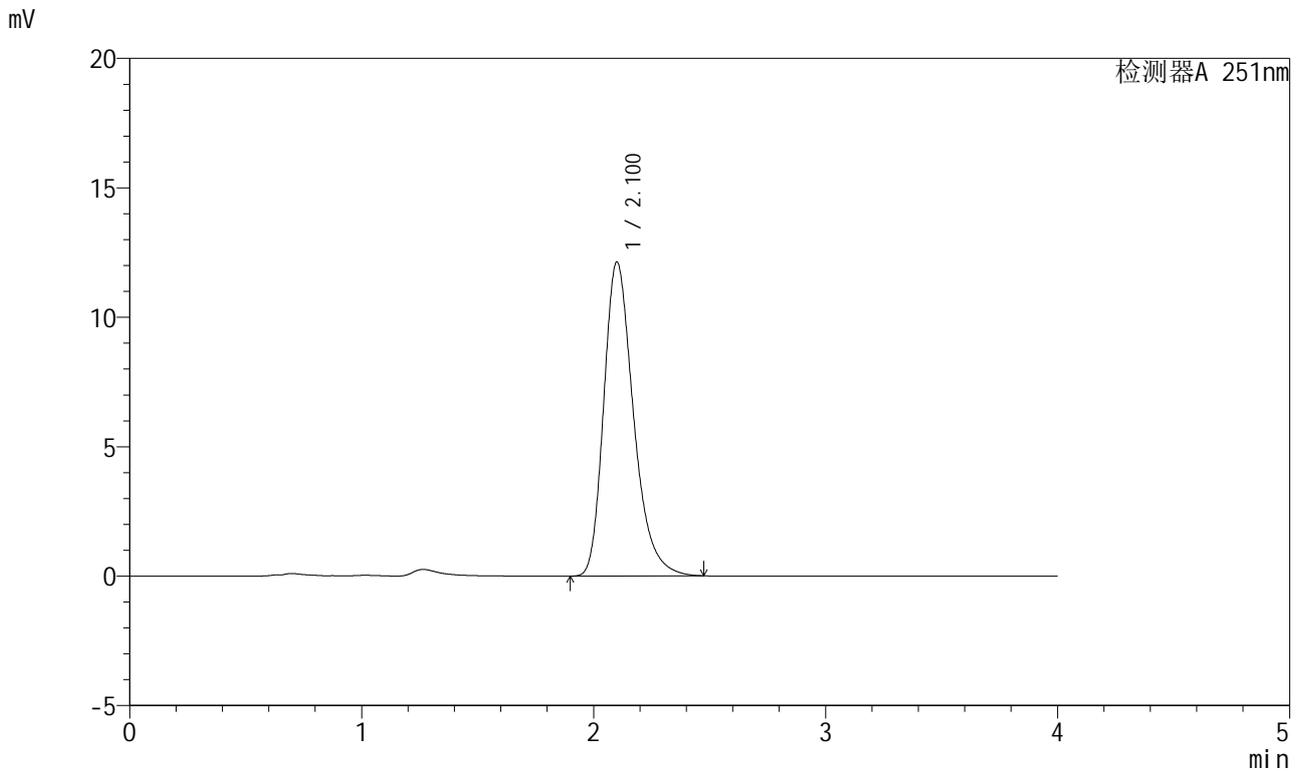

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	108286	100.000	12108	1335	1.300	--
总计		108286	100.000	12108			

图204 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3726-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:29:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

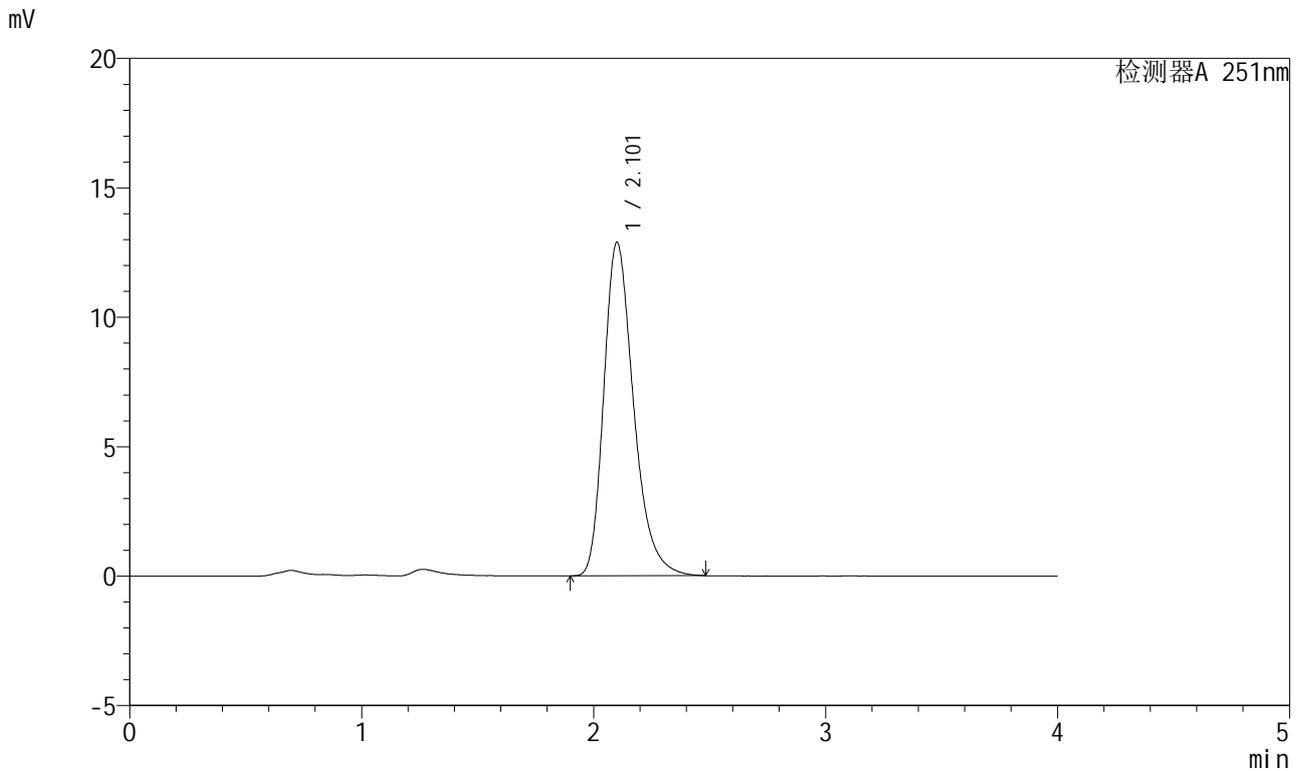

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	115179	100.000	12851	1331	1.301	--
总计		115179	100.000	12851			

图205 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3727-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:33:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

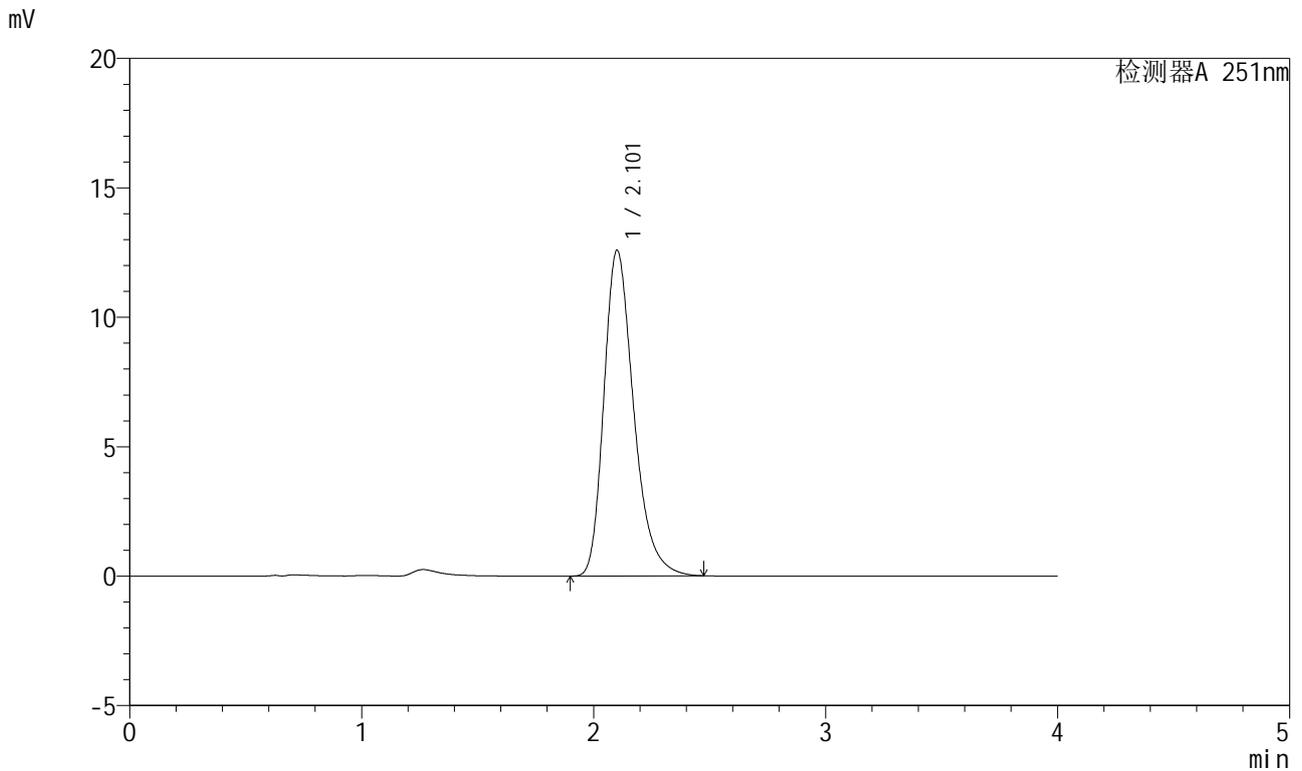

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	112418	100.000	12556	1331	1.300	--
总计		112418	100.000	12556			

图206 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3728-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:38:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

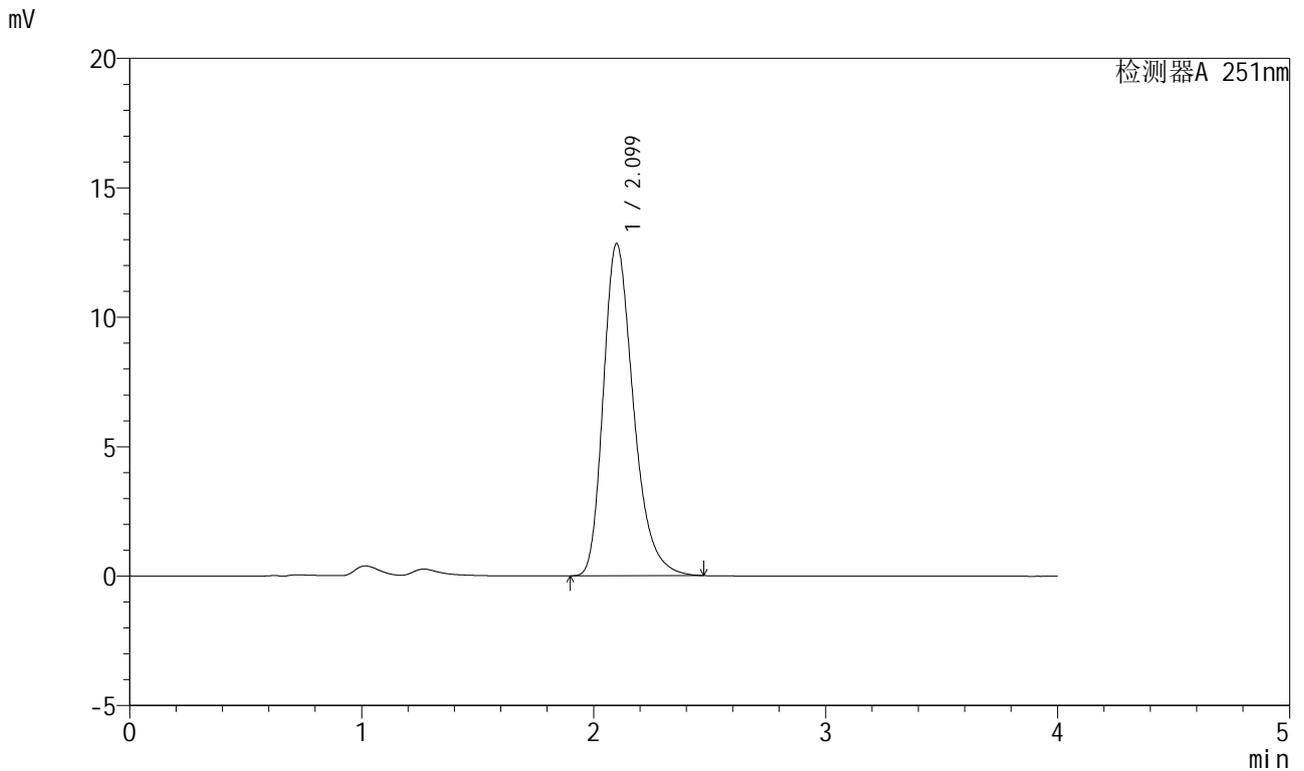

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	115775	100.000	12820	1301	1.298	--
总计		115775	100.000	12820			

图207 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3729-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:42:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

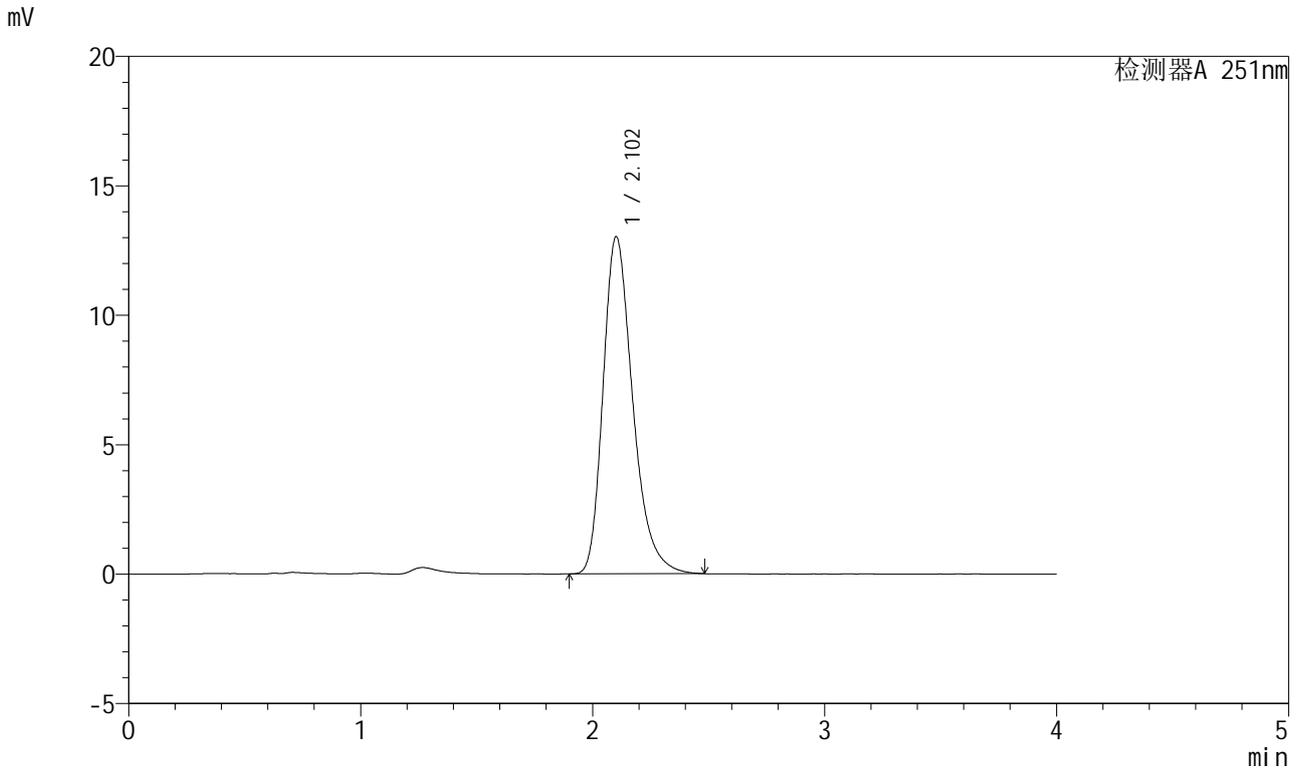

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	116003	100.000	13005	1344	1.303	--
总计		116003	100.000	13005			

图208 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3730-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:46:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

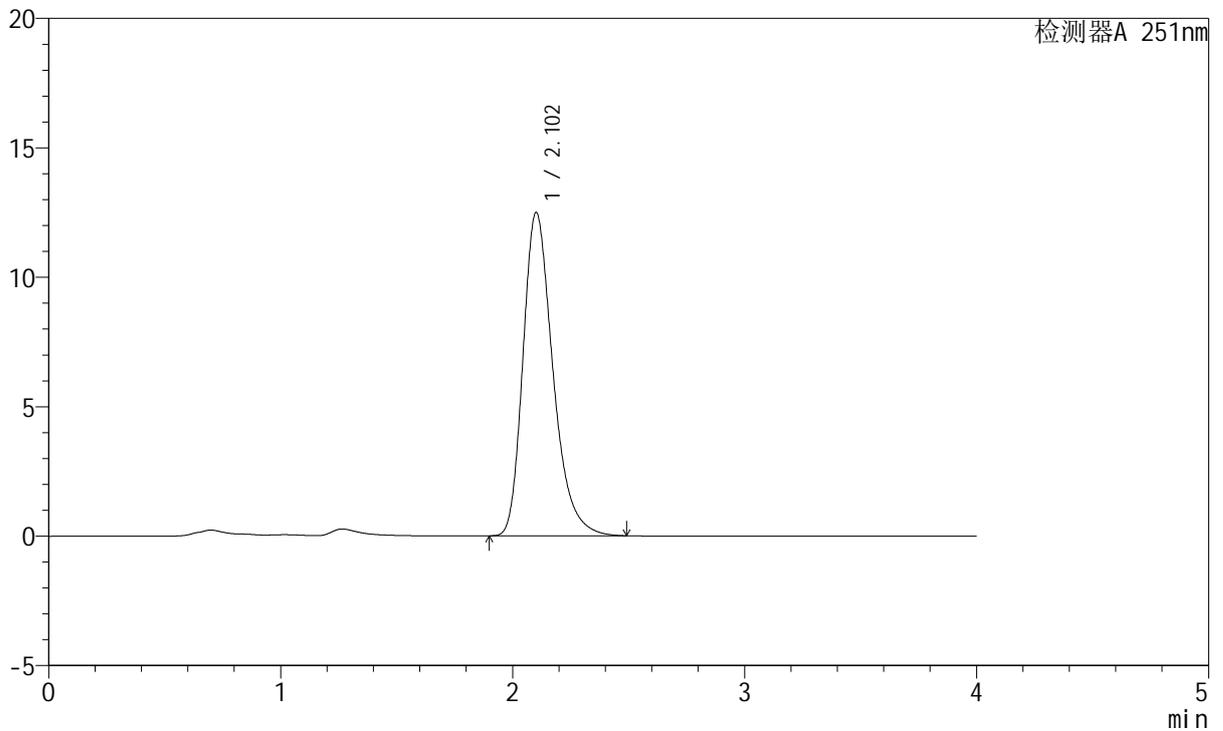

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	112159	100.000	12475	1321	1.303	--
总计		112159	100.000	12475			

图209 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3731-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:51:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

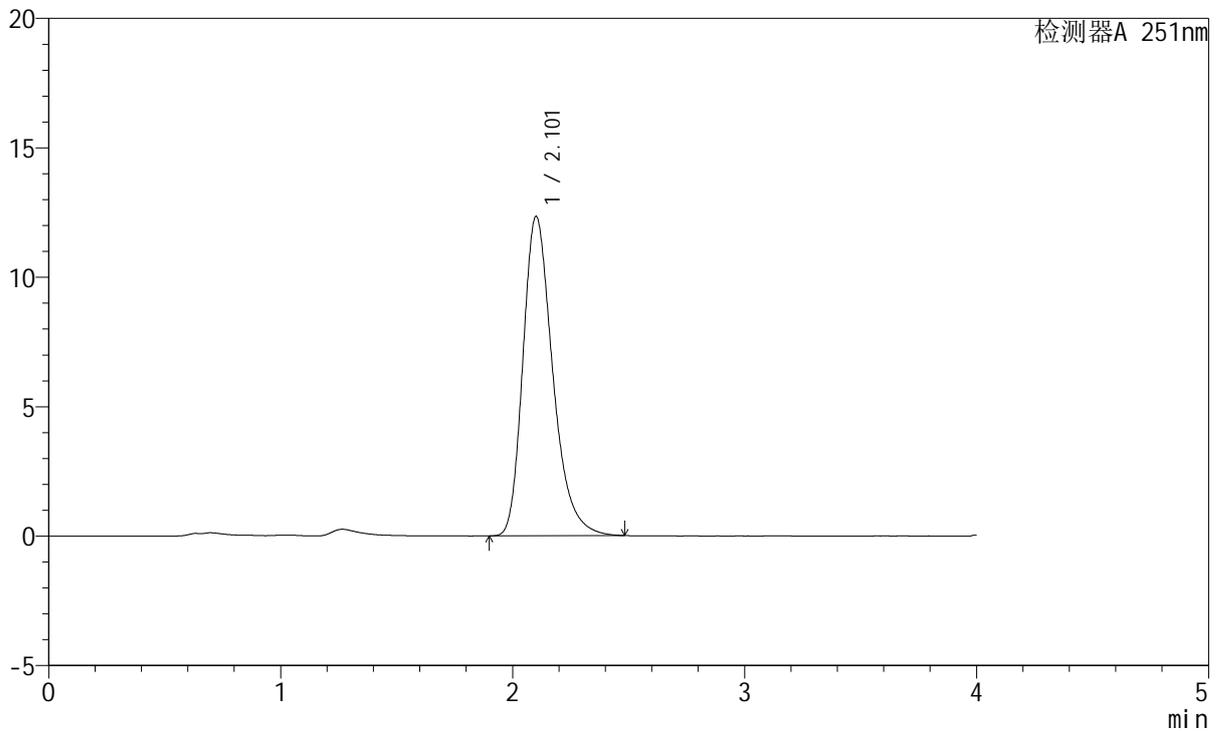

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	110386	100.000	12315	1331	1.302	--
总计		110386	100.000	12315			

图210 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3732-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 05:55:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

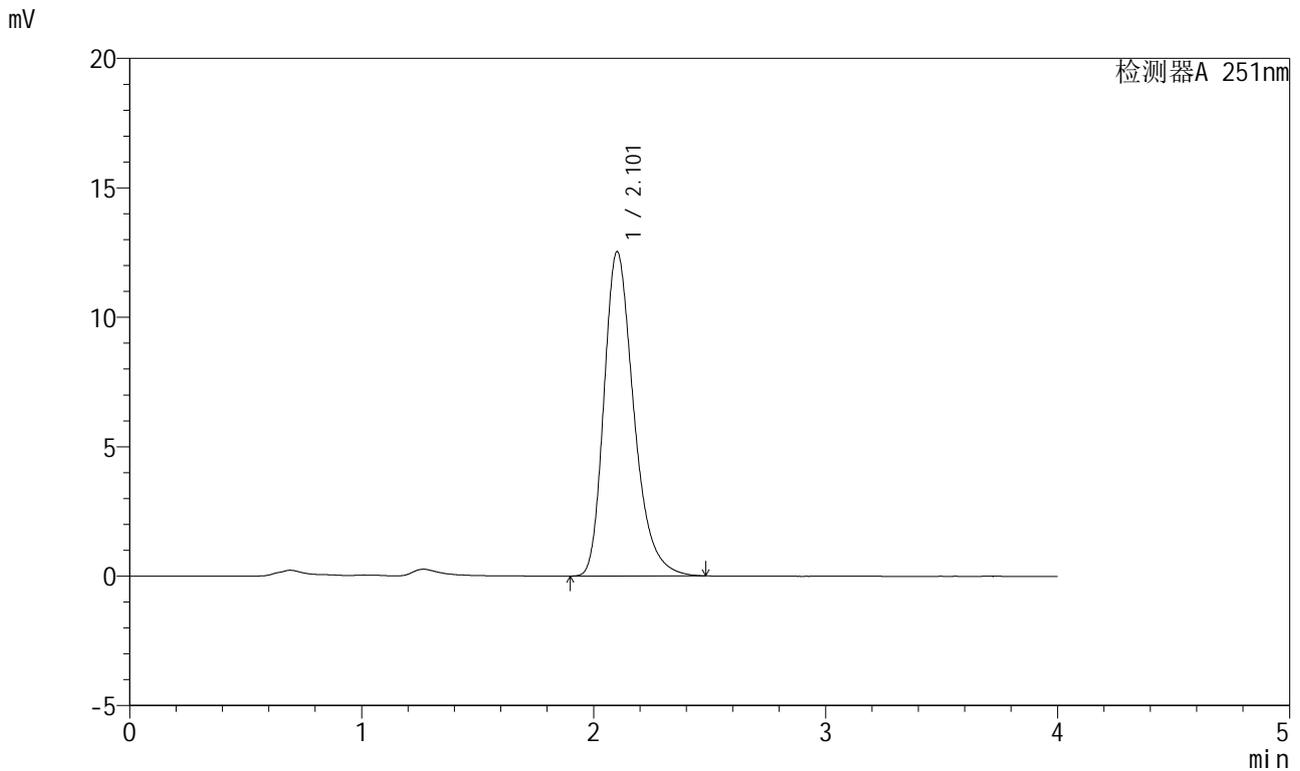

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	112012	100.000	12510	1332	1.304	--
总计		112012	100.000	12510			

图211 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3733-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:00:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

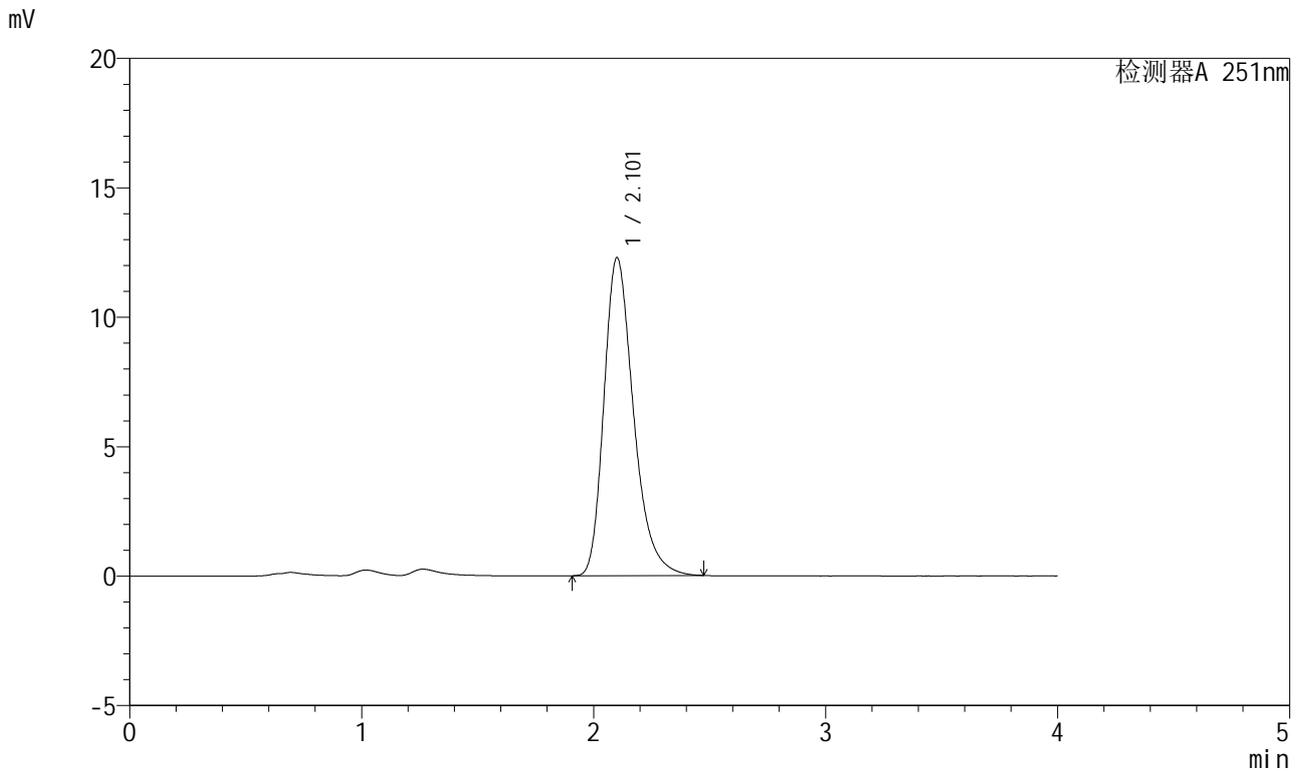

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	109128	100.000	12255	1347	1.303	--
总计		109128	100.000	12255			

图212 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3734-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:04:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

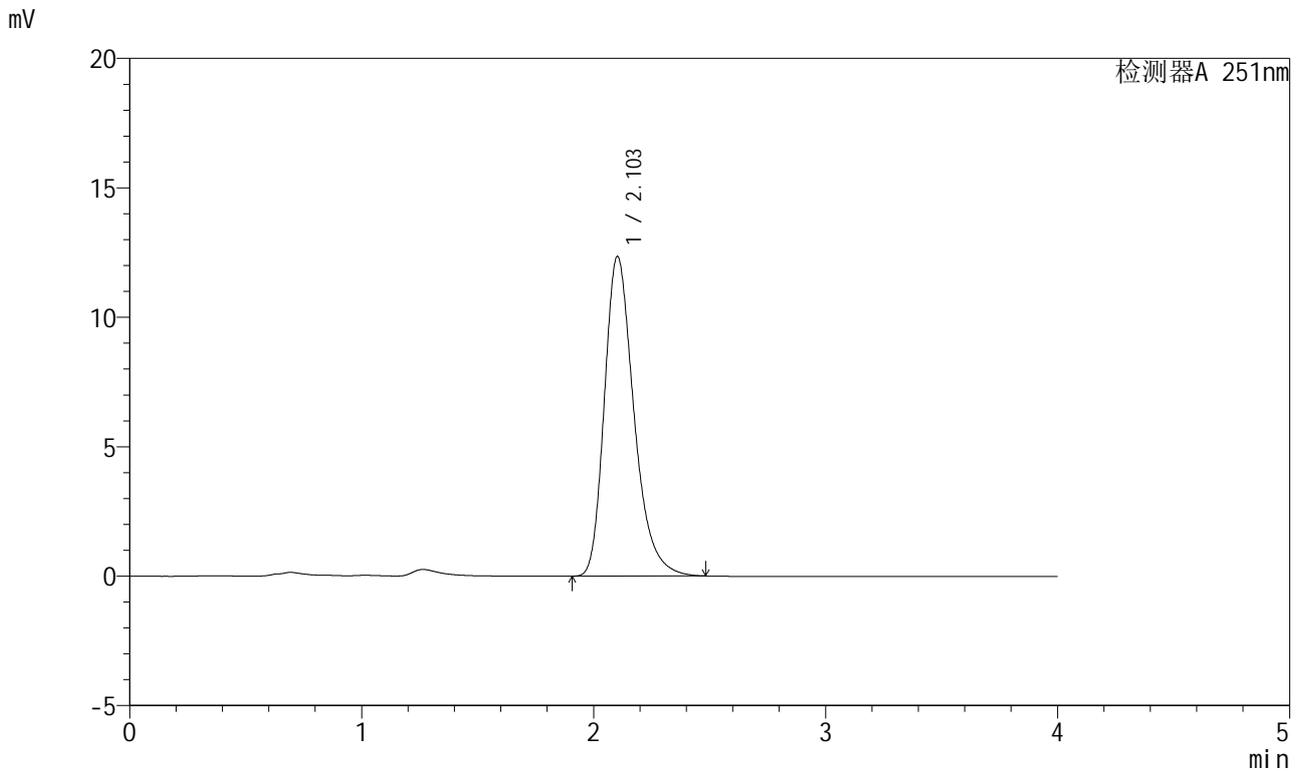

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	109471	100.000	12345	1359	1.302	--
总计		109471	100.000	12345			

图213 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3735-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:08:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

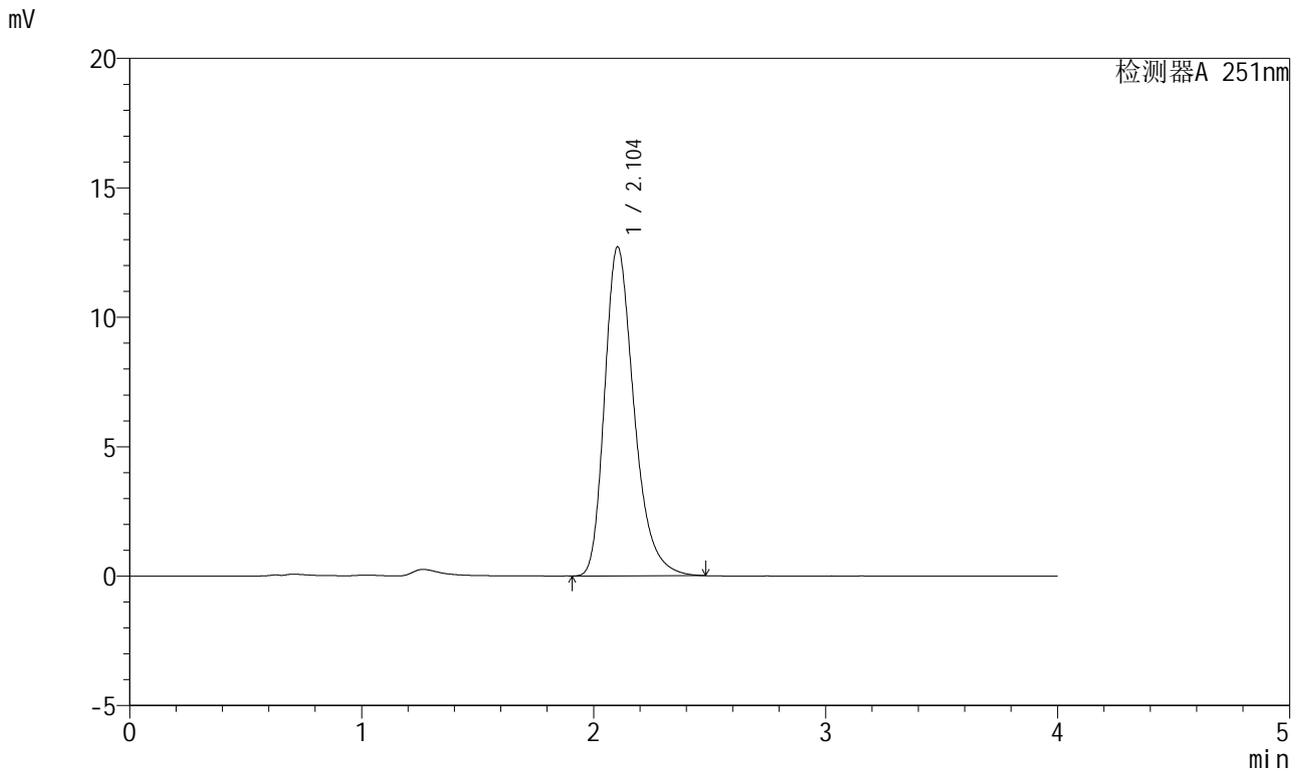

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	112128	100.000	12711	1375	1.302	--
总计		112128	100.000	12711			

图214 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3736-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:13:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

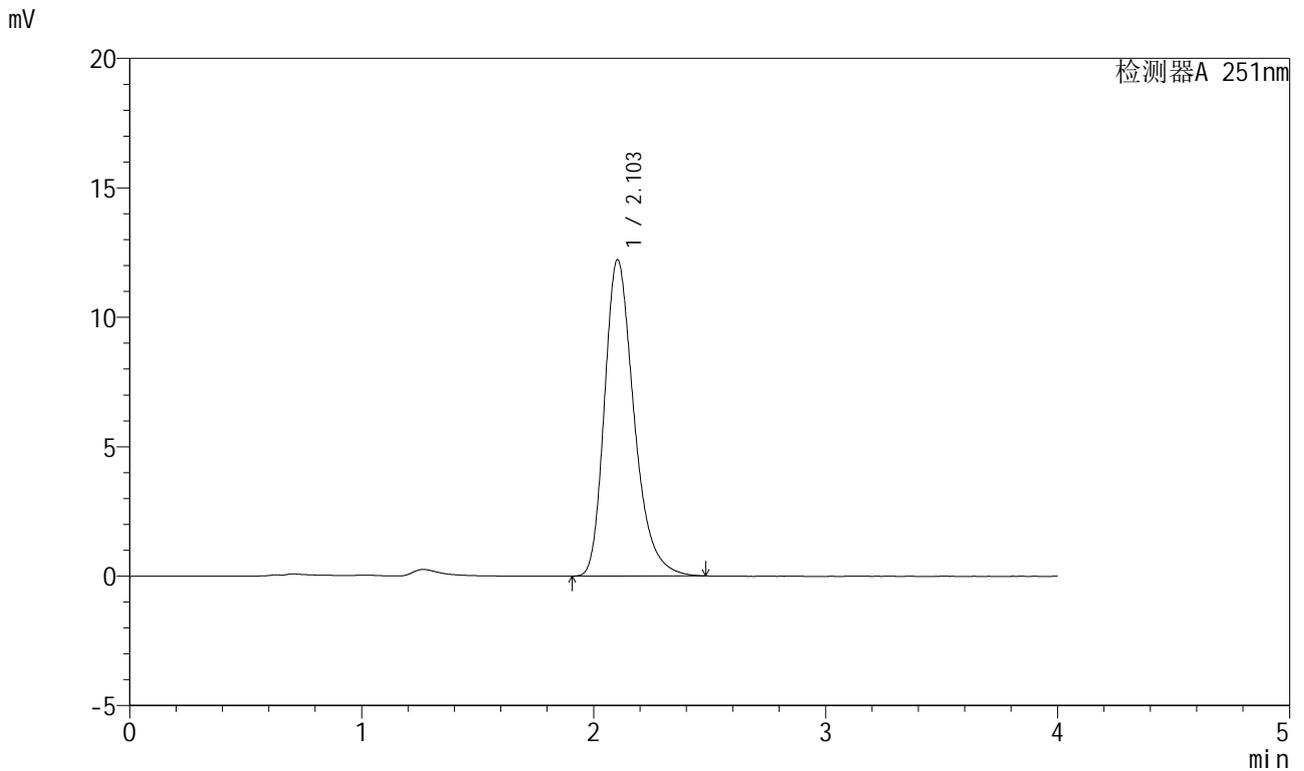

<峰表>

检测器A 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	108022	100.000	12220	1367	1.302	--
总计		108022	100.000	12220			

图215 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3737-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:17:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

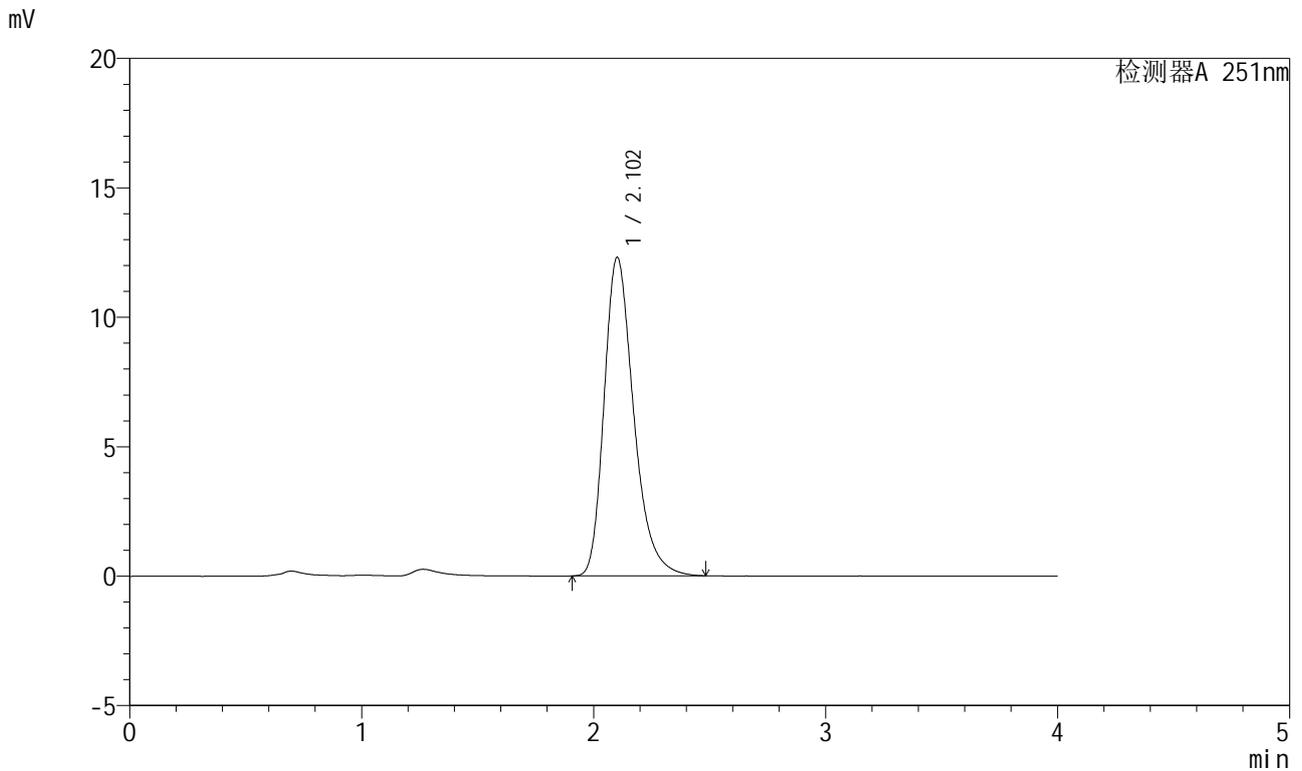

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	109152	100.000	12287	1355	1.300	--
总计		109152	100.000	12287			

图216 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3738-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:22:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

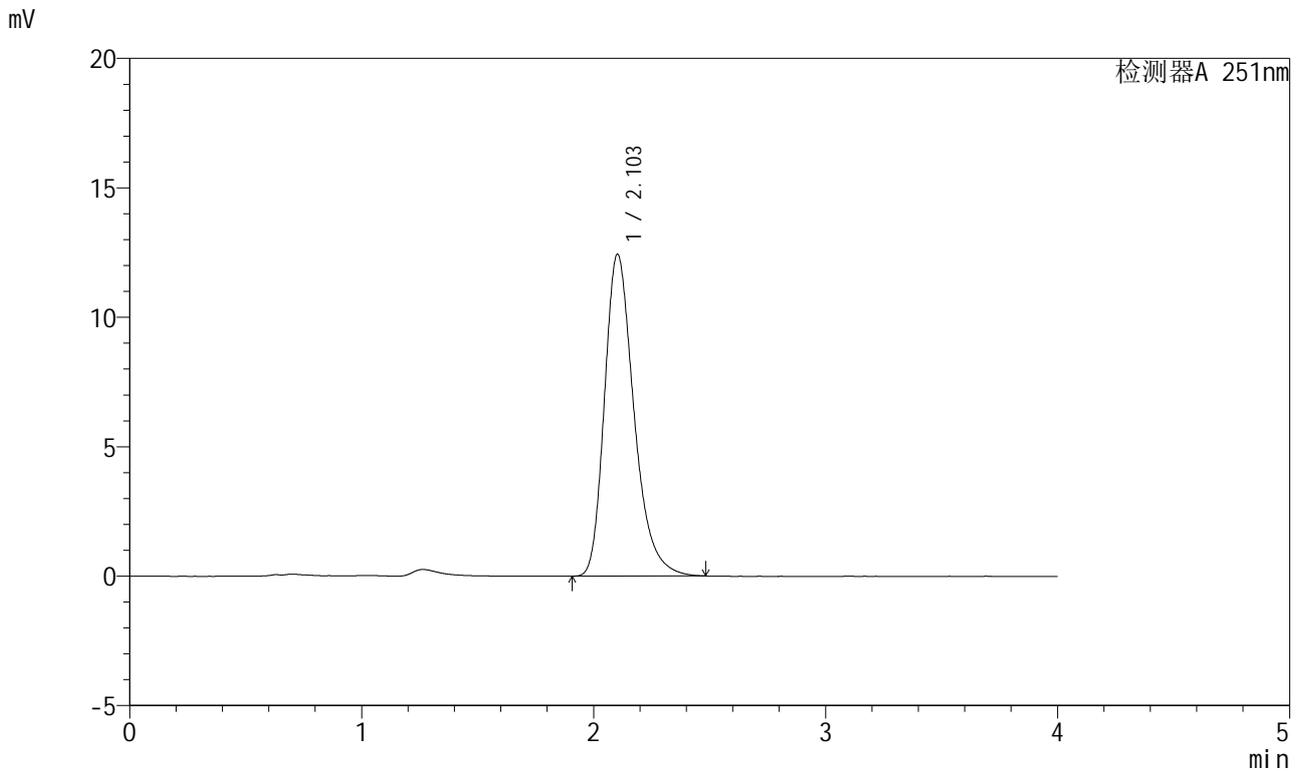

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	109966	100.000	12432	1367	1.303	--
总计		109966	100.000	12432			

图217 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3739-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:26:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

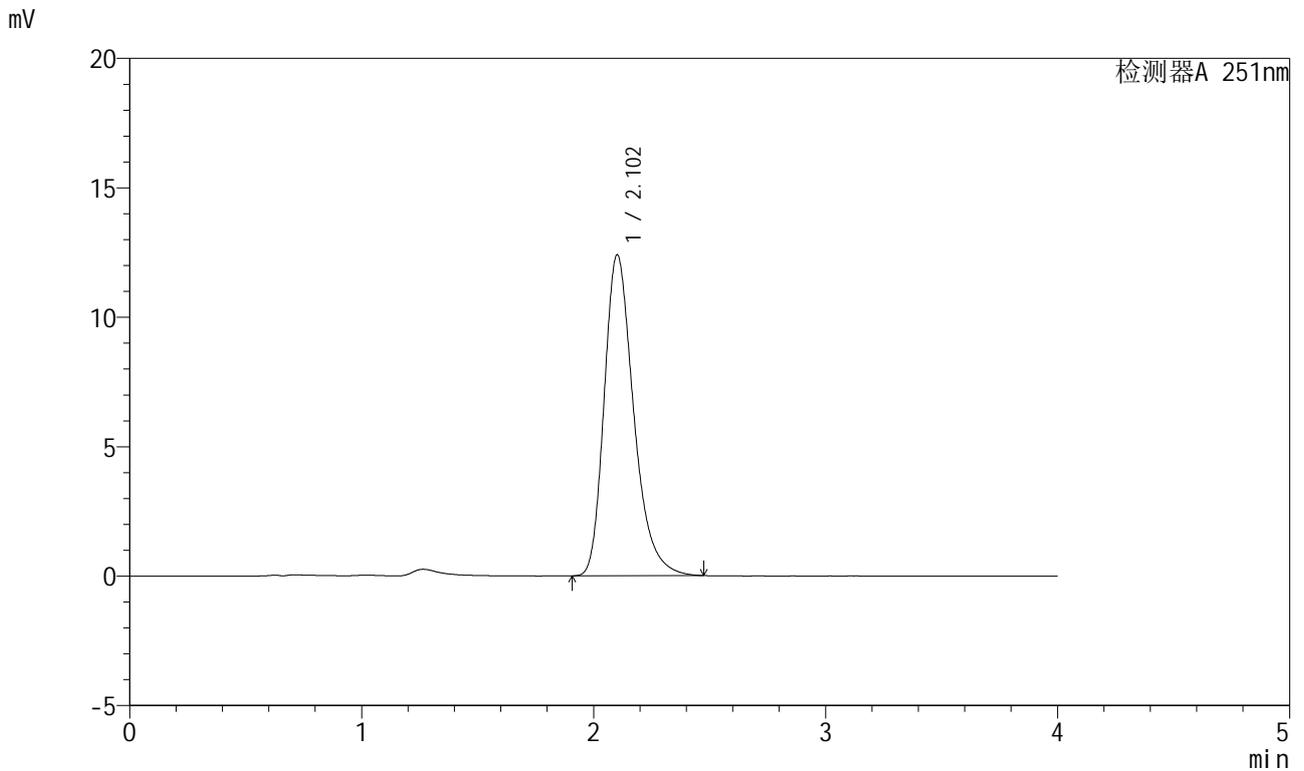

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	109686	100.000	12380	1363	1.303	--
总计		109686	100.000	12380			

图218 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3740-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:30:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

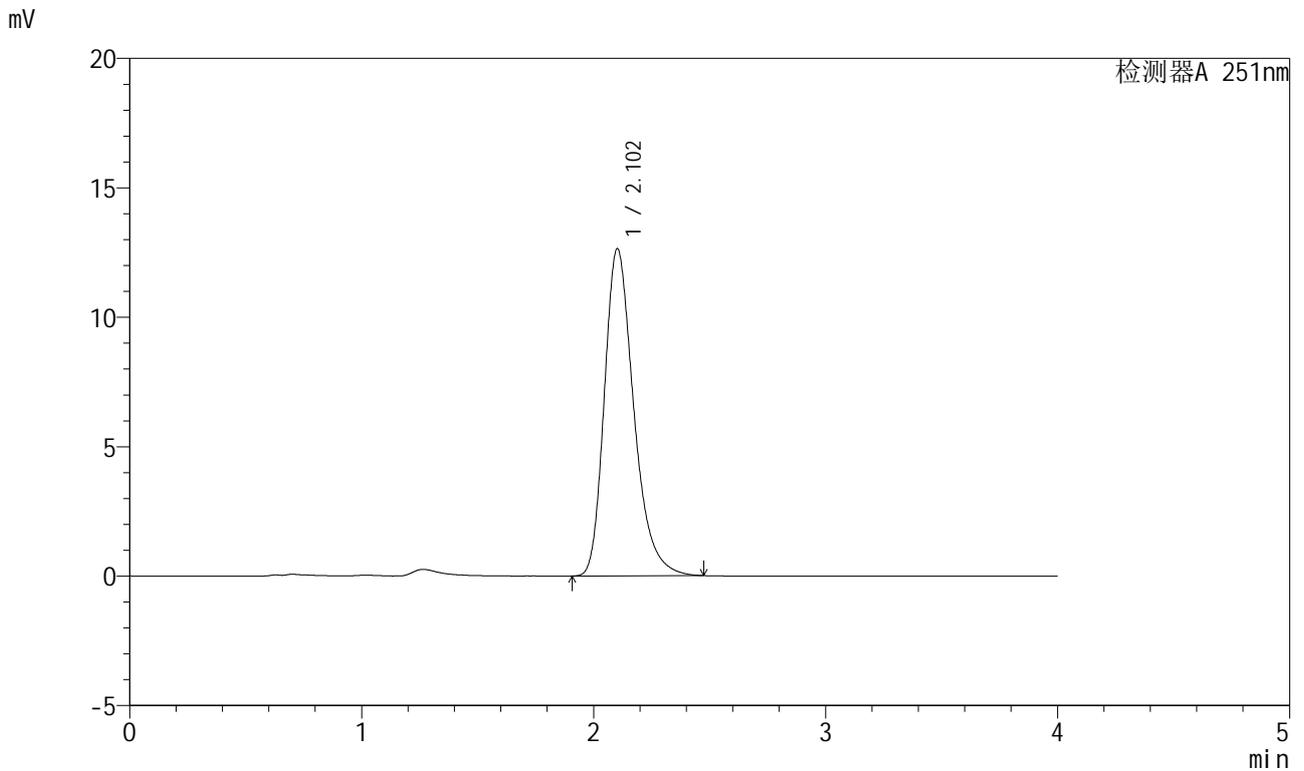

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	111492	100.000	12629	1371	1.301	--
总计		111492	100.000	12629			

图219 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3741-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:35:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

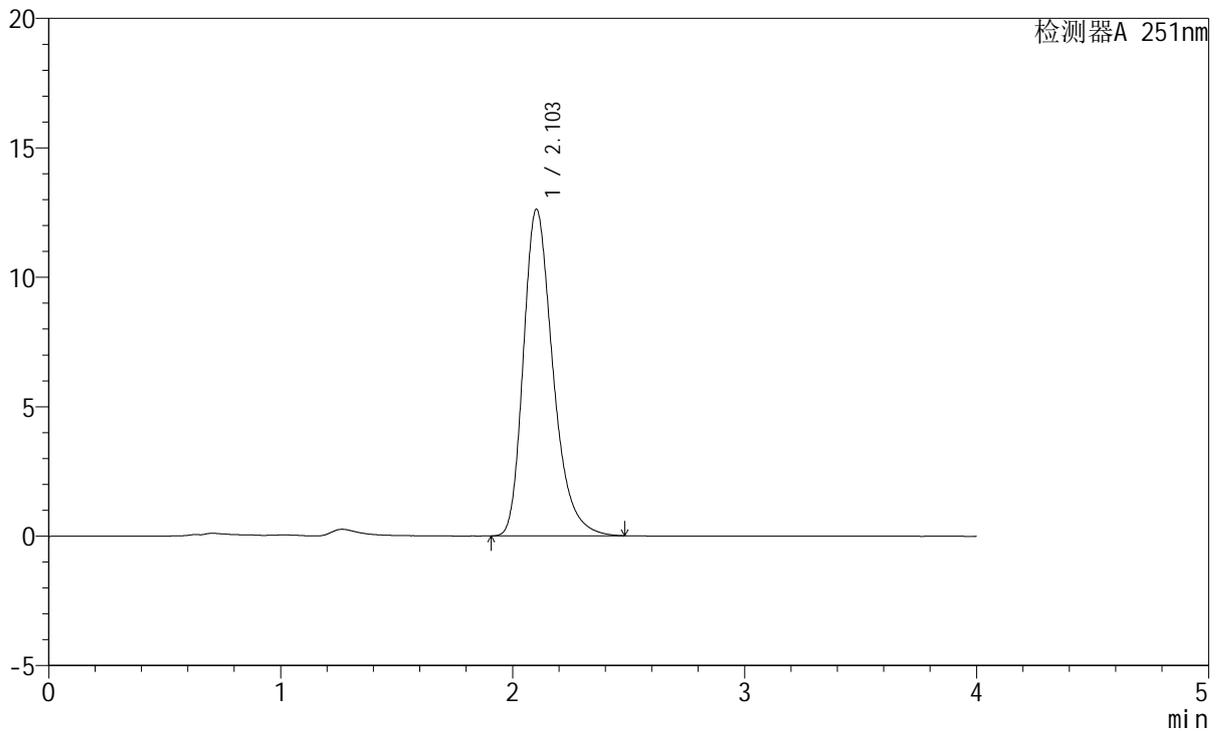

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	111766	100.000	12609	1359	1.301	--
总计		111766	100.000	12609			

图220 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-75/10-3743-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:44:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:10:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

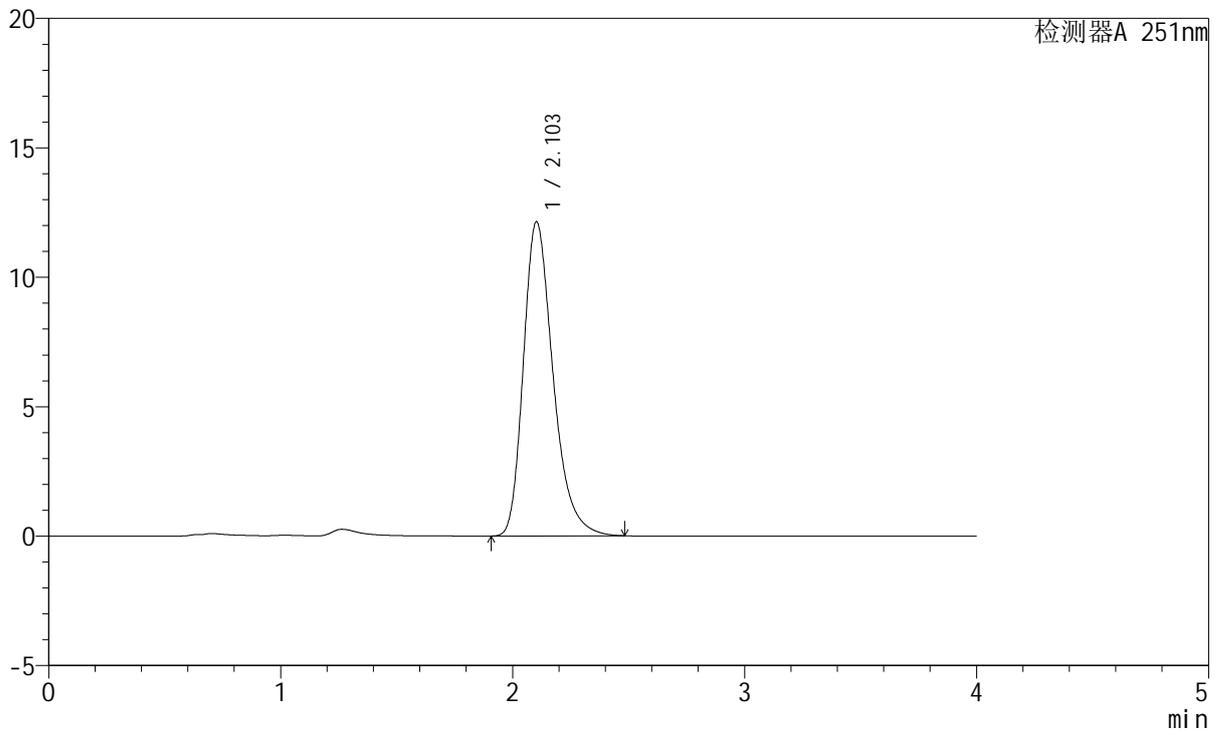

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	108029	100.000	12131	1348	1.303	--
总计		108029	100.000	12131			

图222 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-76/10-3744-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:48:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:18:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

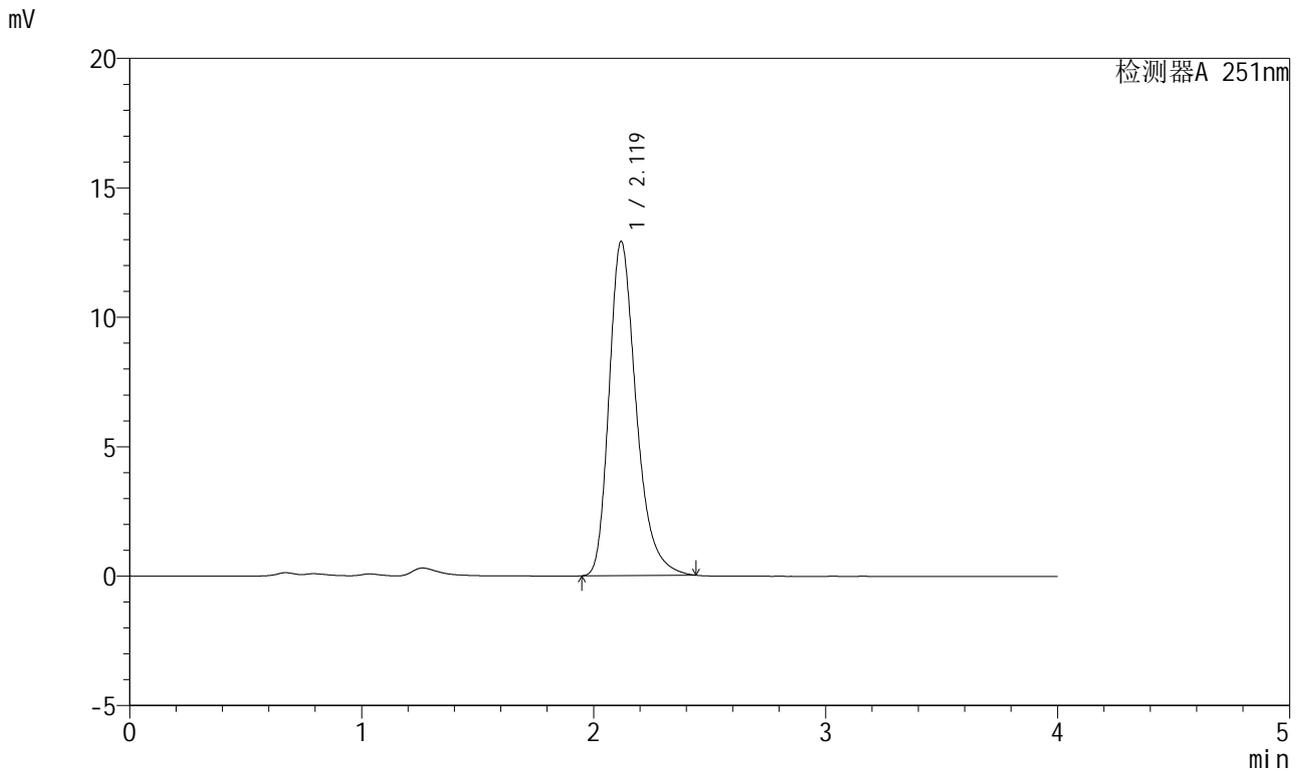

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	104933	100.000	12895	1655	1.301	--
总计		104933	100.000	12895			

图223 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-76/10-3745-2 - zzp-2023111821p-jyx2-zjtj9y-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-FX259.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240829-FX259.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/08/30 06:52:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/08/30 09:19:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

<色谱图>

mV

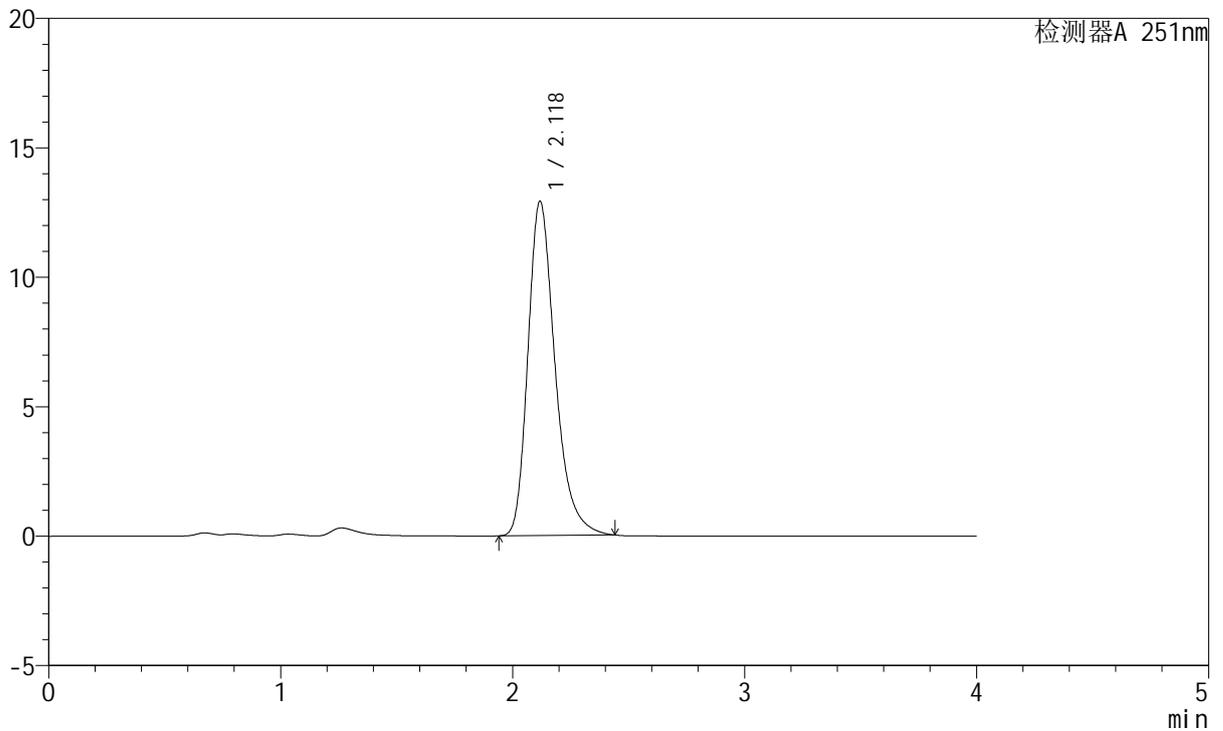

<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	105014	100.000	12888	1652	1.301	--
总计		105014	100.000	12888			

图224 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2