



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.14	36775	36928	36934	36920	37050	36921	0.27
2	11.39	38485	38602				38544	0.22

单位质量响应值		RSD%	判断
3314.27	3384.02	1.48	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20429	-	20429	54.734	53.71	14.16	54.73	53.71	14.16
	2	15858	-	15858	42.487			42.49		
	3	18273	-	18273	48.957			48.96		
	4	21142	-	21142	56.644			56.64		
	5	24312	-	24312	65.137			65.14		
	6	20273	-	20273	54.316			54.32		
10min	1	30935	-	30935	82.881	83.24	1.50	82.97	83.33	1.51
	2	30265	-	30265	81.086			81.16		
	3	31027	-	31027	83.128			83.21		
	4	31624	-	31624	84.727			84.82		
	5	31204	-	31204	83.602			83.71		
	6	31365	-	31365	84.033			84.12		
15min	1	33254	-	33254	89.094	88.72	1.61	89.32	88.95	1.60
	2	32979	-	32979	88.358			88.56		
	3	33632	-	33632	90.107			90.33		
	4	33564	-	33564	89.925			90.16		
	5	32165	-	32165	86.177			86.42		
	6	33090	-	33090	88.655			88.89		
20min	1	33988	-	33988	91.061	90.58	2.18	91.44	90.96	2.17
	2	33595	-	33595	90.008			90.36		
	3	34395	-	34395	92.151			92.52		
	4	34518	-	34518	92.481			92.87		
	5	32474	-	32474	87.005			87.40		
	6	33880	-	33880	90.772			91.15		
30min	1	34469	-	34469	92.350	91.56	2.01	92.88	92.08	2.00
	2	34375	-	34375	92.098			92.60		
	3	34755	-	34755	93.116			93.64		
	4	34466	-	34466	92.342			92.88		
	5	32833	-	32833	87.967			88.50		
	6	34136	-	34136	91.458			91.99		
45min	1	34931	-	34931	93.588	93.01	1.08	94.27	93.69	1.07
	2	34612	-	34612	92.733			93.39		
	3	35200	-	35200	94.308			94.99		
	4	34849	-	34849	93.368			94.06		
	5	34107	-	34107	91.380			92.06		
	6	34591	-	34591	92.677			93.36		
60min	1	35111	-	35111	94.070	93.34	2.02	94.91	94.17	2.00
	2	35059	-	35059	93.930			94.74		
	3	35381	-	35381	94.793			95.63		
	4	35098	-	35098	94.035			94.88		
	5	33433	-	33433	89.574			90.41		
	6	34942	-	34942	93.617			94.45		
极限	1	35202	-	35202	94.314	93.69	2.05	95.31	94.68	2.03
	2	35165	-	35165	94.214			95.18		
	3	35558	-	35558	95.267			96.26		
	4	35233	-	35233	94.397			95.40		
	5	33549	-	33549	89.885			90.87		
	6	35110	-	35110	94.067			95.06		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.11	267283	266766	267464	267270	267465	267250	0.11
2	11.31	277445	277632				277538	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
24054.91	24539.17	1.41	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	168537	-	168537	62.372	61.71	14.20	62.37	61.70	14.20
	2	130338	-	130338	48.236			48.24		
	3	153807	-	153807	56.921			56.92		
	4	175022	-	175022	64.772			64.77		
	5	201626	-	201626	74.618			74.62		
	6	171080	-	171080	63.314			63.31		
10min	1	242866	-	242866	89.880	90.17	1.58	89.98	90.27	1.59
	2	237808	-	237808	88.008			88.09		
	3	246575	-	246575	91.253			91.35		
	4	245812	-	245812	90.971			91.08		
	5	240862	-	240862	89.139			89.26		
	6	247918	-	247918	91.750			91.86		
15min	1	257311	-	257311	95.226	94.51	2.09	95.48	94.76	2.08
	2	252454	-	252454	93.429			93.66		
	3	261434	-	261434	96.752			97.00		
	4	256788	-	256788	95.033			95.29		
	5	246215	-	246215	91.120			91.39		
	6	258003	-	258003	95.482			95.74		
20min	1	261859	-	261859	96.909	95.87	2.58	97.32	96.28	2.57
	2	256059	-	256059	94.763			95.15		
	3	263679	-	263679	97.583			97.99		
	4	263423	-	263423	97.488			97.91		
	5	246702	-	246702	91.300			91.72		
	6	262578	-	262578	97.175			97.59		
30min	1	264339	-	264339	97.827	96.45	2.68	98.40	97.02	2.66
	2	257870	-	257870	95.433			95.97		
	3	265560	-	265560	98.279			98.85		
	4	260992	-	260992	96.588			97.17		
	5	248081	-	248081	91.810			92.39		
	6	266891	-	266891	98.772			99.35		
45min	1	267090	-	267090	98.845	97.30	2.90	99.58	98.03	2.89
	2	260419	-	260419	96.376			97.08		
	3	267871	-	267871	99.134			99.87		
	4	262373	-	262373	97.099			97.84		
	5	249289	-	249289	92.257			92.99		
	6	270384	-	270384	100.064			100.81		
60min	1	267217	-	267217	98.892	97.54	3.15	99.79	98.43	3.13
	2	260920	-	260920	96.562			97.42		
	3	268957	-	268957	99.536			100.44		
	4	262776	-	262776	97.249			98.15		
	5	248976	-	248976	92.142			93.03		
	6	272522	-	272522	100.855			101.77		
极限	1	267408	-	267408	98.963	97.52	3.20	100.03	98.57	3.17
	2	261063	-	261063	96.615			97.64		
	3	269181	-	269181	99.619			100.68		
	4	263022	-	263022	97.340			98.41		
	5	248377	-	248377	91.920			92.96		
	6	271926	-	271926	100.635			101.71		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.14	37421	37517	37483	37644	37537	37520	0.22
2	11.39	38226	38101				38164	0.24
单位质量响应值			RSD%	判断				
3368.04			0.37	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20238	-	20238	54.052	60.52	7.45	54.05	60.52	7.45
	2	23980	-	23980	64.046			64.05		
	3	23636	-	23636	63.127			63.13		
	4	24216	-	24216	64.676			64.68		
	5	20892	-	20892	55.798			55.80		
	6	22992	-	22992	61.407			61.41		
10min	1	30406	-	30406	81.208	84.94	2.60	81.30	85.05	2.60
	2	32679	-	32679	87.279			87.39		
	3	31841	-	31841	85.041			85.15		
	4	32299	-	32299	86.264			86.37		
	5	31333	-	31333	83.684			83.78		
	6	32270	-	32270	86.187			86.29		
15min	1	32992	-	32992	88.115	89.71	1.25	88.34	89.96	1.25
	2	33374	-	33374	89.135			89.39		
	3	33506	-	33506	89.488			89.73		
	4	34099	-	34099	91.072			91.32		
	5	33538	-	33538	89.573			89.81		
	6	34036	-	34036	90.903			91.15		
20min	1	33617	-	33617	89.784	91.27	1.32	90.16	91.67	1.32
	2	33768	-	33768	90.188			90.59		
	3	34071	-	34071	90.997			91.39		
	4	34756	-	34756	92.826			93.23		
	5	34242	-	34242	91.454			91.84		
	6	34592	-	34592	92.388			92.79		
30min	1	34156	-	34156	91.224	92.47	1.30	91.75	93.01	1.30
	2	34173	-	34173	91.269			91.82		
	3	34387	-	34387	91.841			92.39		
	4	35165	-	35165	93.919			94.48		
	5	34757	-	34757	92.829			93.36		
	6	35087	-	35087	93.710			94.26		
45min	1	34586	-	34586	92.372	93.53	1.18	93.05	94.23	1.18
	2	34645	-	34645	92.530			93.23		
	3	34773	-	34773	92.872			93.57		
	4	35569	-	35569	94.998			95.71		
	5	35157	-	35157	93.897			94.59		
	6	35396	-	35396	94.536			95.24		
60min	1	34924	-	34924	93.275	94.03	1.05	94.10	94.88	1.06
	2	34838	-	34838	93.045			93.90		
	3	34946	-	34946	93.334			94.19		
	4	35771	-	35771	95.537			96.41		
	5	35271	-	35271	94.202			95.05		
	6	35480	-	35480	94.760			95.63		
极限	1	34904	-	34904	93.222	94.39	1.26	94.21	95.40	1.26
	2	35002	-	35002	93.483			94.50		
	3	35054	-	35054	93.622			94.63		
	4	35947	-	35947	96.007			97.04		
	5	35329	-	35329	94.357			95.36		
	6	35817	-	35817	95.660			96.68		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.11	274058	274395	273665	273671	273242	273806	0.16
2	11.31	277347	276623				276985	0.19
单位质量响应值				RSD%	判断			
24645.00				0.45	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	170217	-	170217	62.295	69.72	7.39	62.29	69.72	7.39
	2	201129	-	201129	73.608			73.61		
	3	197388	-	197388	72.239			72.24		
	4	205522	-	205522	75.215			75.22		
	5	176758	-	176758	64.689			64.69		
	6	192052	-	192052	70.286			70.29		
10min	1	240381	-	240381	87.973	91.47	2.07	88.08	91.58	2.07
	2	249997	-	249997	91.492			91.61		
	3	250976	-	250976	91.850			91.97		
	4	254567	-	254567	93.165			93.29		
	5	249357	-	249357	91.258			91.37		
	6	254322	-	254322	93.075			93.19		
15min	1	256201	-	256201	93.763	95.59	1.47	94.01	95.86	1.48
	2	258786	-	258786	94.709			94.98		
	3	259219	-	259219	94.867			95.14		
	4	266816	-	266816	97.647			97.93		
	5	263116	-	263116	96.293			96.55		
	6	263063	-	263063	96.274			96.55		
20min	1	259788	-	259788	95.075	96.47	1.43	95.48	96.90	1.43
	2	260227	-	260227	95.236			95.67		
	3	261991	-	261991	95.882			96.31		
	4	269672	-	269672	98.693			99.14		
	5	265806	-	265806	97.278			97.70		
	6	264052	-	264052	96.636			97.07		
30min	1	263521	-	263521	96.442	97.25	1.52	97.01	97.84	1.52
	2	261574	-	261574	95.729			96.32		
	3	262826	-	262826	96.187			96.78		
	4	272066	-	272066	99.569			100.18		
	5	268927	-	268927	98.420			99.00		
	6	265492	-	265492	97.163			97.76		
45min	1	265509	-	265509	97.169	97.56	1.68	97.90	98.31	1.67
	2	262058	-	262058	95.906			96.66		
	3	262989	-	262989	96.247			97.00		
	4	273405	-	273405	100.059			100.83		
	5	270556	-	270556	99.016			99.76		
	6	264891	-	264891	96.943			97.70		
60min	1	267547	-	267547	97.915	97.65	1.79	98.80	98.56	1.78
	2	262268	-	262268	95.983			96.89		
	3	262216	-	262216	95.964			96.88		
	4	273312	-	273312	100.025			100.97		
	5	271428	-	271428	99.335			100.25		
	6	264171	-	264171	96.679			97.60		
极限	1	265379	-	265379	97.122	97.46	1.77	98.17	98.53	1.76
	2	261535	-	261535	95.715			96.79		
	3	261608	-	261608	95.741			96.81		
	4	272404	-	272404	99.692			100.80		
	5	271481	-	271481	99.355			100.43		
	6	265369	-	265369	97.118			98.20		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.14	38241	38269	38239	38310	38446	38301	0.23
2	11.39	38856	39001				38928	0.27
单位质量响应值				RSD%	判断			
3438.15		3417.73		0.43	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19779	-	19779	51.769	46.61	20.53	51.77	46.61	20.52
	2	20074	-	20074	52.541			52.54		
	3	17990	-	17990	47.086			47.09		
	4	10555	-	10555	27.626			27.63		
	5	18489	-	18489	48.392			48.39		
	6	19968	-	19968	52.264			52.26		
10min	1	31324	-	31324	81.986	78.93	4.55	82.07	79.00	4.57
	2	30714	-	30714	80.390			80.48		
	3	29780	-	29780	77.945			78.02		
	4	27676	-	27676	72.438			72.48		
	5	30084	-	30084	78.741			78.82		
	6	31349	-	31349	82.052			82.14		
15min	1	33628	-	33628	88.017	85.67	2.16	88.24	85.88	2.18
	2	32810	-	32810	85.876			86.10		
	3	32784	-	32784	85.808			86.02		
	4	31569	-	31569	82.628			82.79		
	5	32403	-	32403	84.810			85.02		
	6	33190	-	33190	86.870			87.09		
20min	1	34364	-	34364	89.943	87.81	1.50	90.31	88.16	1.51
	2	33413	-	33413	87.454			87.82		
	3	33736	-	33736	88.299			88.65		
	4	33071	-	33071	86.559			86.86		
	5	33011	-	33011	86.402			86.76		
	6	33705	-	33705	88.218			88.59		
30min	1	34977	-	34977	91.548	89.29	1.53	92.07	89.79	1.53
	2	33846	-	33846	88.587			89.10		
	3	34300	-	34300	89.776			90.27		
	4	34142	-	34142	89.362			89.81		
	5	33406	-	33406	87.436			87.93		
	6	34025	-	34025	89.056			89.57		
45min	1	35249	-	35249	92.260	90.34	1.41	92.93	90.98	1.41
	2	34384	-	34384	89.995			90.65		
	3	34737	-	34737	90.919			91.57		
	4	34604	-	34604	90.571			91.17		
	5	33789	-	33789	88.438			89.08		
	6	34325	-	34325	89.841			90.51		
60min	1	35502	-	35502	92.922	90.88	1.38	93.75	91.68	1.37
	2	34418	-	34418	90.084			90.89		
	3	34791	-	34791	91.061			91.86		
	4	34903	-	34903	91.354			92.10		
	5	34105	-	34105	89.265			90.06		
	6	34612	-	34612	90.592			91.41		
极限	1	35635	-	35635	93.270	91.19	1.45	94.25	92.14	1.44
	2	34513	-	34513	90.333			91.29		
	3	35034	-	35034	91.697			92.65		
	4	34909	-	34909	91.370			92.27		
	5	34148	-	34148	89.378			90.32		
	6	34799	-	34799	91.082			92.05		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.11	282174	281764	281074	280817	280807	281327	0.22
2	11.31	282813	283086				282950	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
25321.96				0.86	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	164851	-	164851	58.889	53.16	20.19	58.89	53.16	20.19
	2	166931	-	166931	59.632			59.63		
	3	152058	-	152058	54.319			54.32		
	4	88905	-	88905	31.759			31.76		
	5	154084	-	154084	55.043			55.04		
	6	166123	-	166123	59.344			59.34		
10min	1	246436	-	246436	88.033	85.35	3.72	88.13	85.44	3.73
	2	242836	-	242836	86.747			86.85		
	3	237387	-	237387	84.801			84.89		
	4	223233	-	223233	79.745			79.80		
	5	236515	-	236515	84.489			84.58		
	6	247165	-	247165	88.294			88.39		
15min	1	260326	-	260326	92.995	90.77	1.70	93.24	91.00	1.71
	2	253887	-	253887	90.695			90.94		
	3	256448	-	256448	91.610			91.84		
	4	248264	-	248264	88.686			88.87		
	5	250509	-	250509	89.488			89.72		
	6	255097	-	255097	91.127			91.37		
20min	1	264063	-	264063	94.330	92.35	1.59	94.73	92.73	1.59
	2	256429	-	256429	91.603			92.00		
	3	262390	-	262390	93.733			94.12		
	4	257924	-	257924	92.137			92.47		
	5	252800	-	252800	90.307			90.69		
	6	257502	-	257502	91.987			92.38		
30min	1	274511	-	274511	98.063	93.89	2.62	98.62	94.43	2.61
	2	259629	-	259629	92.746			93.29		
	3	265700	-	265700	94.915			95.46		
	4	263846	-	263846	94.253			94.74		
	5	255038	-	255038	91.106			91.64		
	6	258339	-	258339	92.286			92.84		
45min	1	268323	-	268323	95.852	94.02	2.02	96.57	94.71	2.00
	2	261427	-	261427	93.389			94.09		
	3	268262	-	268262	95.830			96.53		
	4	266483	-	266483	95.195			95.84		
	5	255690	-	255690	91.339			92.02		
	6	258943	-	258943	92.501			93.21		
60min	1	268721	-	268721	95.994	94.24	2.05	96.87	95.08	2.03
	2	262563	-	262563	93.794			94.65		
	3	268579	-	268579	95.944			96.80		
	4	267846	-	267846	95.682			96.48		
	5	256340	-	256340	91.571			92.41		
	6	258777	-	258777	92.442			93.30		
极限	1	268843	-	268843	96.038	94.09	1.96	97.08	95.10	1.95
	2	262694	-	262694	93.841			94.86		
	3	267303	-	267303	95.488			96.51		
	4	266797	-	266797	95.307			96.27		
	5	256000	-	256000	91.450			92.44		
	6	258784	-	258784	92.445			93.46		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-345-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:29:57
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

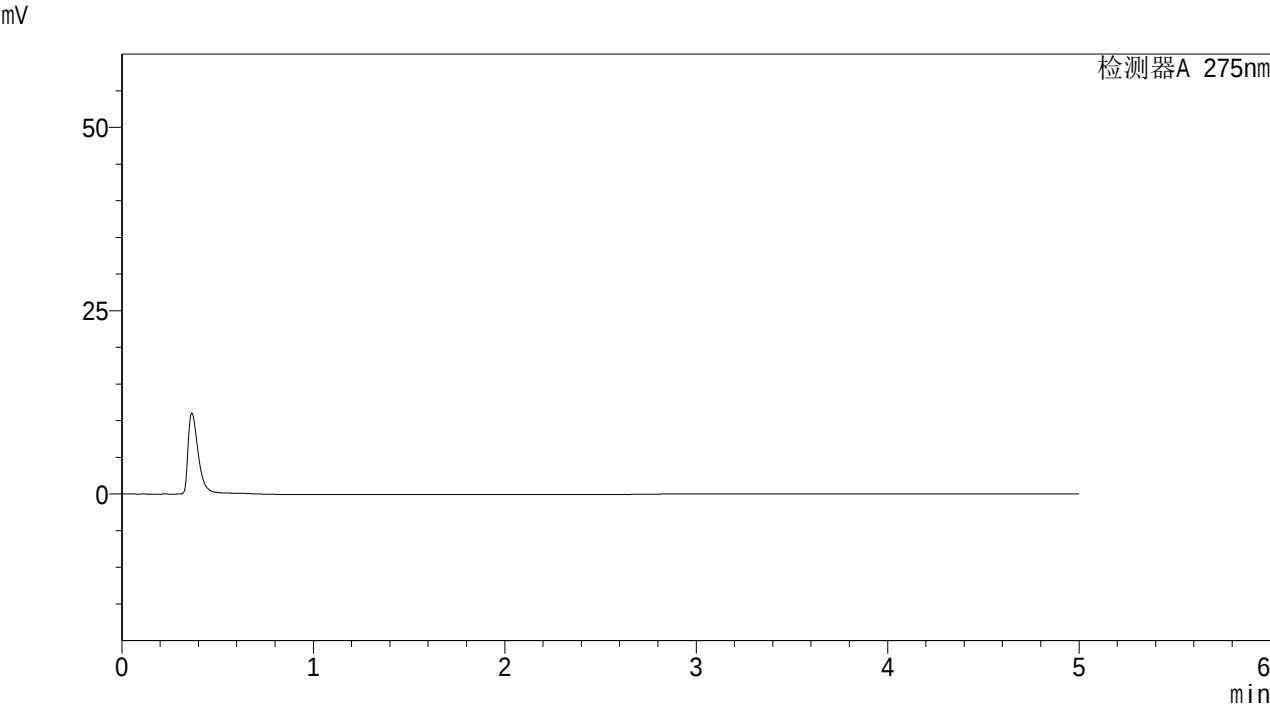

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-346-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:35:21
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

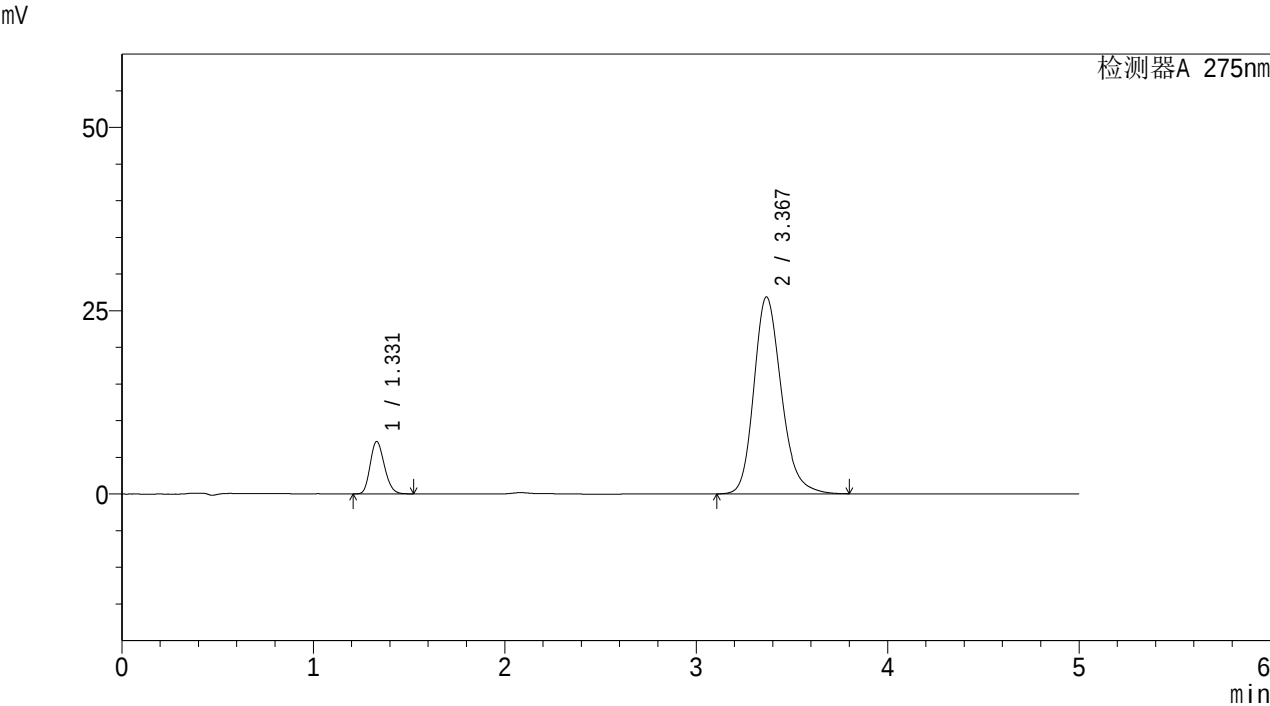

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	36775	12.095	7152	1537	1.190	--
2	3.367	267283	87.905	26825	2756	1.213	10.379
总计		304057	100.000	33977			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-347-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 16:40:44

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

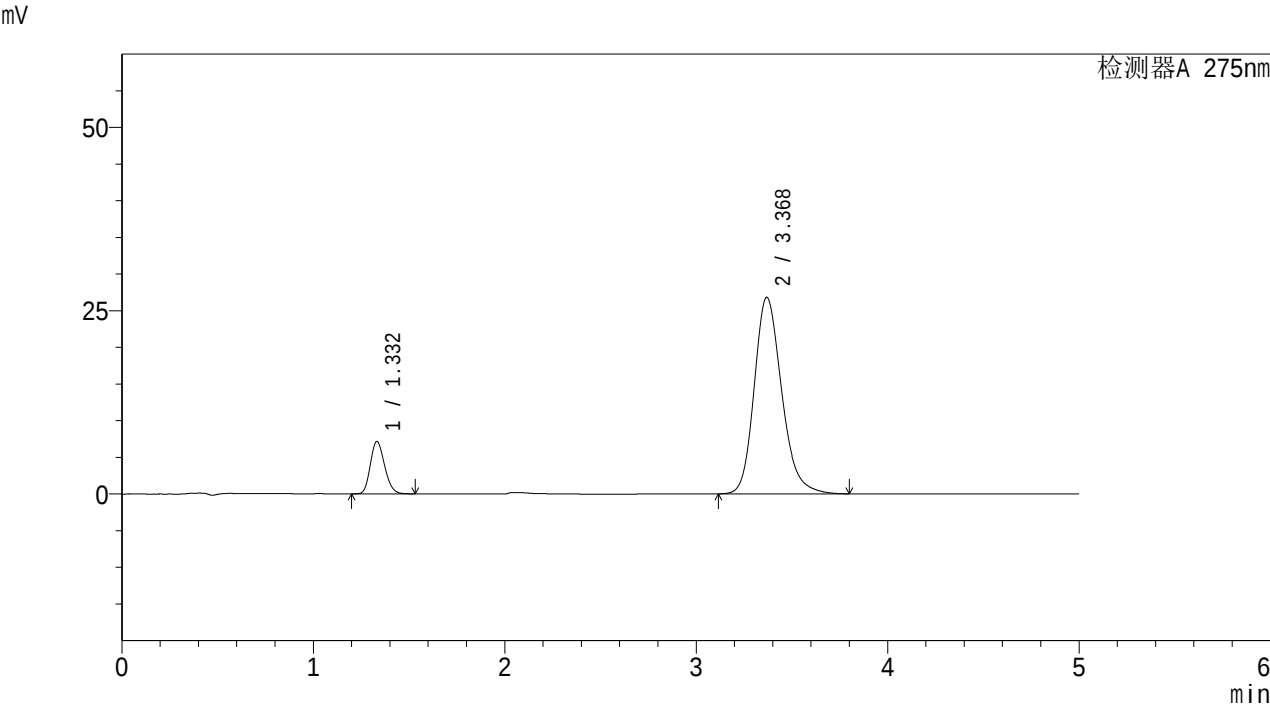

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	36928	12.160	7145	1527	1.187	--
2	3.368	266766	87.840	26781	2759	1.212	10.369
总计		303695	100.000	33925			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-348-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:46:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

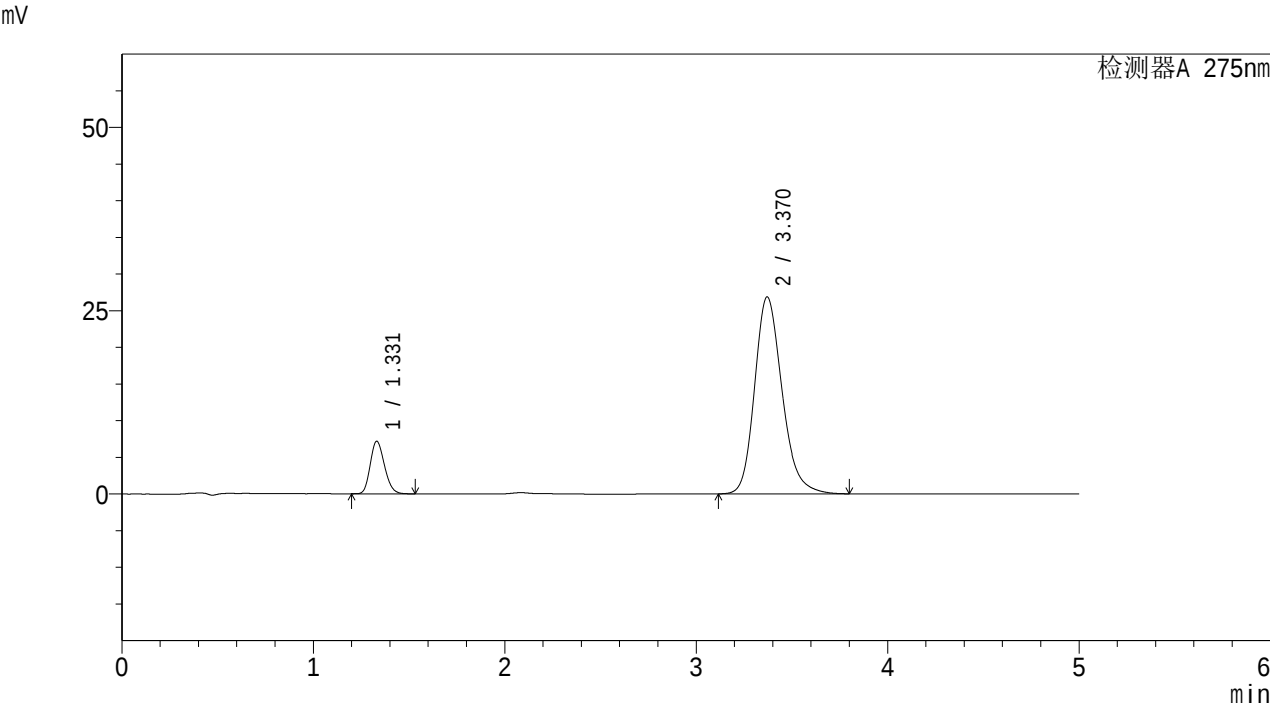

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	36934	12.133	7169	1533	1.191	--
2	3.370	267464	87.867	26865	2758	1.213	10.385
总计		304398	100.000	34034			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-349-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:51:32
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

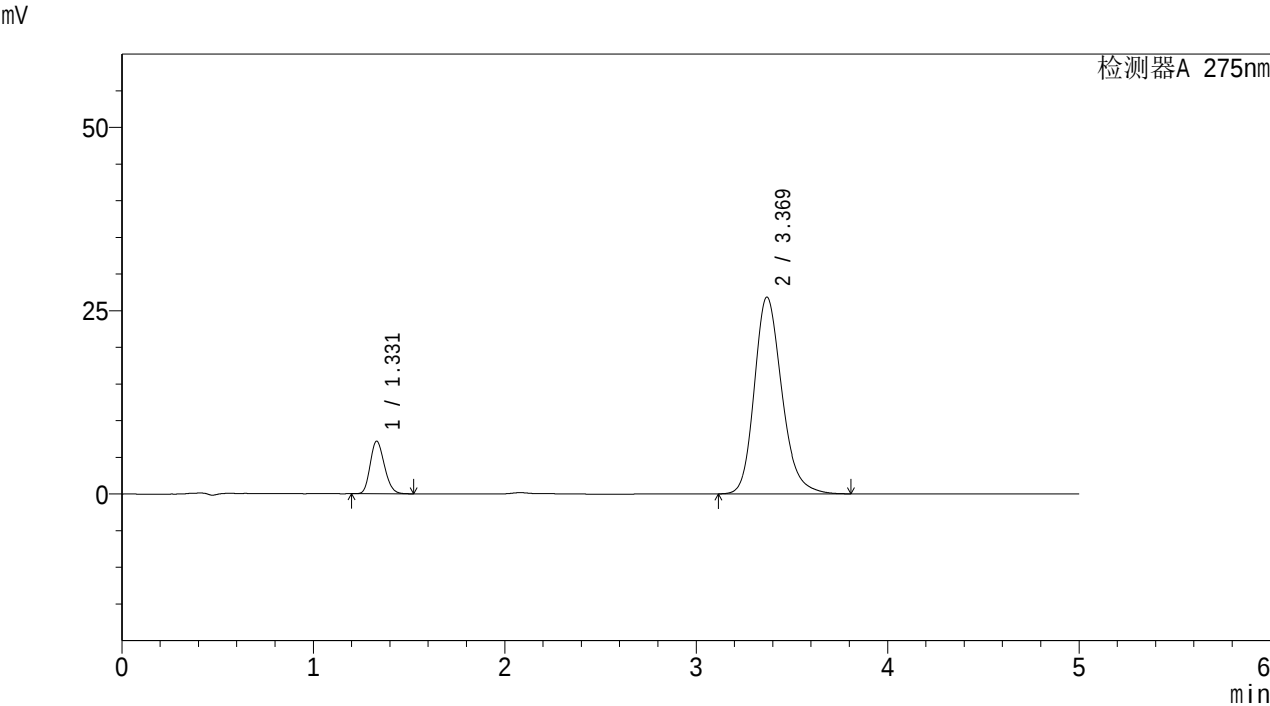

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	36920	12.137	7172	1535	1.189	--
2	3.369	267270	87.863	26834	2759	1.215	10.388
总计		304190	100.000	34006			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-350-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 16:56:56

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

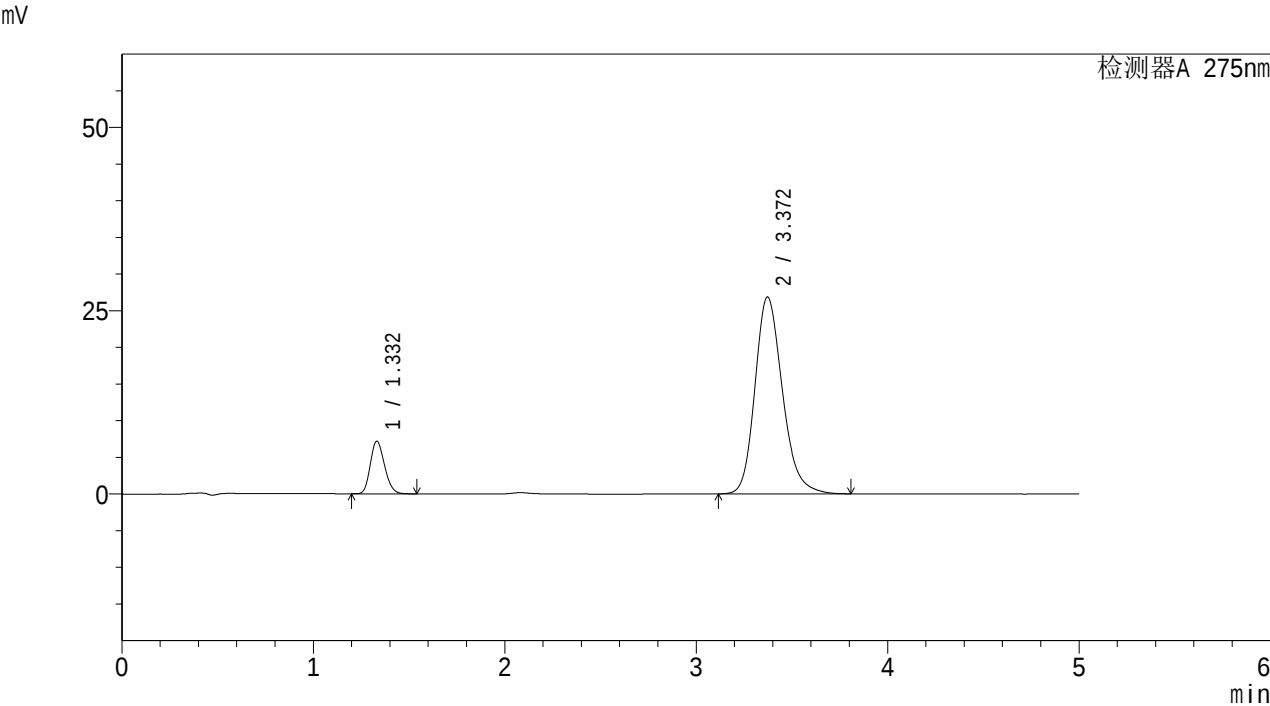

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	37050	12.167	7176	1529	1.189	--
2	3.372	267465	87.833	26867	2760	1.215	10.387
总计		304515	100.000	34043			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-351-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:02:19

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

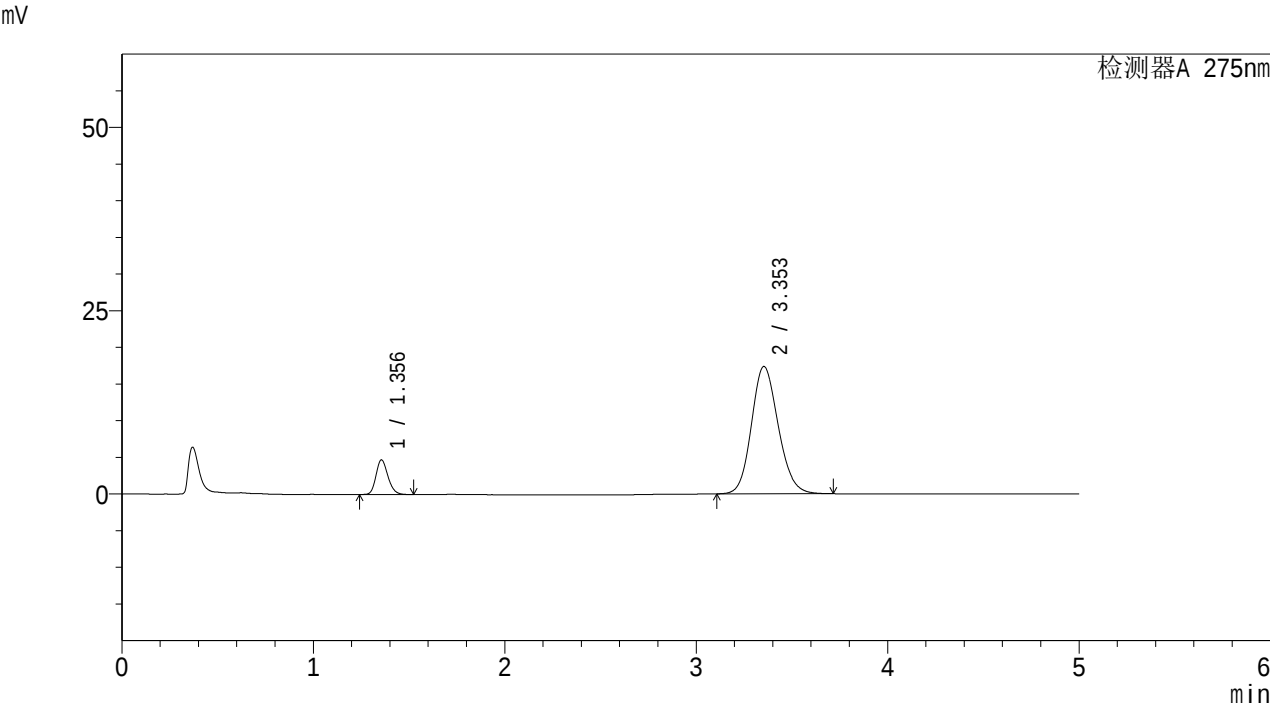

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	20429	10.811	4727	2290	1.196	--
2	3.353	168537	89.189	17371	2802	1.149	10.894
总计		188966	100.000	22097			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-352-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:07:42

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

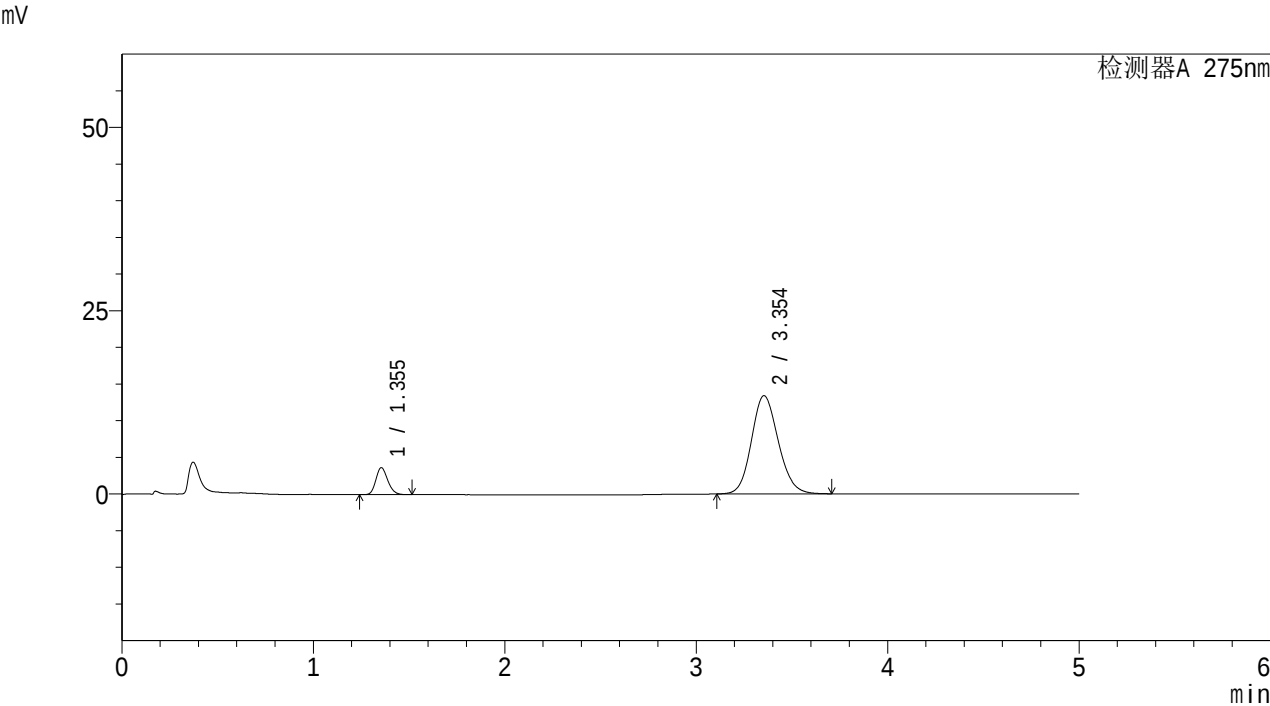

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	15858	10.847	3689	2299	1.190	--
2	3.354	130338	89.153	13402	2783	1.142	10.883
总计		146196	100.000	17091			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-353-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:13:05
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

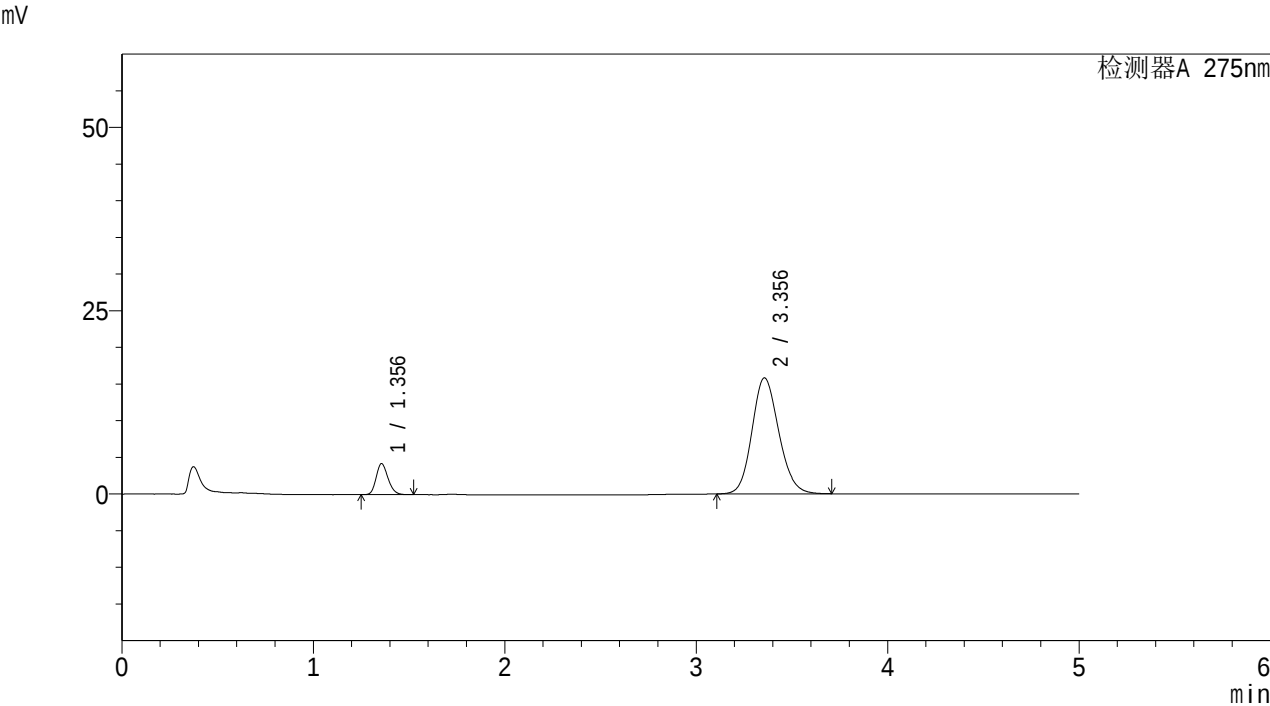

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	18273	10.619	4233	2292	1.197	--
2	3.356	153807	89.381	15826	2790	1.146	10.885
总计		172080	100.000	20059			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-354-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:18:28

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

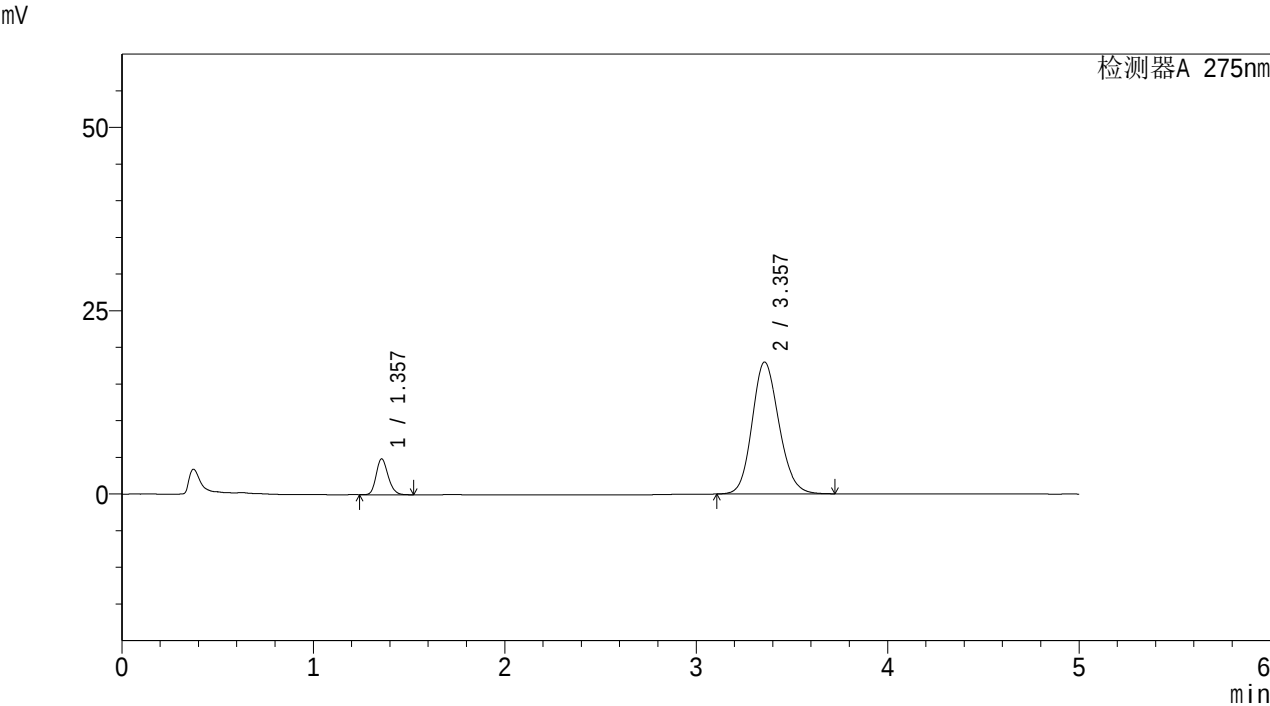

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	21142	10.778	4897	2290	1.195	--
2	3.357	175022	89.222	17984	2792	1.151	10.886
总计		196165	100.000	22882			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-355-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:23:50

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

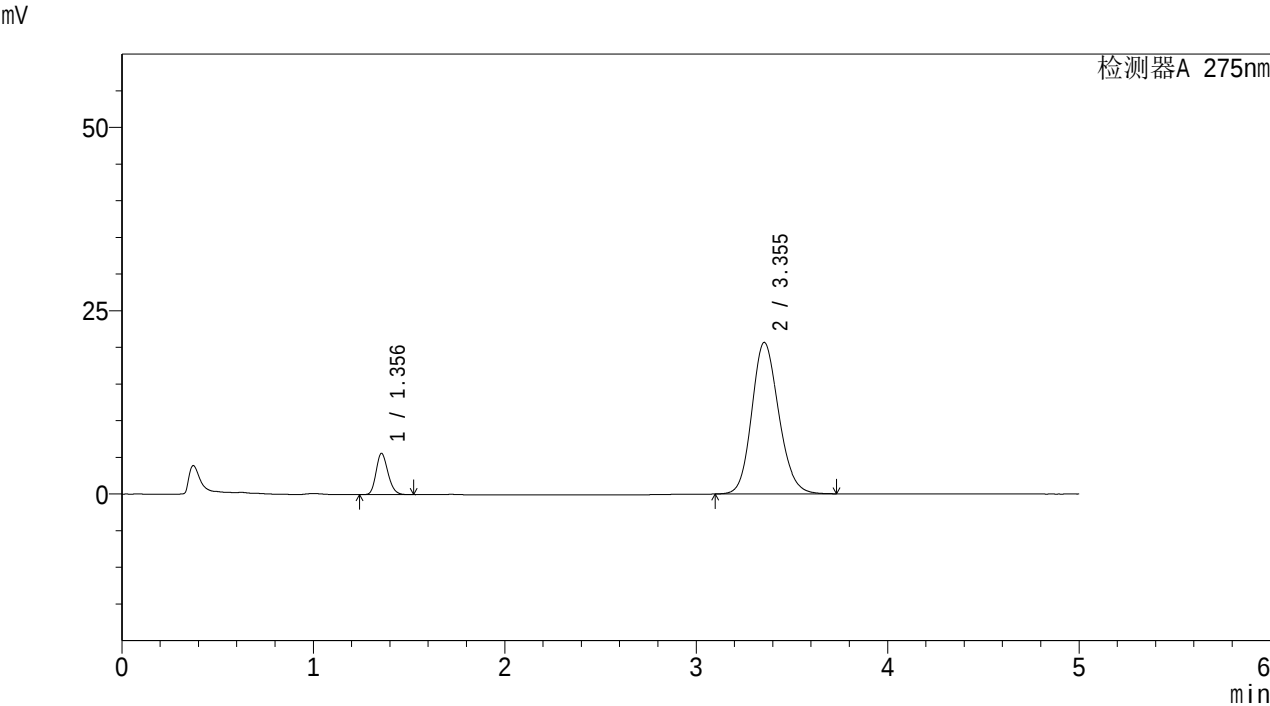

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	24312	10.760	5631	2290	1.197	--
2	3.355	201626	89.240	20674	2777	1.156	10.865
总计		225938	100.000	26305			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-356-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:29:13
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

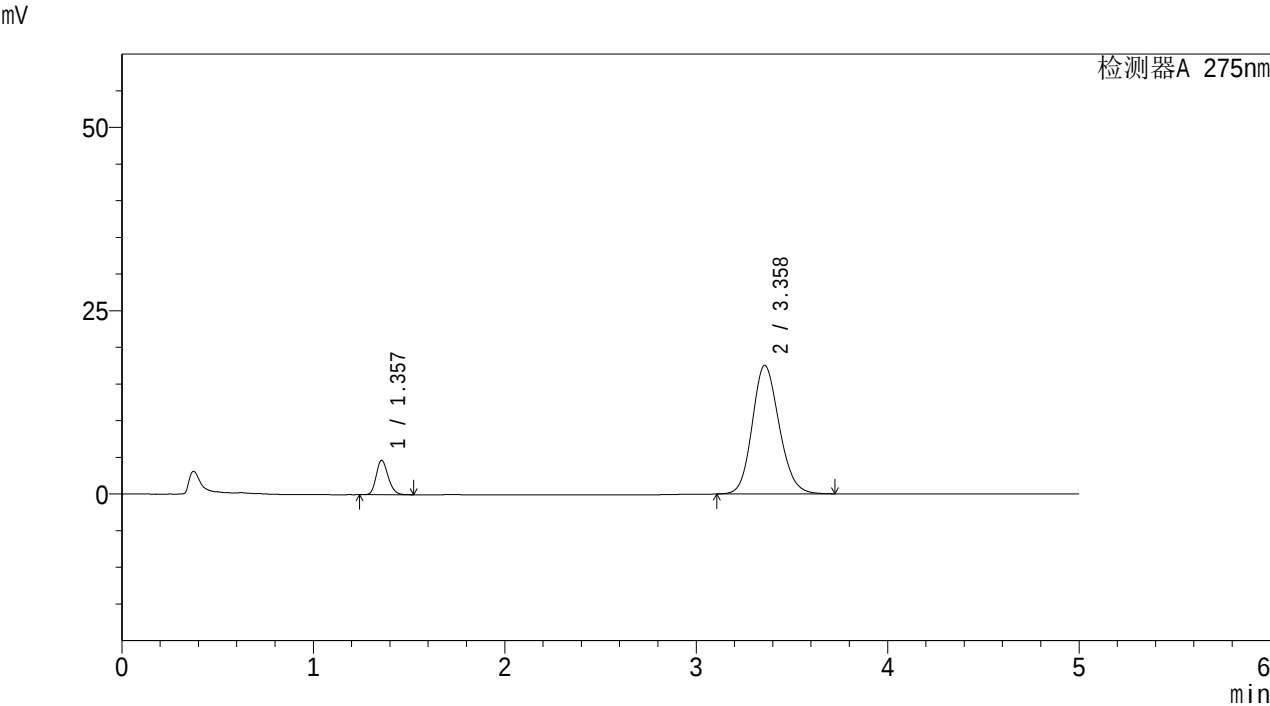

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	20273	10.595	4692	2288	1.195	--
2	3.358	171080	89.405	17522	2775	1.152	10.862
总计		191354	100.000	22214			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-357-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:34:36
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

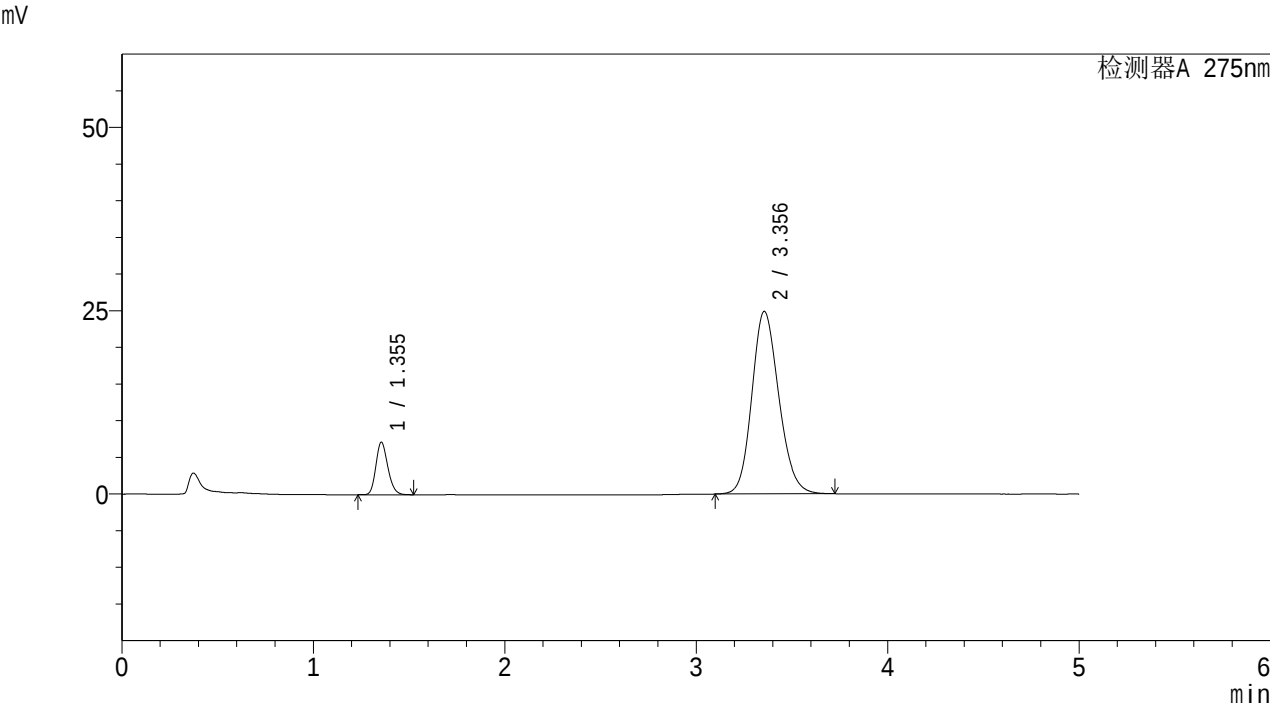

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	30935	11.298	7172	2282	1.196	--
2	3.356	242866	88.702	24902	2773	1.163	10.861
总计		273801	100.000	32074			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-358-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:39:59

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

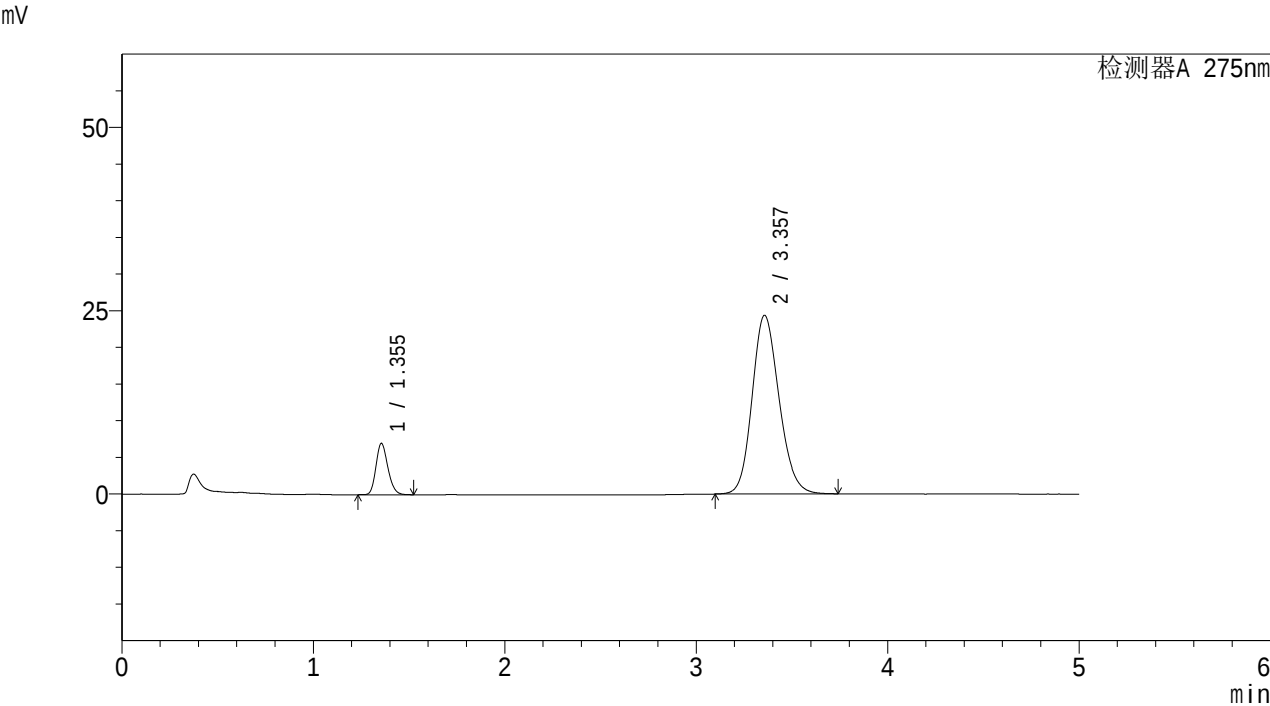

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	30265	11.290	7015	2287	1.195	--
2	3.357	237808	88.710	24367	2775	1.164	10.869
总计		268074	100.000	31382			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-359-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:45:22

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

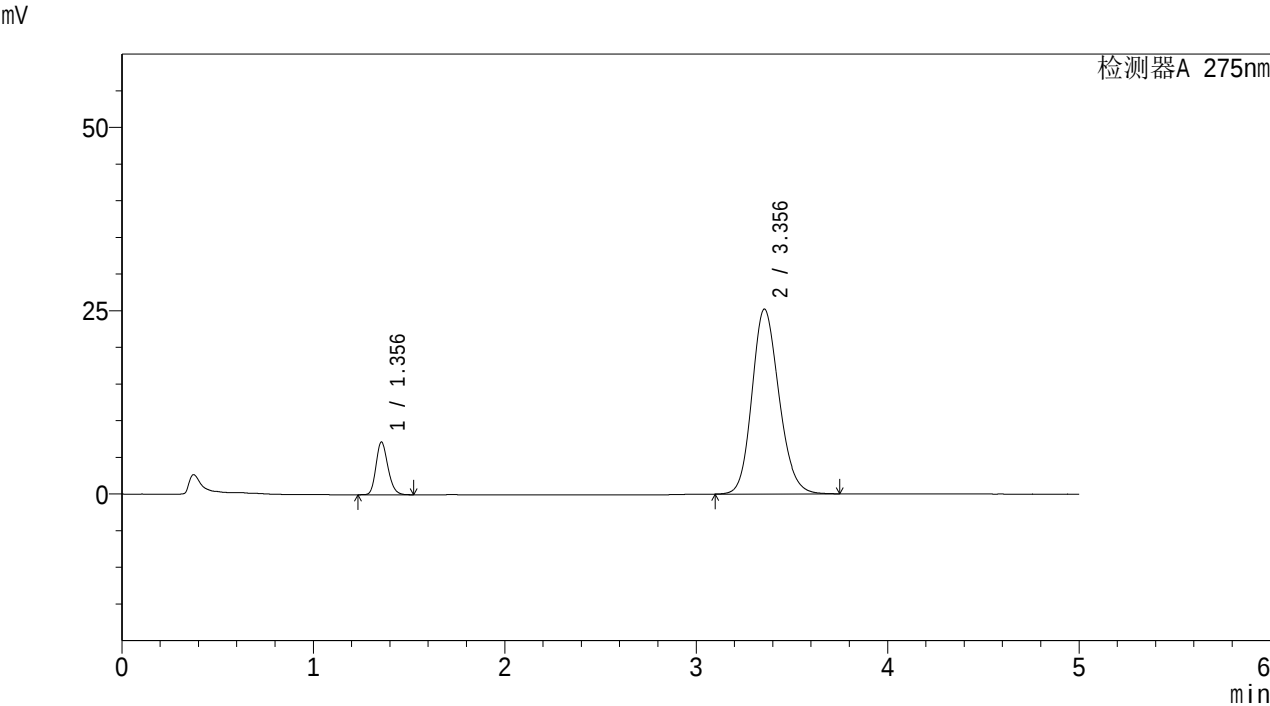

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	31027	11.177	7194	2292	1.196	--
2	3.356	246575	88.823	25225	2766	1.166	10.857
总计		277602	100.000	32419			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-360-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:50:45

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

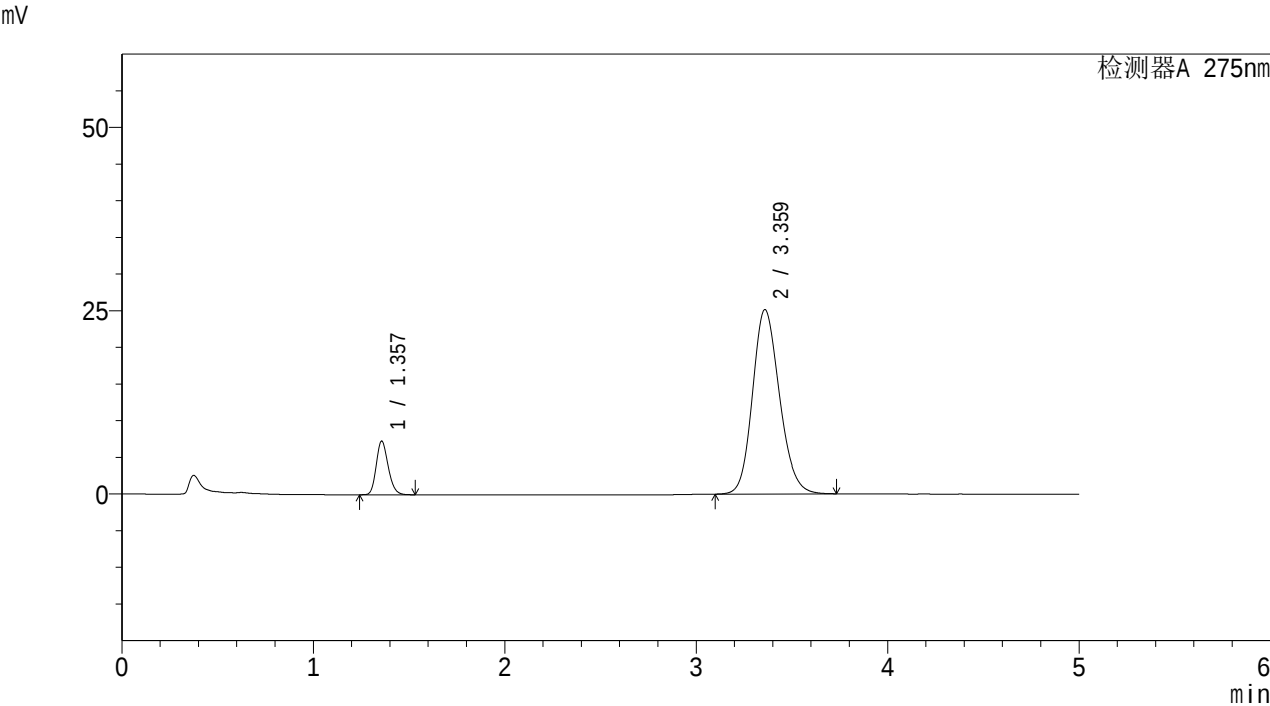

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	31624	11.399	7309	2287	1.198	--
2	3.359	245812	88.601	25114	2769	1.167	10.855
总计		277436	100.000	32422			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-361-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:56:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

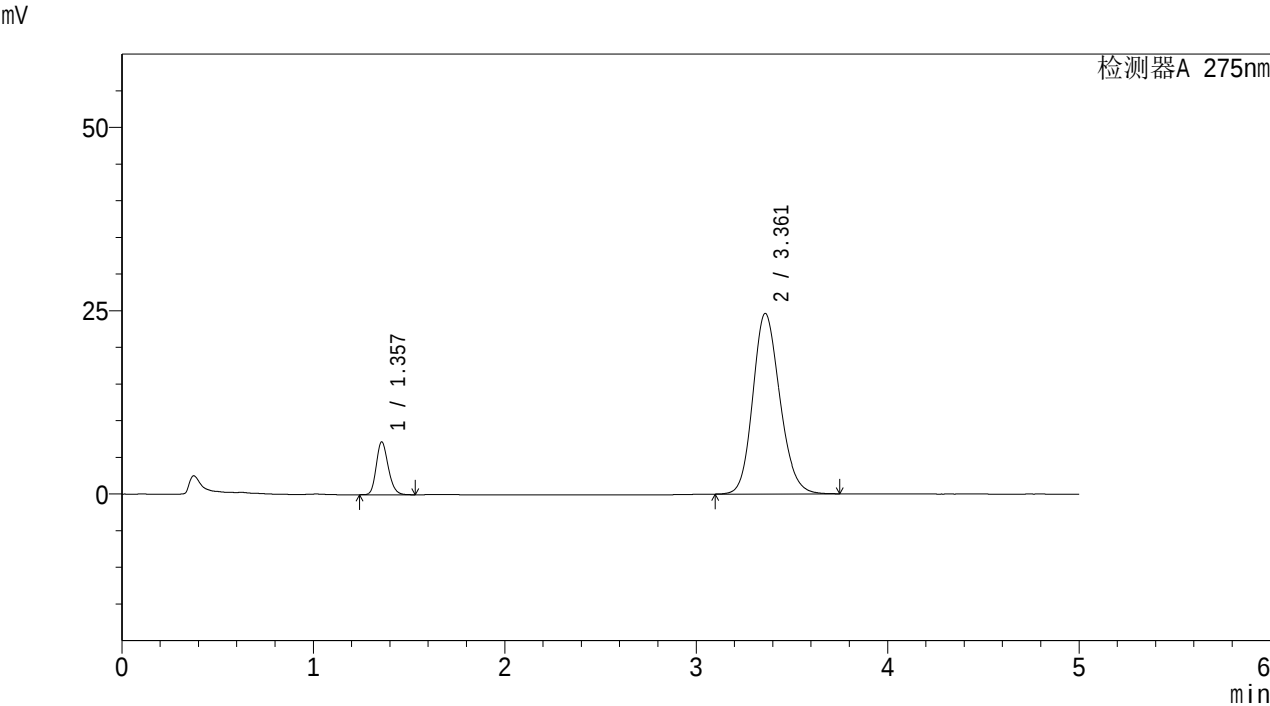

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	31204	11.469	7201	2284	1.198	--
2	3.361	240862	88.531	24609	2772	1.166	10.862
总计		272066	100.000	31810			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-362-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:01:31
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

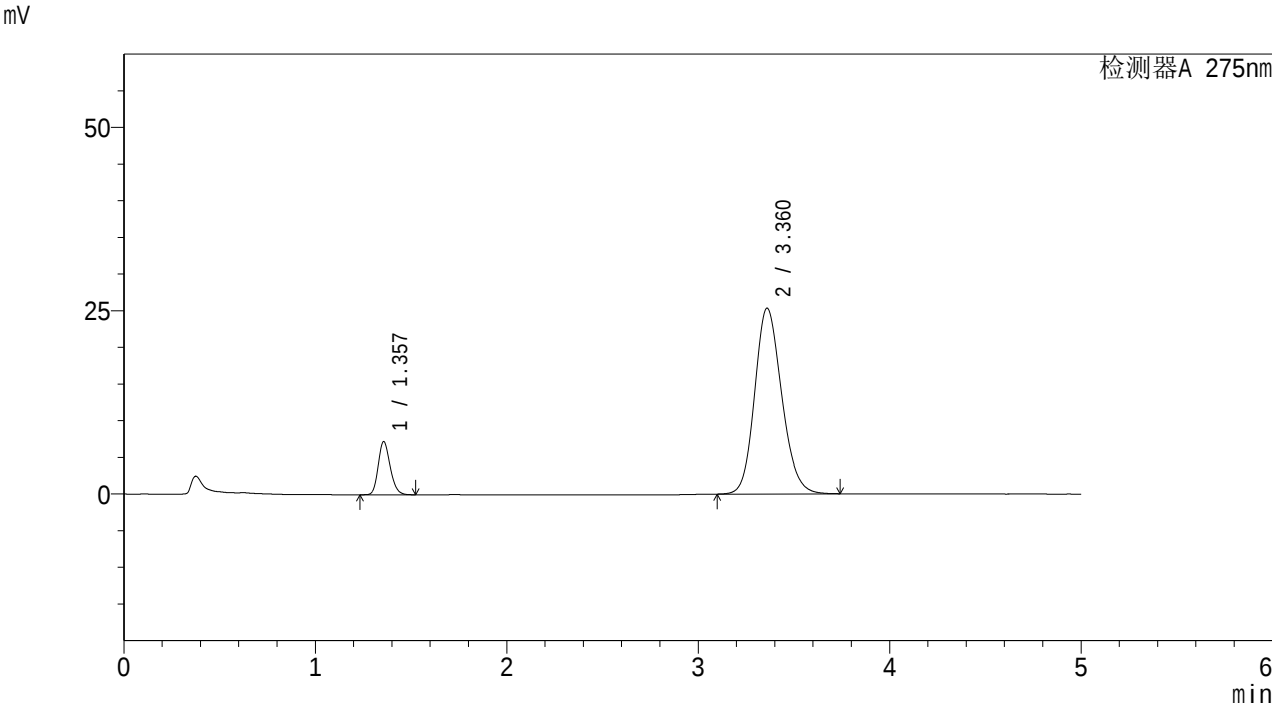

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	31365	11.231	7248	2287	1.197	--
2	3.360	247918	88.769	25302	2767	1.167	10.856
总计		279283	100.000	32550			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-363-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:06:54

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

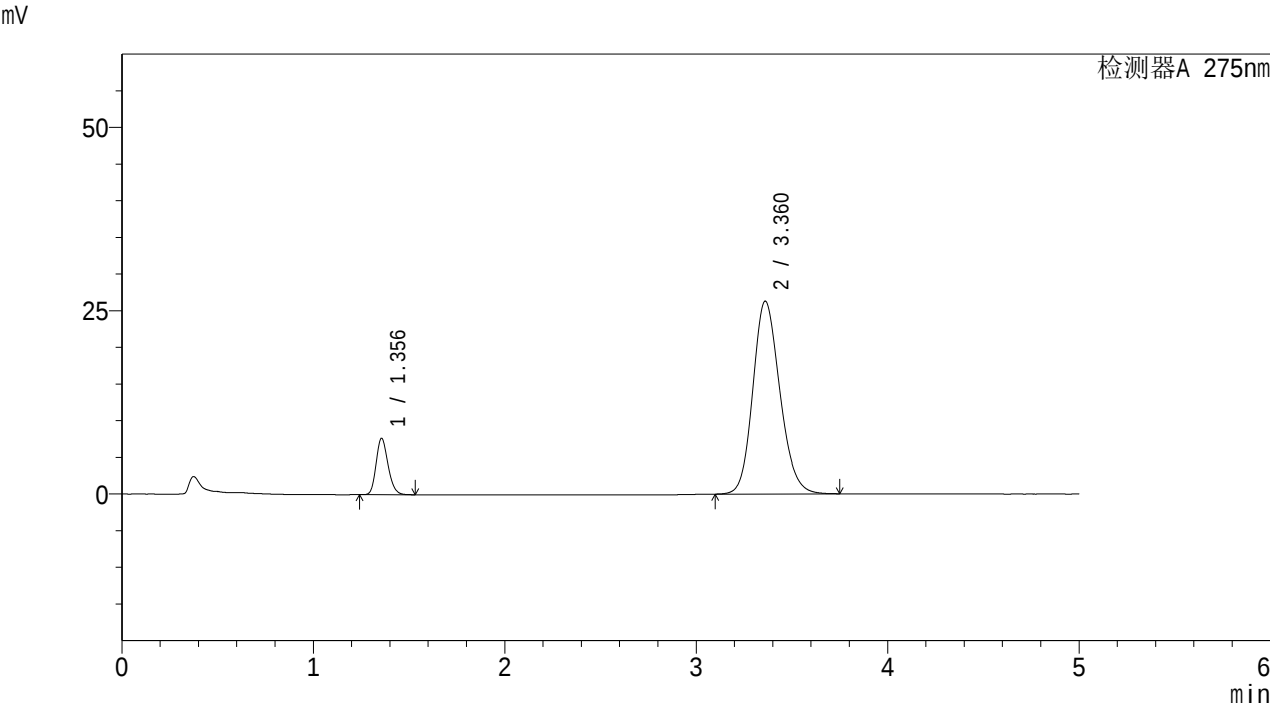

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	33254	11.445	7693	2288	1.197	--
2	3.360	257311	88.555	26278	2772	1.169	10.871
总计		290565	100.000	33971			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-364-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:12:17
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

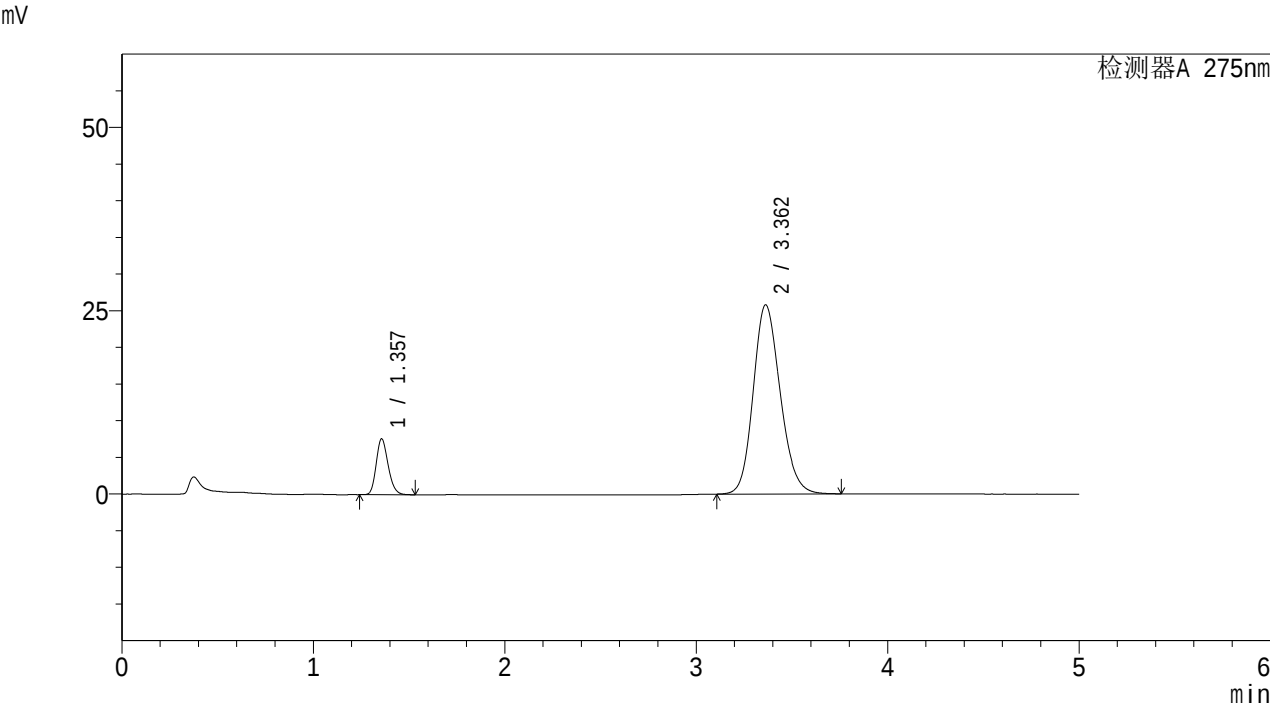

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	32979	11.554	7621	2283	1.199	--
2	3.362	252454	88.446	25805	2773	1.169	10.872
总计		285434	100.000	33426			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-365-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:17:40
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

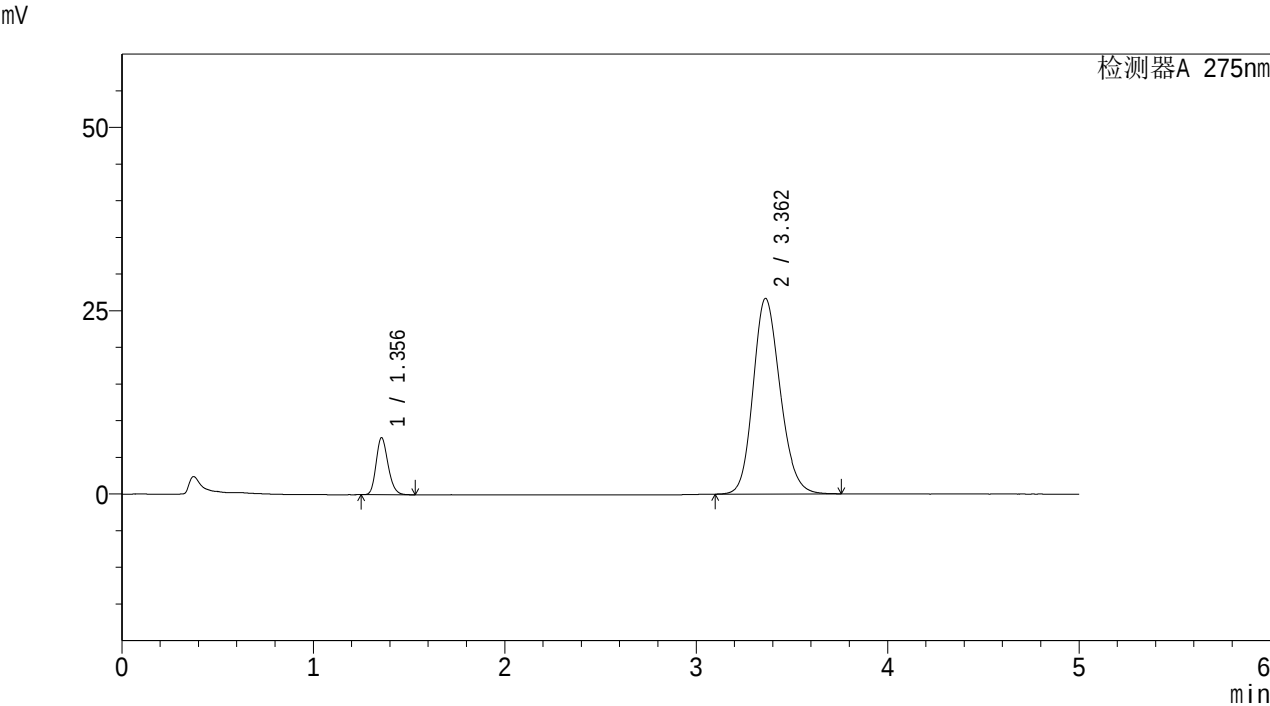

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	33632	11.398	7782	2285	1.200	--
2	3.362	261434	88.602	26686	2767	1.170	10.866
总计		295066	100.000	34469			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-366-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:23:03
处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

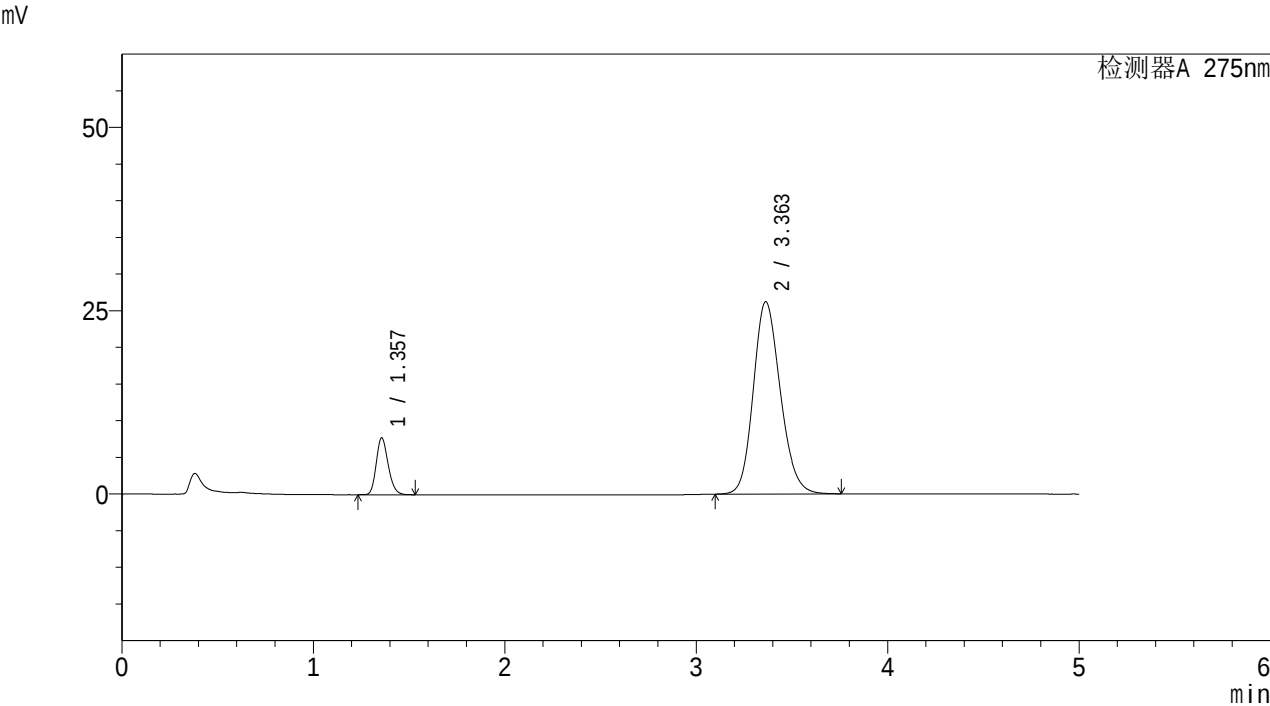

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33564	11.560	7749	2283	1.197	--
2	3.363	256788	88.440	26238	2773	1.170	10.872
总计		290352	100.000	33987			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-367-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:28:25

处理时间(V2): 2026/05/12 11:54:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

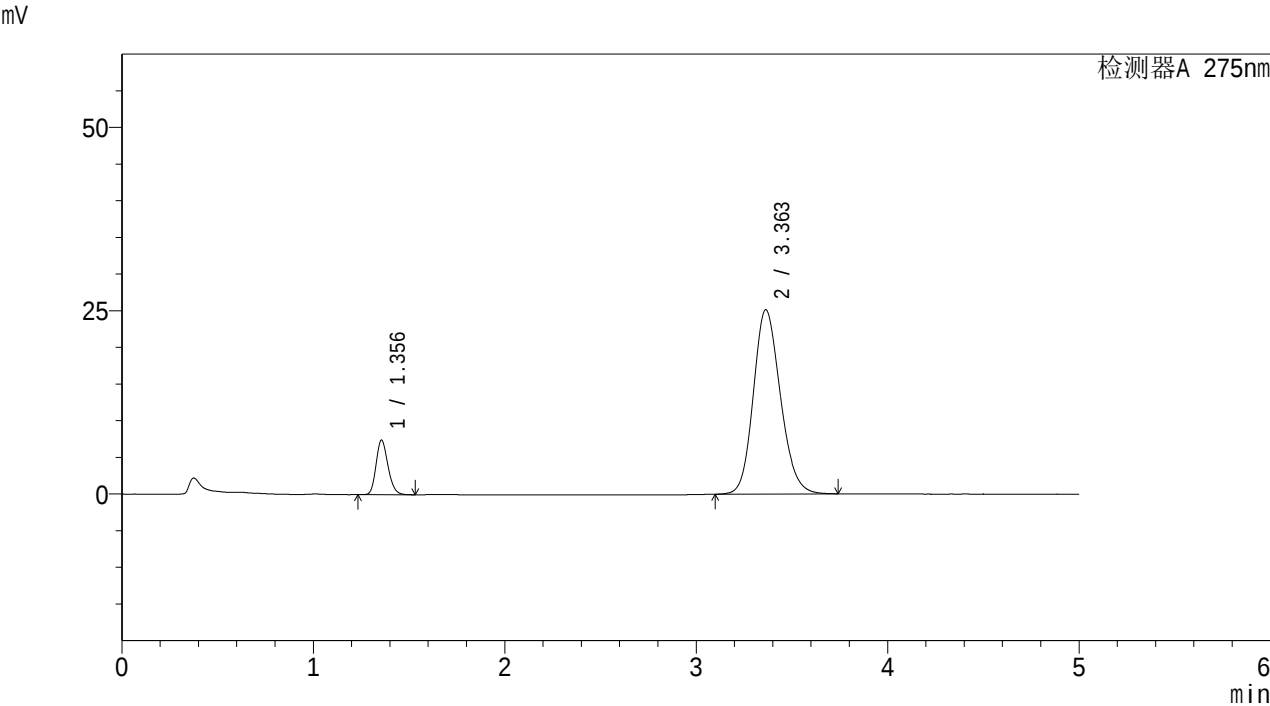

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	32165	11.554	7445	2289	1.195	--
2	3.363	246215	88.446	25142	2768	1.167	10.877
总计		278381	100.000	32587			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-368-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:33:48

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

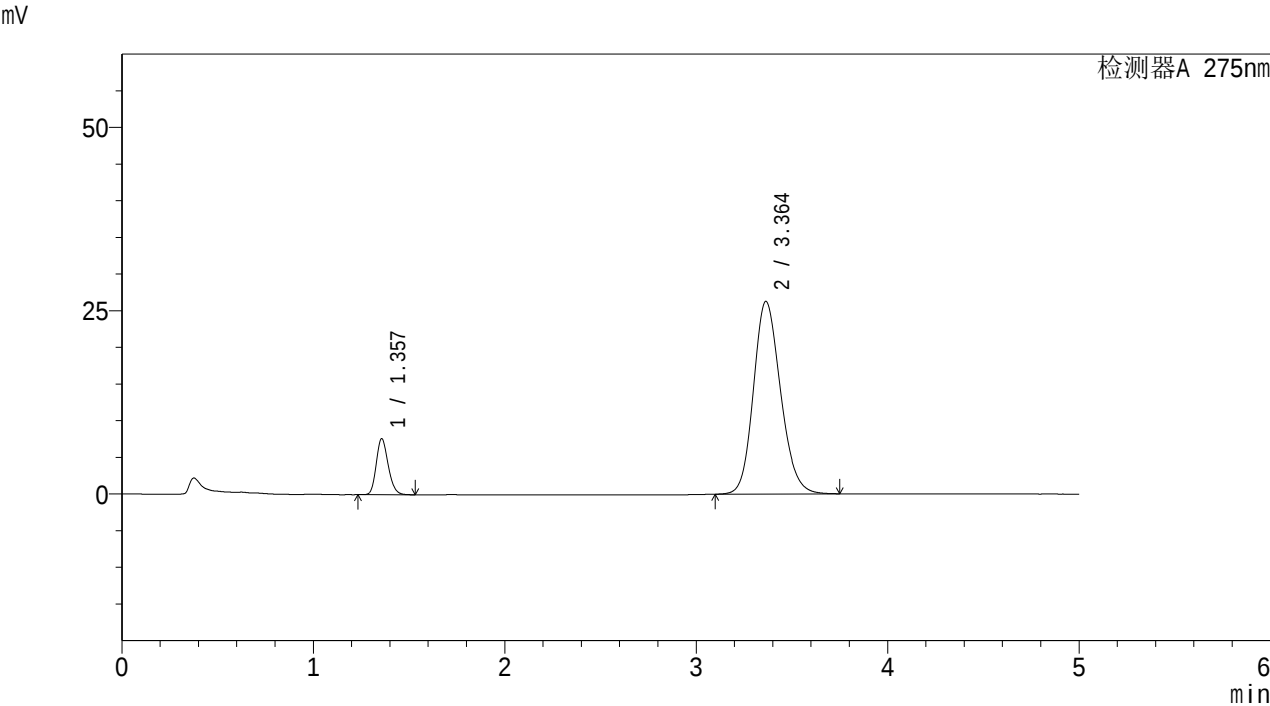

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33090	11.368	7636	2283	1.197	--
2	3.364	258003	88.632	26282	2756	1.170	10.850
总计		291093	100.000	33918			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-369-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:39:11

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

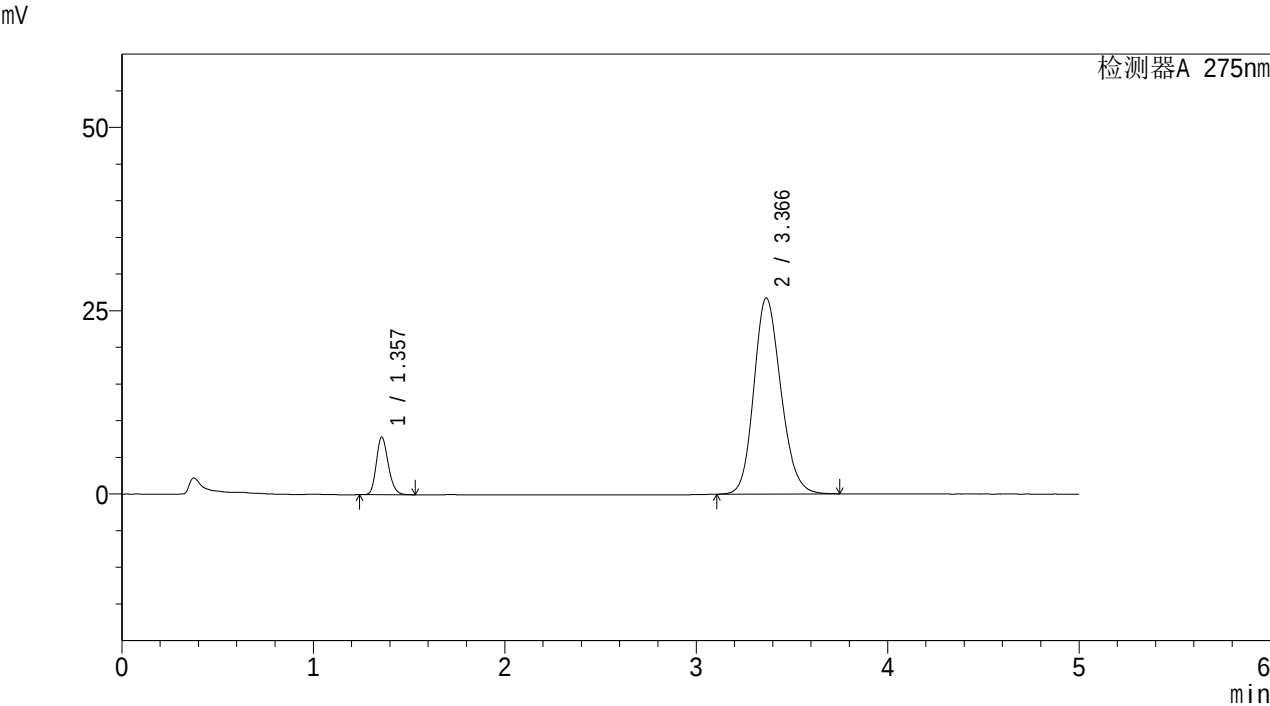

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33988	11.488	7849	2291	1.198	--
2	3.366	261859	88.512	26733	2774	1.171	10.885
总计		295846	100.000	34583			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-370-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:44:34

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

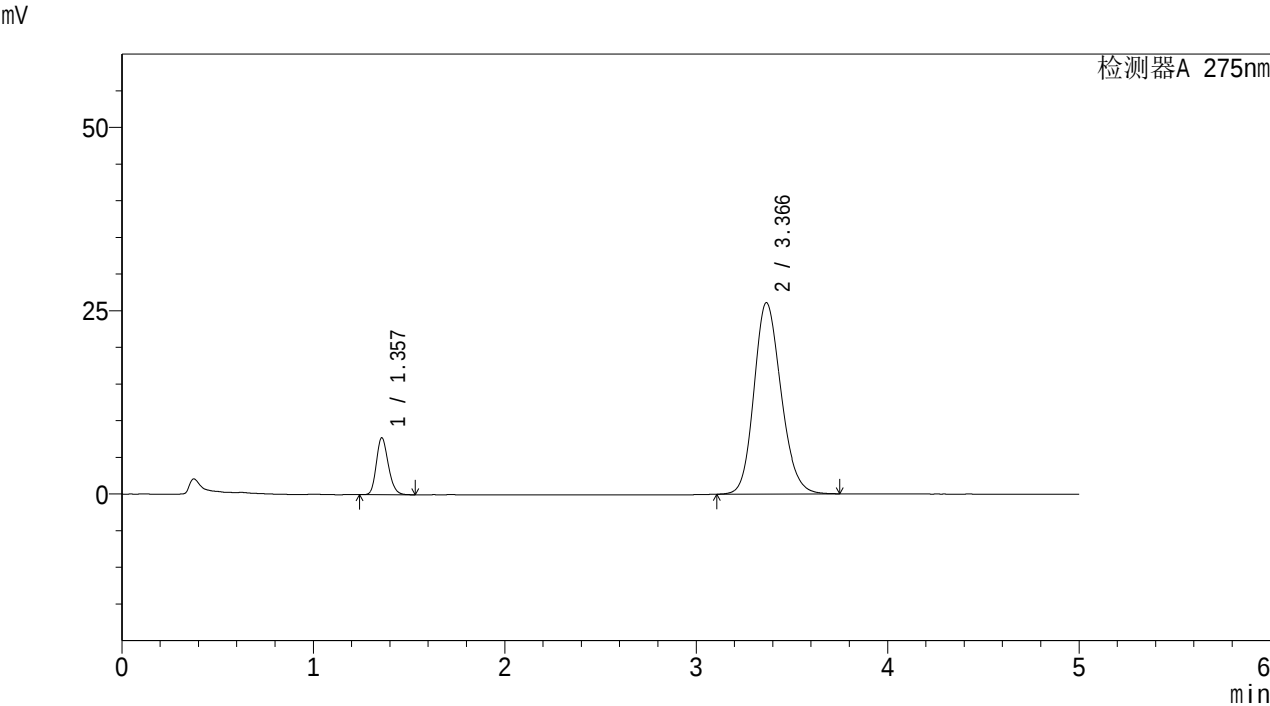

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33595	11.598	7751	2290	1.198	--
2	3.366	256059	88.402	26080	2768	1.171	10.877
总计		289654	100.000	33832			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-371-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:49:57
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

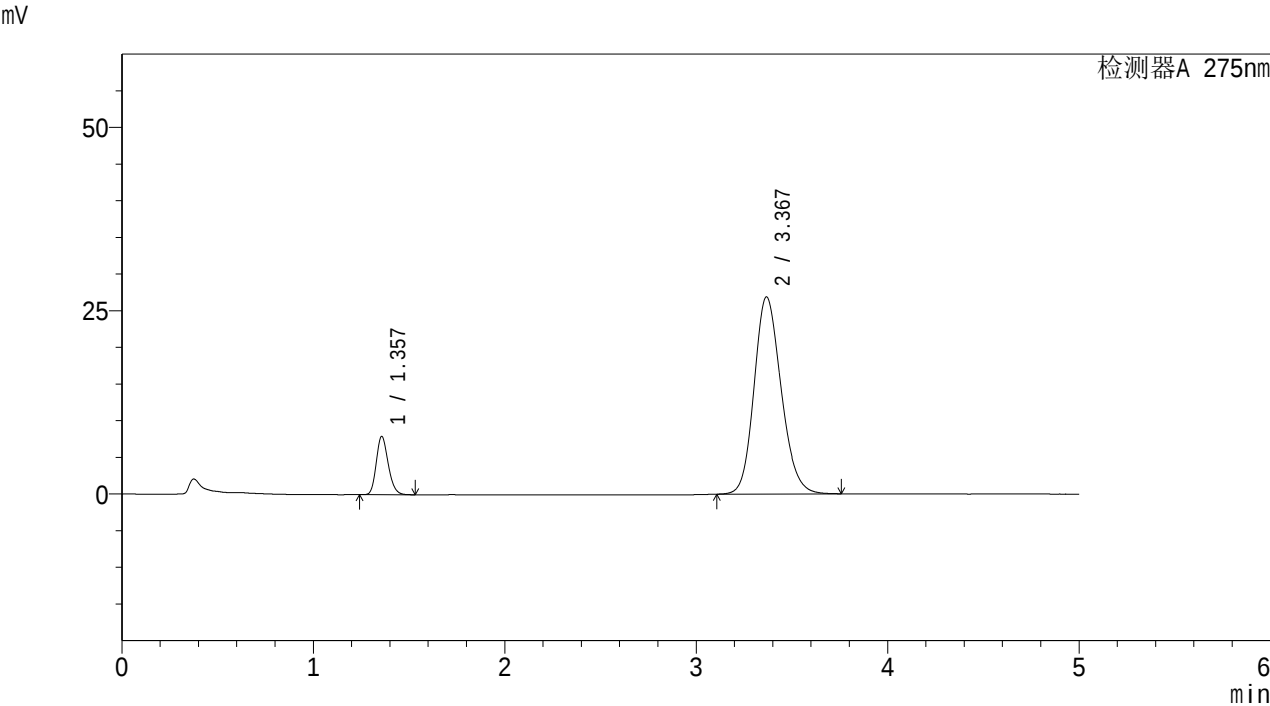

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	34395	11.539	7939	2286	1.198	--
2	3.367	263679	88.461	26847	2766	1.172	10.876
总计		298075	100.000	34786			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-372-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:55:20
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

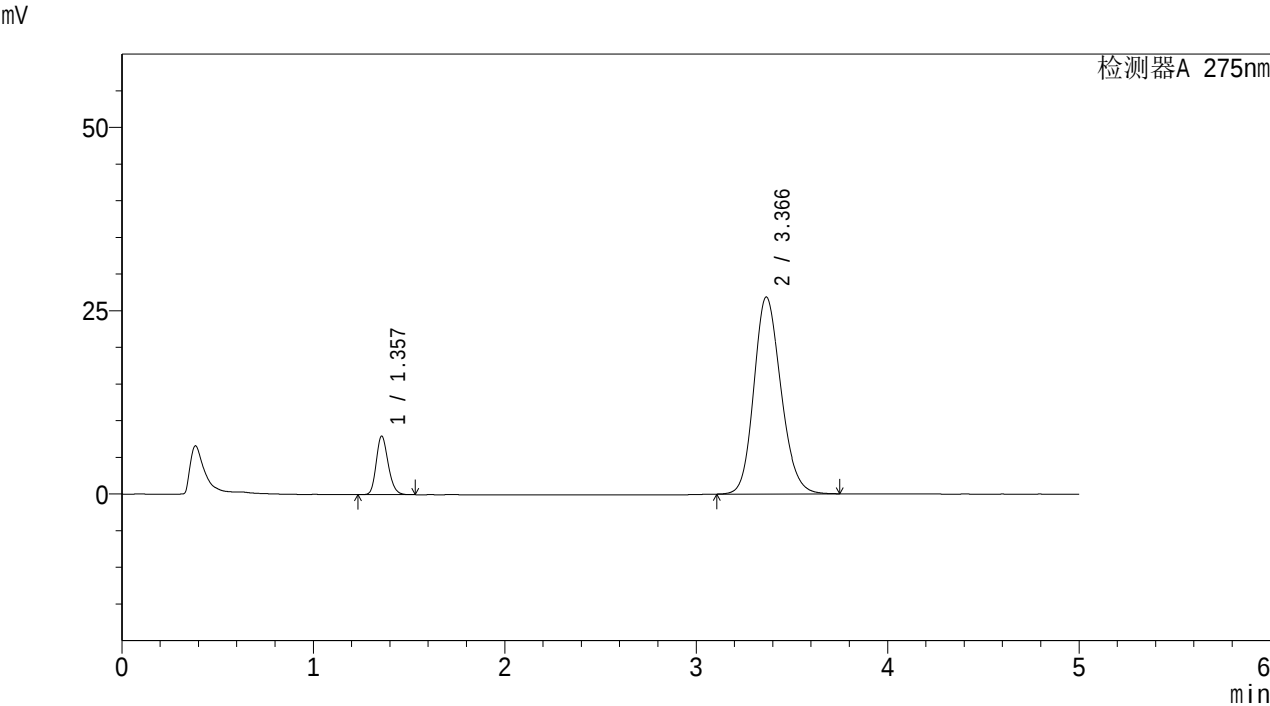

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	34518	11.585	7980	2287	1.197	--
2	3.366	263423	88.415	26860	2768	1.170	10.878
总计		297940	100.000	34841			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-373-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:00:43
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

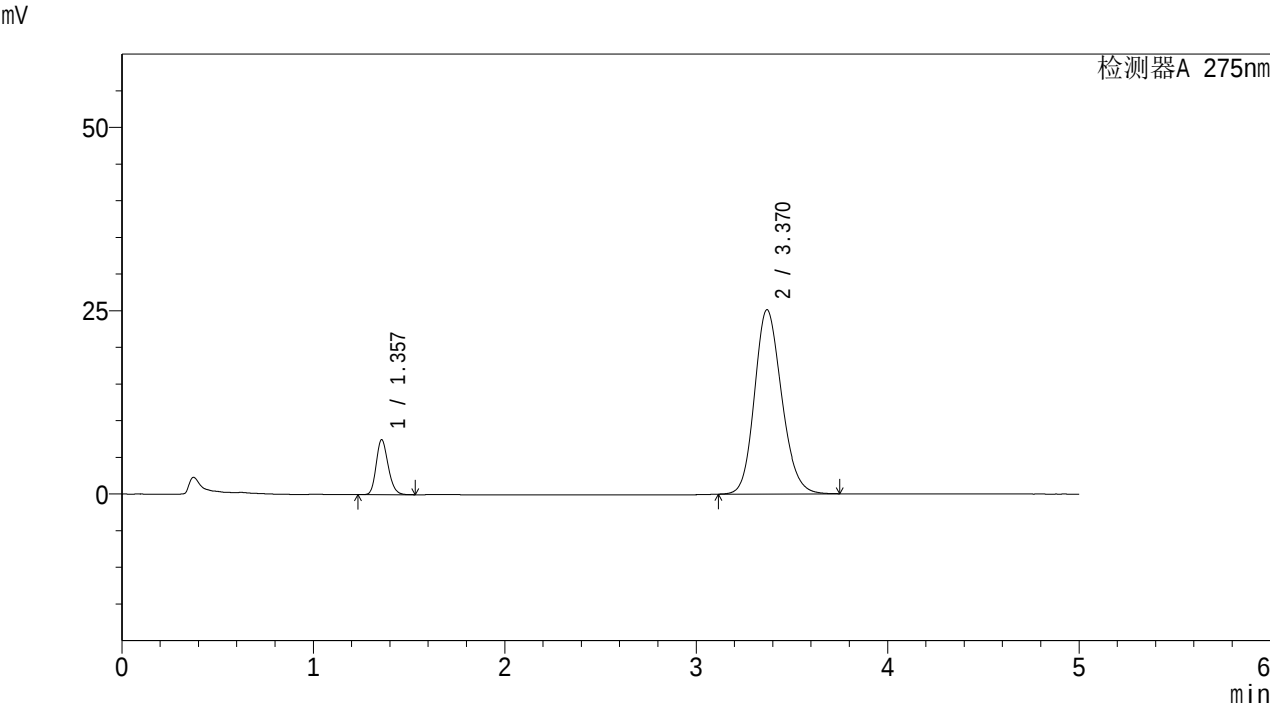

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	32474	11.632	7498	2286	1.196	--
2	3.370	246702	88.368	25130	2765	1.169	10.886
总计		279176	100.000	32628			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-374-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:06:05
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

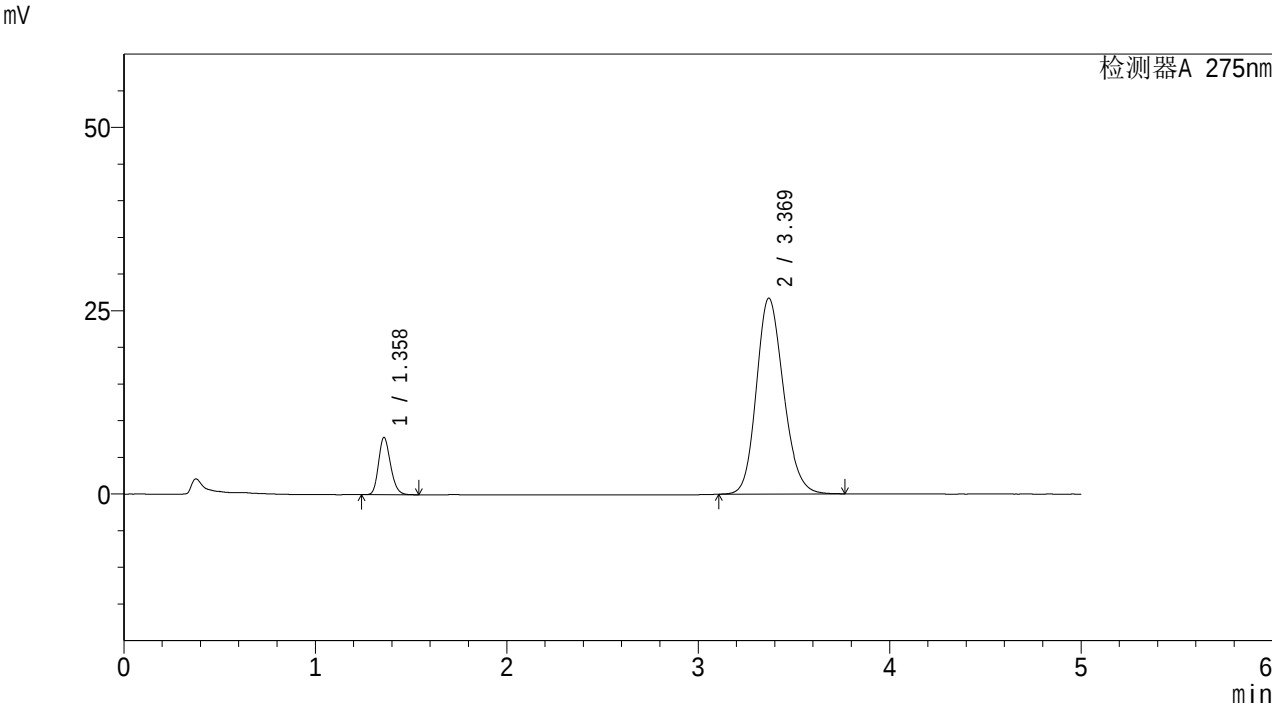

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	33880	11.428	7769	2285	1.200	--
2	3.369	262578	88.572	26698	2762	1.172	10.864
总计		296459	100.000	34468			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-375-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 19:11:28

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

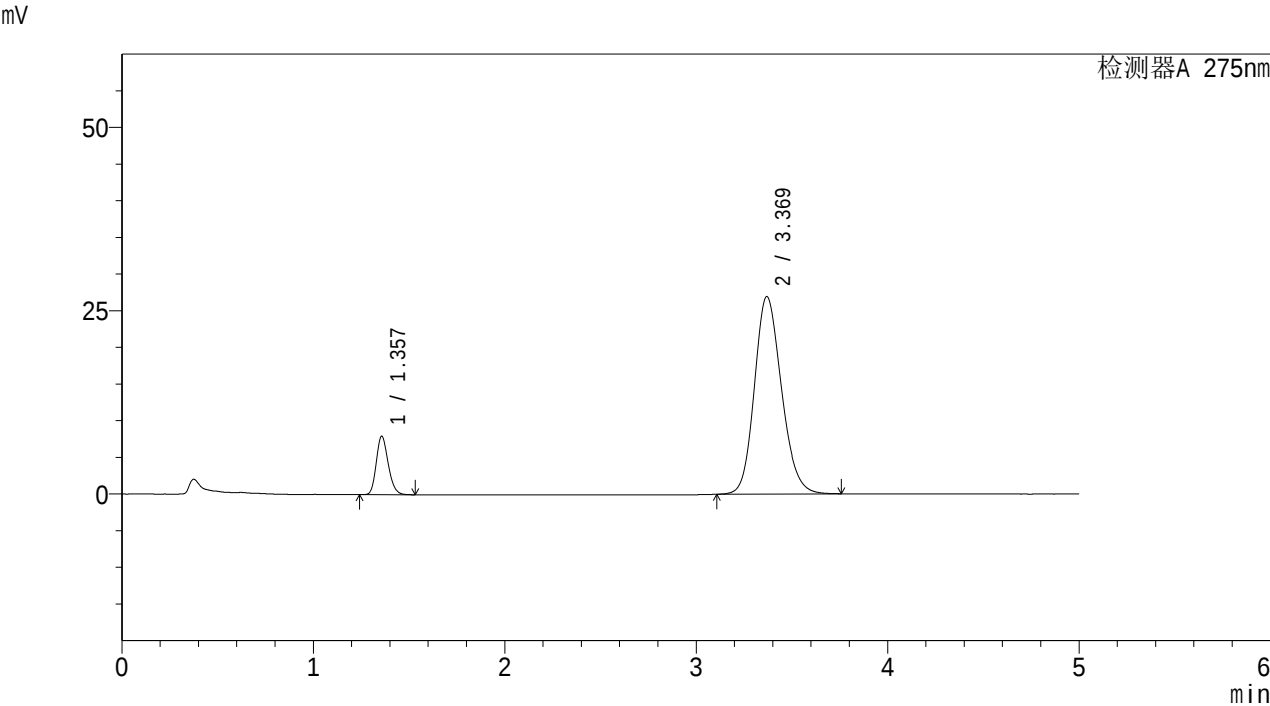

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	34469	11.535	7964	2287	1.199	--
2	3.369	264339	88.465	26918	2768	1.172	10.885
总计		298807	100.000	34882			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-376-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:16:51
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

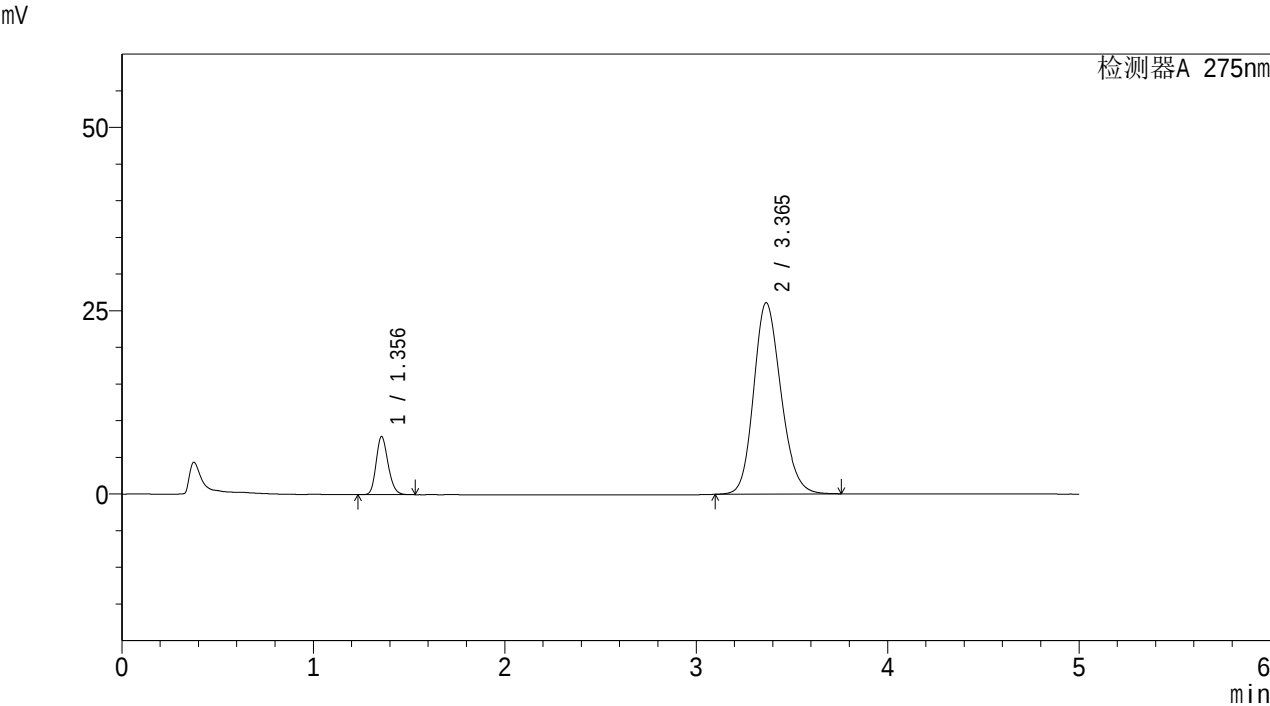

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	34375	11.762	7929	2276	1.196	--
2	3.365	257870	88.238	26097	2726	1.173	10.814
总计		292246	100.000	34026			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-377-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 19:22:14

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

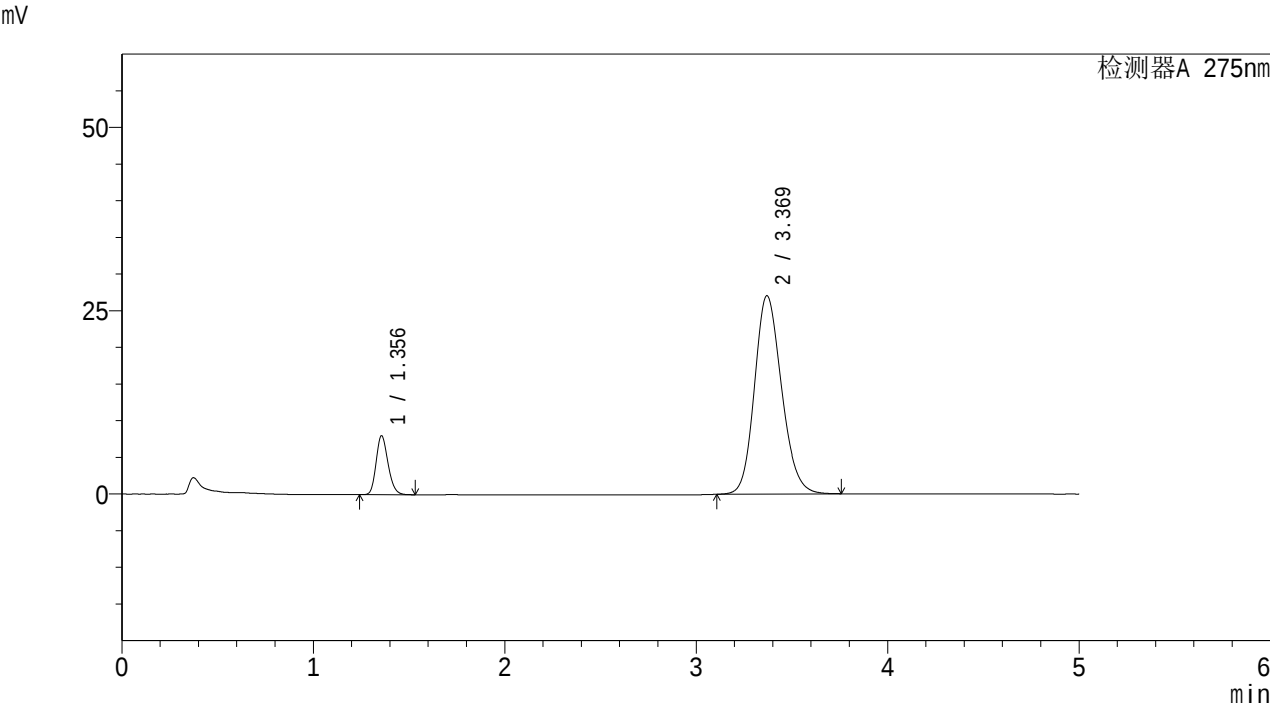

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	34755	11.573	8042	2288	1.197	--
2	3.369	265560	88.427	27040	2767	1.171	10.893
总计		300315	100.000	35081			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-378-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:27:37
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

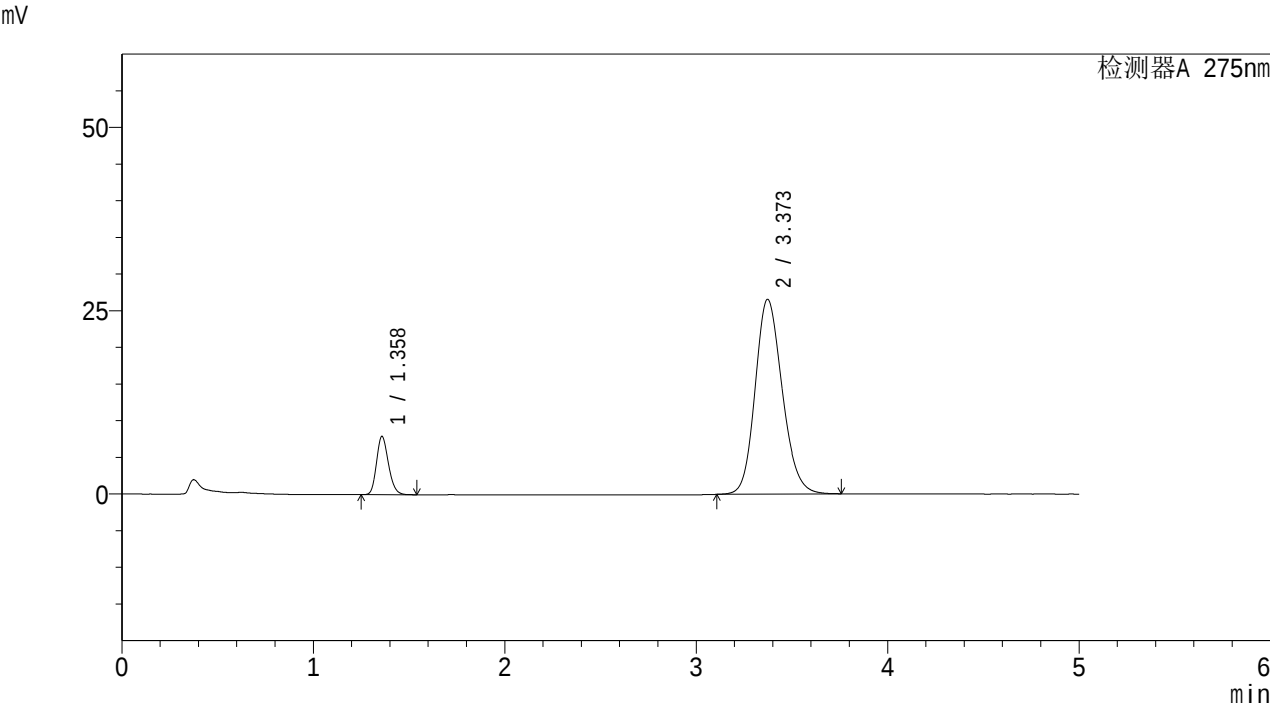

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34466	11.665	7911	2287	1.199	--
2	3.373	260992	88.335	26579	2771	1.170	10.892
总计		295458	100.000	34490			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-379-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:32:59
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

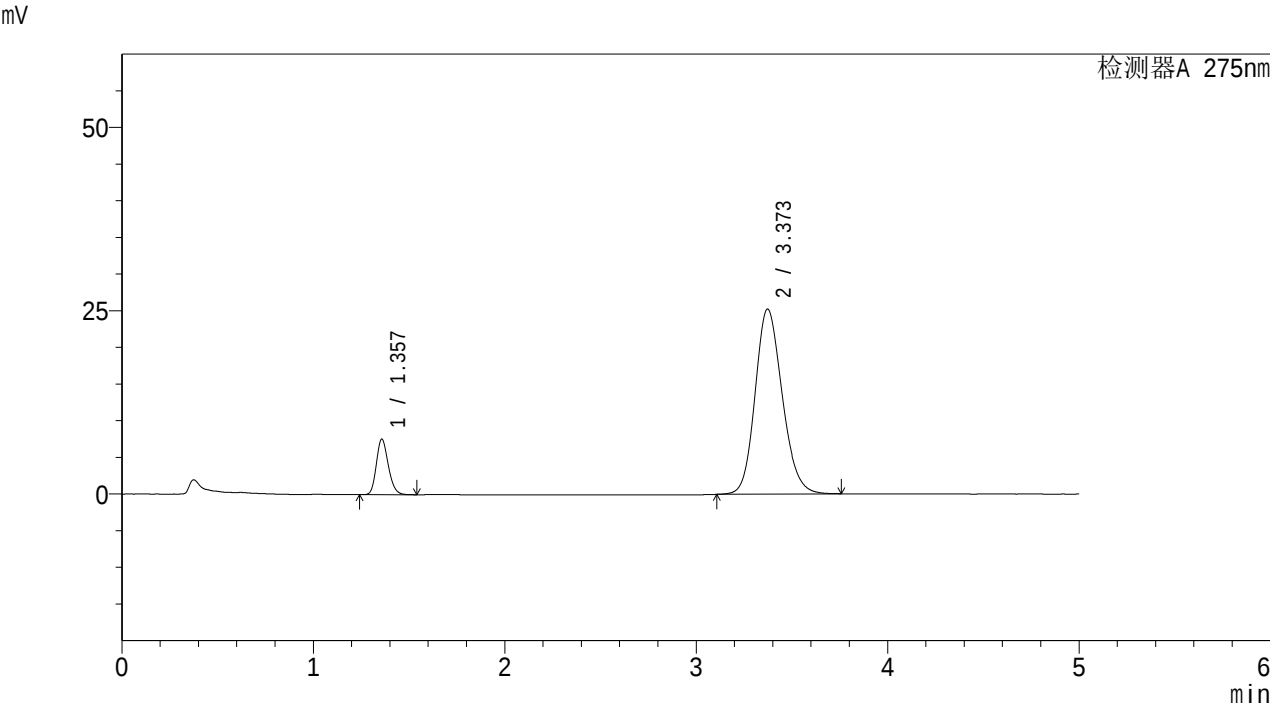

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	32833	11.688	7558	2285	1.199	--
2	3.373	248081	88.312	25247	2770	1.168	10.896
总计		280914	100.000	32805			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-380-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 19:38:22

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

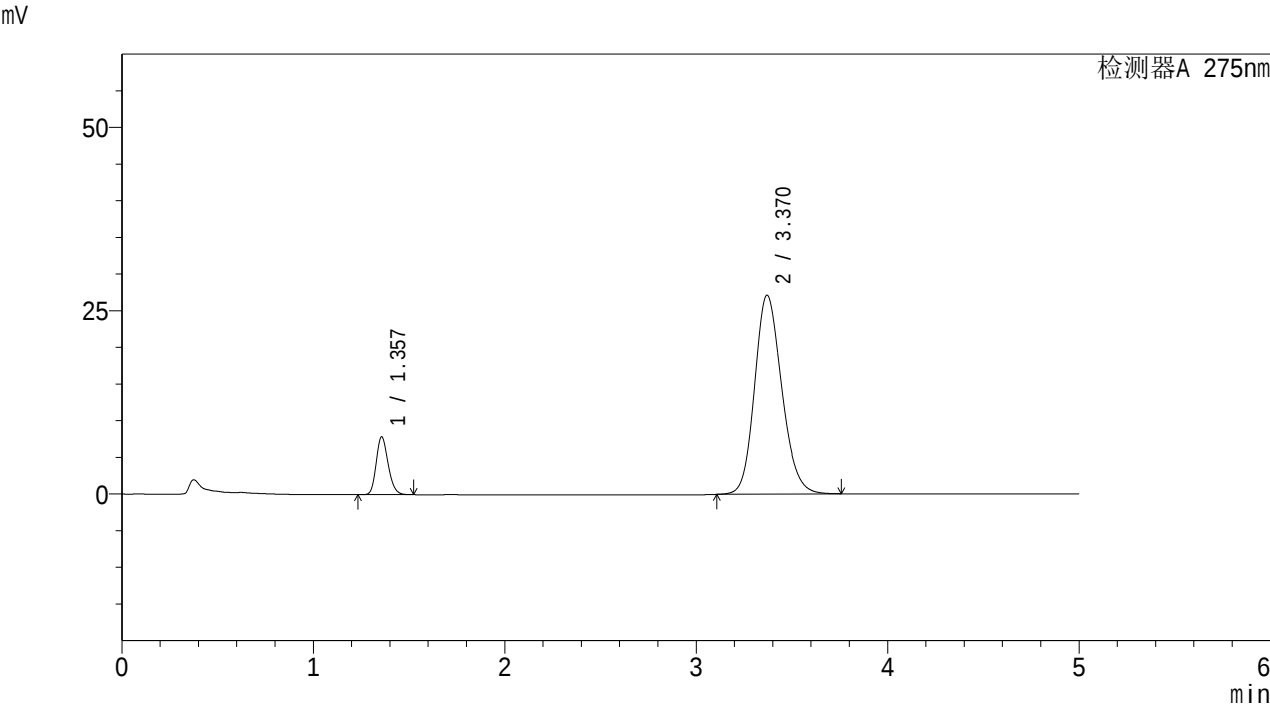

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	34136	11.340	7887	2285	1.197	--
2	3.370	266891	88.660	27128	2756	1.172	10.873
总计		301027	100.000	35015			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-381-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:43:45
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

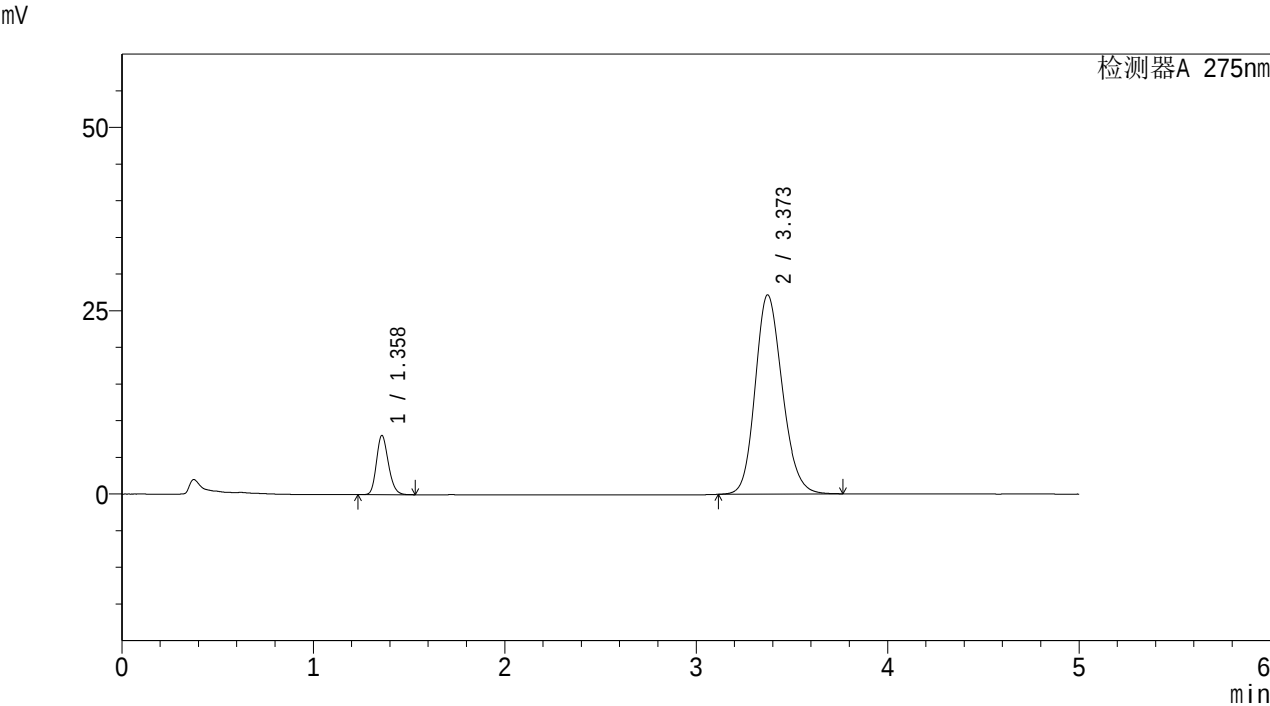

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34931	11.566	8044	2293	1.196	--
2	3.373	267090	88.434	27185	2770	1.172	10.898
总计		302021	100.000	35230			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-382-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:49:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

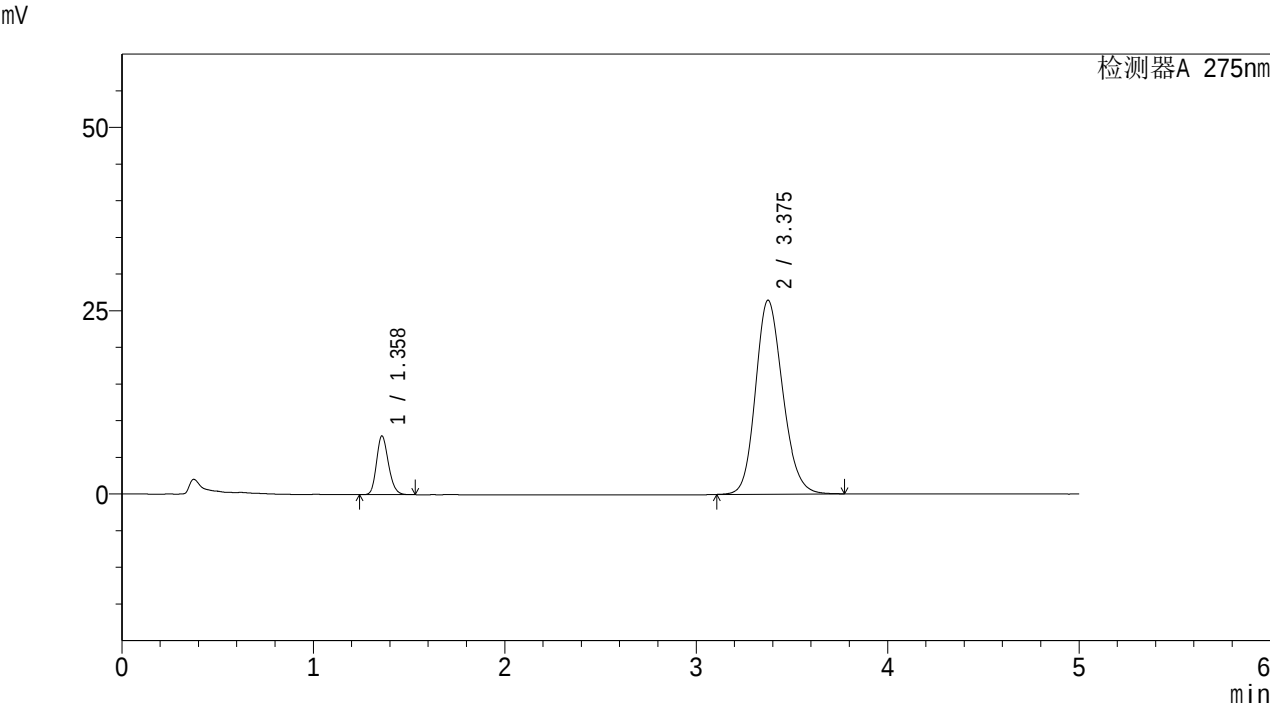

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34612	11.732	7962	2291	1.198	--
2	3.375	260419	88.268	26429	2765	1.171	10.894
总计		295031	100.000	34392			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-383-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 19:54:31

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

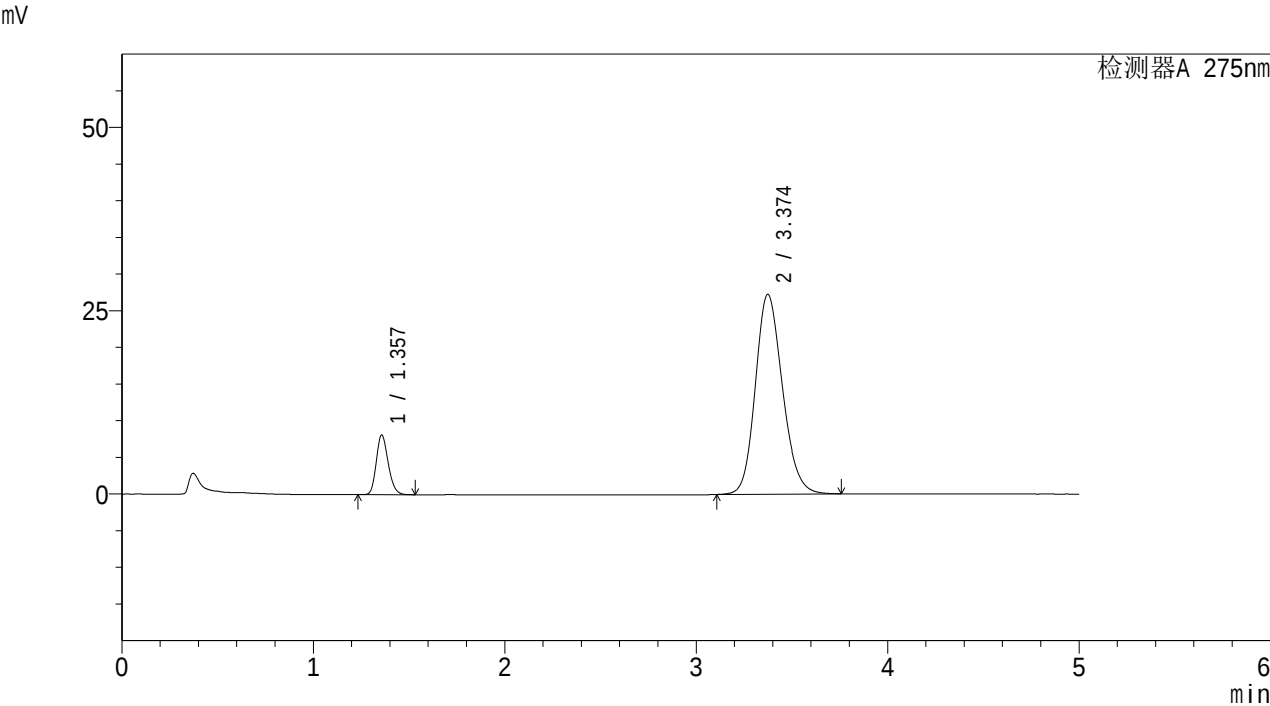

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	35200	11.614	8128	2285	1.197	--
2	3.374	267871	88.386	27252	2770	1.172	10.903
总计		303071	100.000	35381			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-384-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:59:54
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

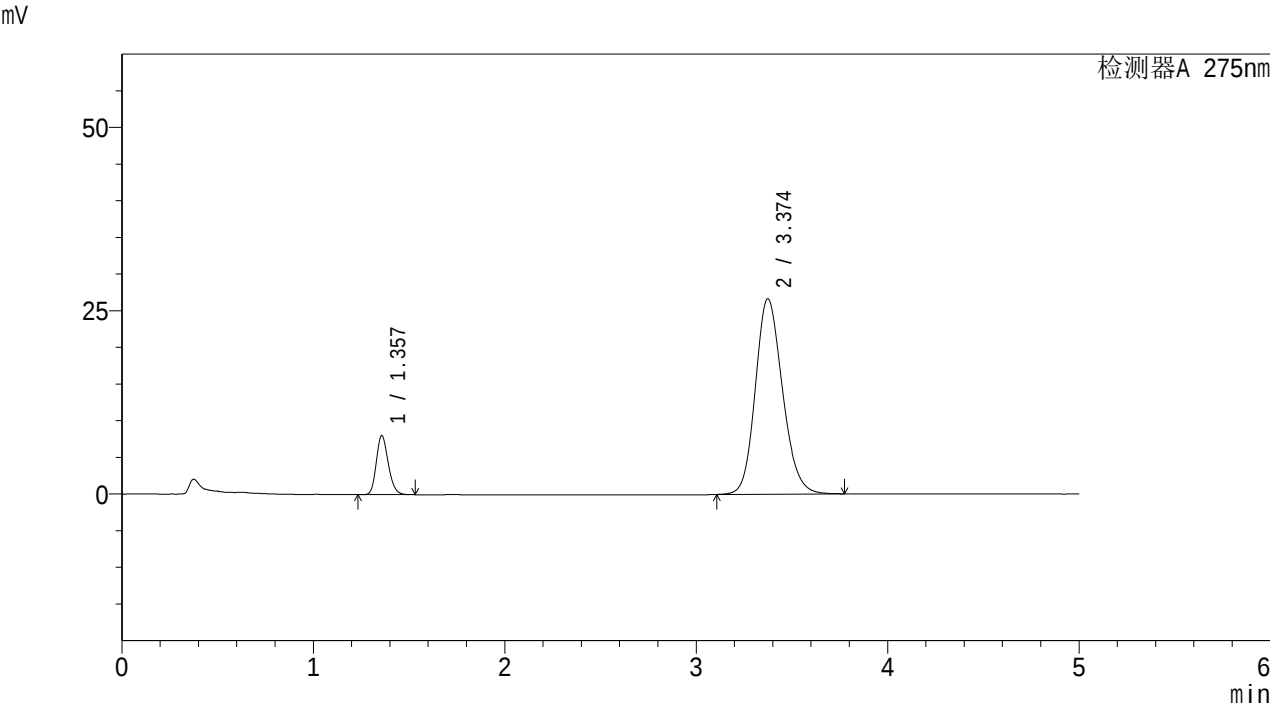

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	34849	11.725	8034	2286	1.198	--
2	3.374	262373	88.275	26656	2763	1.171	10.892
总计		297222	100.000	34690			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-385-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:05:15
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

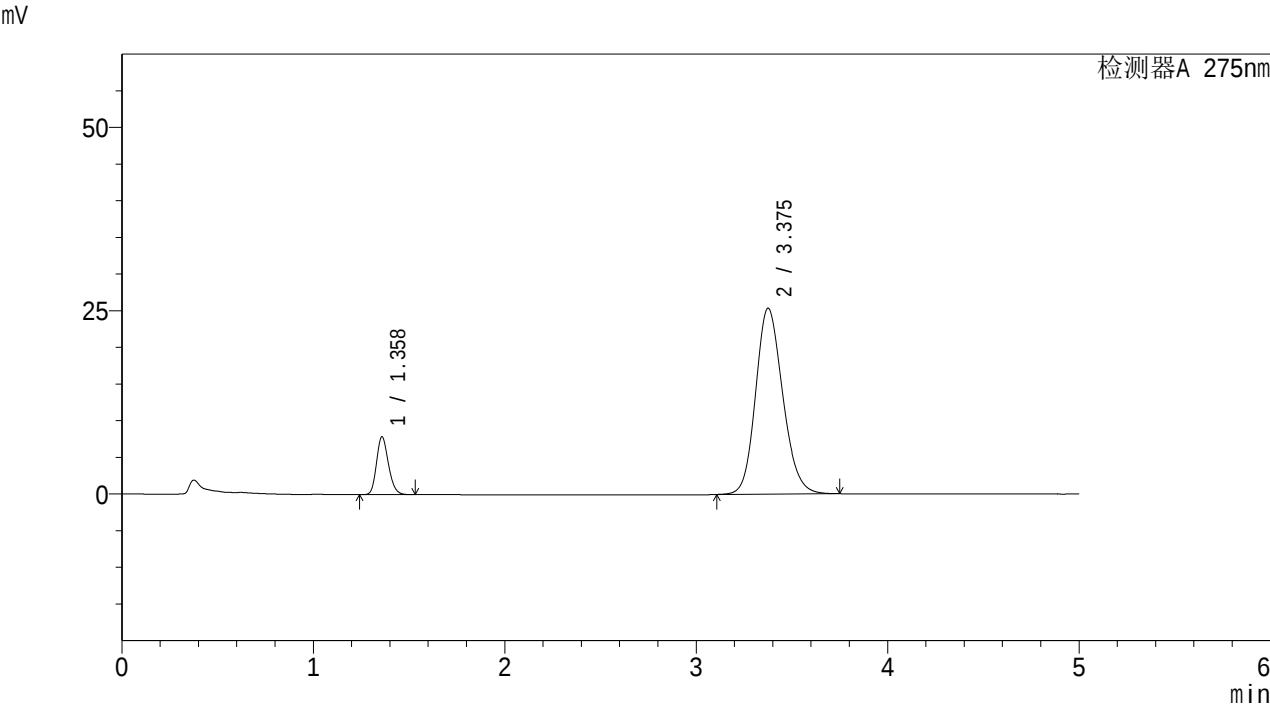

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34107	12.035	7845	2293	1.199	--
2	3.375	249289	87.965	25329	2770	1.167	10.903
总计		283396	100.000	33174			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-386-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:10:38

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

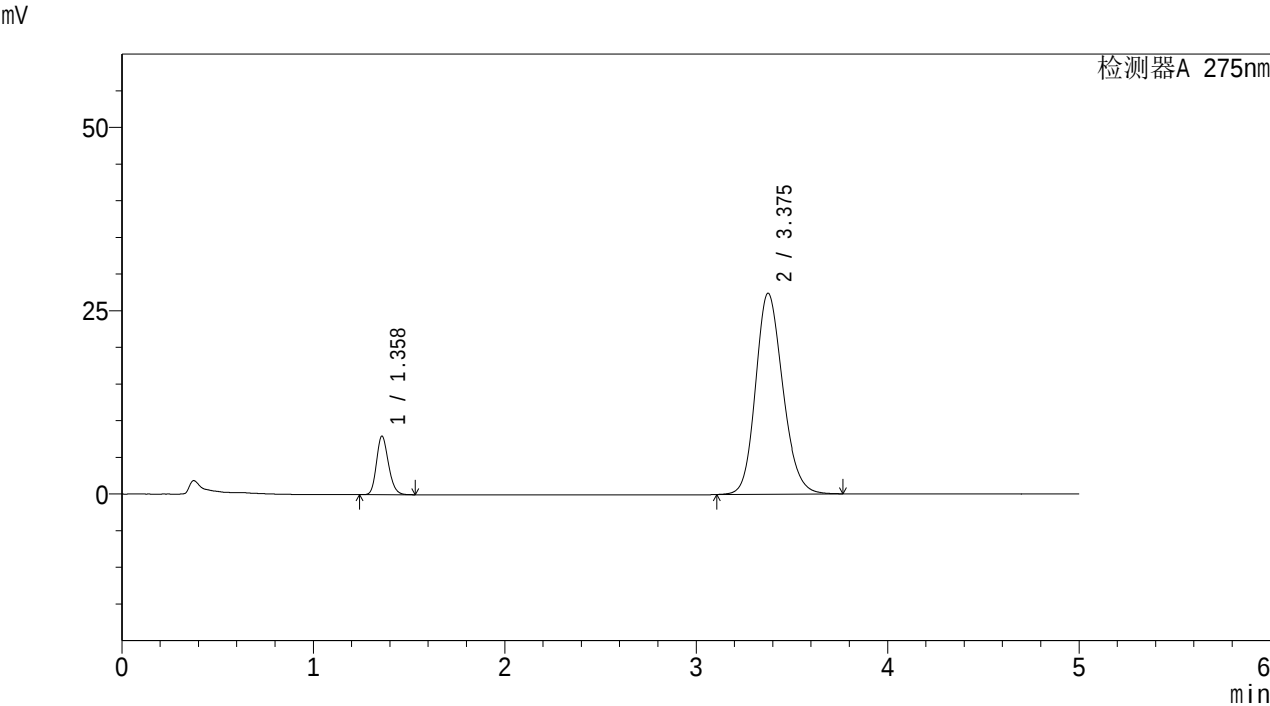

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34591	11.342	7943	2285	1.197	--
2	3.375	270384	88.658	27382	2756	1.172	10.878
总计		304975	100.000	35325			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-387-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:16:01
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

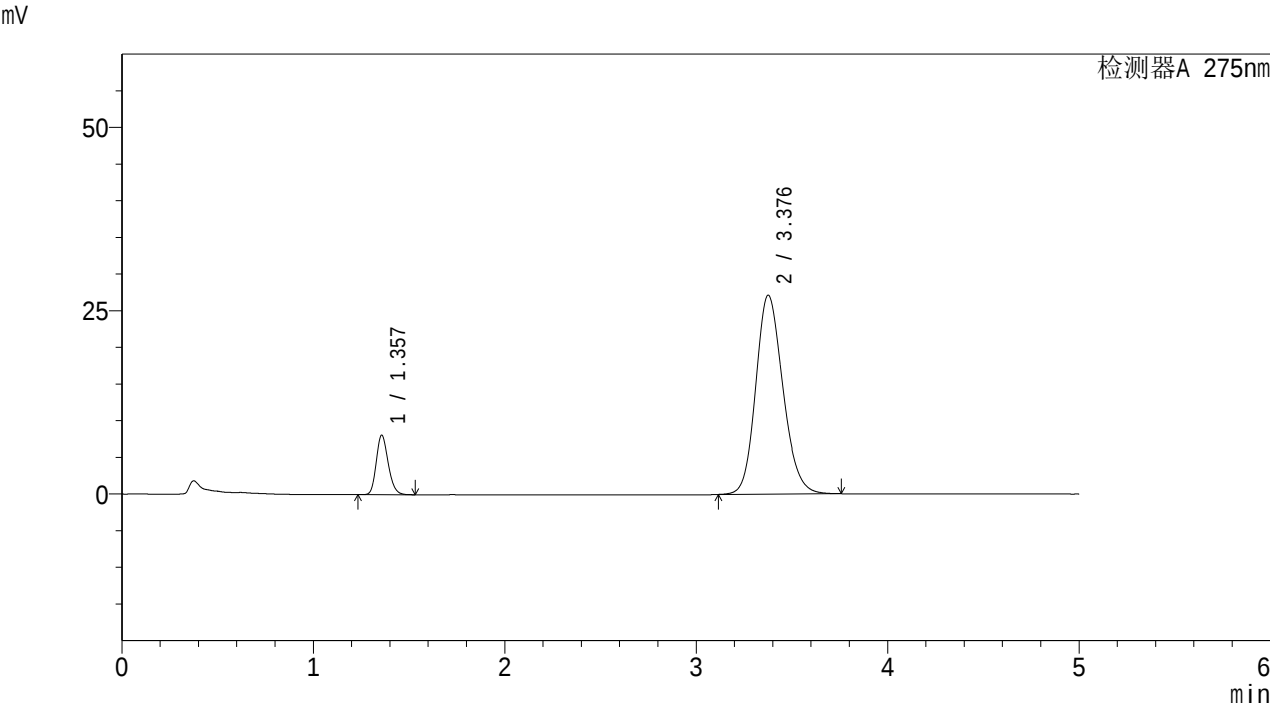

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	35111	11.613	8102	2285	1.198	--
2	3.376	267217	88.387	27087	2762	1.171	10.898
总计		302328	100.000	35189			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-388-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:21:24

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

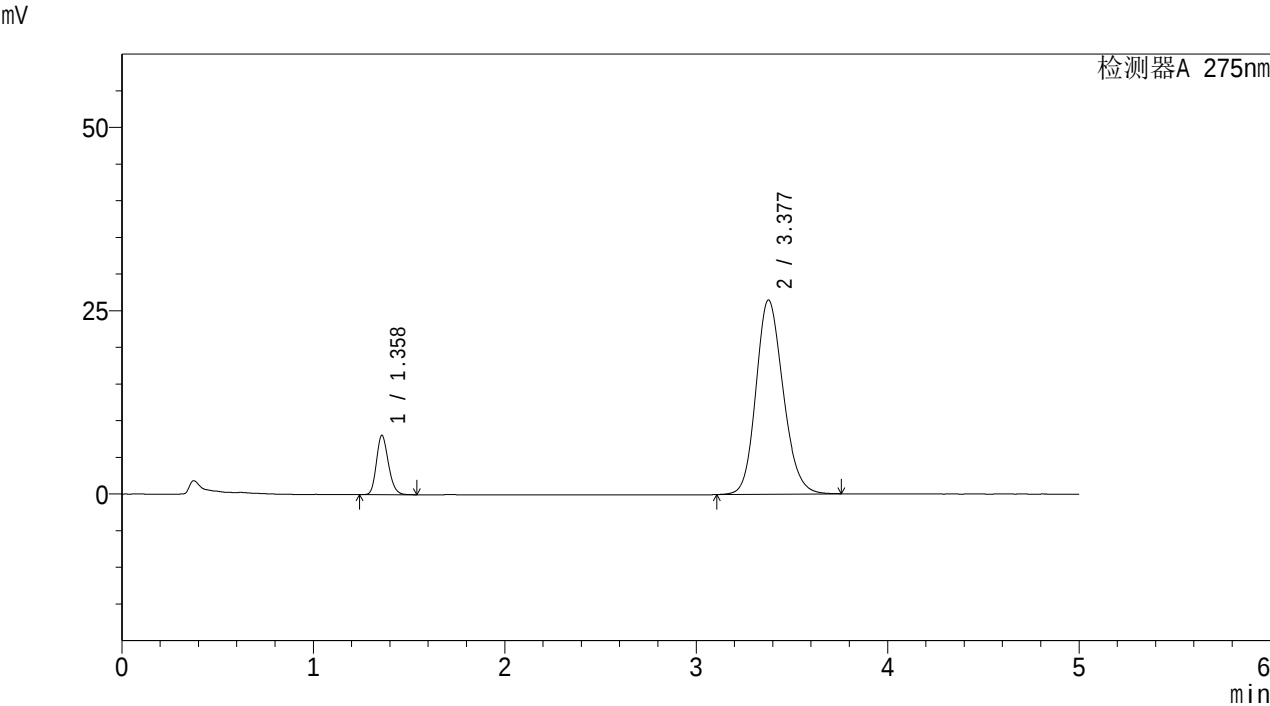

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	35059	11.845	8055	2288	1.197	--
2	3.377	260920	88.155	26478	2766	1.169	10.903
总计		295979	100.000	34533			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-389-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:26:48
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

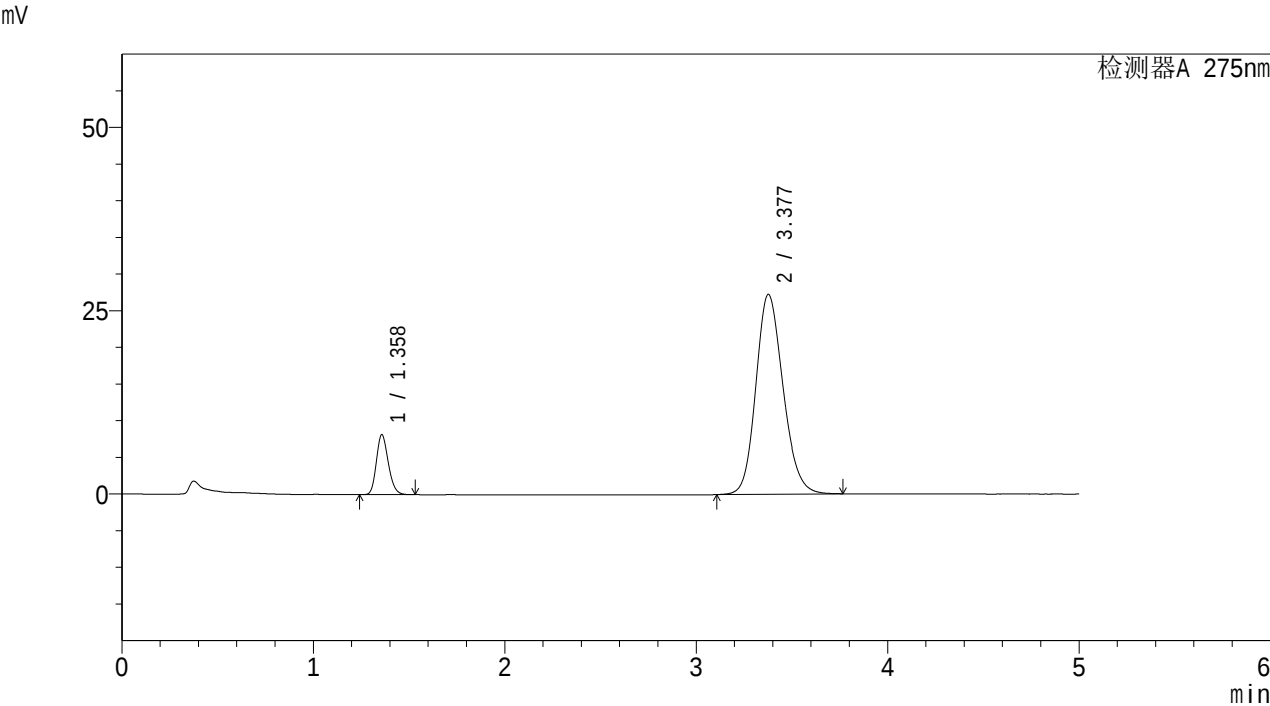

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	35381	11.626	8155	2287	1.198	--
2	3.377	268957	88.374	27237	2757	1.170	10.891
总计		304338	100.000	35392			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-390-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:32:10
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

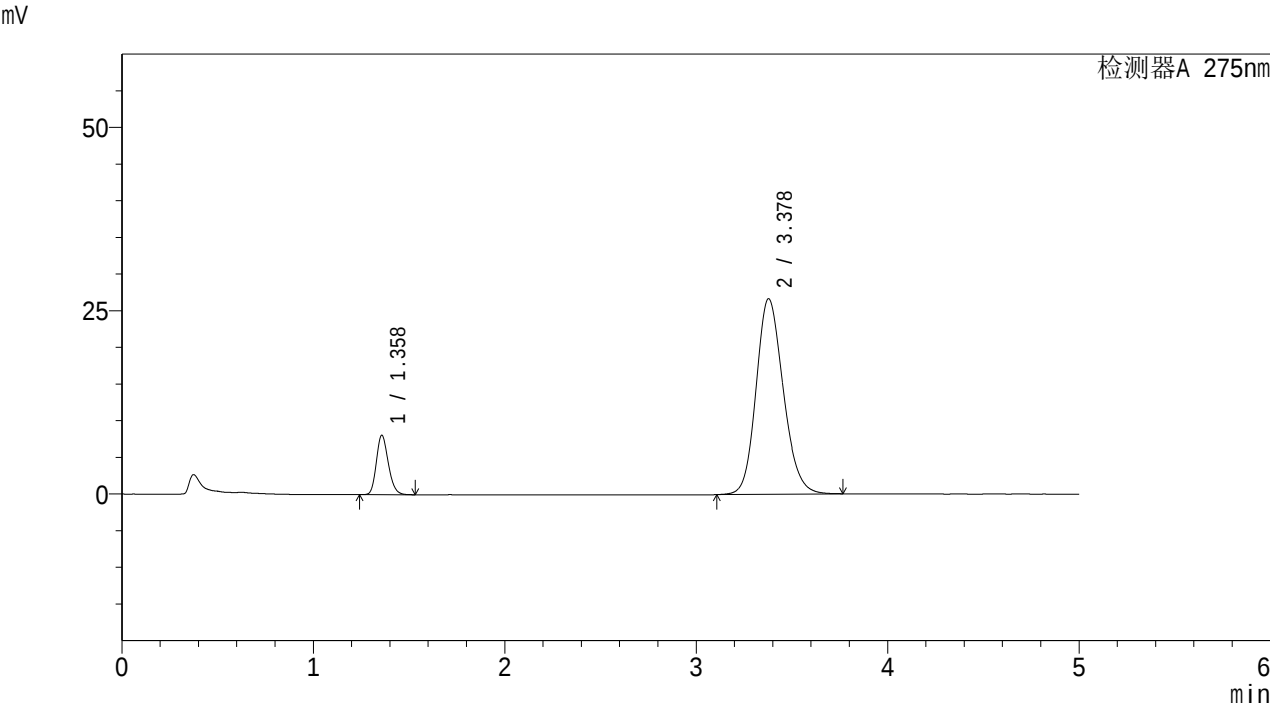

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	35098	11.783	8080	2287	1.198	--
2	3.378	262776	88.217	26666	2769	1.169	10.912
总计		297874	100.000	34746			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-391-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:37:32
处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

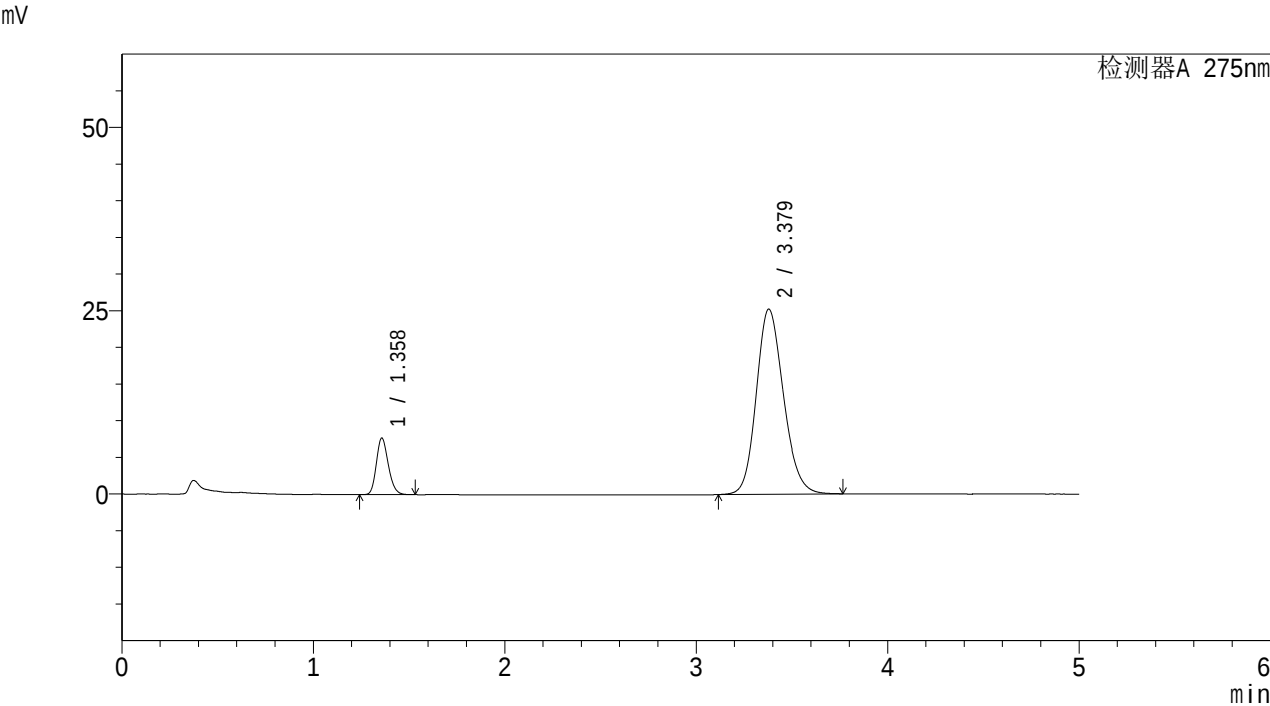

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	33433	11.839	7699	2284	1.196	--
2	3.379	248976	88.161	25257	2762	1.167	10.902
总计		282409	100.000	32956			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-392-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:42:55

处理时间(V2): 2026/05/12 11:55:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

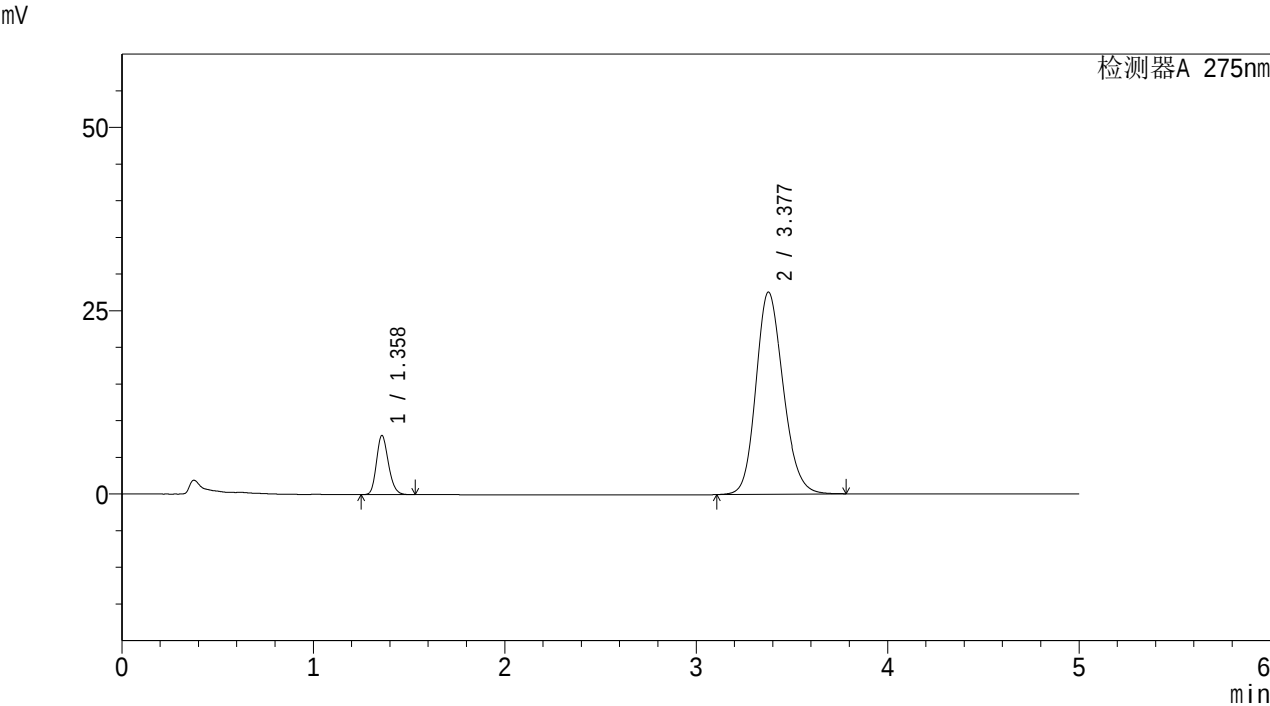

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34942	11.365	8028	2285	1.197	--
2	3.377	272522	88.635	27550	2751	1.173	10.879
总计		307465	100.000	35578			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-393-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:48:20
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

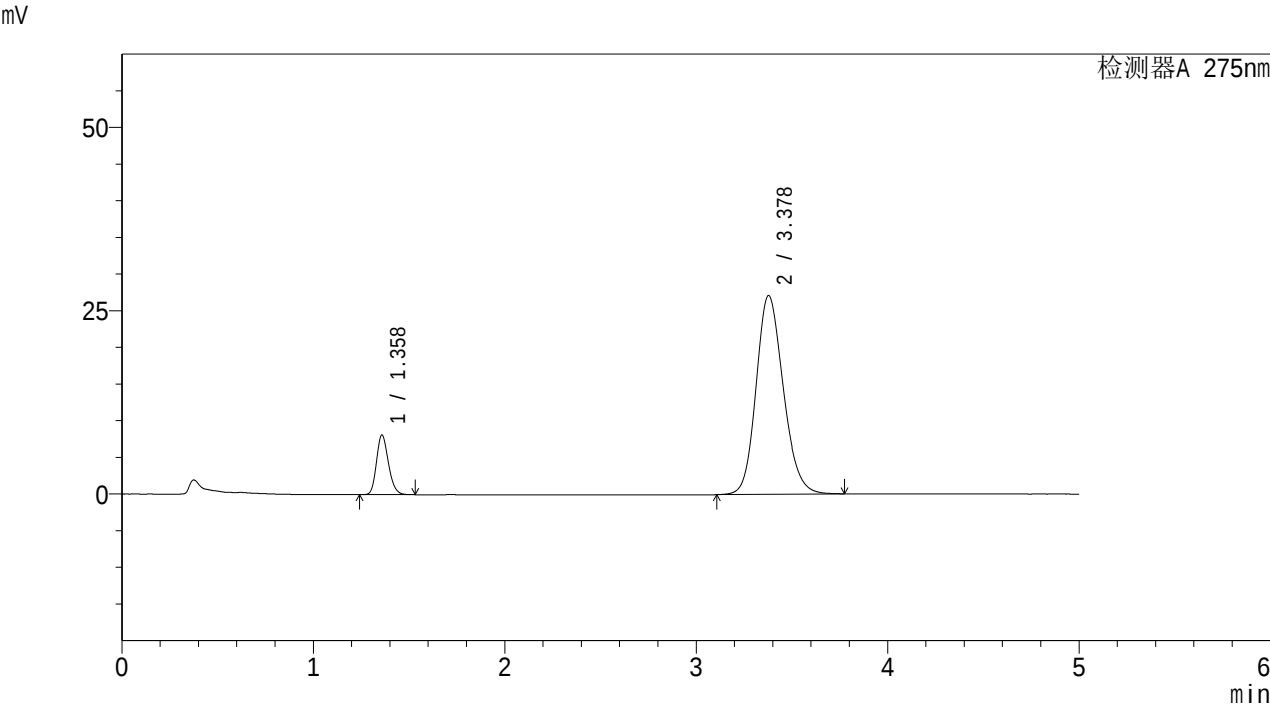

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	35202	11.633	8095	2290	1.198	--
2	3.378	267408	88.367	27097	2760	1.171	10.895
总计		302610	100.000	35192			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-394-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:53:43

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

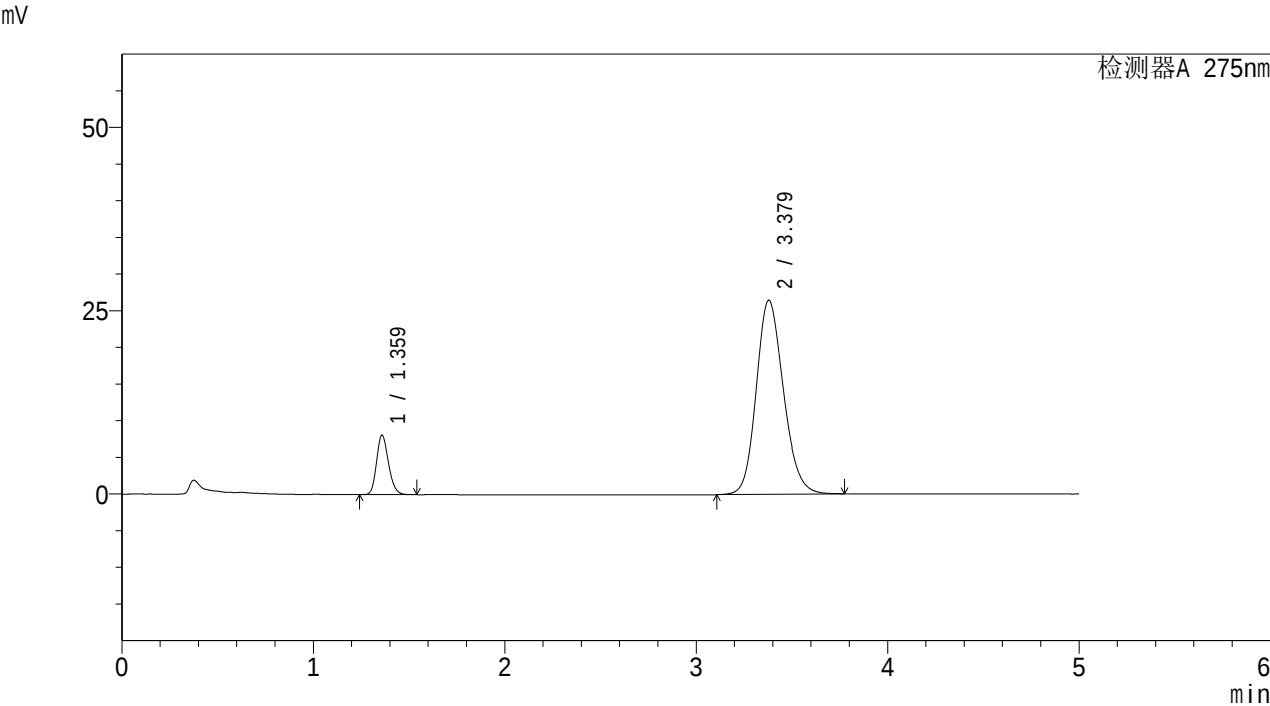

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	35165	11.871	8066	2290	1.199	--
2	3.379	261063	88.129	26478	2765	1.168	10.903
总计		296229	100.000	34544			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-395-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:59:07
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

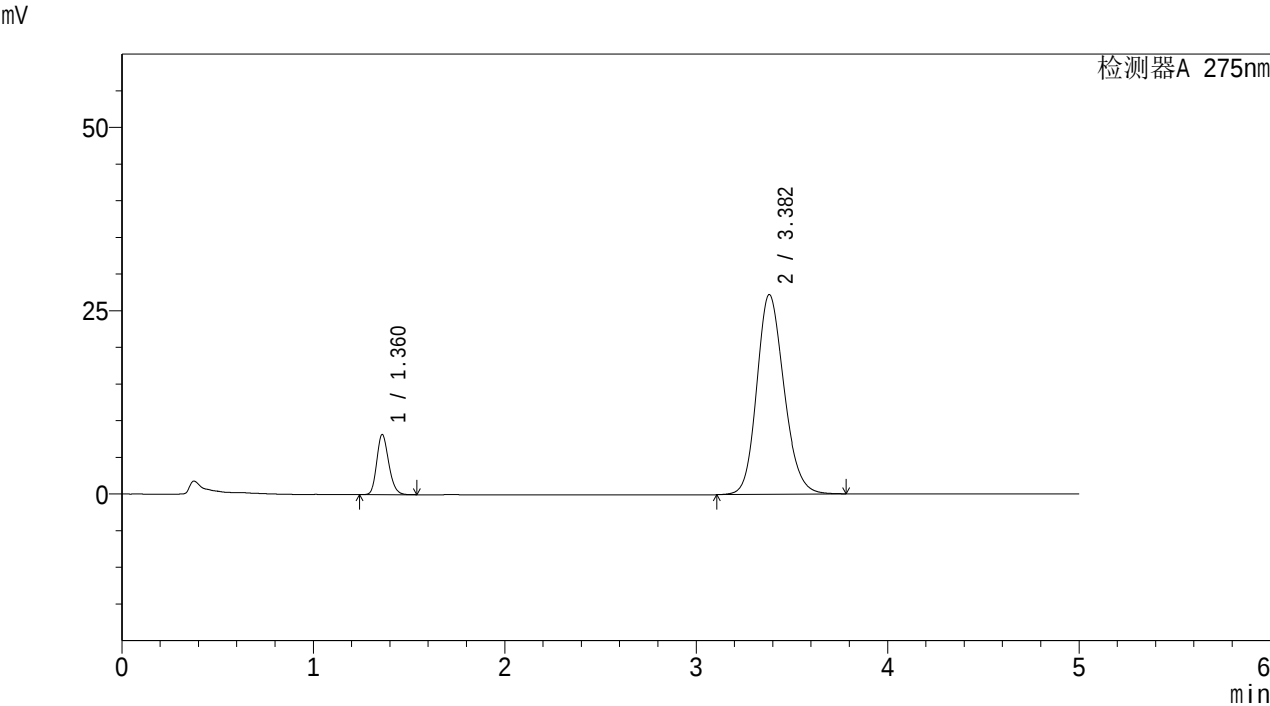

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35558	11.668	8137	2291	1.199	--
2	3.382	269181	88.332	27251	2761	1.172	10.899
总计		304740	100.000	35388			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-396-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:04:30

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

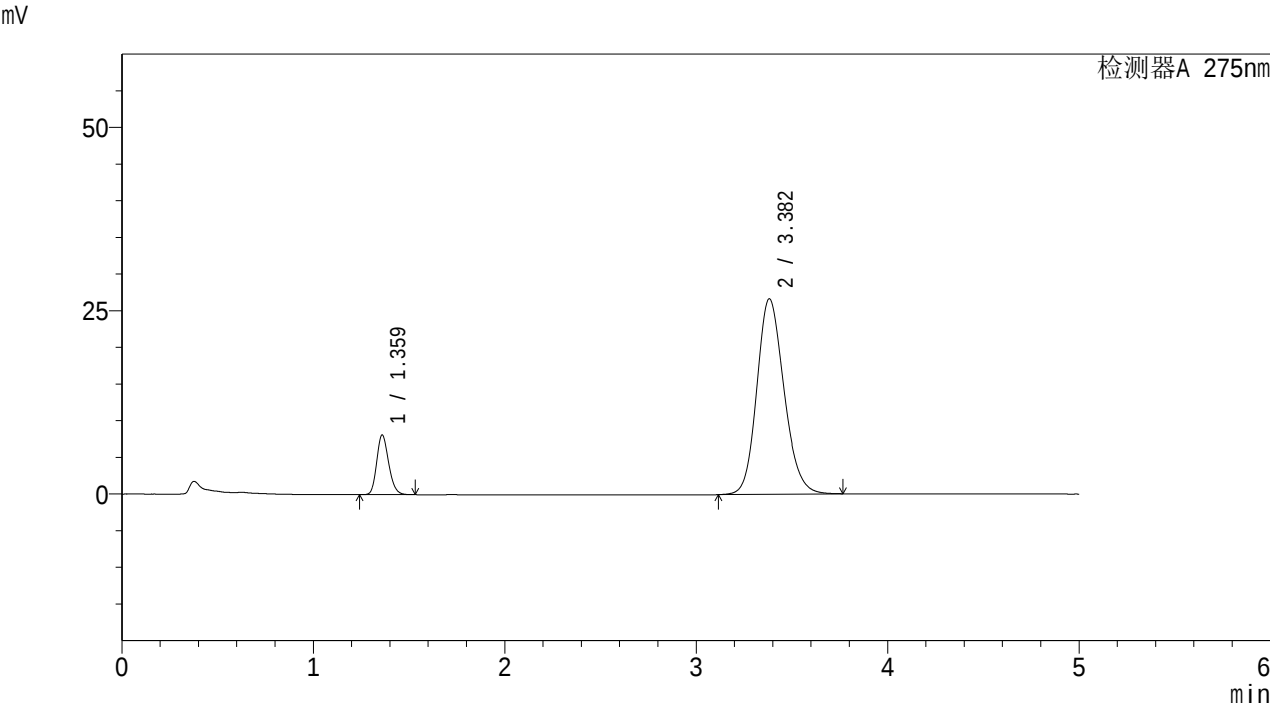

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	35233	11.813	8065	2293	1.198	--
2	3.382	263022	88.187	26665	2766	1.169	10.909
总计		298254	100.000	34729			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-397-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:09:53
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

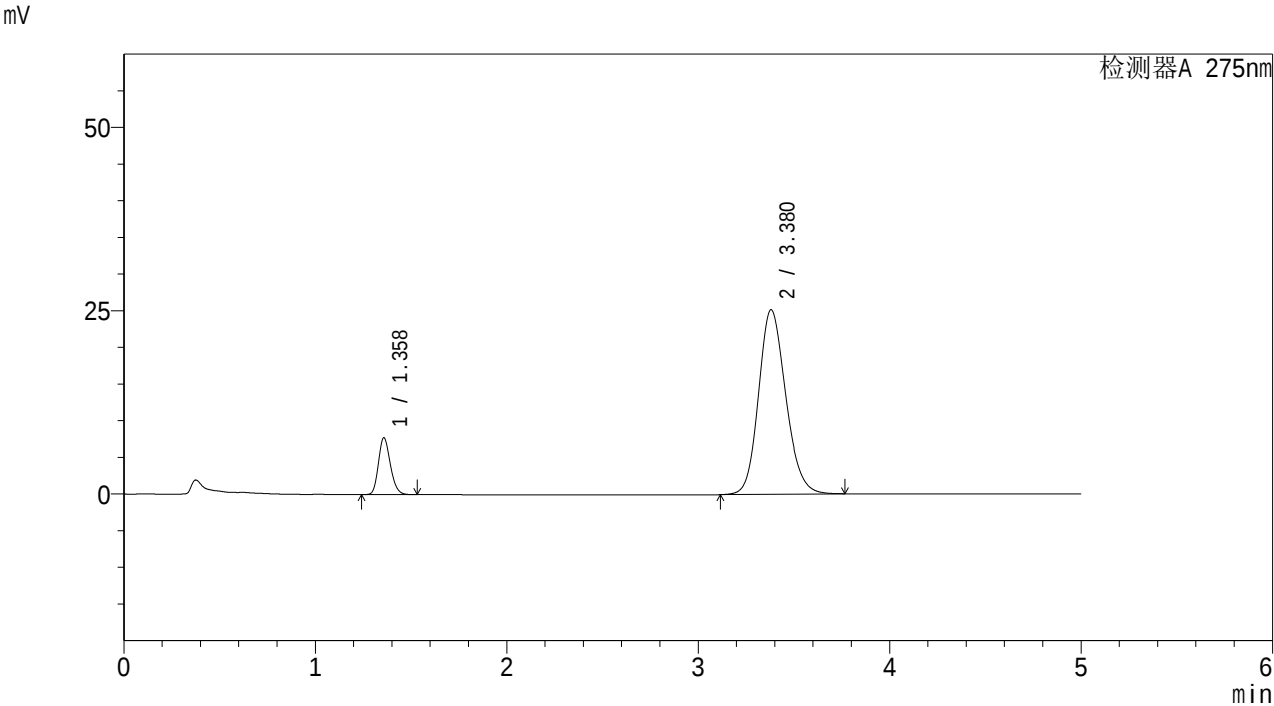

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	33549	11.900	7731	2293	1.197	--
2	3.380	248377	88.100	25182	2764	1.166	10.914
总计		281926	100.000	32913			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-398-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:15:17

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

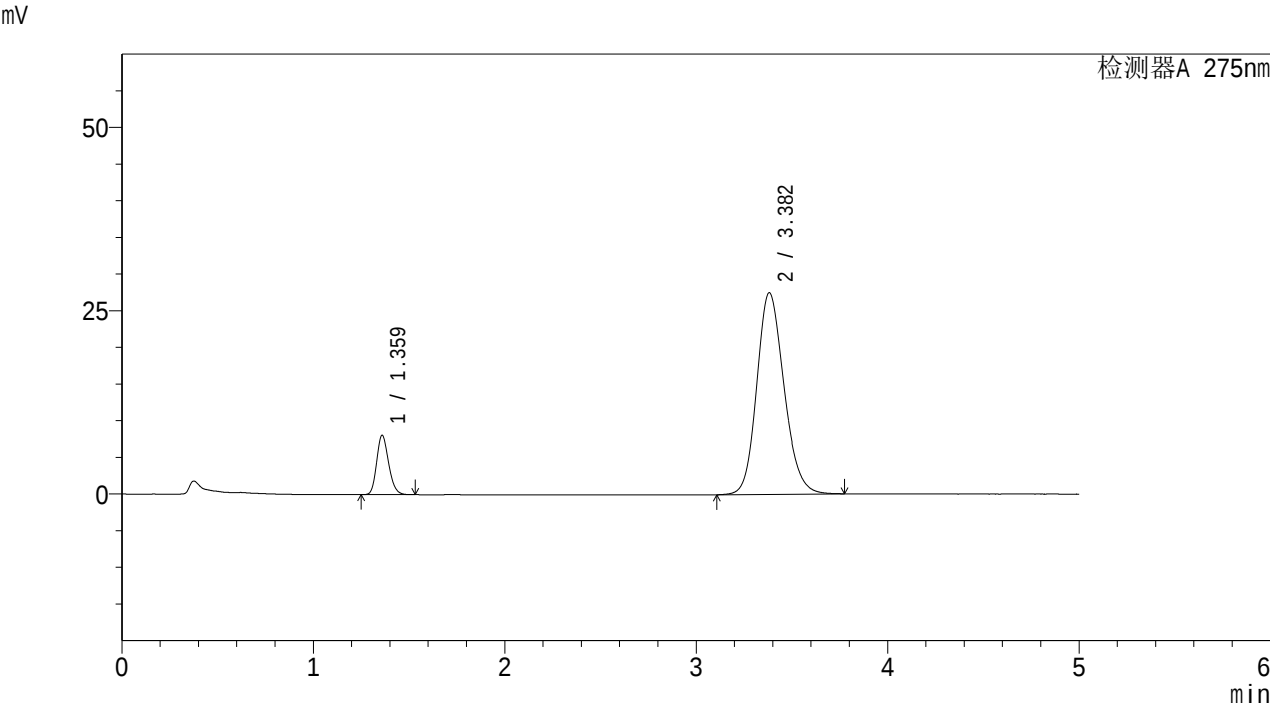

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	35110	11.435	8023	2286	1.198	--
2	3.382	271926	88.565	27503	2756	1.170	10.891
总计		307036	100.000	35526			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-399-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:20:41
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

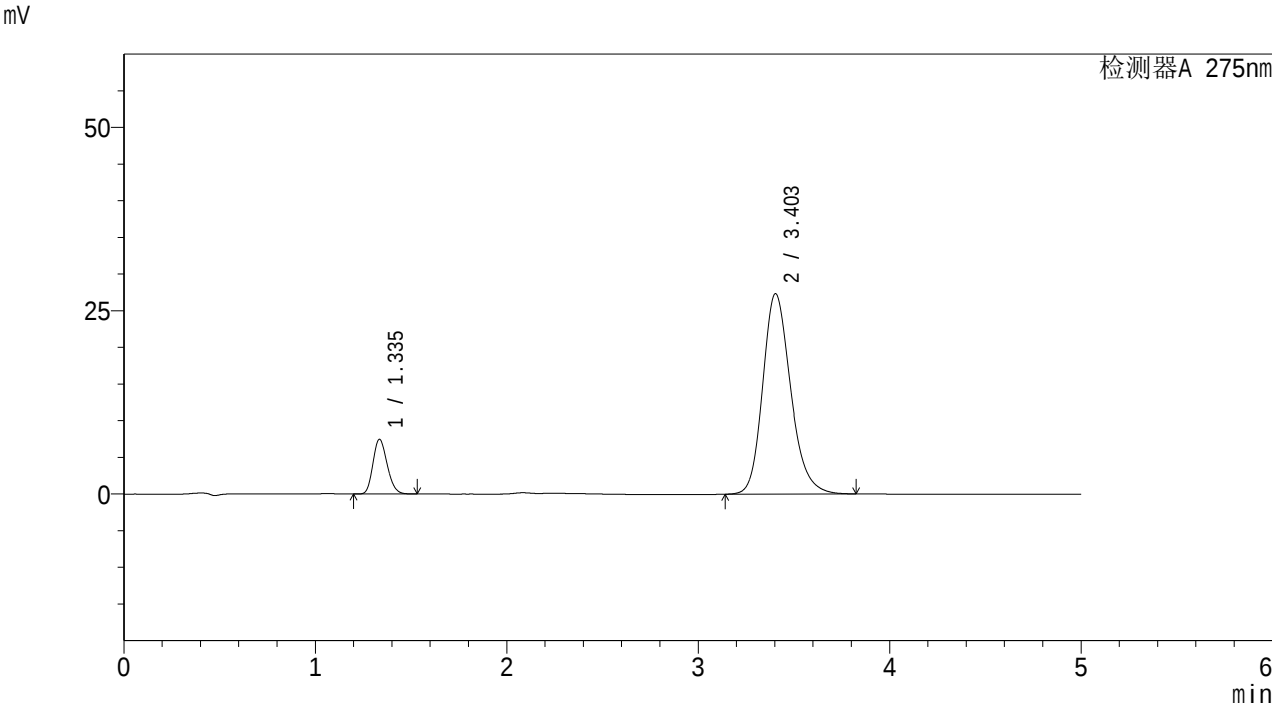

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	38485	12.182	7427	1537	1.189	--
2	3.403	277445	87.818	27338	2697	1.213	10.386
总计		315930	100.000	34764			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-400-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:26:04

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

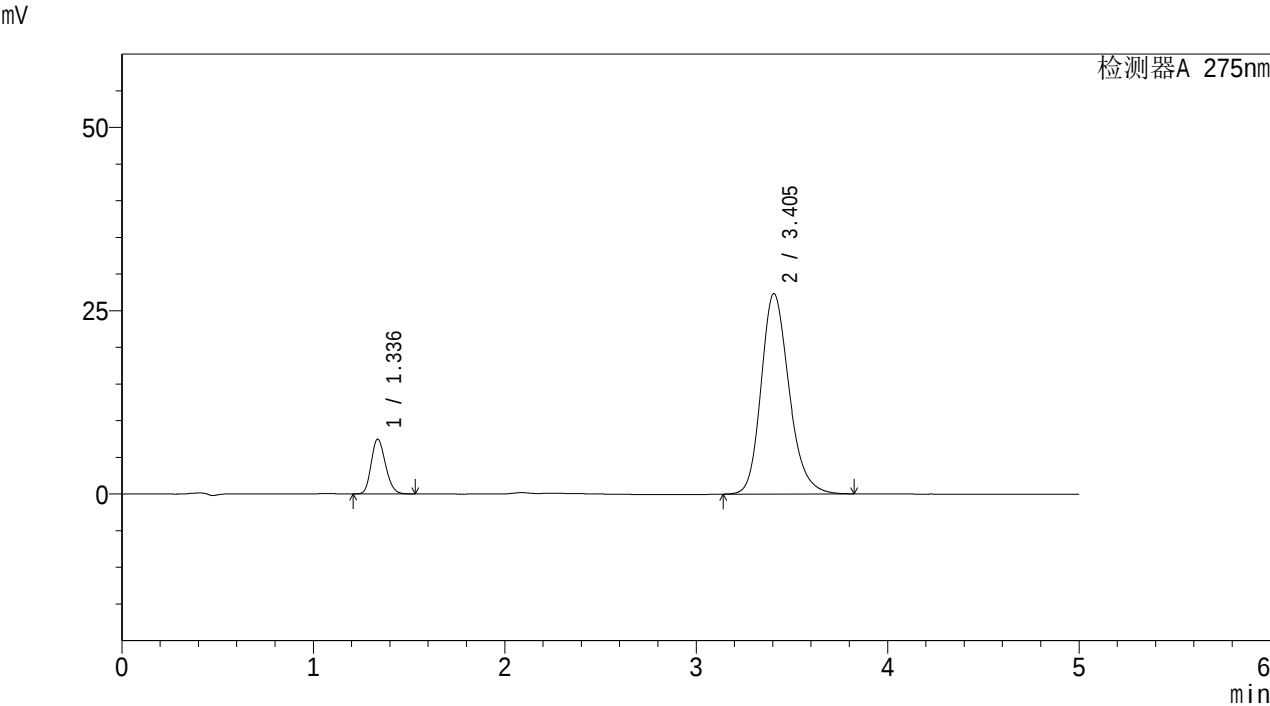

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.336	38602	12.207	7458	1533	1.185	--
2	3.405	277632	87.793	27352	2694	1.213	10.373
总计		316234	100.000	34810			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-401-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:31:29
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

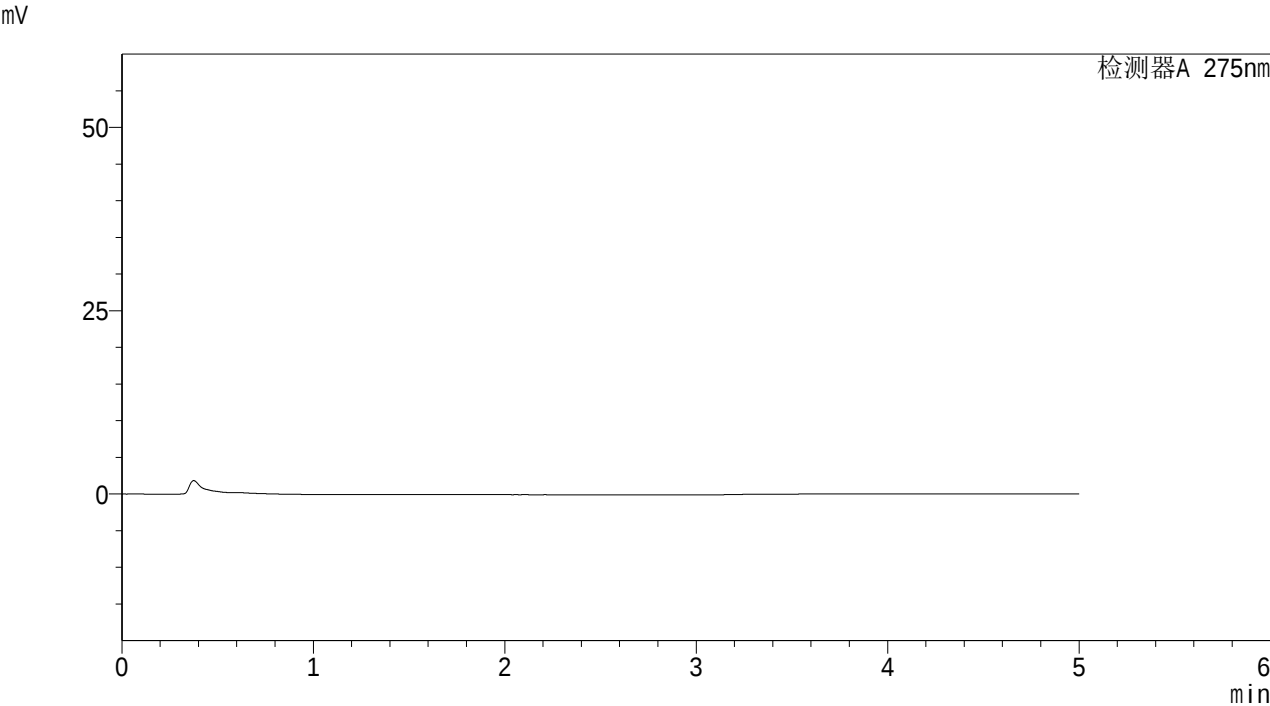

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-402-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:36:54
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

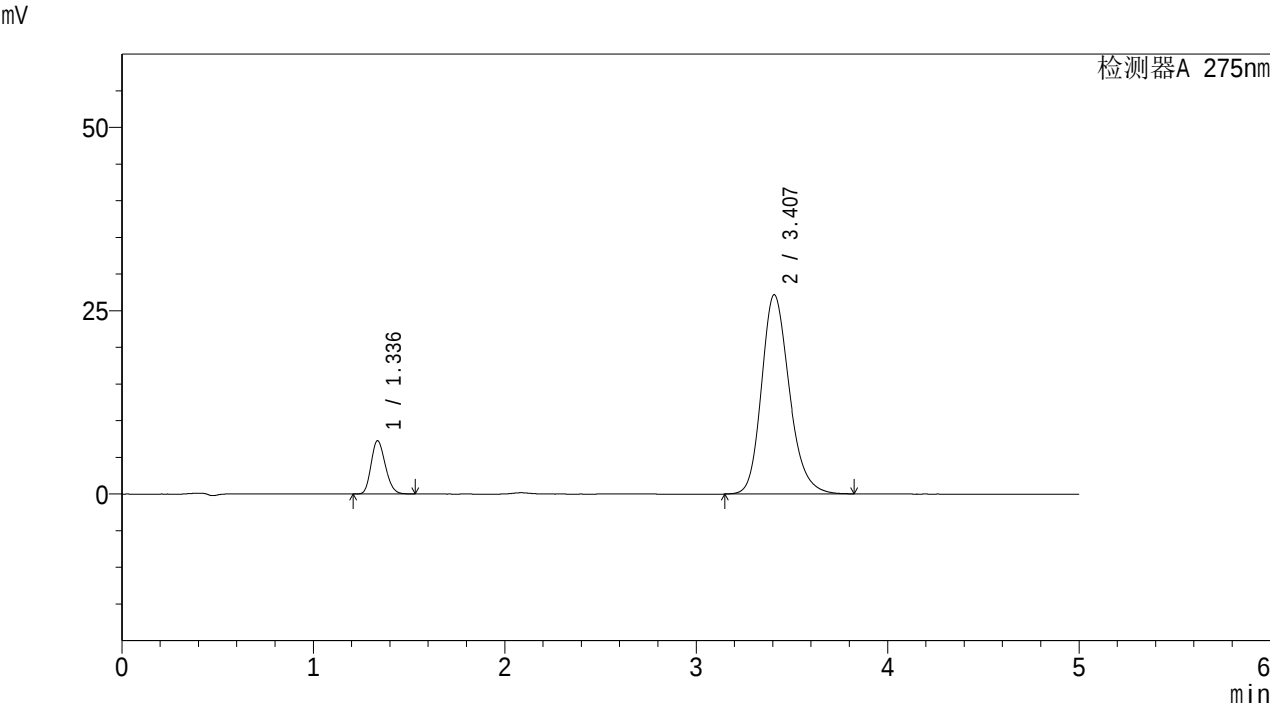

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.336	37421	12.014	7244	1543	1.187	--
2	3.407	274058	87.986	27165	2732	1.212	10.444
总计		311479	100.000	34409			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-403-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:42:19

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

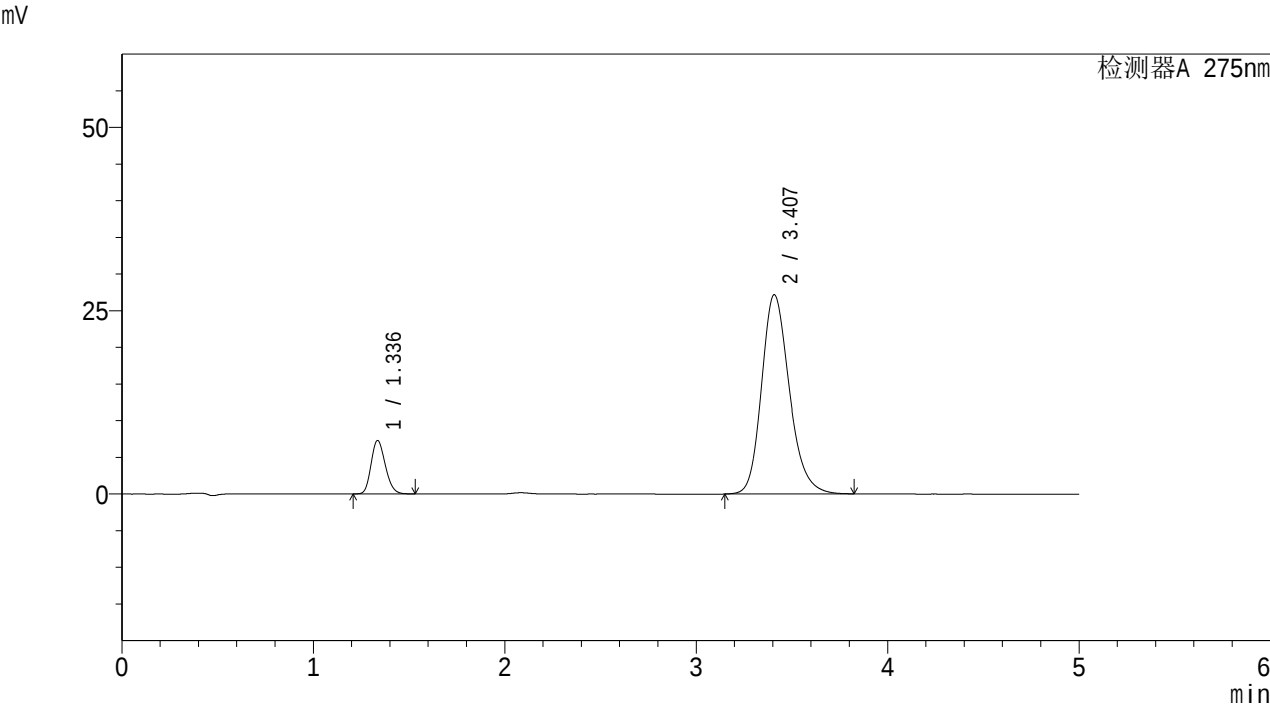

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.336	37517	12.028	7267	1547	1.191	--
2	3.407	274395	87.972	27168	2729	1.213	10.444
总计		311912	100.000	34434			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-404-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:47:43
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

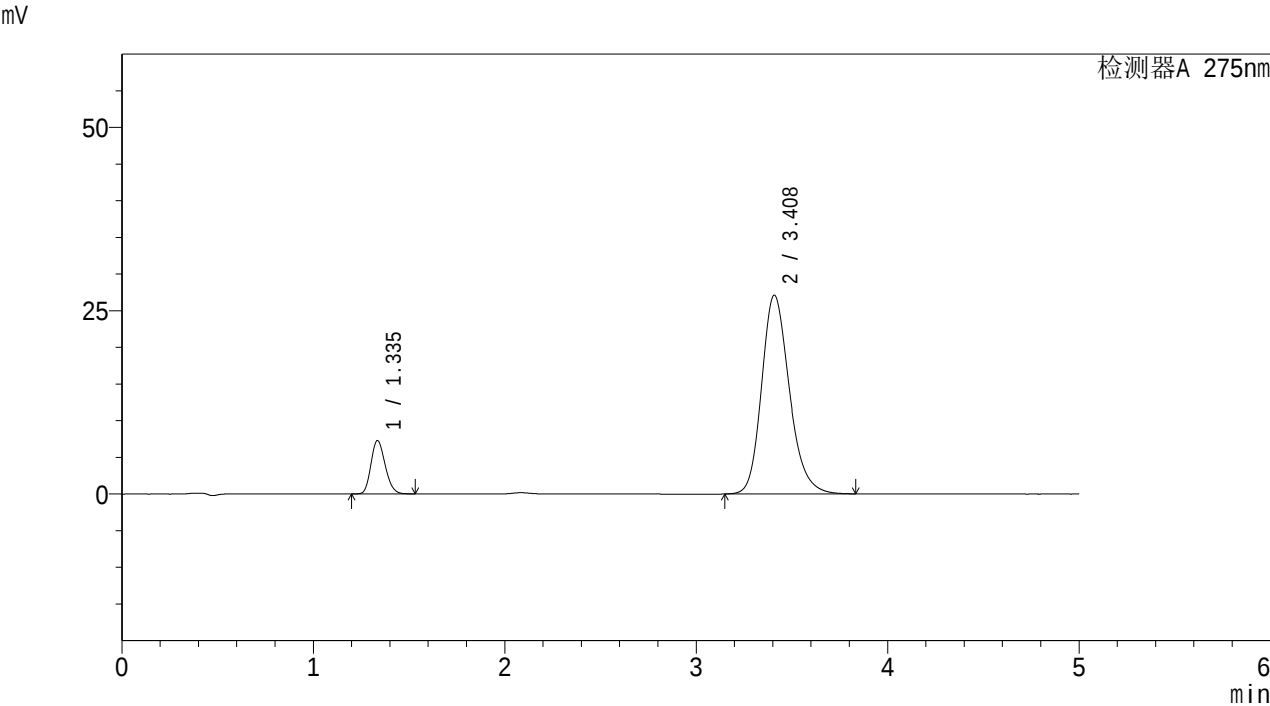

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	37483	12.047	7244	1543	1.189	--
2	3.408	273665	87.953	27098	2729	1.212	10.446
总计		311149	100.000	34343			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-405-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:53:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

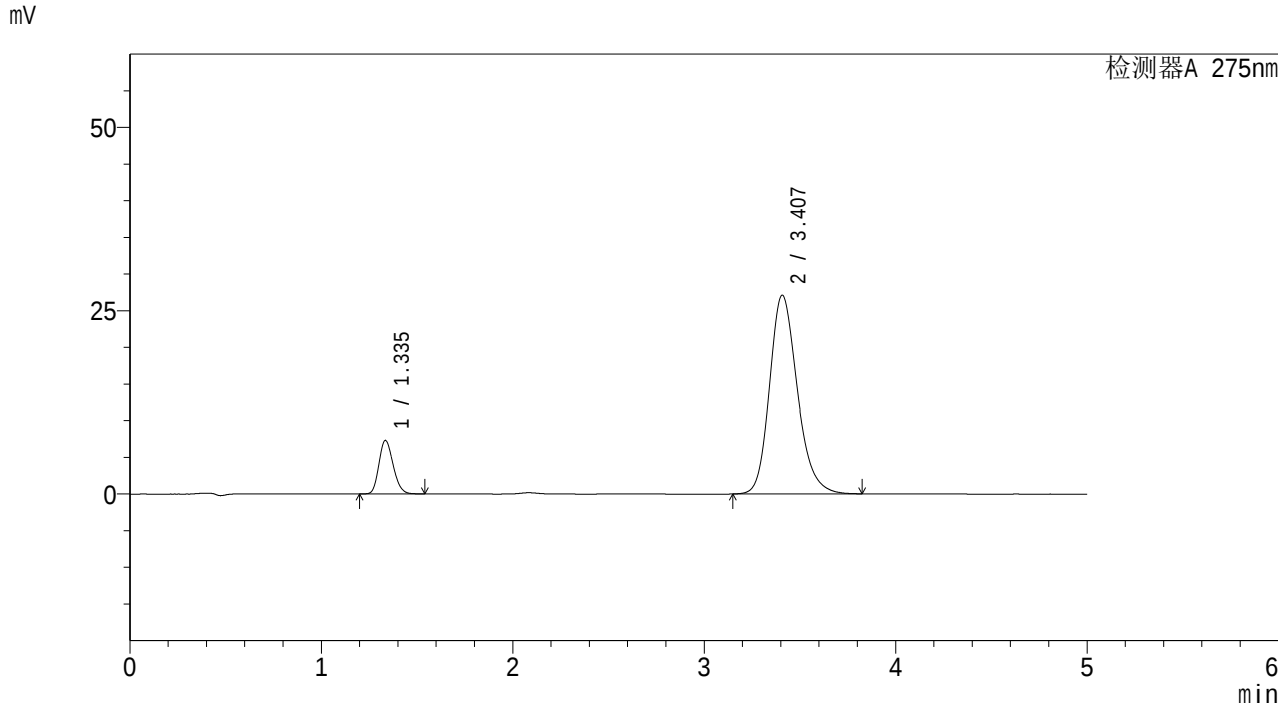

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	37644	12.092	7256	1539	1.192	--
2	3.407	273671	87.908	27103	2727	1.212	10.439
总计		311315	100.000	34359			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-406-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:58:33

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

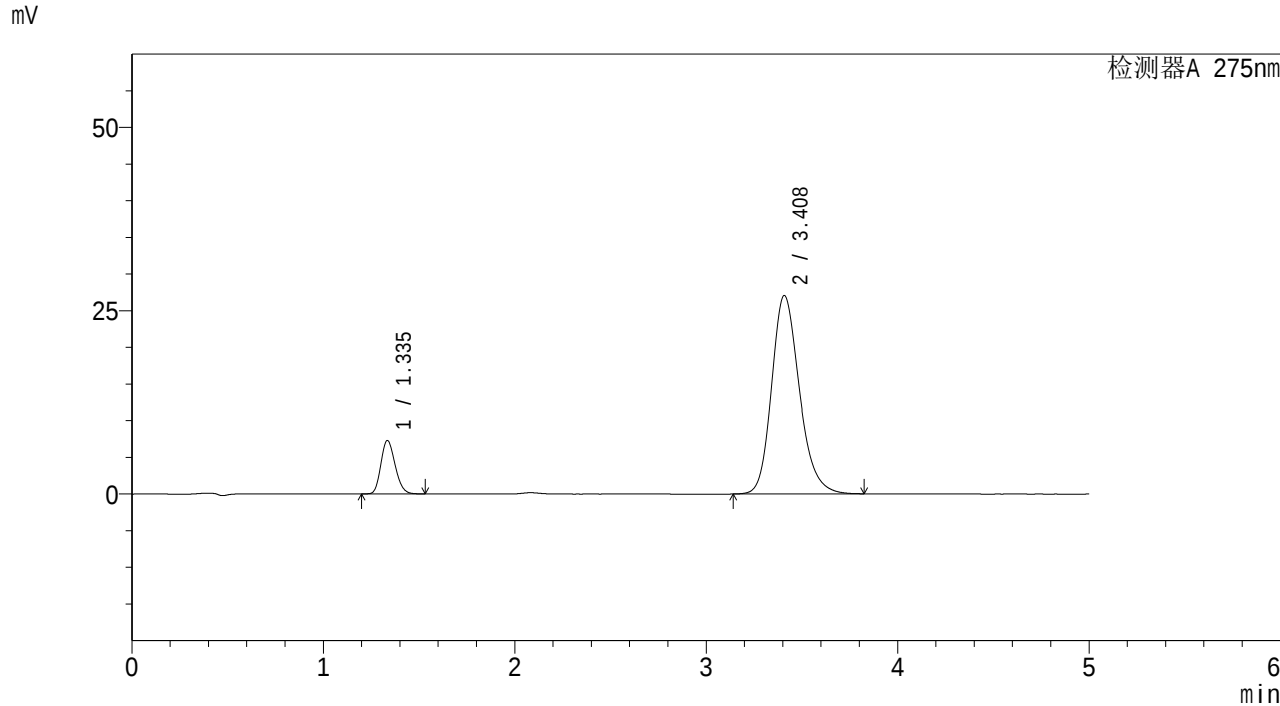

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.335	37537	12.078	7245	1543	1.190	--
2	3.408	273242	87.922	27049	2730	1.211	10.449
总计		310779	100.000	34294			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-407-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:03:57
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

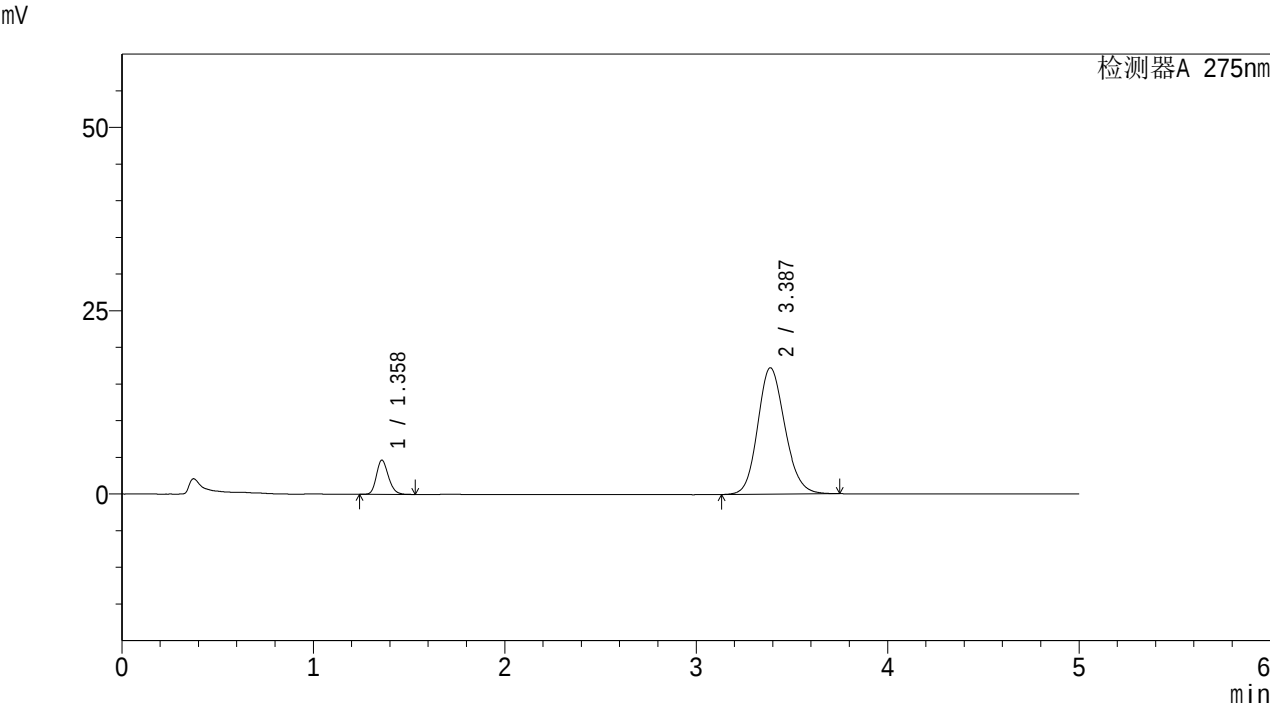

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	20238	10.626	4648	2283	1.198	--
2	3.387	170217	89.374	17250	2769	1.150	10.935
总计		190456	100.000	21898			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-408-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:09:21
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

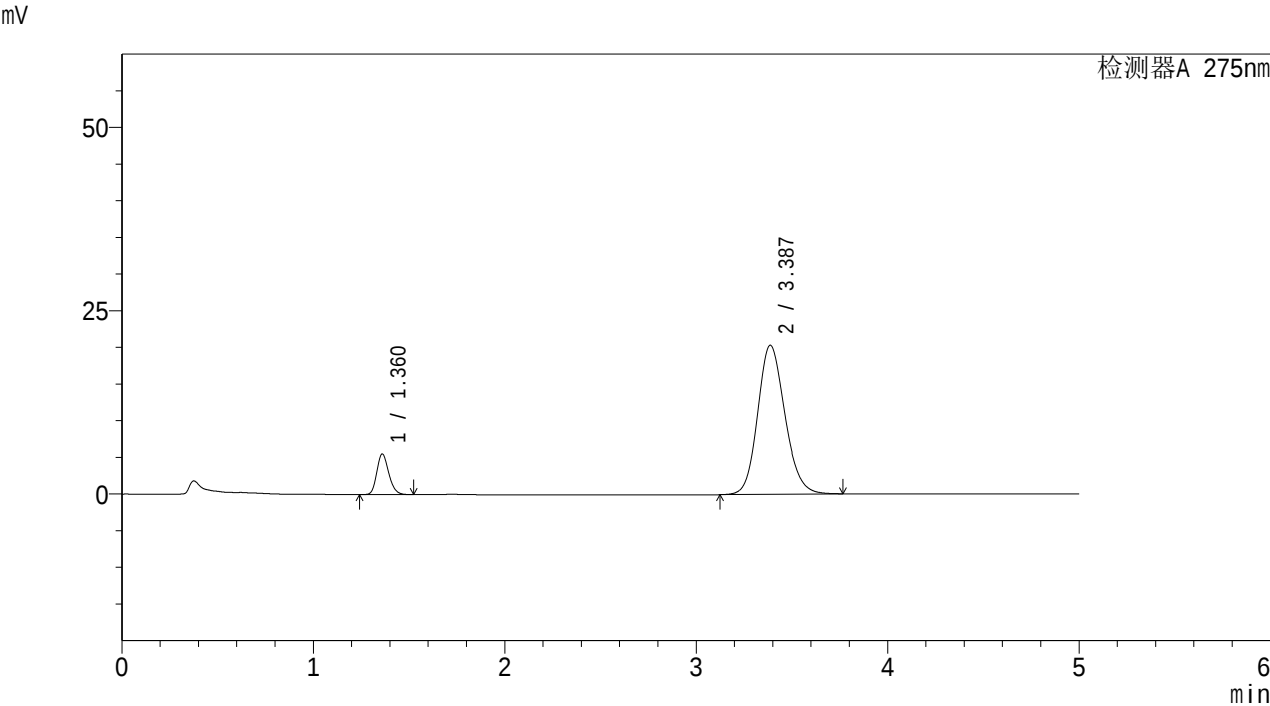

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	23980	10.653	5499	2289	1.195	--
2	3.387	201129	89.347	20338	2760	1.157	10.911
总计		225109	100.000	25837			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-409-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 22:14:46

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

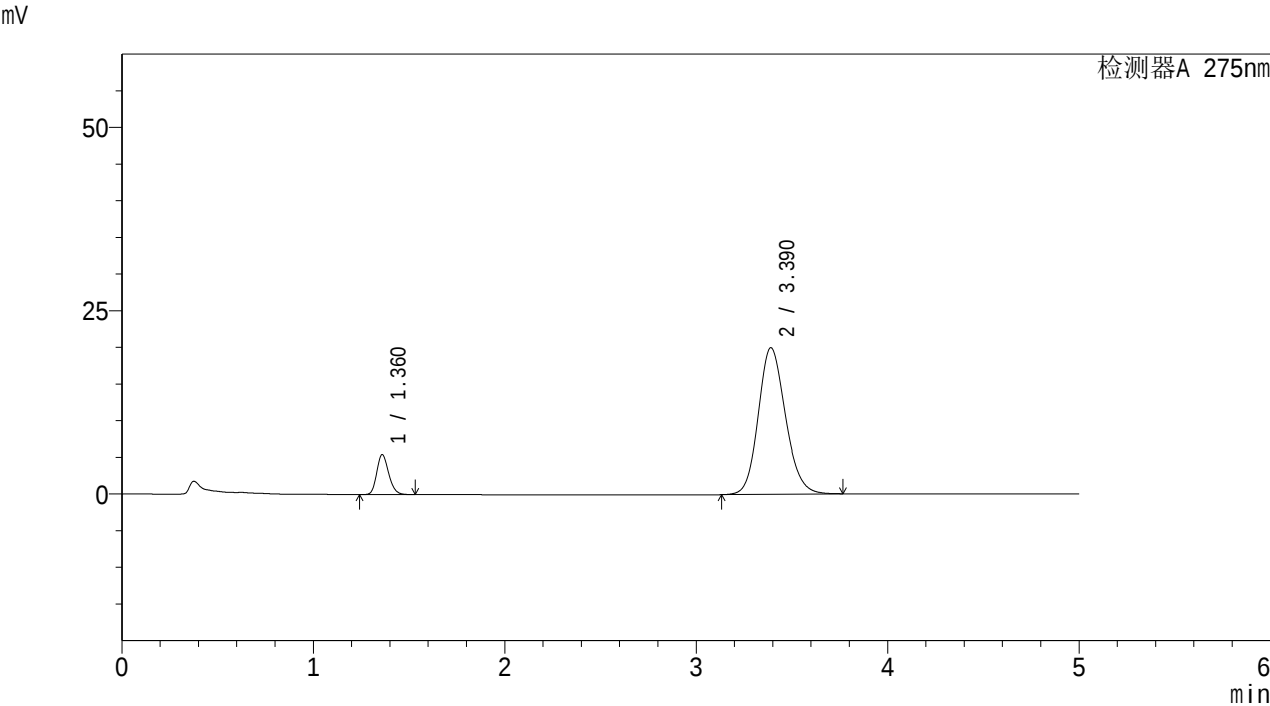

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	23636	10.694	5407	2291	1.195	--
2	3.390	197388	89.306	20001	2775	1.156	10.945
总计		221024	100.000	25409			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-410-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 22:20:09

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

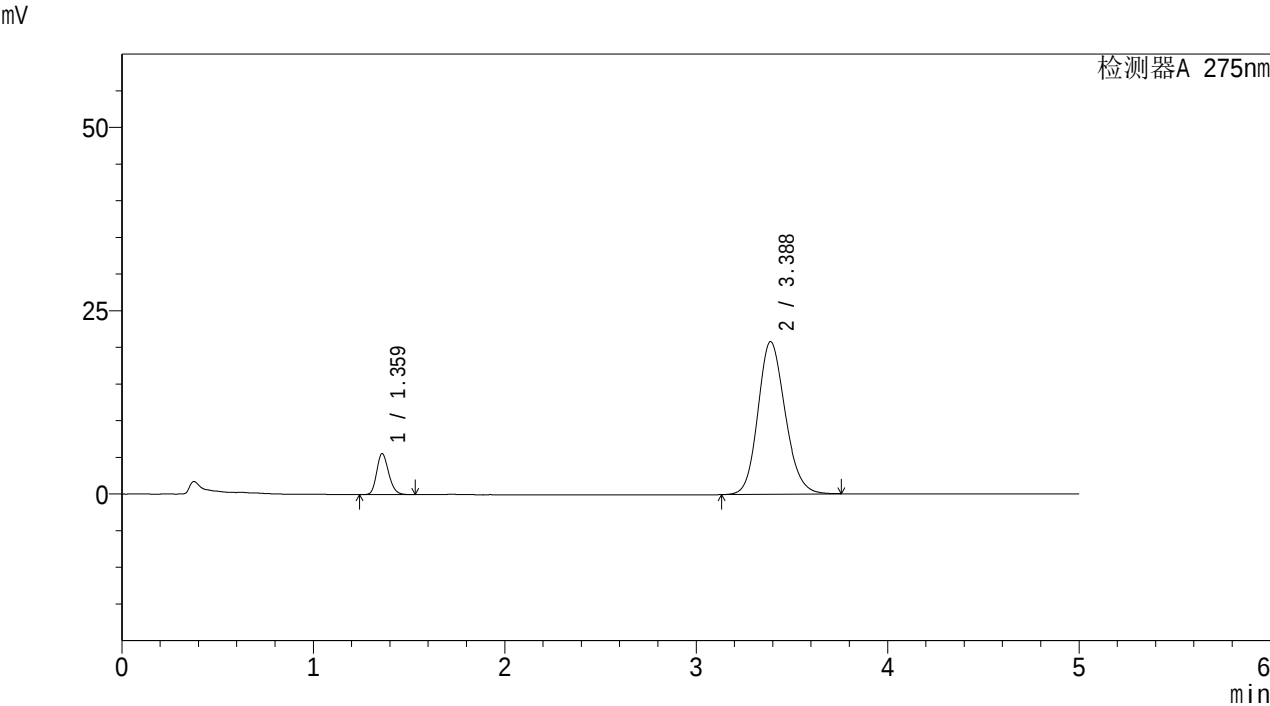

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	24216	10.541	5537	2288	1.197	--
2	3.388	205522	89.459	20826	2767	1.158	10.928
总计		229738	100.000	26364			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-411-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:25:32
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

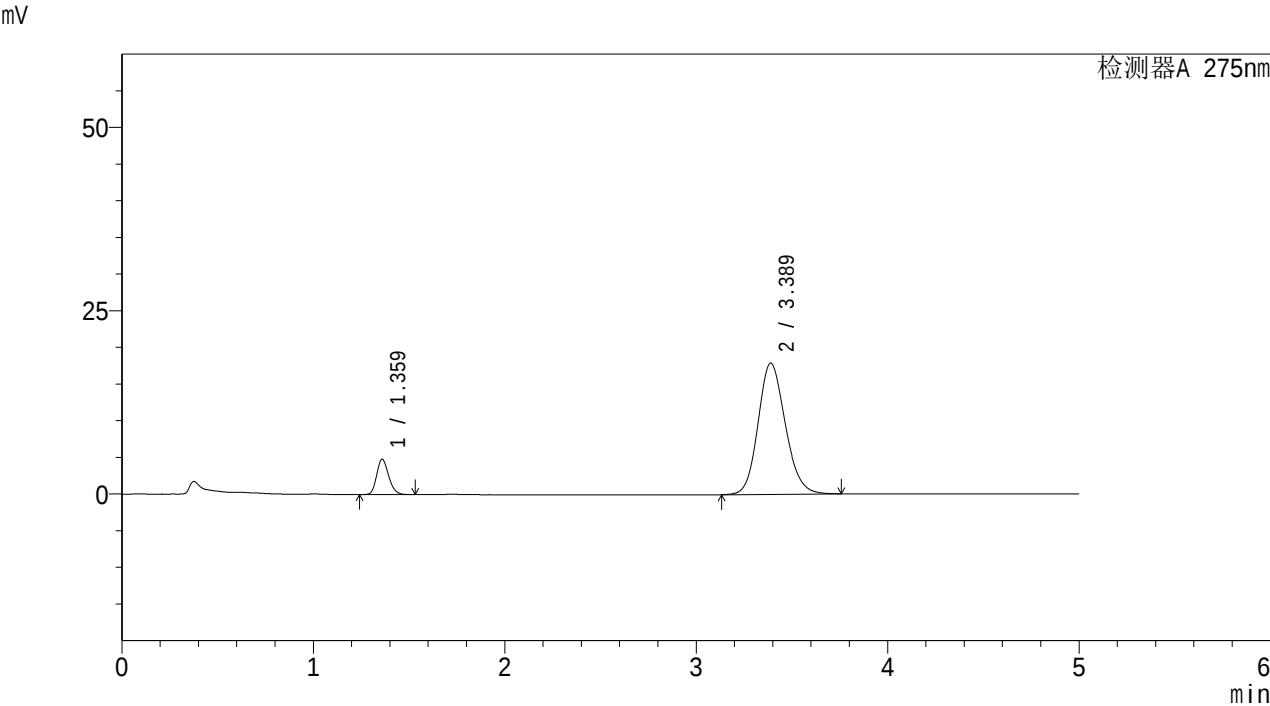

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	20892	10.570	4778	2291	1.196	--
2	3.389	176758	89.430	17907	2770	1.153	10.937
总计		197651	100.000	22685			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-412-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:30:56
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

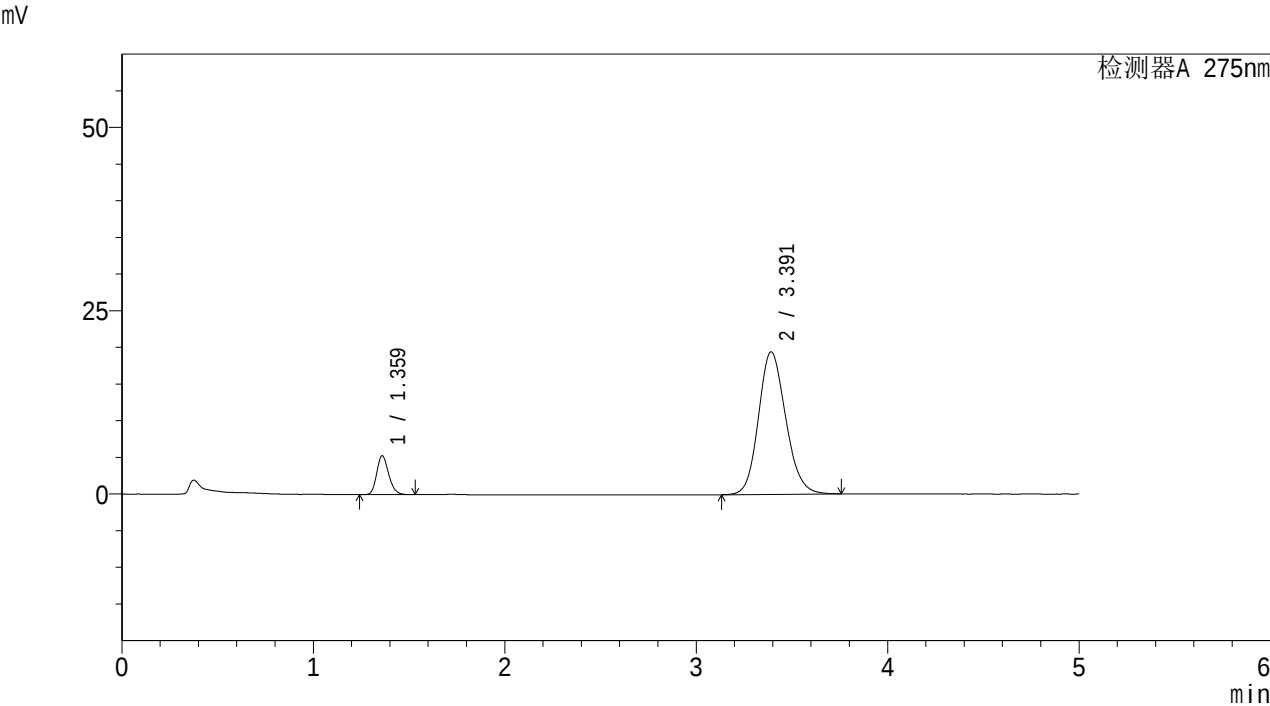

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	22992	10.692	5256	2289	1.195	--
2	3.391	192052	89.308	19435	2770	1.155	10.940
总计		215044	100.000	24690			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-413-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:36:20
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

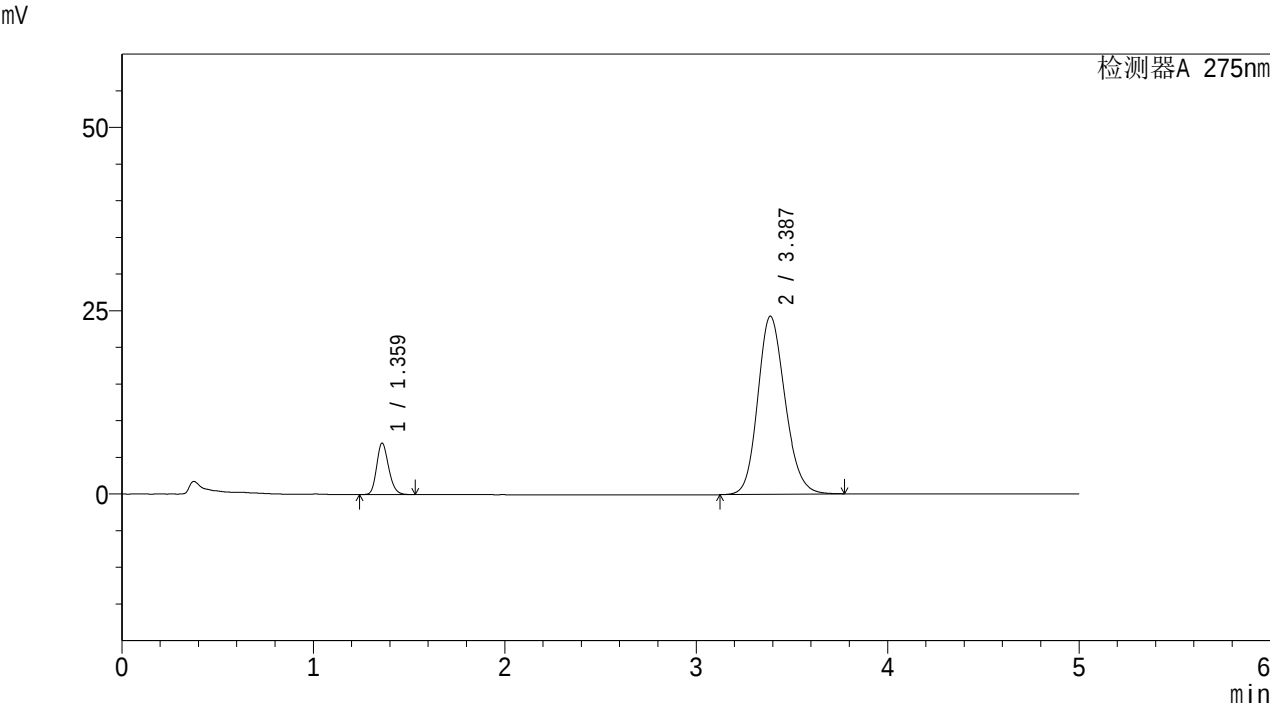

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	30406	11.229	6948	2287	1.198	--
2	3.387	240381	88.771	24301	2756	1.165	10.910
总计		270787	100.000	31249			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-414-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 22:41:44

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

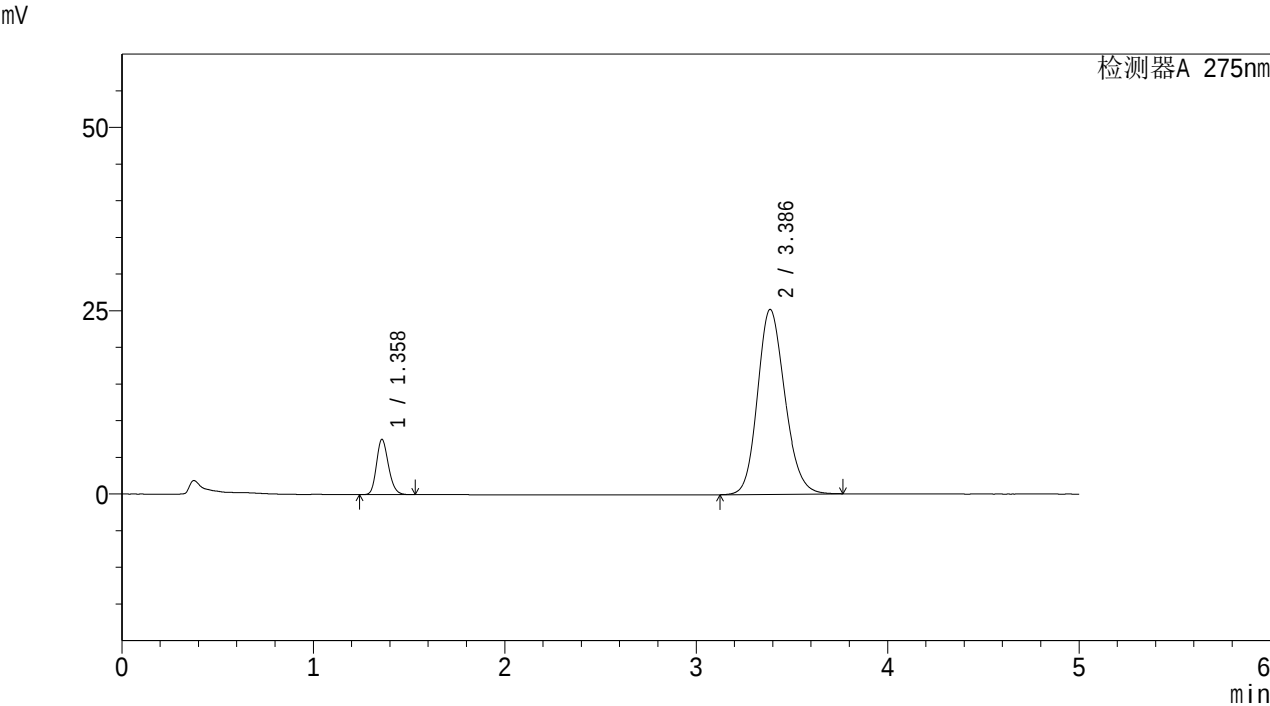

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	32679	11.561	7499	2279	1.194	--
2	3.386	249997	88.439	25209	2741	1.166	10.888
总计		282676	100.000	32708			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-415-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:47:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

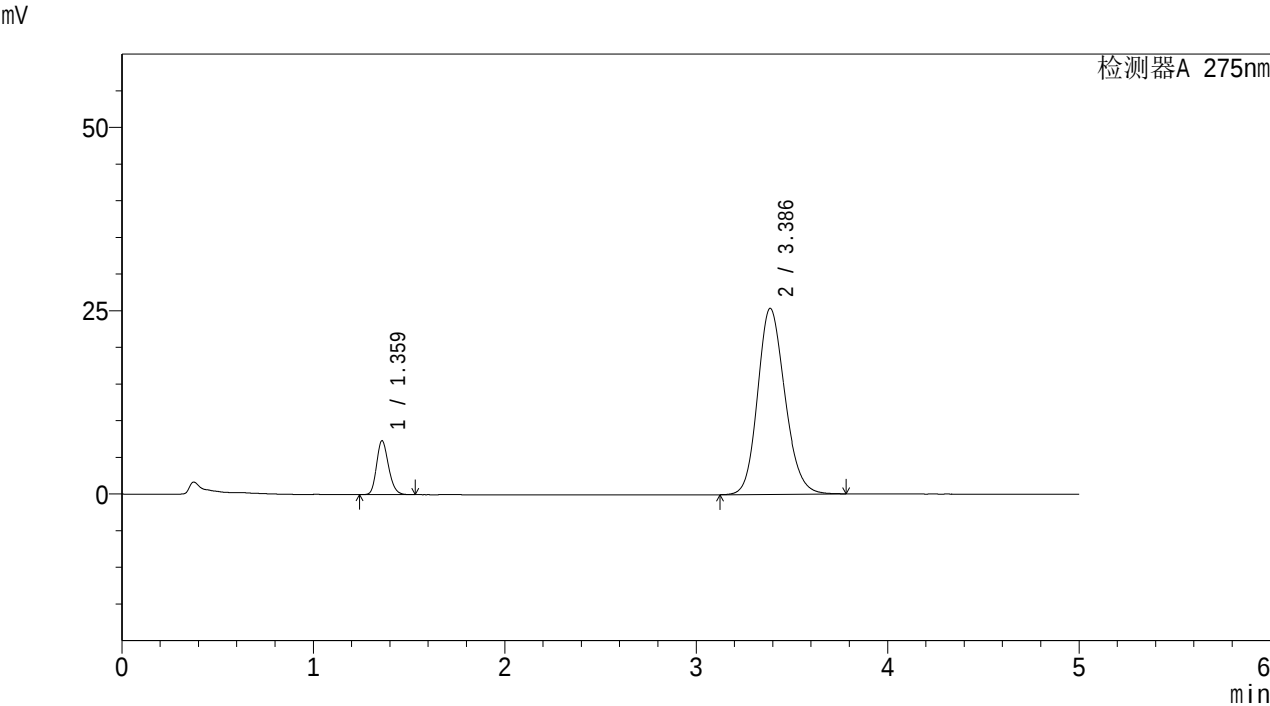

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	31841	11.259	7297	2286	1.197	--
2	3.386	250976	88.741	25368	2757	1.166	10.912
总计		282817	100.000	32665			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-416-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 22:52:32

处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

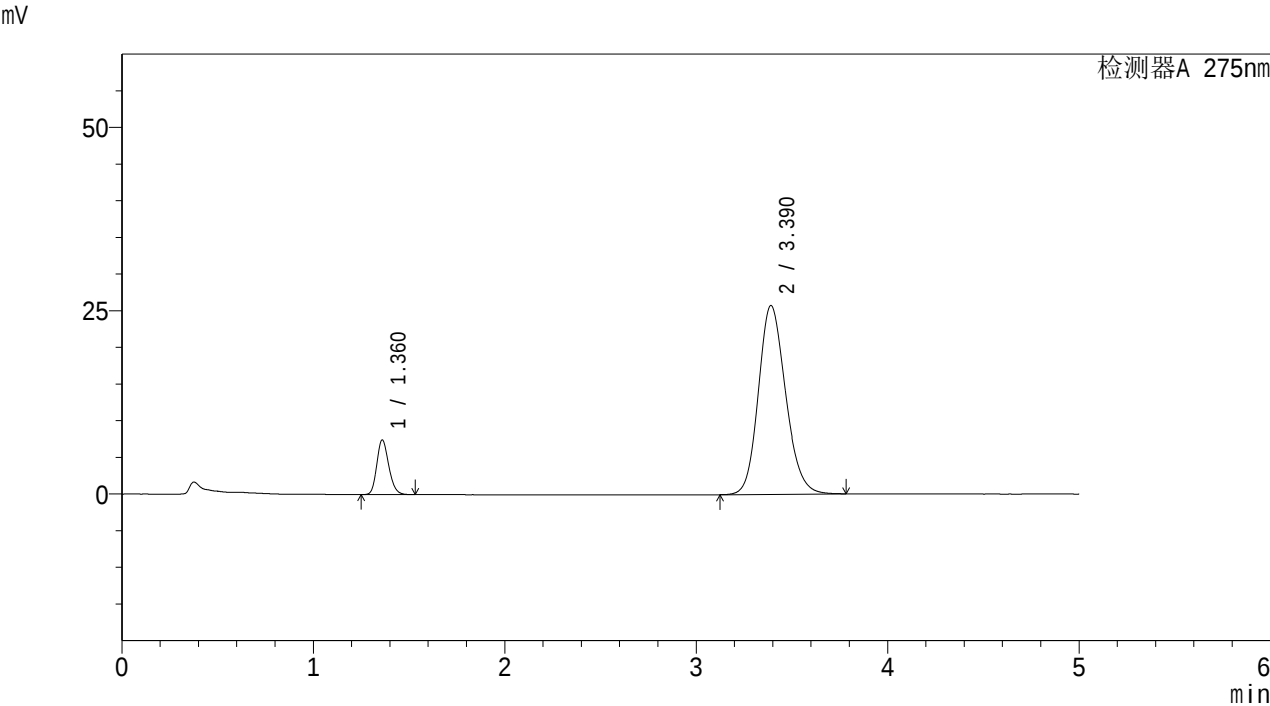

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	32299	11.259	7399	2286	1.194	--
2	3.390	254567	88.741	25749	2764	1.168	10.924
总计		286867	100.000	33148			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-417-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:57:56
处理时间(V2): 2026/05/12 11:56:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

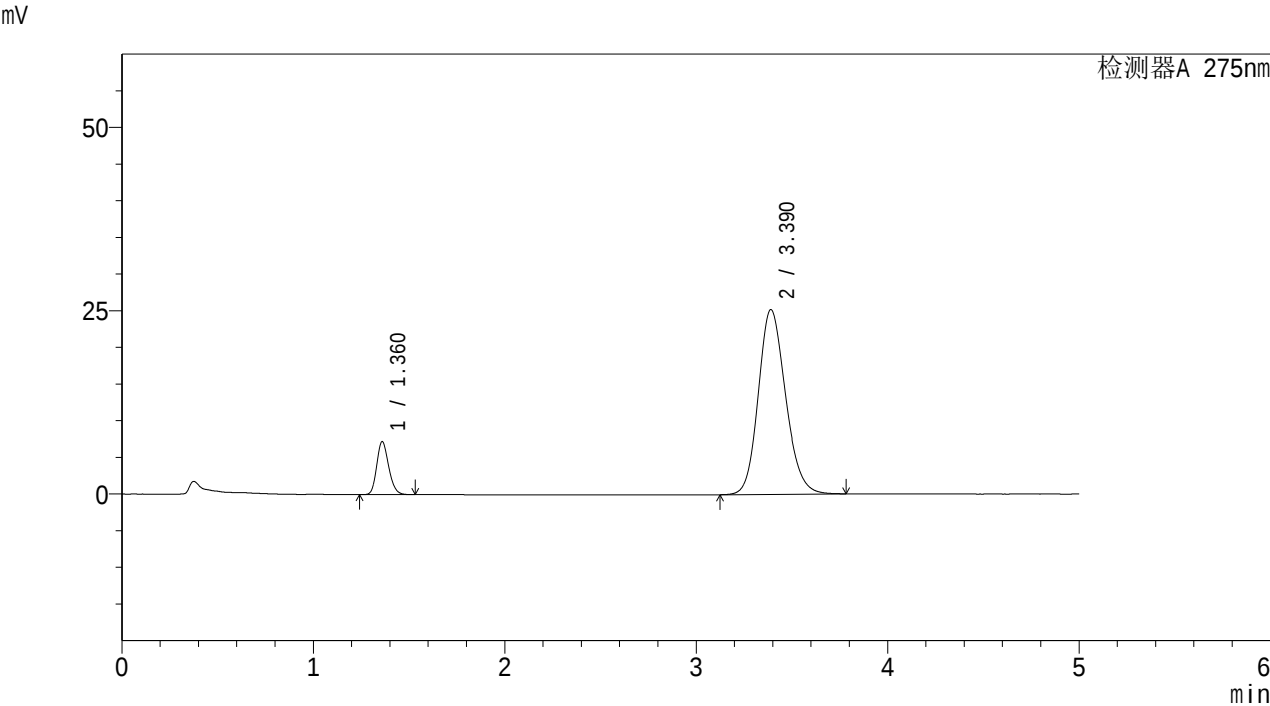

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	31333	11.163	7171	2288	1.195	--
2	3.390	249357	88.837	25210	2759	1.167	10.921
总计		280690	100.000	32380			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-418-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:03:19

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

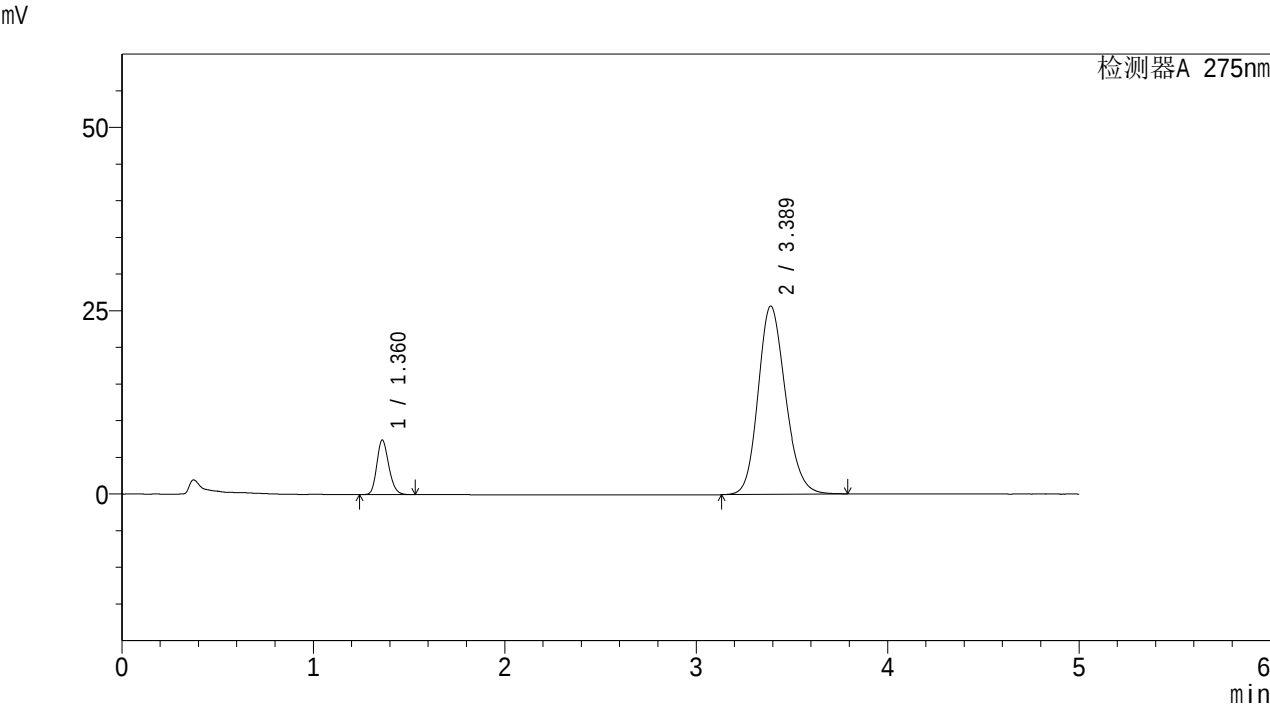

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	32270	11.260	7391	2283	1.193	--
2	3.389	254322	88.740	25693	2753	1.168	10.901
总计		286592	100.000	33084			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-419-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:08:44

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

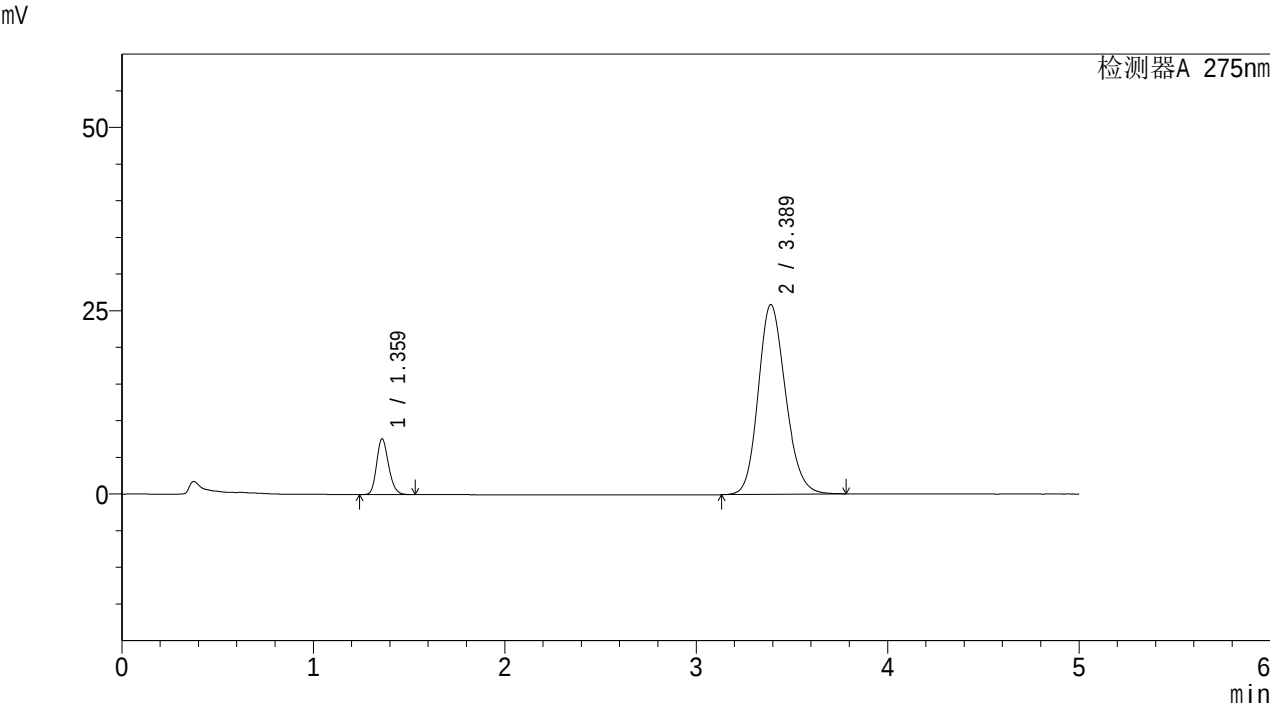

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	32992	11.408	7546	2284	1.197	--
2	3.389	256201	88.592	25888	2754	1.168	10.914
总计		289193	100.000	33434			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-420-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:14:08

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

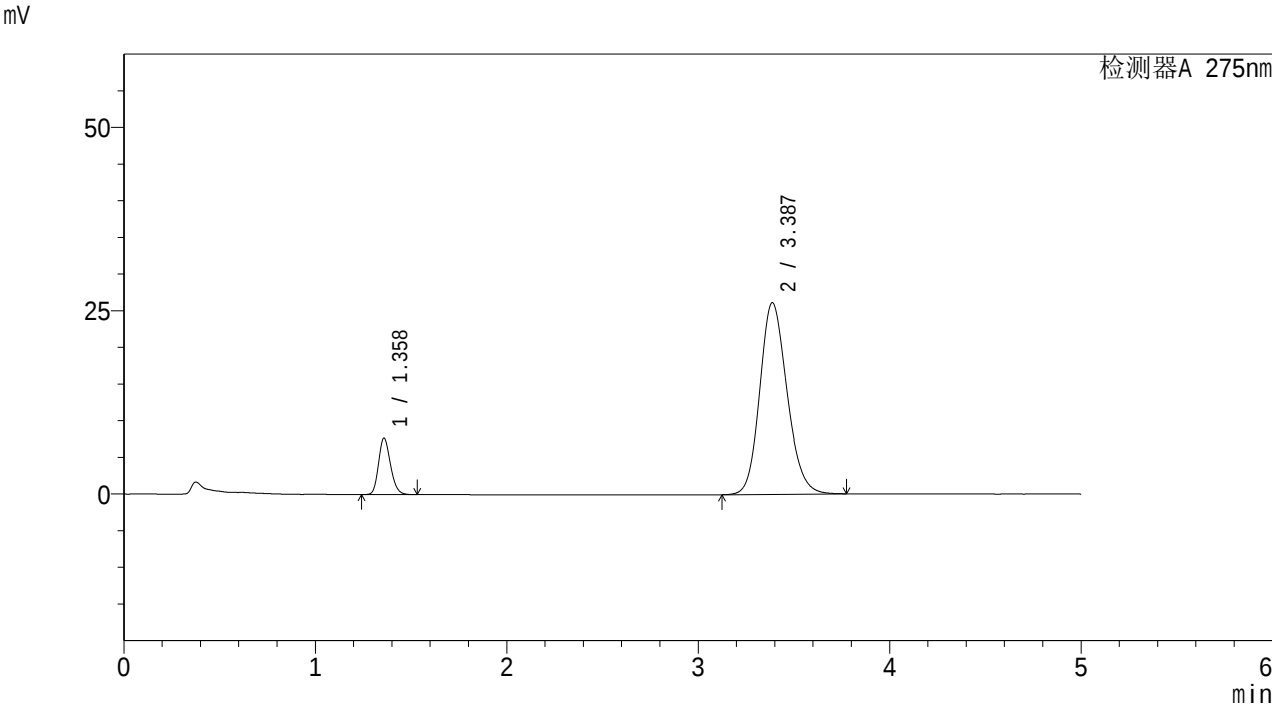

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	33374	11.423	7647	2284	1.196	--
2	3.387	258786	88.577	26145	2749	1.169	10.903
总计		292160	100.000	33791			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-421-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:19:32

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

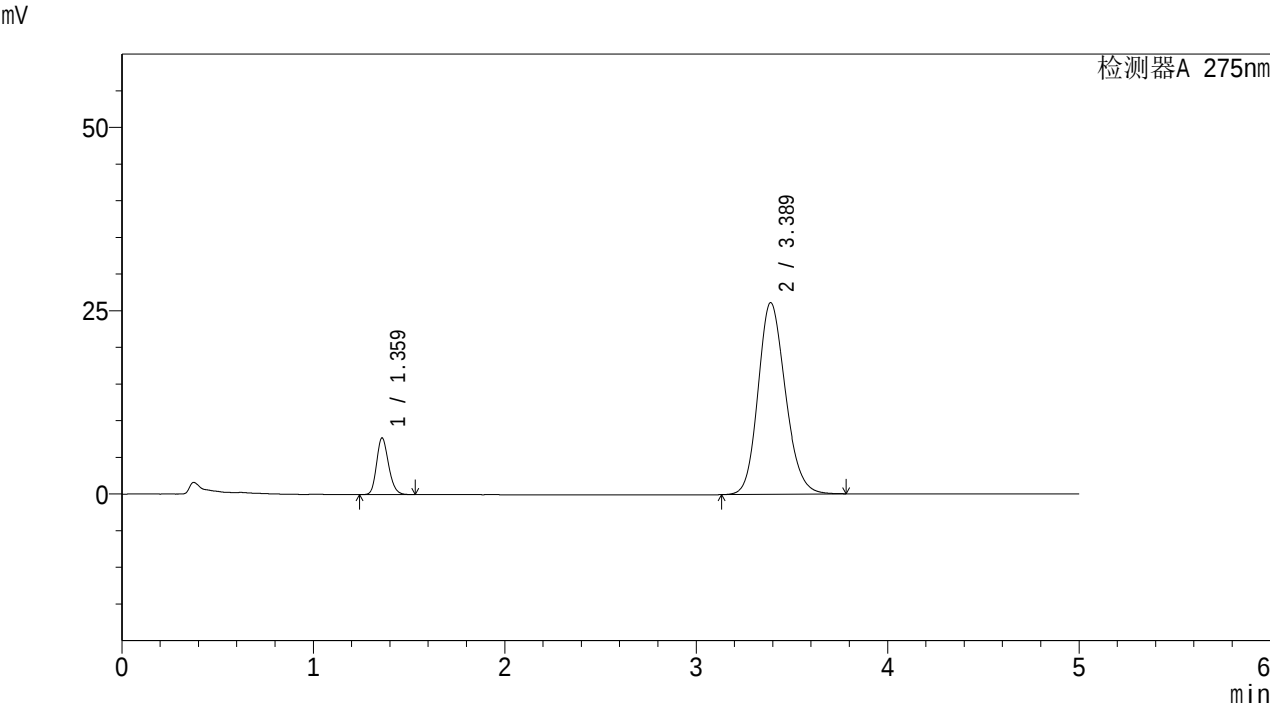

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	33506	11.446	7660	2279	1.198	--
2	3.389	259219	88.554	26157	2744	1.169	10.895
总计		292725	100.000	33816			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-422-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:24:57
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

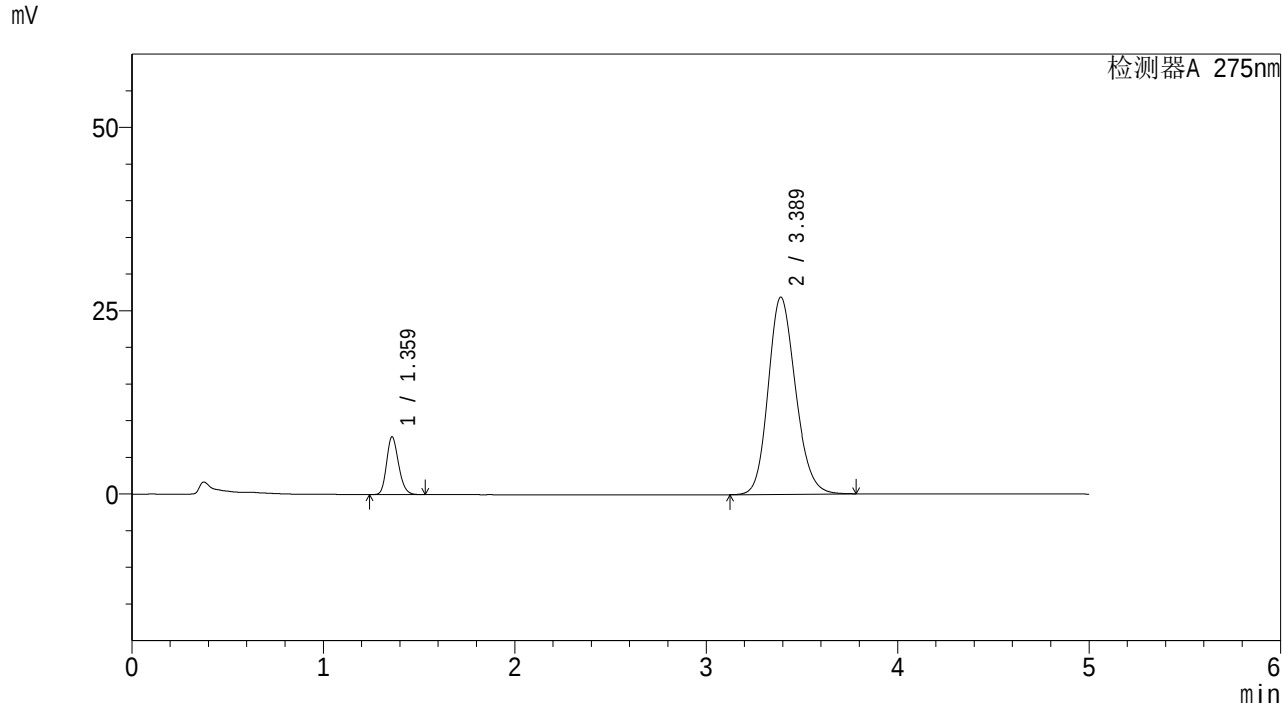

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34099	11.332	7810	2284	1.198	--
2	3.389	266816	88.668	26901	2741	1.170	10.897
总计		300916	100.000	34711			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-423-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:30:20
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

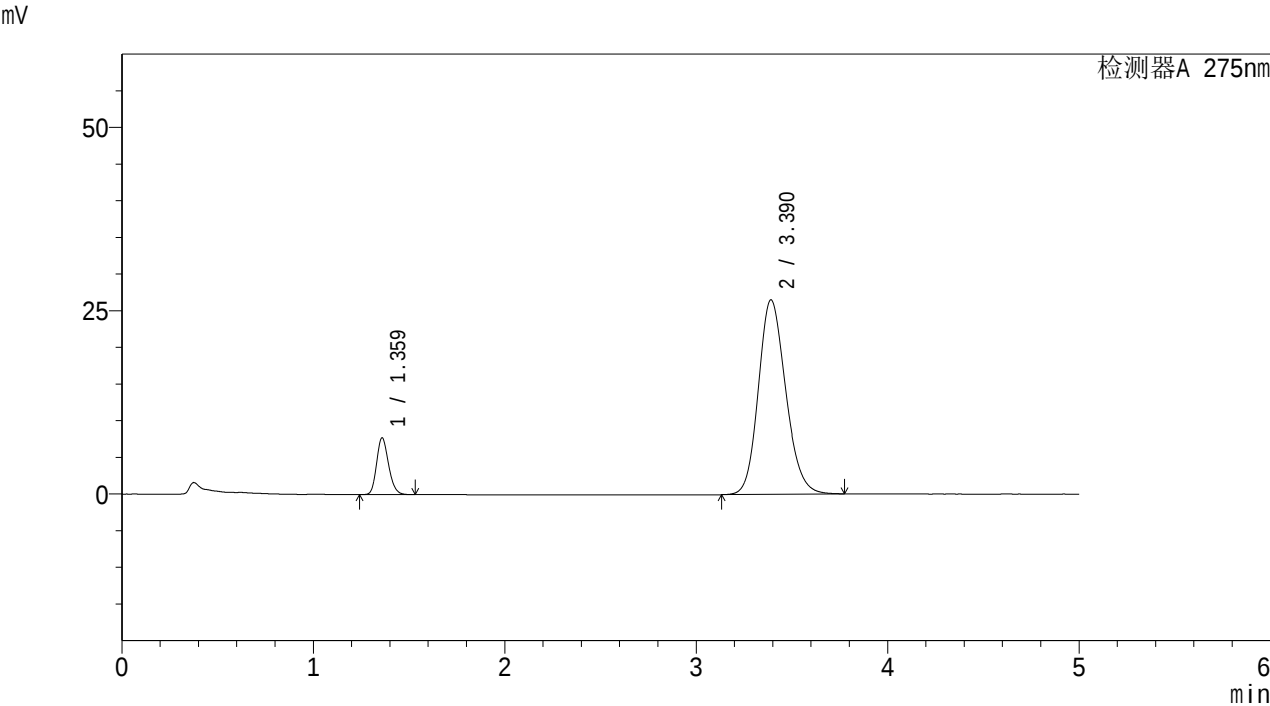

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	33538	11.306	7673	2285	1.197	--
2	3.390	263116	88.694	26526	2741	1.170	10.900
总计		296654	100.000	34199			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-424-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:35:43

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

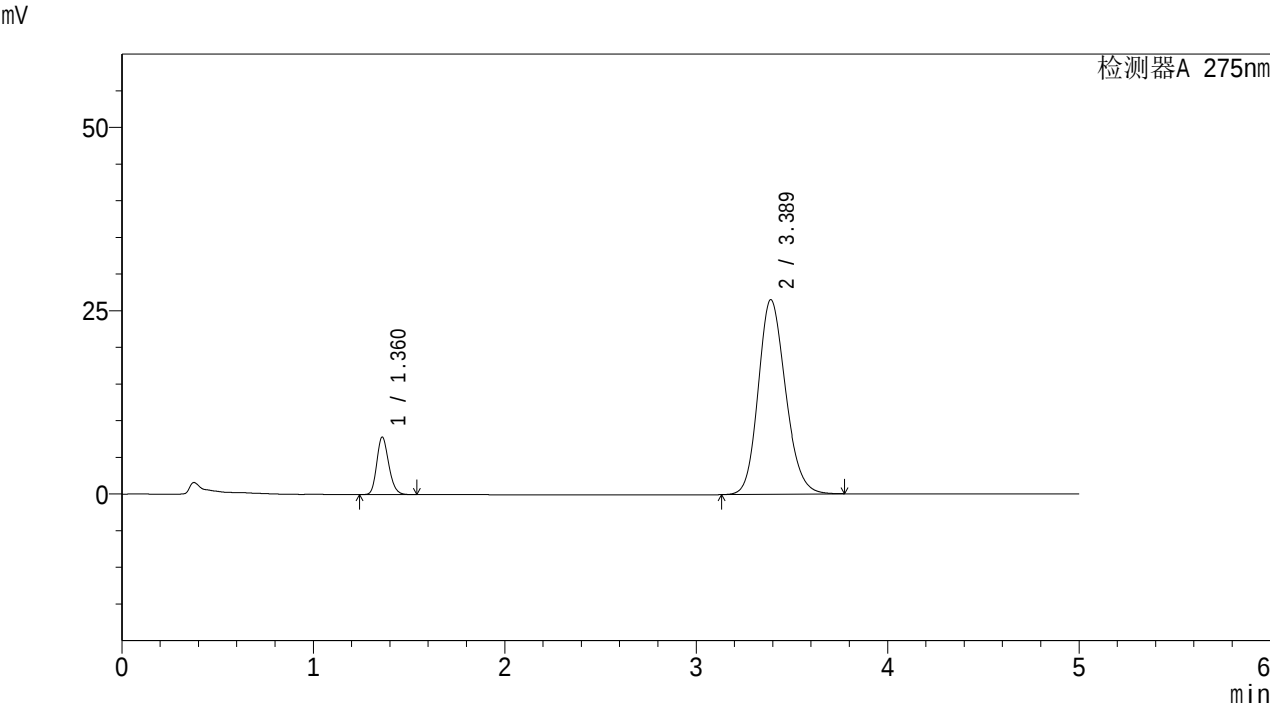

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34036	11.456	7785	2284	1.196	--
2	3.389	263063	88.544	26555	2744	1.171	10.894
总计		297100	100.000	34340			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-425-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:41:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

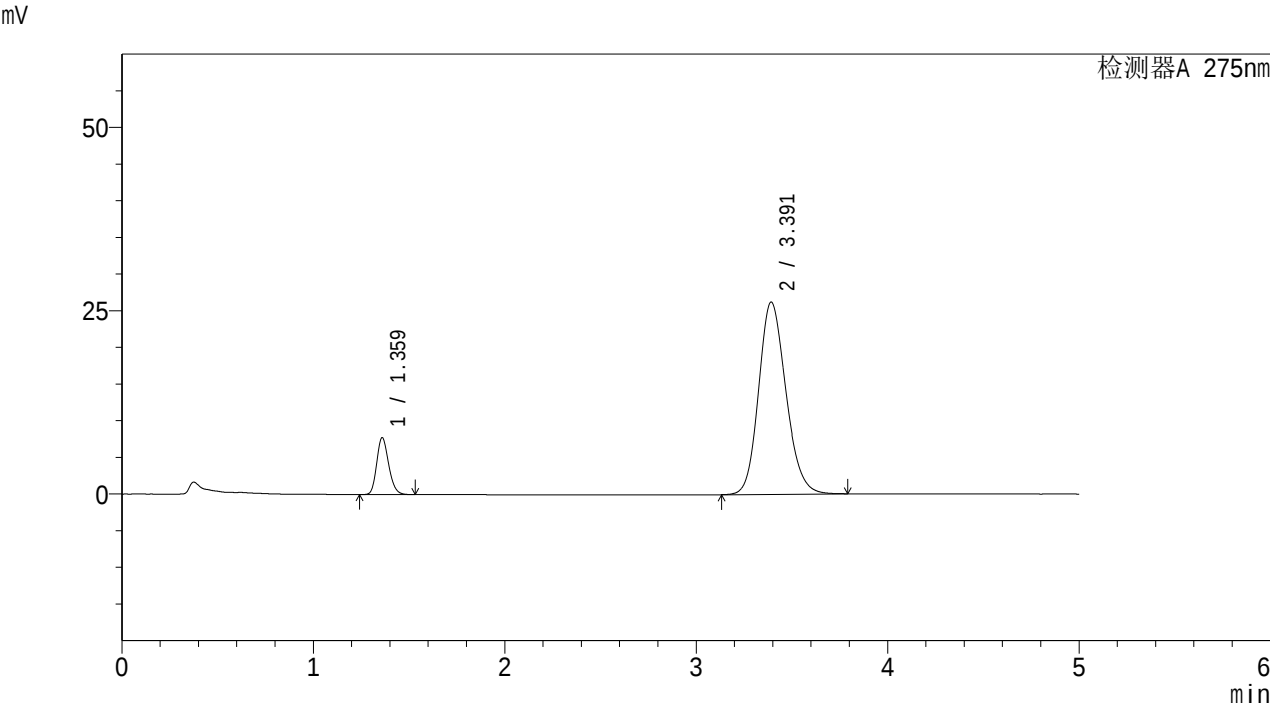

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	33617	11.457	7691	2288	1.195	--
2	3.391	259788	88.543	26204	2752	1.170	10.917
总计		293405	100.000	33894			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-426-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:46:32
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

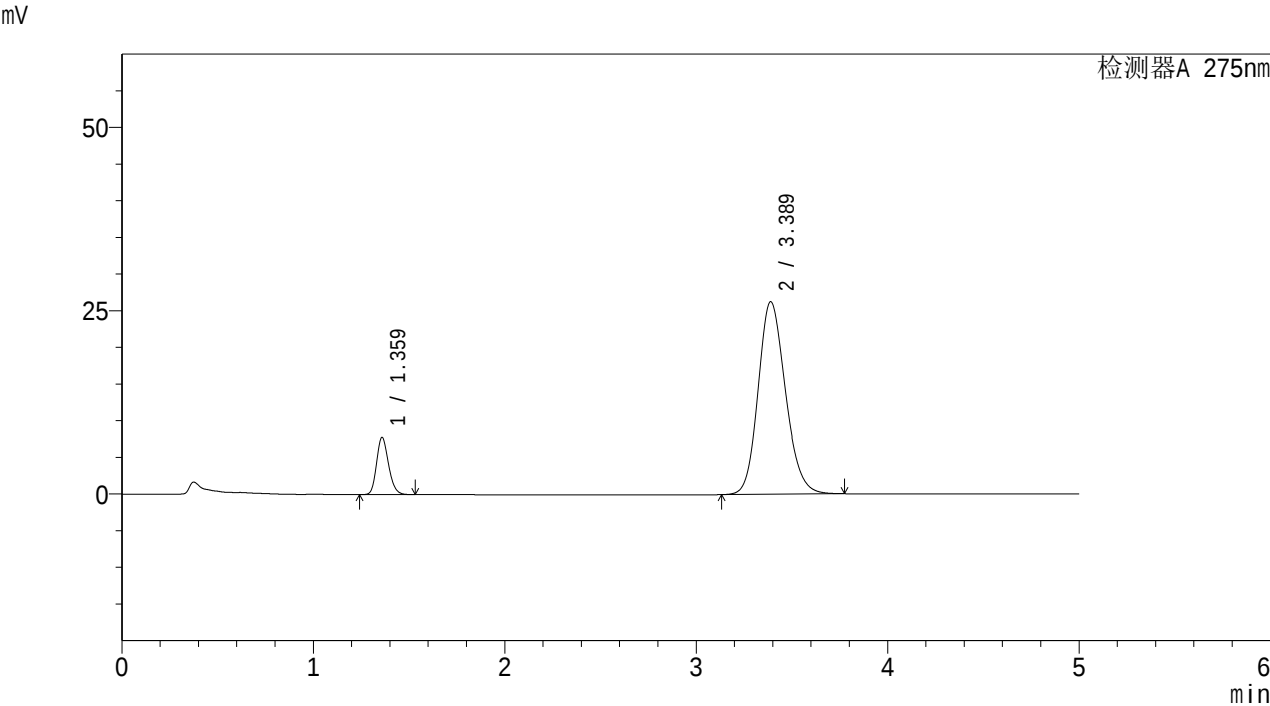

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	33768	11.486	7736	2285	1.197	--
2	3.389	260227	88.514	26275	2742	1.170	10.899
总计		293996	100.000	34011			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-427-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:51:57
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

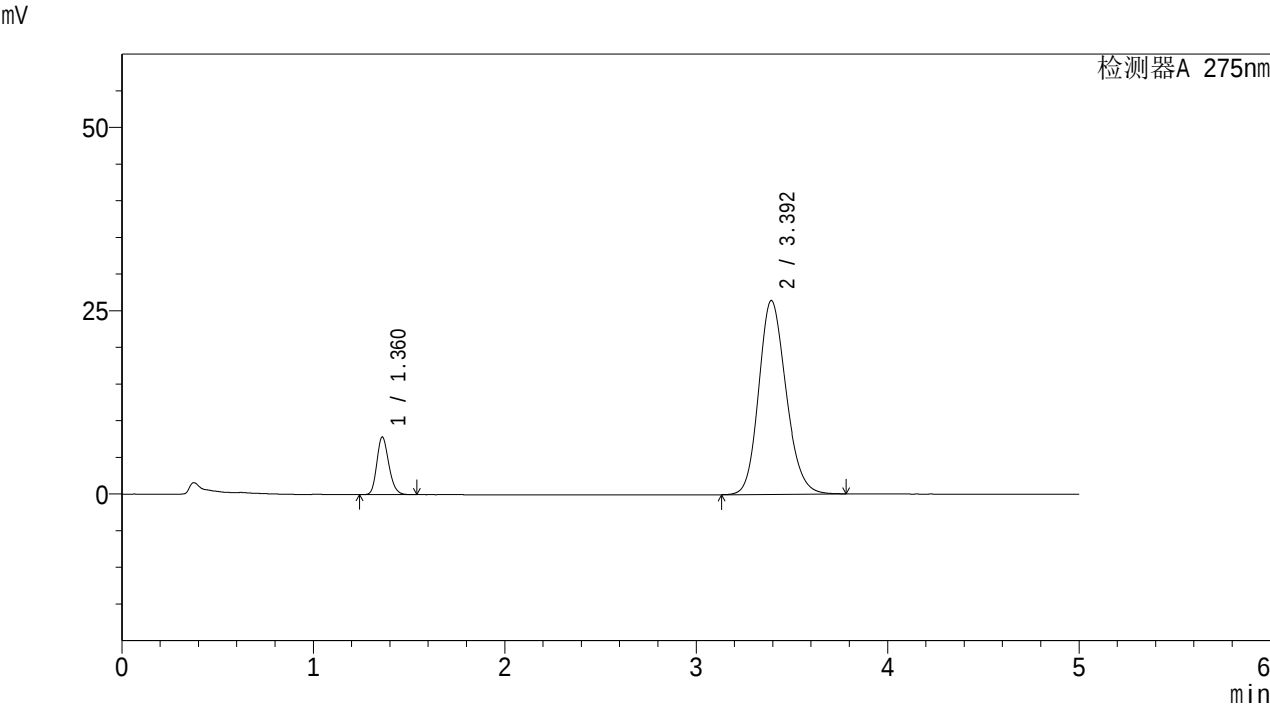

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34071	11.508	7812	2290	1.198	--
2	3.392	261991	88.492	26407	2751	1.170	10.914
总计		296062	100.000	34219			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-428-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:57:21
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

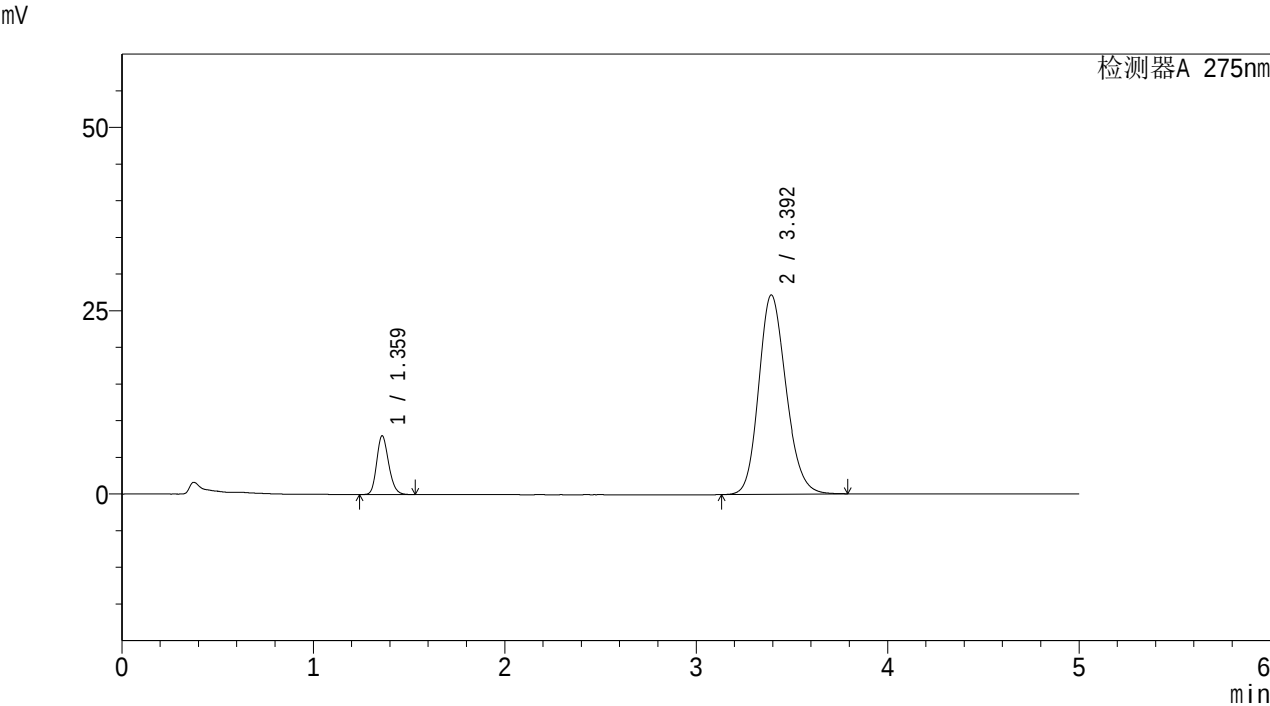

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34756	11.417	7941	2289	1.195	--
2	3.392	269672	88.583	27145	2742	1.173	10.906
总计		304428	100.000	35086			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-429-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:02:46
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

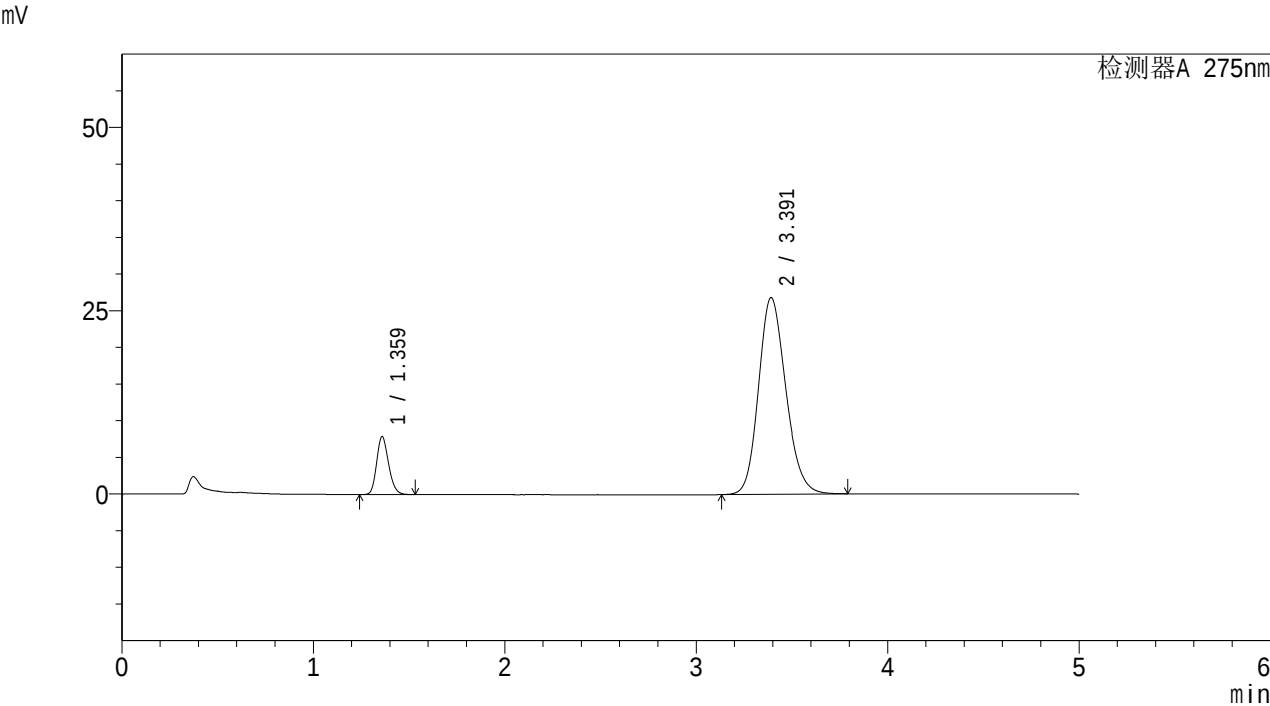

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34242	11.412	7829	2288	1.195	--
2	3.391	265806	88.588	26823	2749	1.172	10.915
总计		300047	100.000	34652			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-430-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:08:11
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

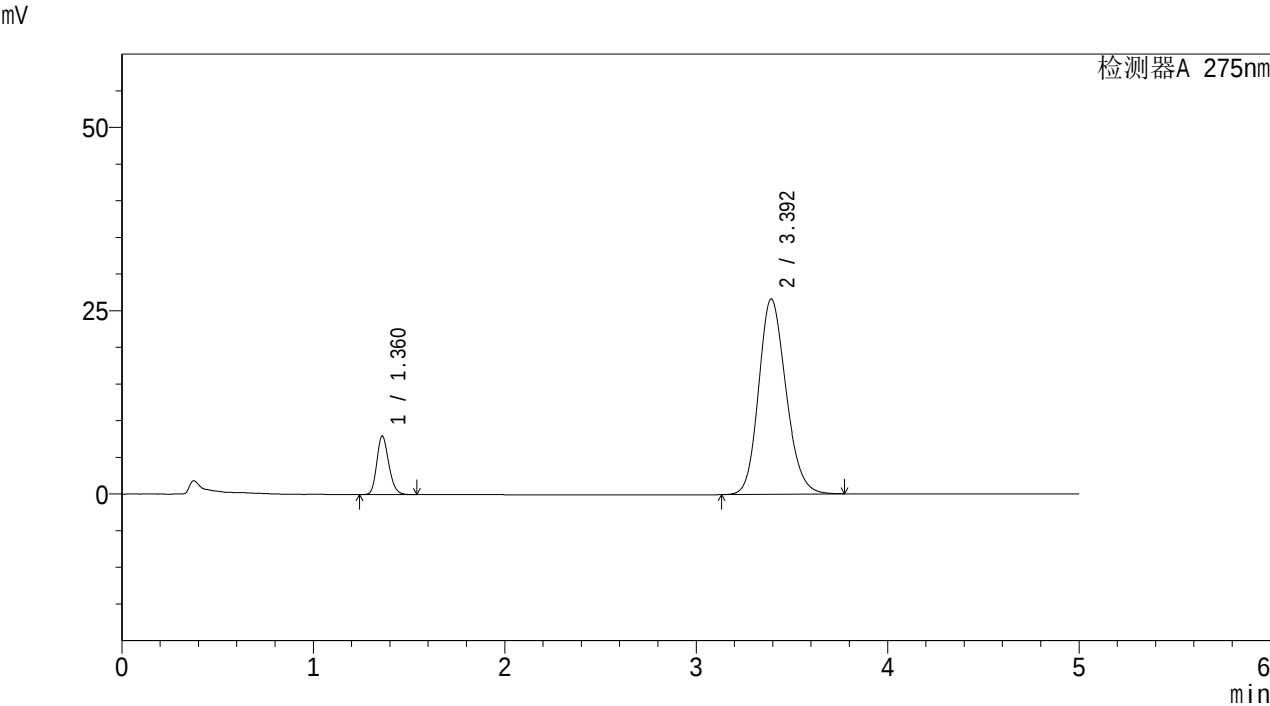

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34592	11.583	7925	2288	1.196	--
2	3.392	264052	88.417	26621	2747	1.172	10.907
总计		298644	100.000	34546			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-431-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:13:34
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

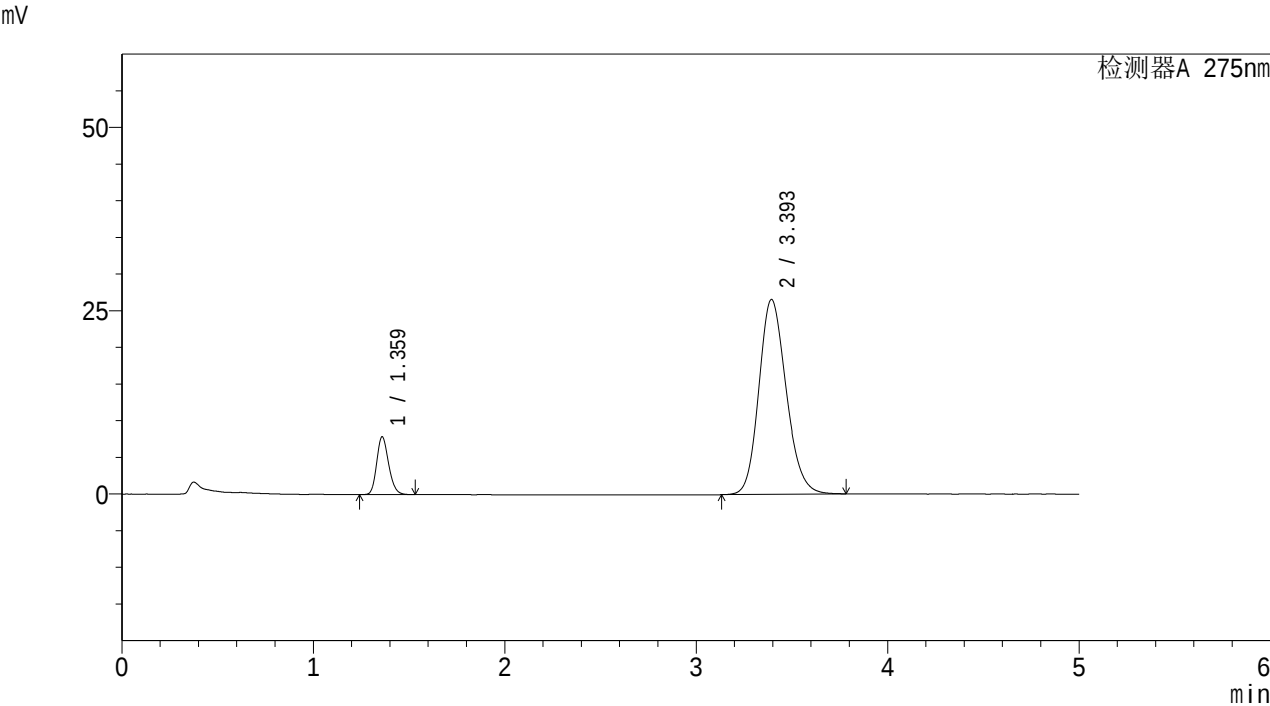

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34156	11.474	7806	2291	1.196	--
2	3.393	263521	88.526	26538	2745	1.172	10.914
总计		297677	100.000	34344			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-432-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 00:18:59

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

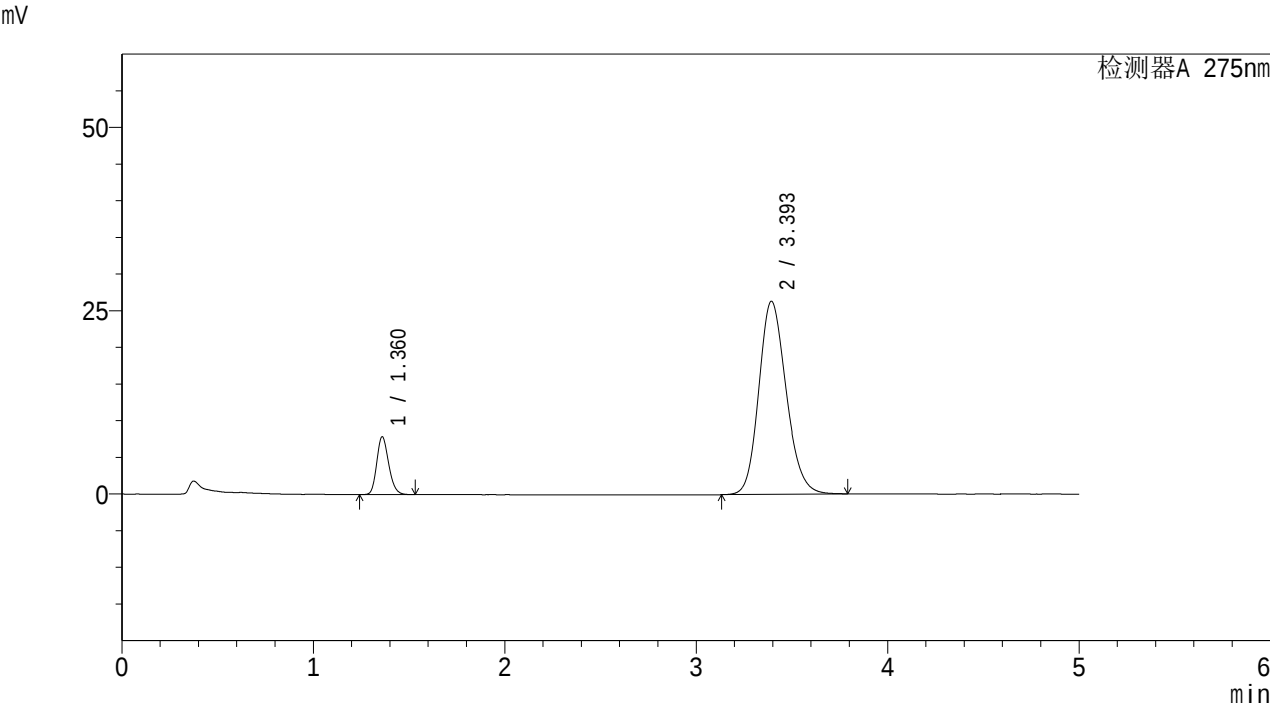

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34173	11.555	7822	2290	1.197	--
2	3.393	261574	88.445	26286	2735	1.173	10.897
总计		295747	100.000	34108			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-433-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 00:24:23

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

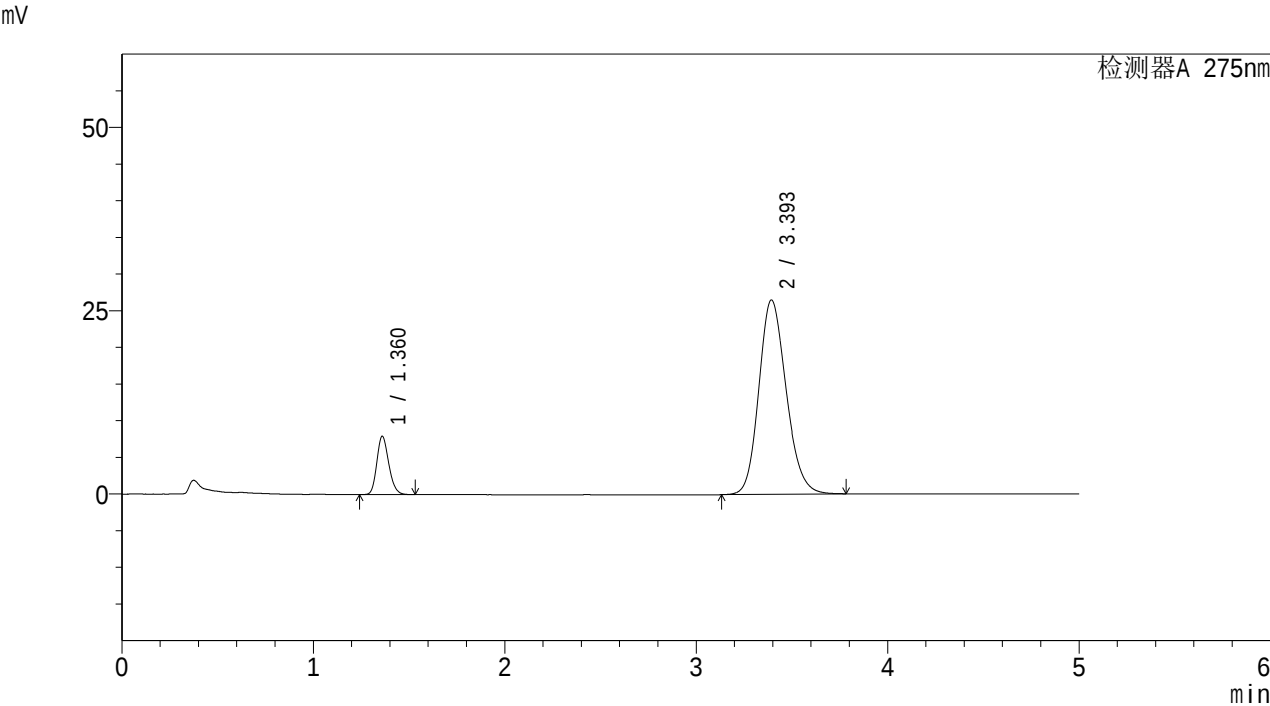

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34387	11.570	7896	2293	1.193	--
2	3.393	262826	88.430	26470	2748	1.173	10.914
总计		297213	100.000	34366			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-434-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 00:29:47

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

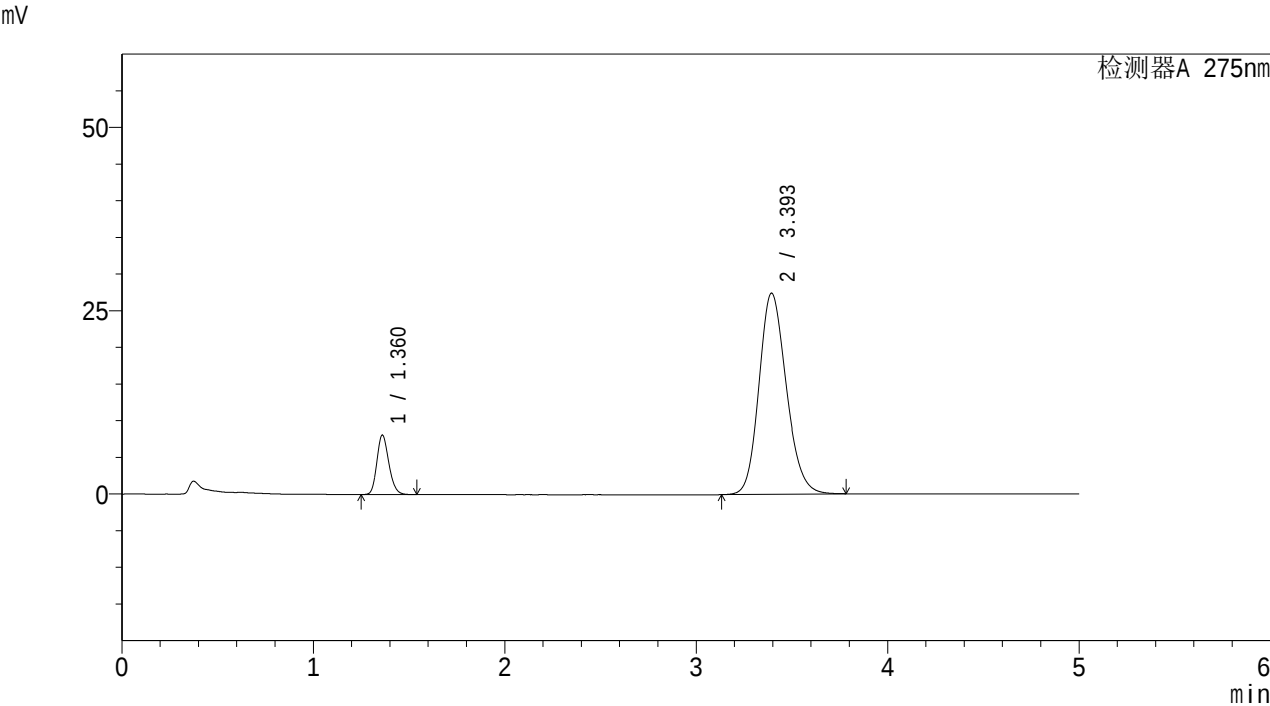

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35165	11.446	8068	2289	1.194	--
2	3.393	272066	88.554	27397	2744	1.173	10.905
总计		307230	100.000	35466			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-435-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 00:35:12

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

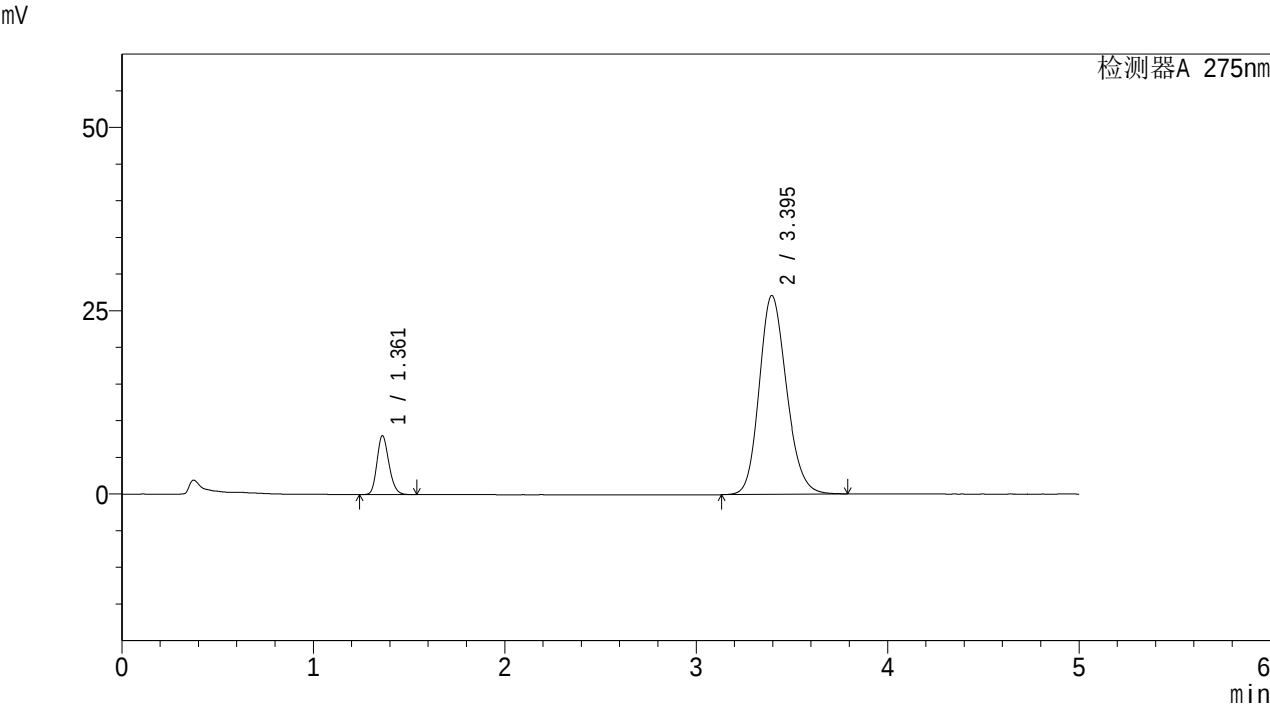

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	34757	11.445	7995	2294	1.193	--
2	3.395	268927	88.555	27111	2746	1.174	10.912
总计		303684	100.000	35106			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-436-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 00:40:36

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

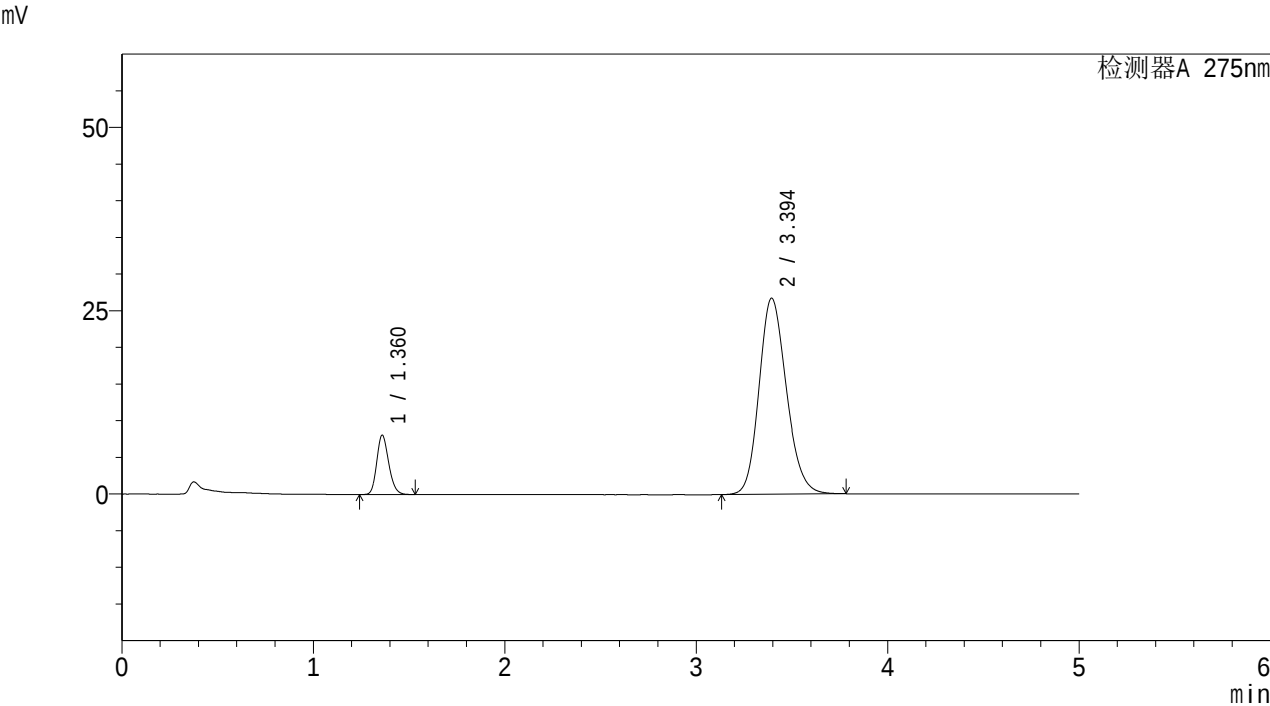

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35087	11.673	8031	2288	1.194	--
2	3.394	265492	88.327	26719	2738	1.174	10.902
总计		300579	100.000	34749			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-437-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:46:01
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

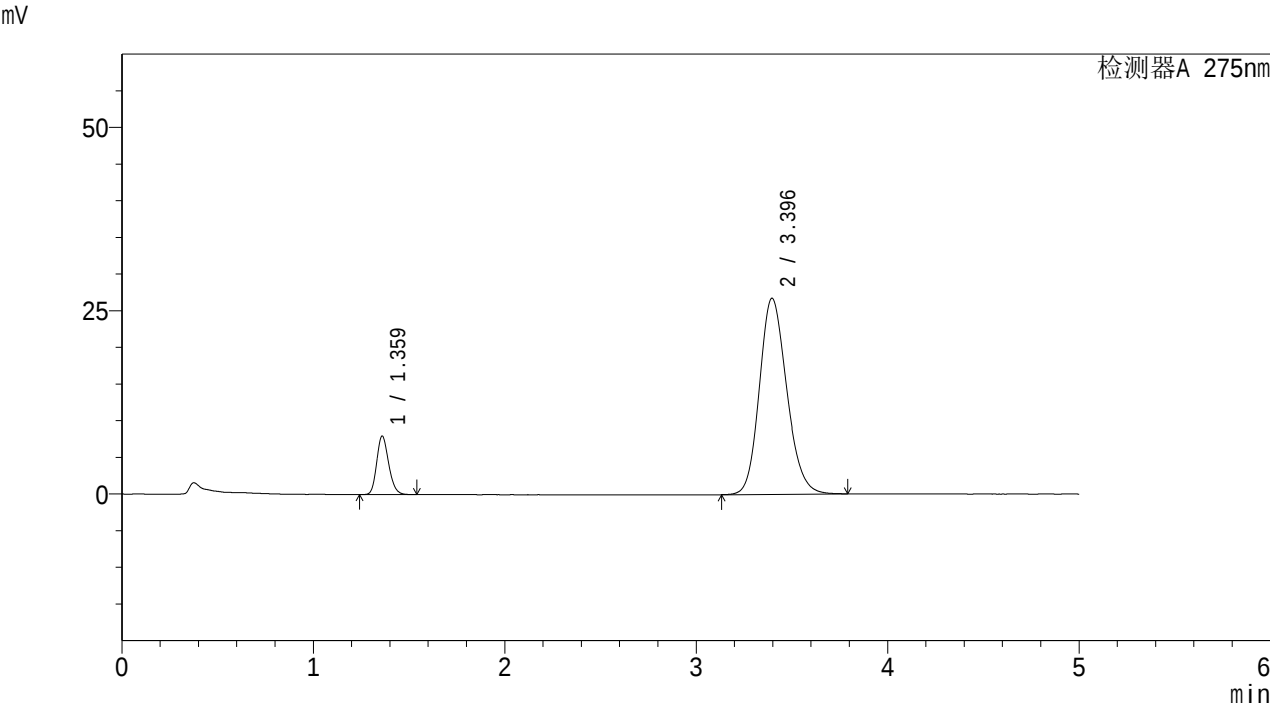

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34586	11.525	7907	2290	1.196	--
2	3.396	265509	88.475	26751	2744	1.172	10.920
总计		300094	100.000	34658			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-438-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:51:26
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

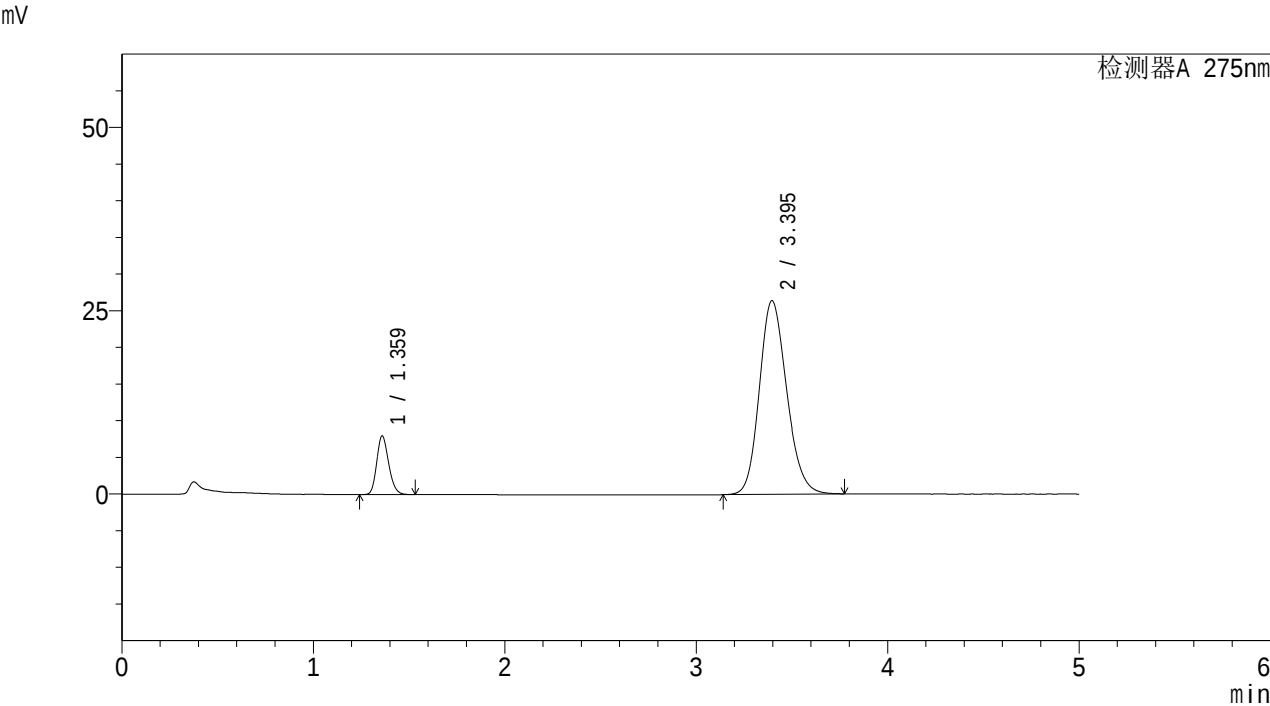

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34645	11.677	7927	2289	1.195	--
2	3.395	262058	88.323	26418	2742	1.172	10.916
总计		296703	100.000	34345			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-439-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:56:50
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

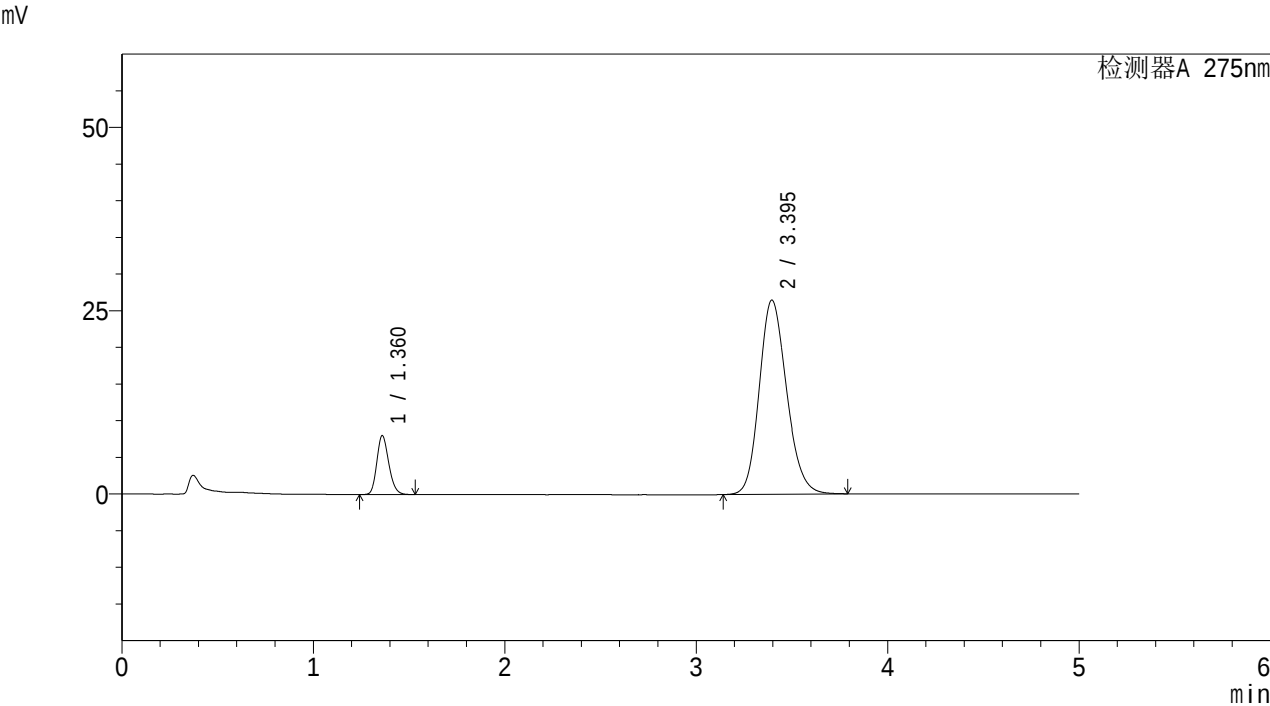

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34773	11.678	7975	2288	1.193	--
2	3.395	262989	88.322	26485	2739	1.174	10.905
总计		297762	100.000	34460			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-440-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:02:16

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

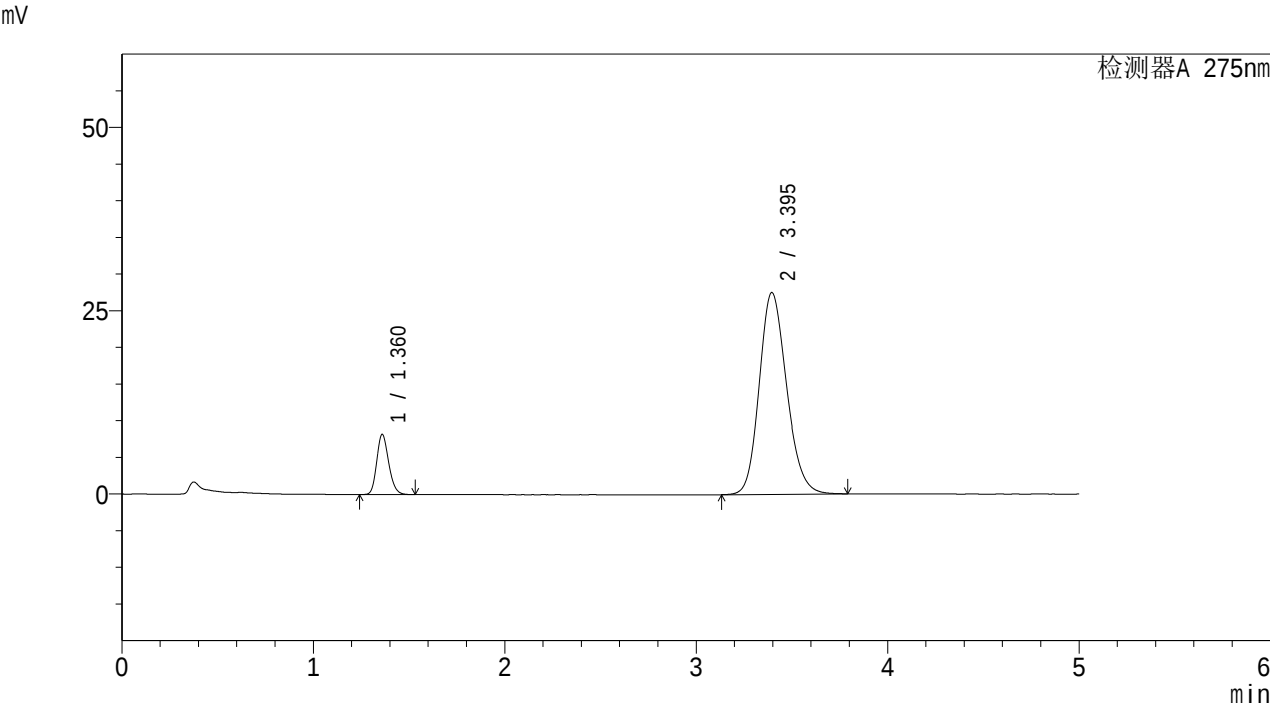

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35569	11.512	8142	2290	1.194	--
2	3.395	273405	88.488	27522	2739	1.175	10.909
总计		308974	100.000	35664			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-441-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:07:39
处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

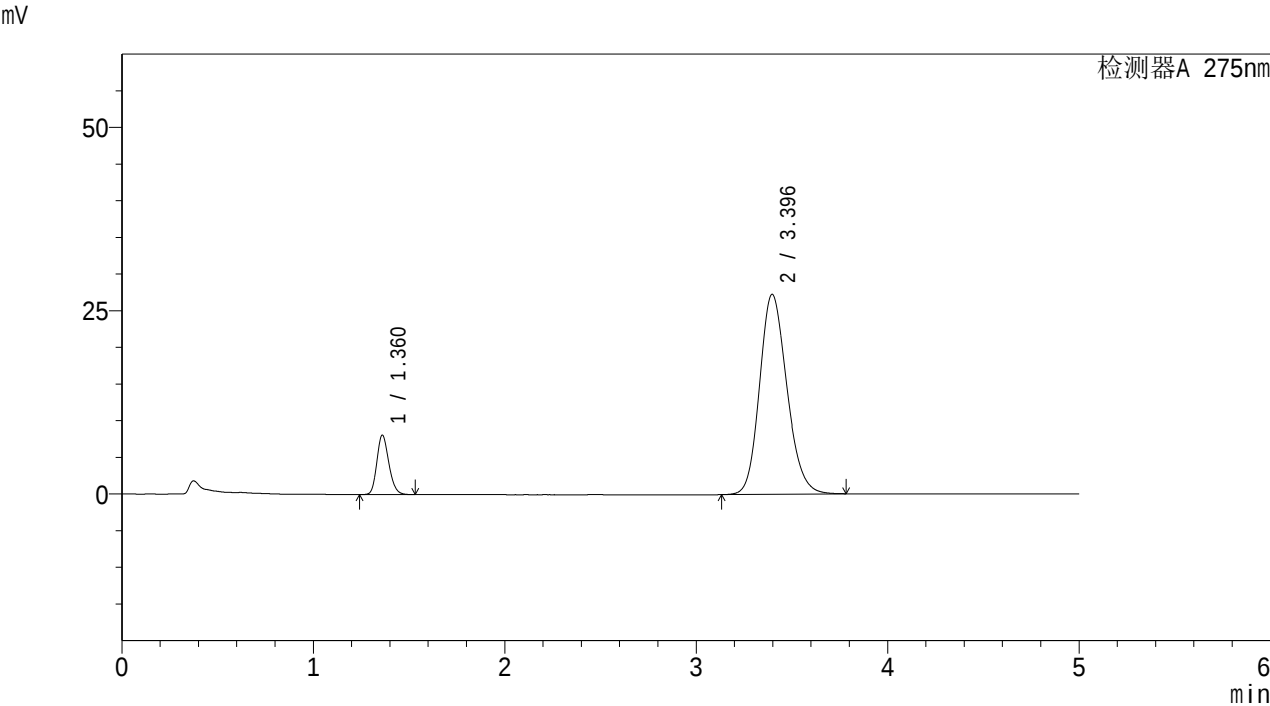

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35157	11.500	8061	2284	1.193	--
2	3.396	270556	88.500	27282	2745	1.175	10.913
总计		305713	100.000	35343			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-442-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:13:03

处理时间(V2): 2026/05/12 11:57:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

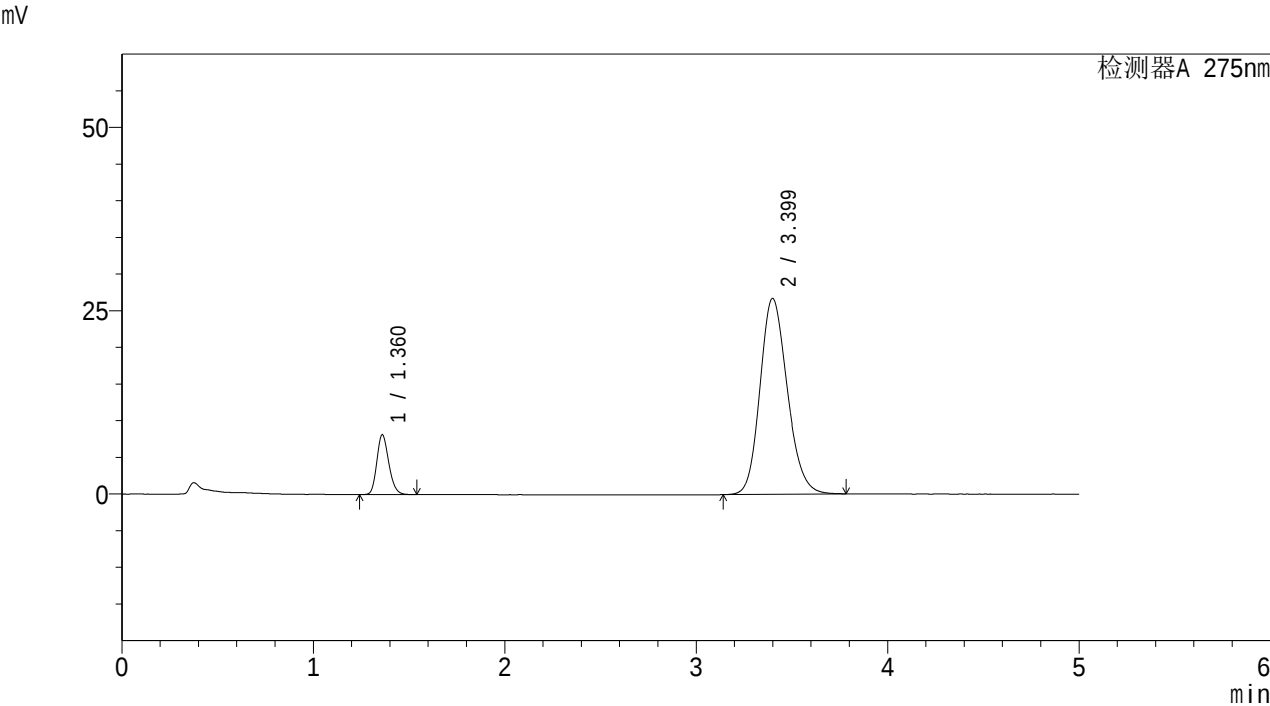

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35396	11.787	8110	2287	1.196	--
2	3.399	264891	88.213	26723	2752	1.174	10.933
总计		300287	100.000	34832			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-443-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:18:28
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

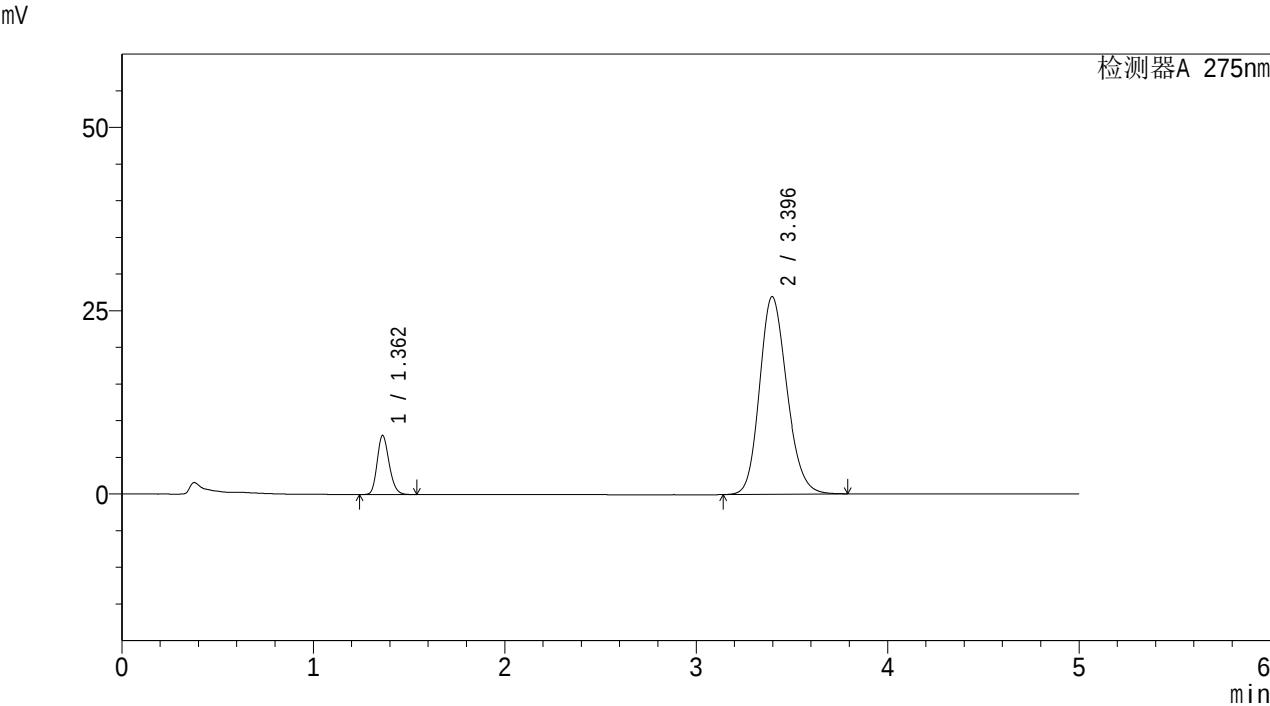

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34924	11.546	8055	2293	1.192	--
2	3.396	267547	88.454	26965	2743	1.175	10.905
总计		302471	100.000	35020			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-444-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:23:53

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

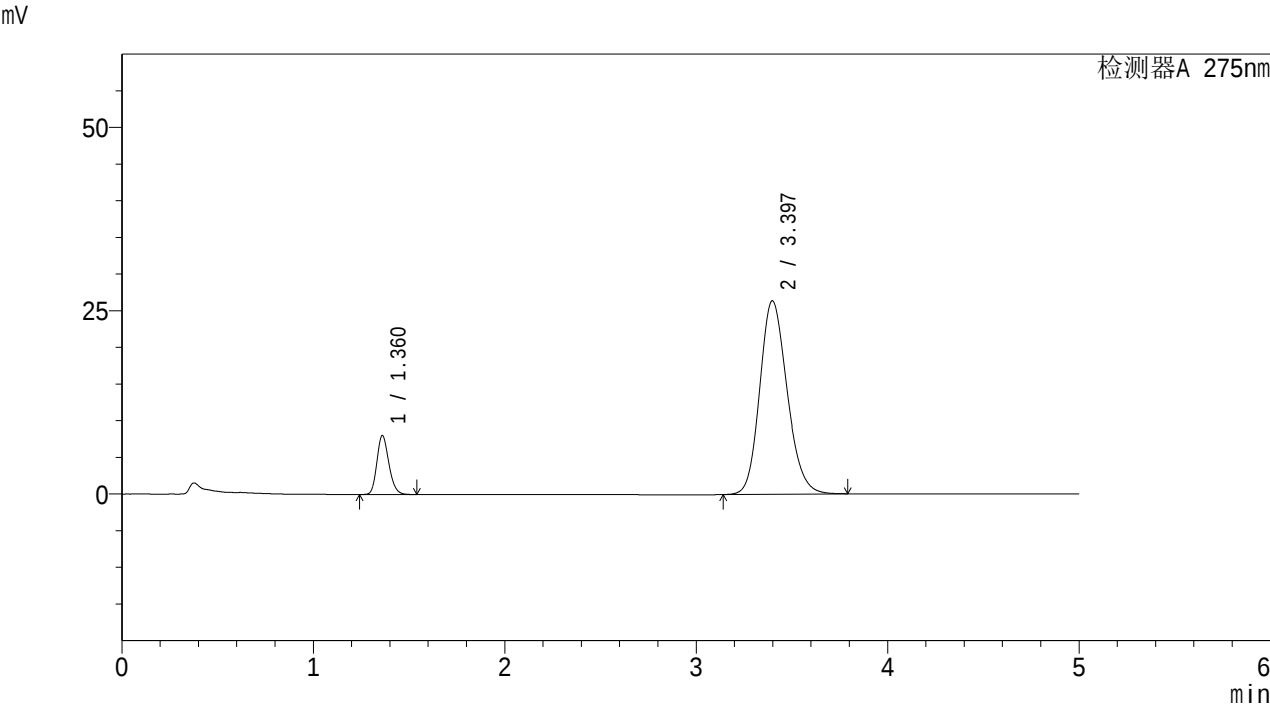

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34838	11.726	8001	2290	1.194	--
2	3.397	262268	88.274	26397	2738	1.174	10.910
总计		297106	100.000	34398			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-445-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:29:18

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

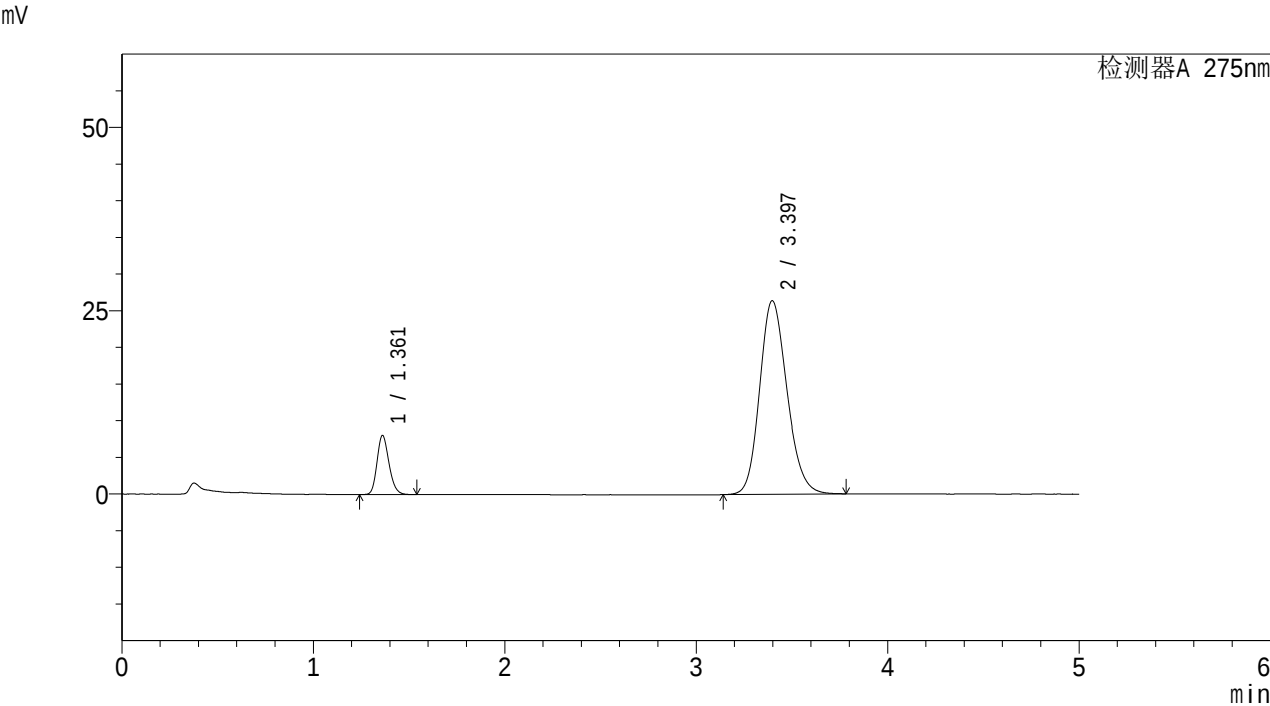

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	34946	11.760	8042	2293	1.194	--
2	3.397	262216	88.240	26422	2741	1.174	10.908
总计		297162	100.000	34465			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-446-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:34:41
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

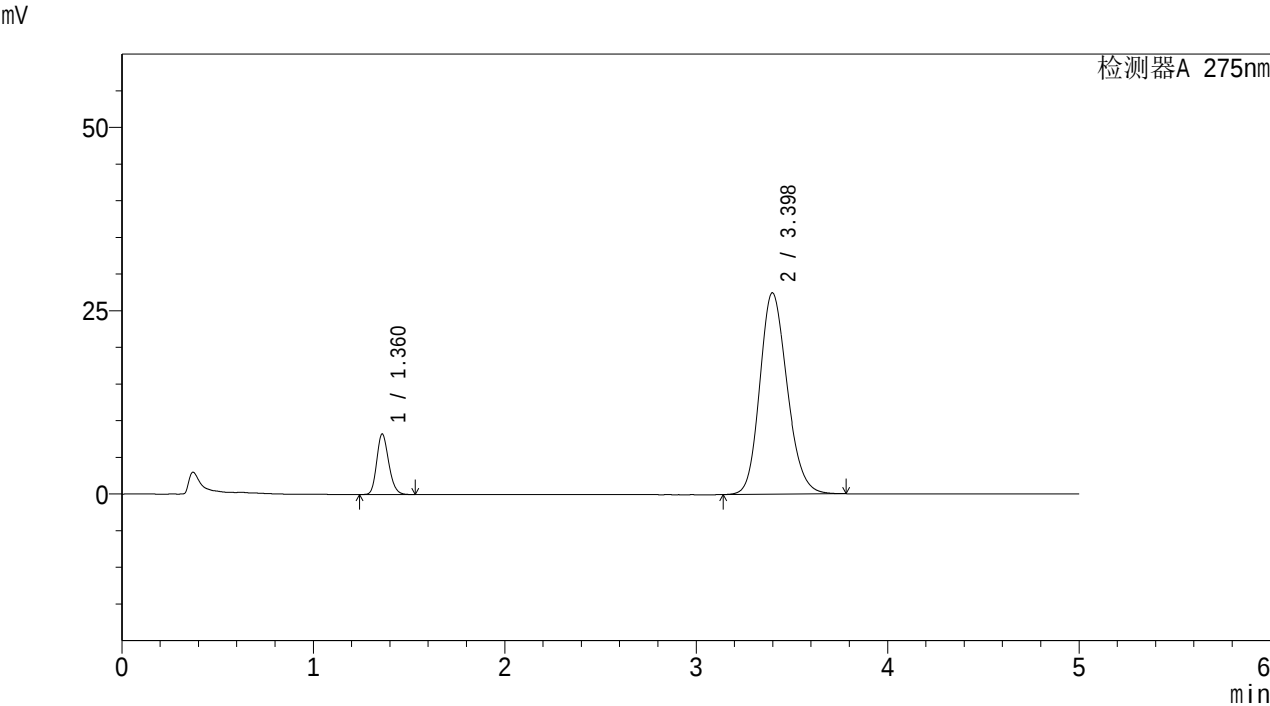

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35771	11.573	8188	2289	1.194	--
2	3.398	273312	88.427	27487	2731	1.176	10.907
总计		309082	100.000	35675			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-447-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:40:06

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

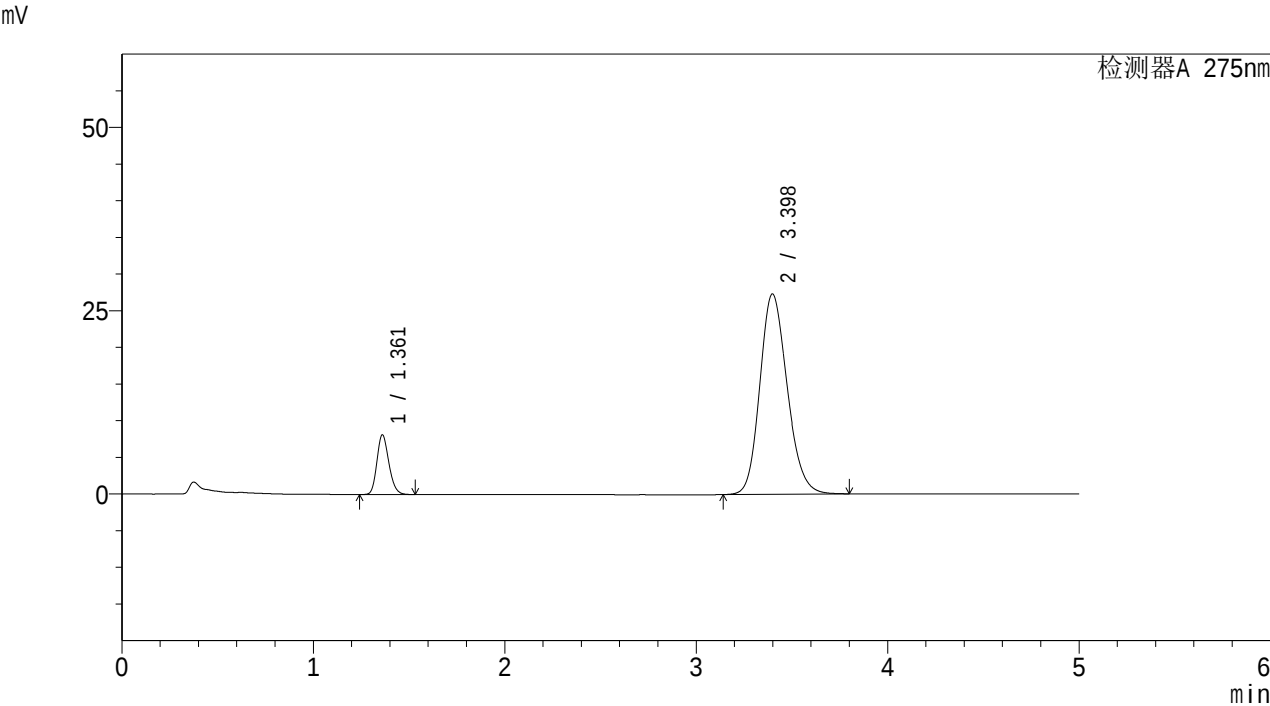

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	35271	11.500	8098	2285	1.192	--
2	3.398	271428	88.500	27326	2738	1.177	10.907
总计		306698	100.000	35425			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-448-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:45:30
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

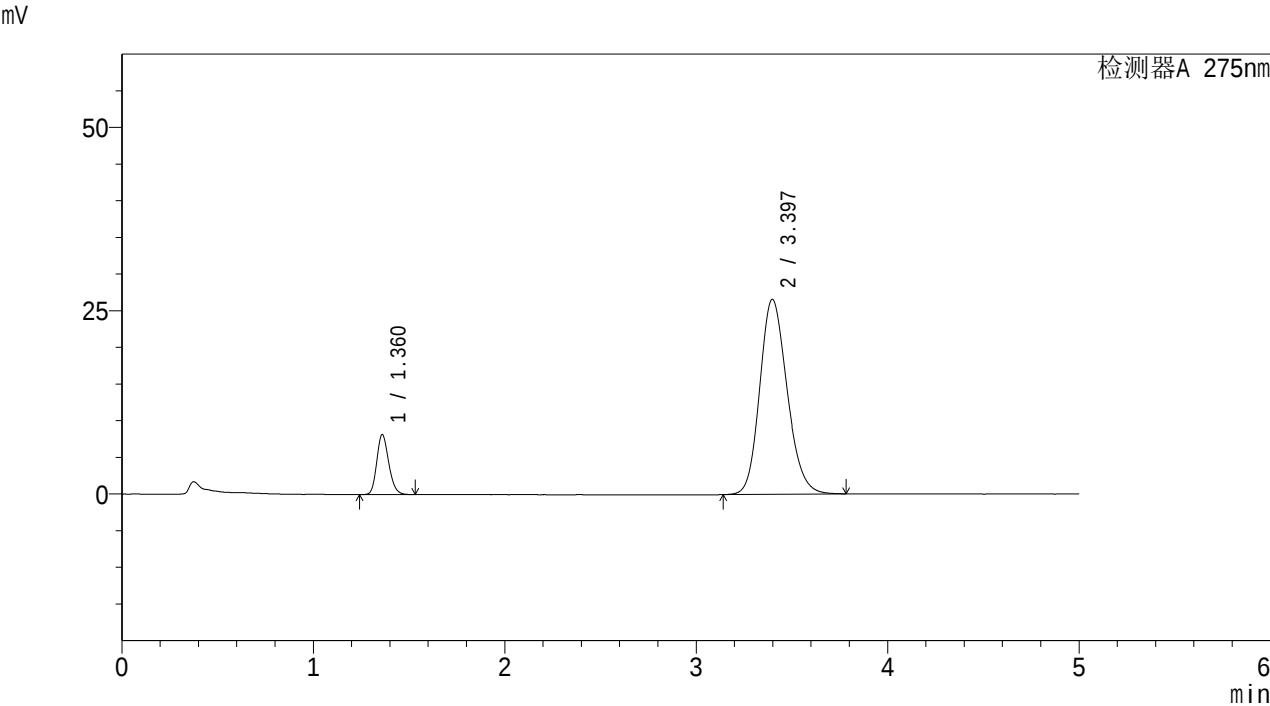

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35480	11.840	8121	2286	1.196	--
2	3.397	264171	88.160	26605	2738	1.176	10.912
总计		299651	100.000	34726			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-449-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:50:55
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

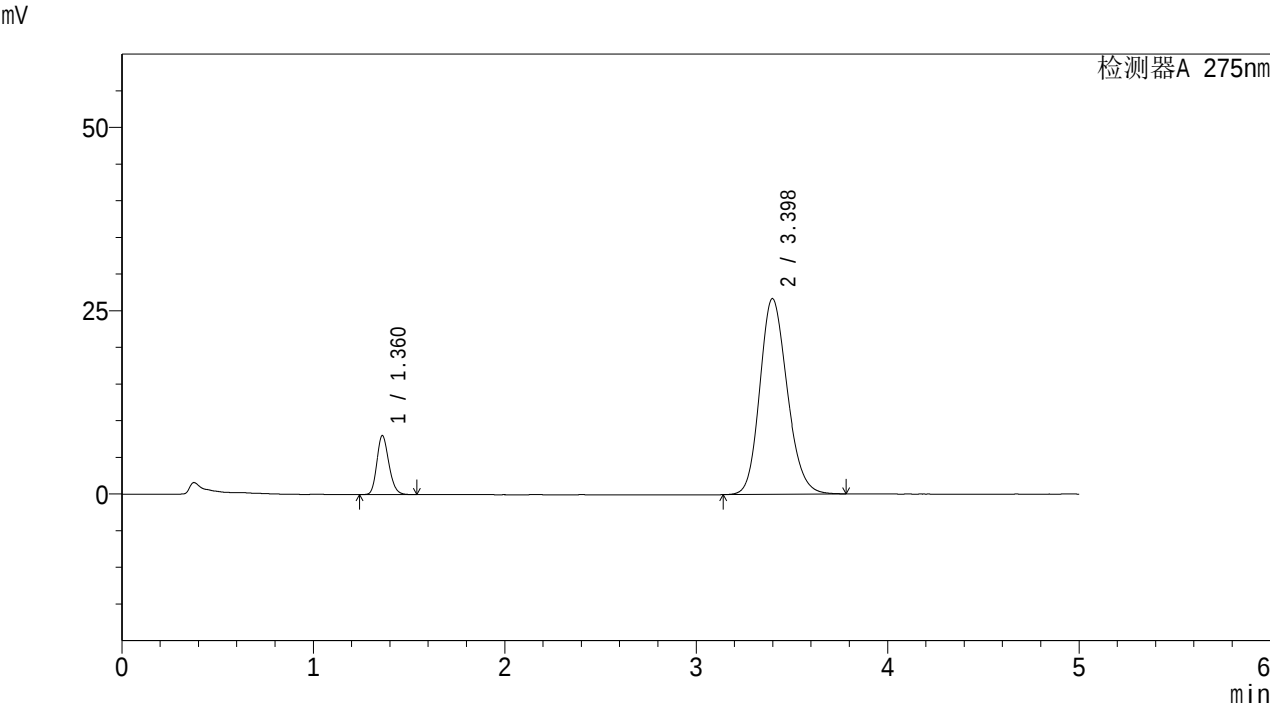

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	34904	11.624	8004	2284	1.193	--
2	3.398	265379	88.376	26704	2735	1.176	10.903
总计		300283	100.000	34709			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-450-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:56:20
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

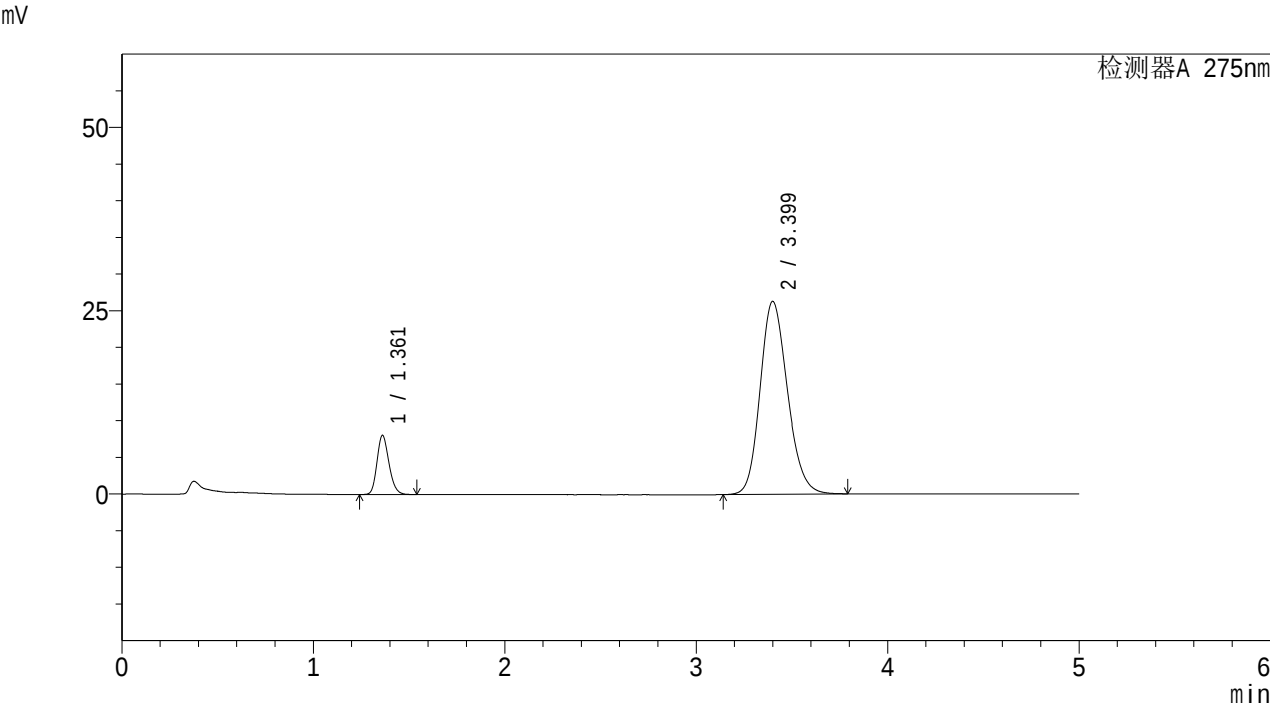

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	35002	11.804	8040	2287	1.192	--
2	3.399	261535	88.196	26302	2739	1.176	10.910
总计		296537	100.000	34342			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-451-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:01:45
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

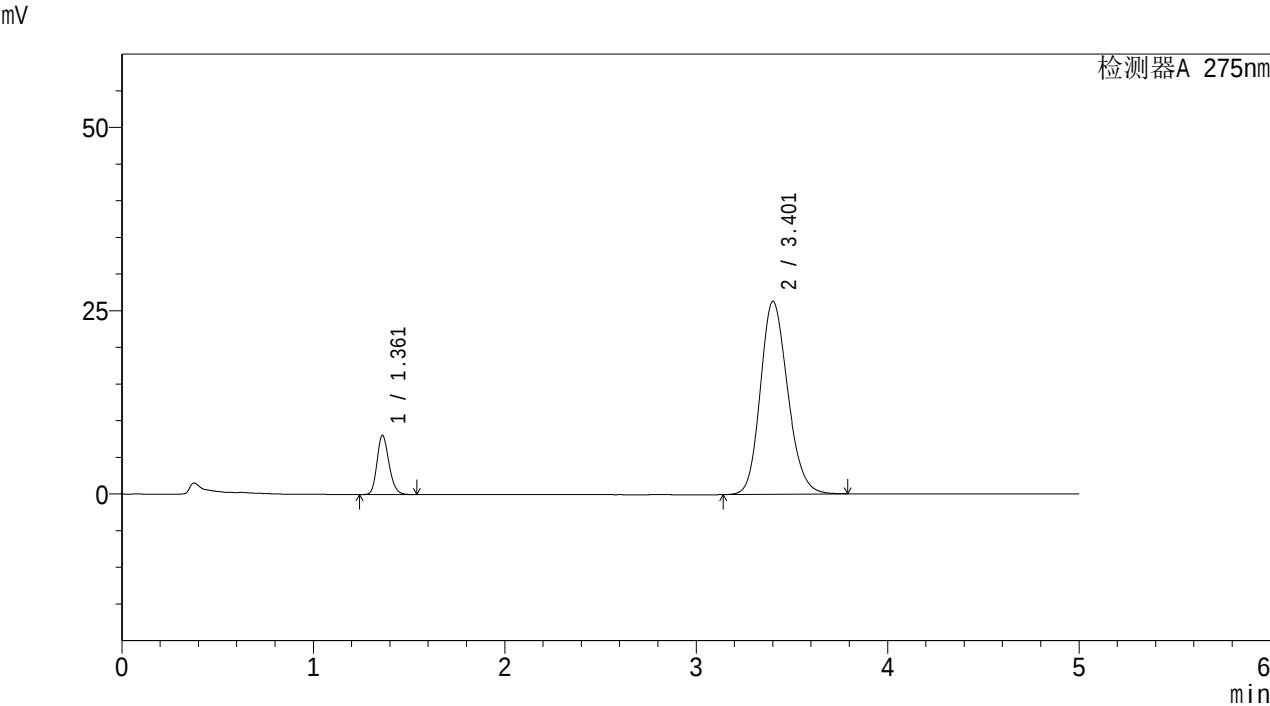

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	35054	11.816	8055	2292	1.194	--
2	3.401	261608	88.184	26284	2742	1.175	10.922
总计		296662	100.000	34339			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-452-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:07:11

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

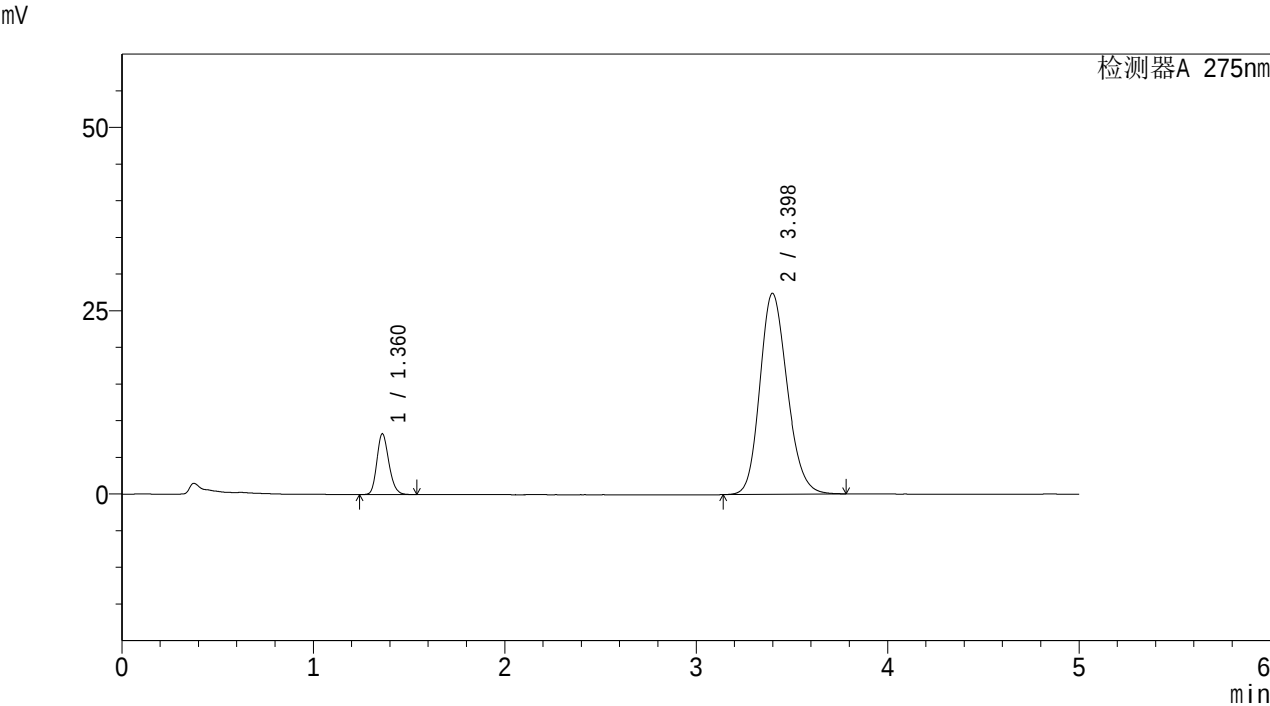

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35947	11.658	8245	2286	1.194	--
2	3.398	272404	88.342	27421	2736	1.178	10.907
总计		308351	100.000	35666			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-453-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:12:36

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

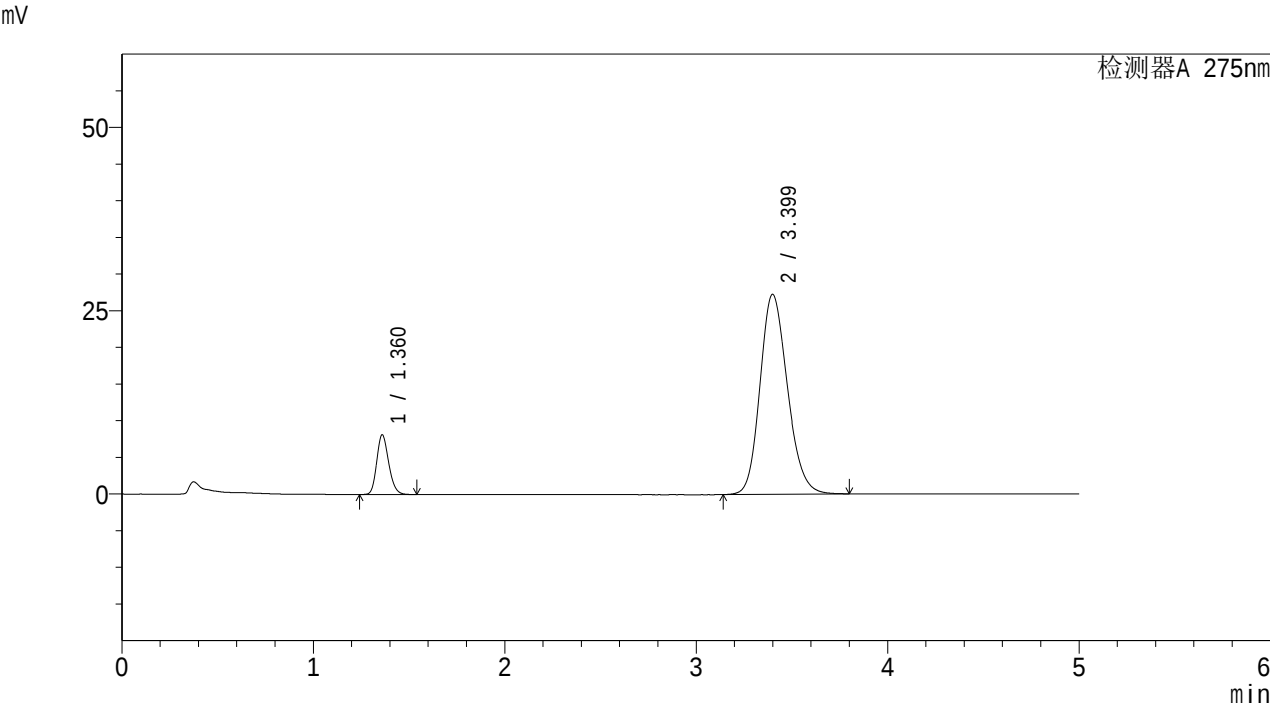

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35329	11.515	8075	2288	1.196	--
2	3.399	271481	88.485	27269	2729	1.179	10.906
总计		306810	100.000	35344			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-454-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:18:00

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

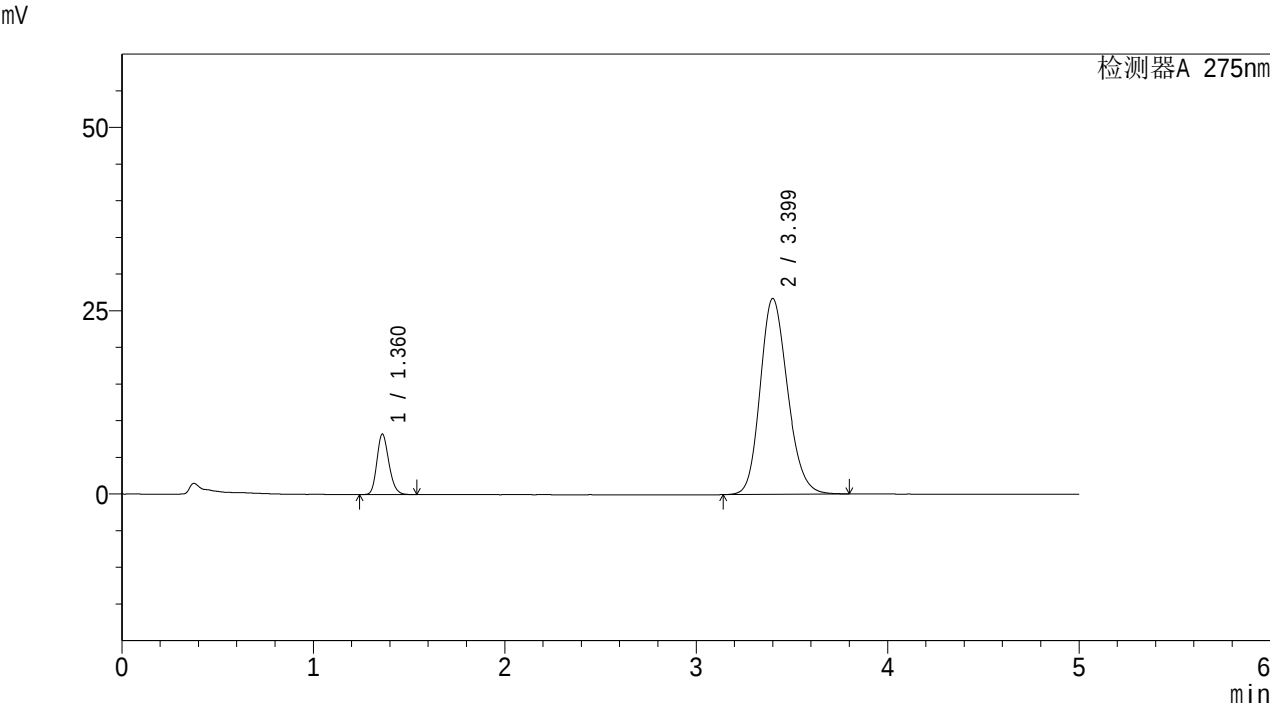

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	35817	11.892	8212	2283	1.195	--
2	3.399	265369	88.108	26698	2743	1.179	10.917
总计		301186	100.000	34910			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-455-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:23:26
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

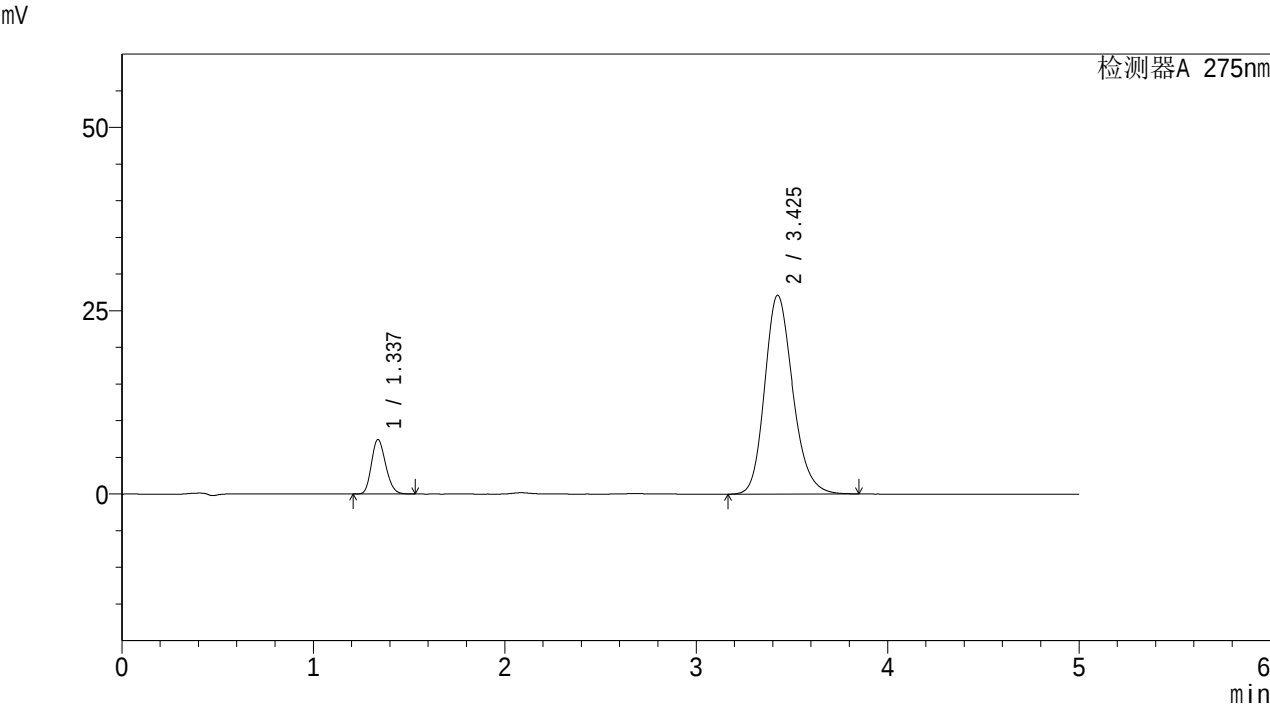

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	38226	12.113	7425	1550	1.185	--
2	3.425	277347	87.887	27107	2674	1.199	10.416
总计		315573	100.000	34532			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-456-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:28:50

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

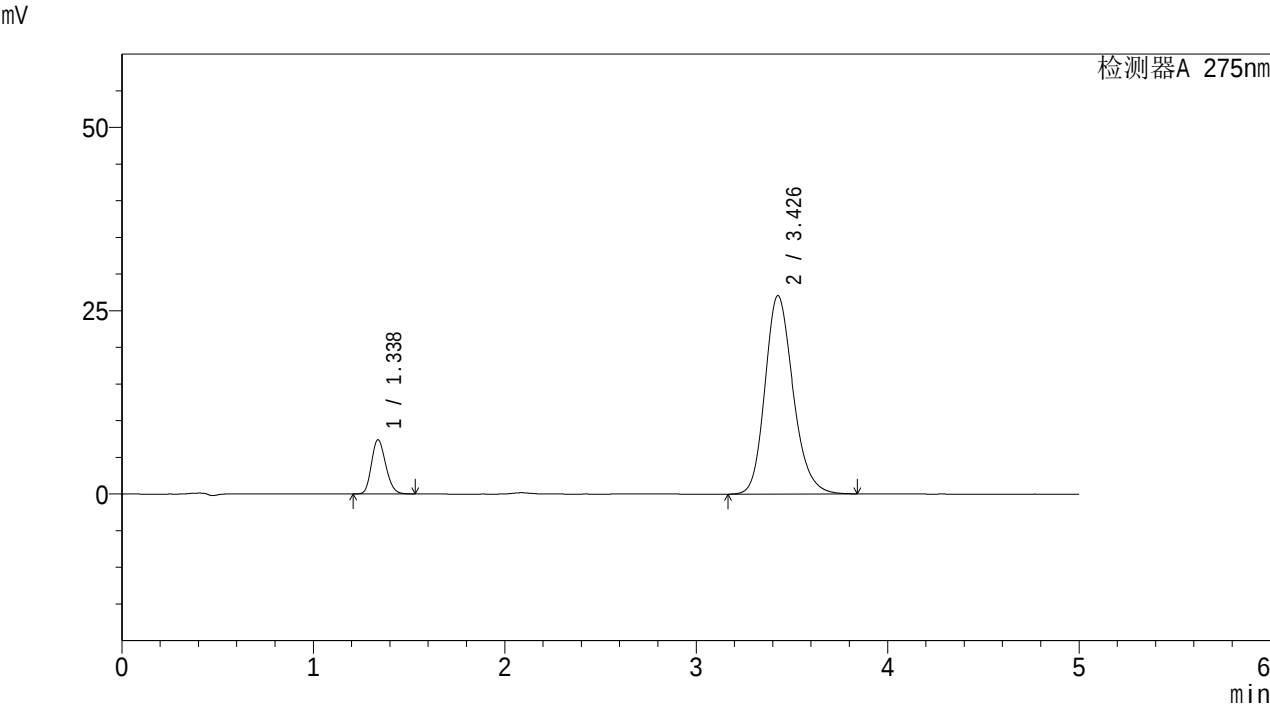

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	38101	12.106	7386	1542	1.186	--
2	3.426	276623	87.894	27036	2678	1.200	10.414
总计		314724	100.000	34422			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-457-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:34:13
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

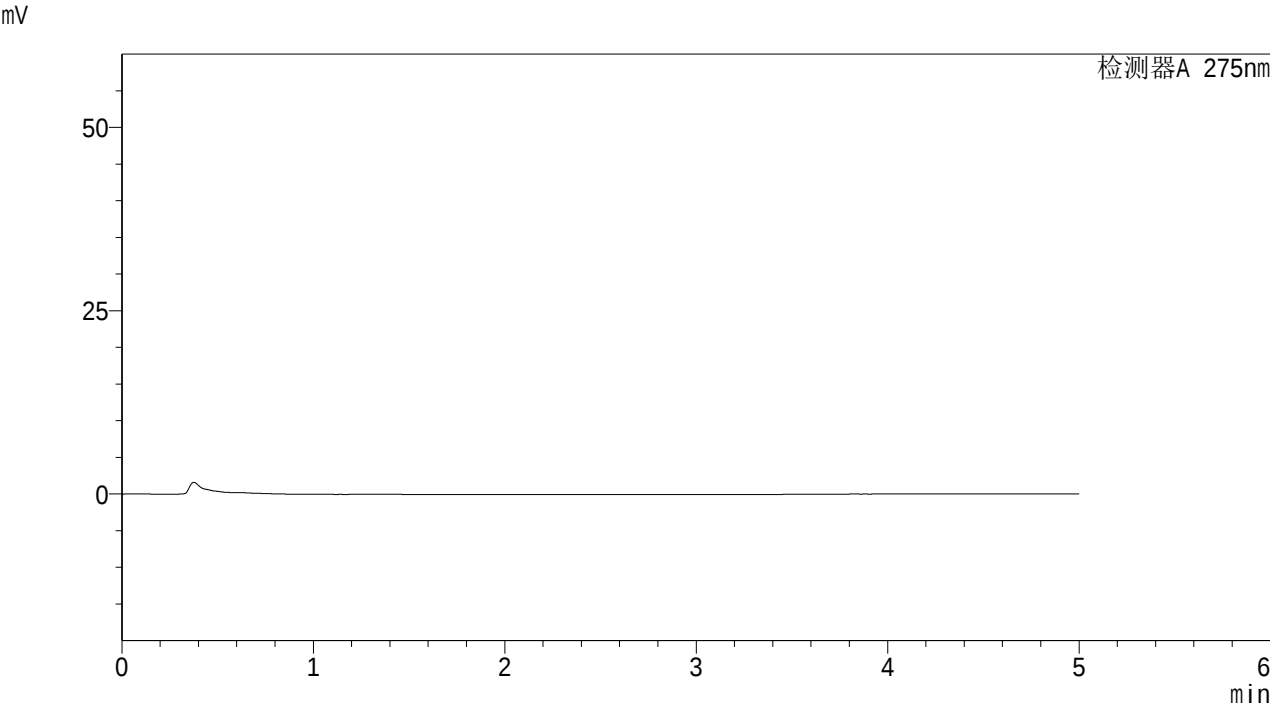

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-458-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:39:36

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

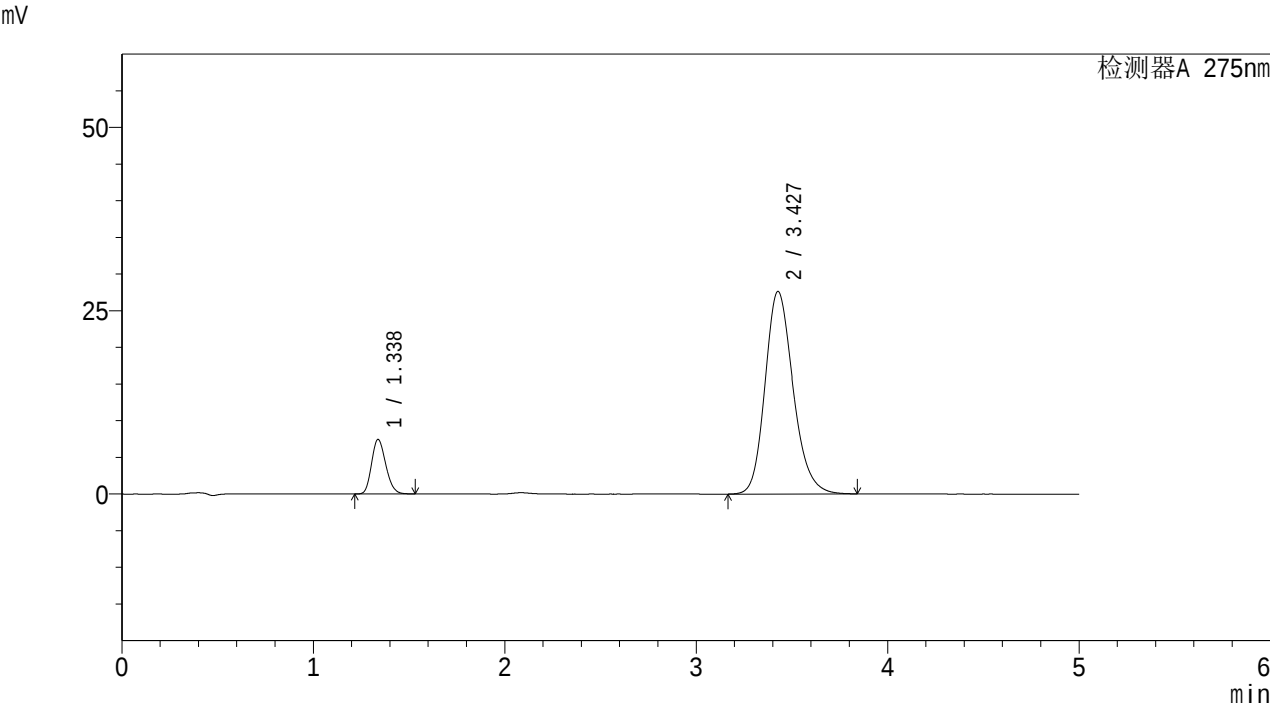

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	38241	11.935	7440	1553	1.187	--
2	3.427	282174	88.065	27608	2679	1.199	10.427
总计		320415	100.000	35048			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-459-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:44:59

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

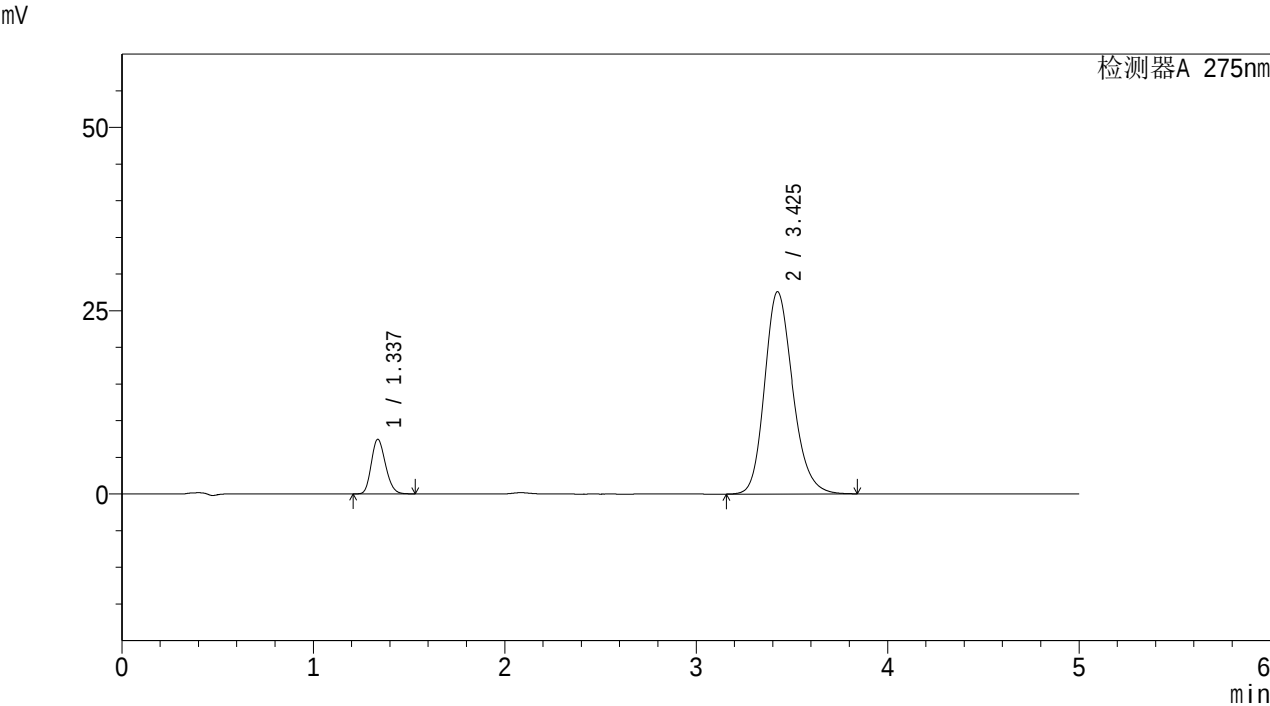

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	38269	11.958	7436	1552	1.185	--
2	3.425	281764	88.042	27576	2678	1.198	10.428
总计		320033	100.000	35012			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-460-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:50:23

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

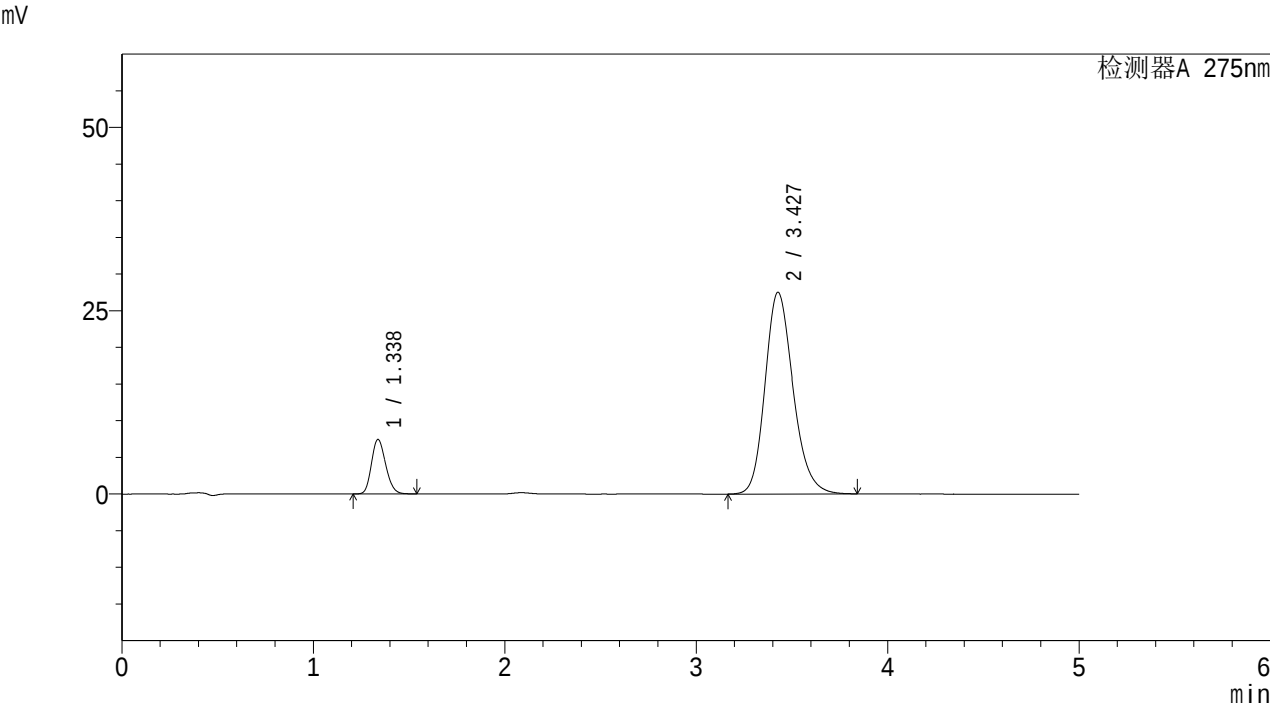

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	38239	11.976	7434	1555	1.188	--
2	3.427	281074	88.024	27486	2678	1.199	10.431
总计		319313	100.000	34921			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-461-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:55:45

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

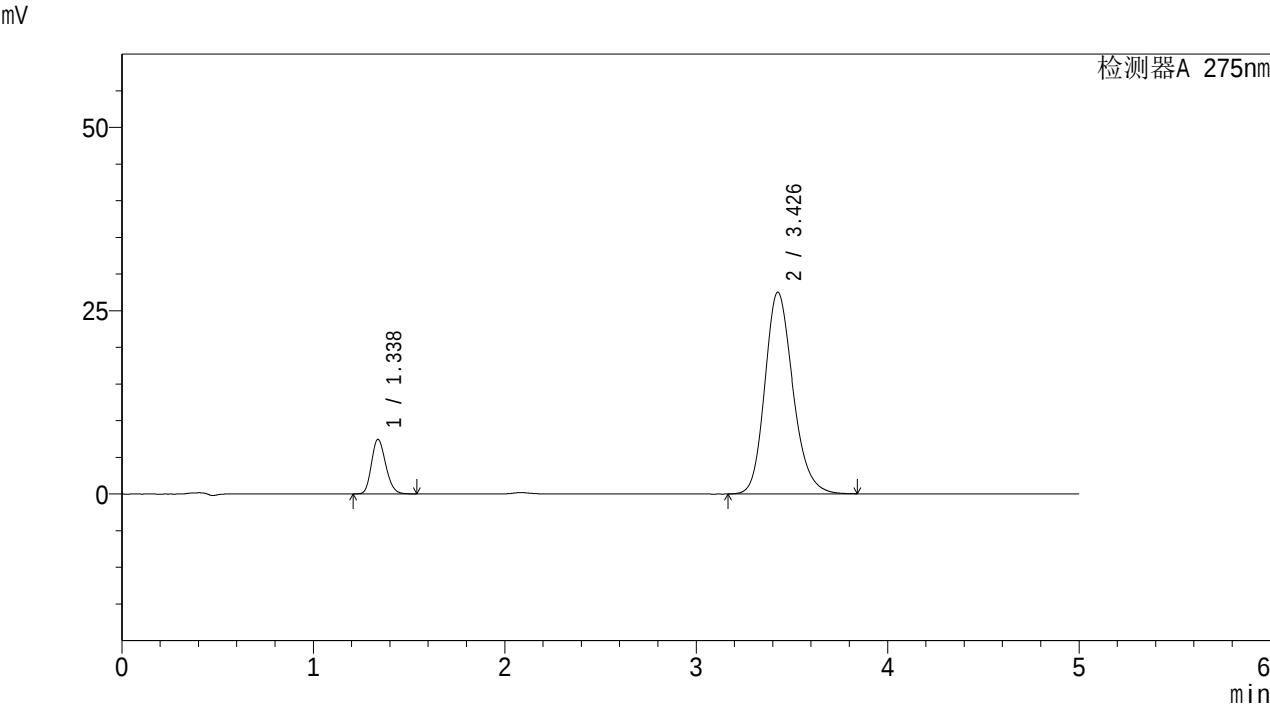

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	38310	12.005	7440	1549	1.187	--
2	3.426	280817	87.995	27466	2682	1.198	10.426
总计		319127	100.000	34906			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-462-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:01:08
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

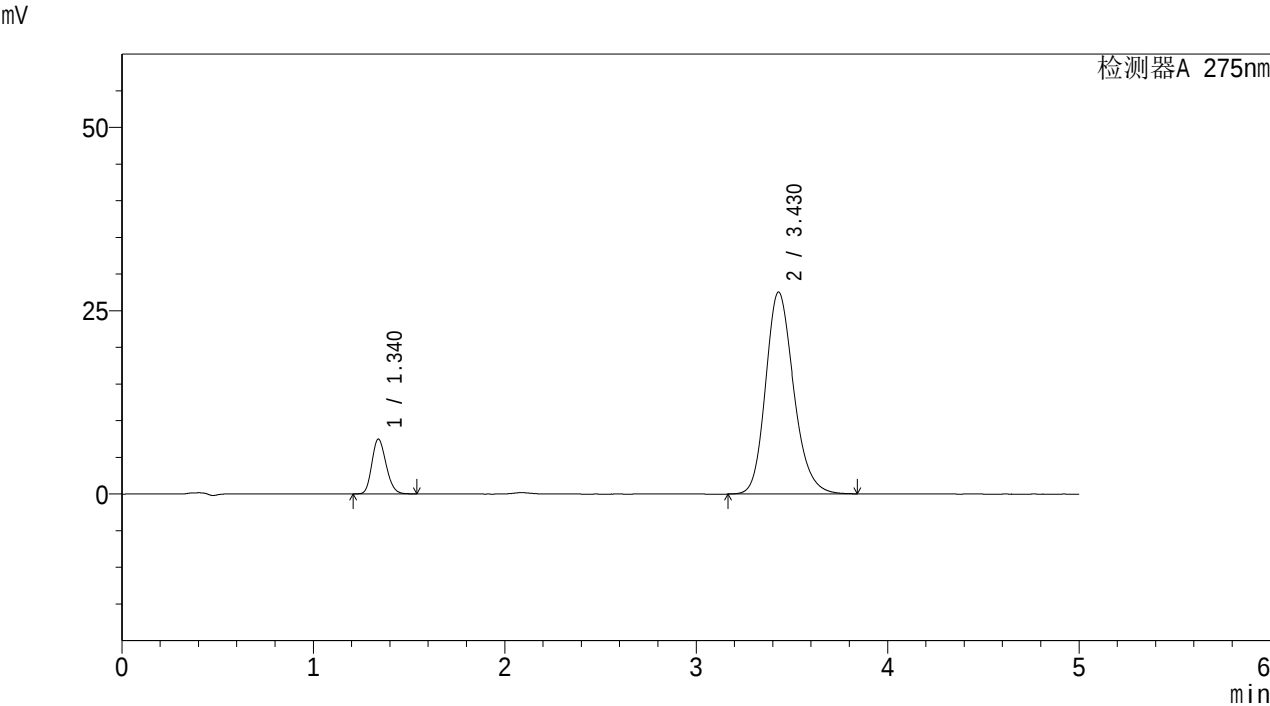

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38446	12.042	7468	1555	1.188	--
2	3.430	280807	87.958	27549	2693	1.197	10.443
总计		319252	100.000	35017			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-463-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:06:31
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

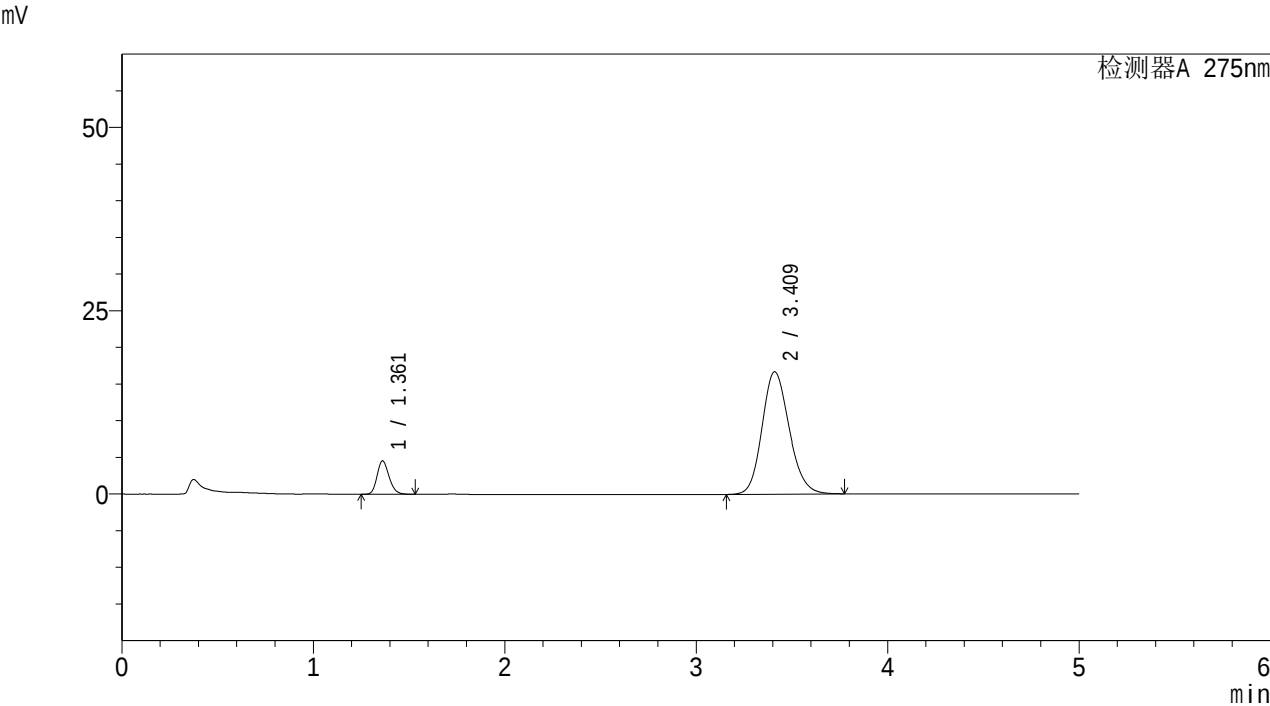

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	19779	10.713	4545	2285	1.194	--
2	3.409	164851	89.287	16672	2795	1.161	11.015
总计		184630	100.000	21218			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-464-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:11:54

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

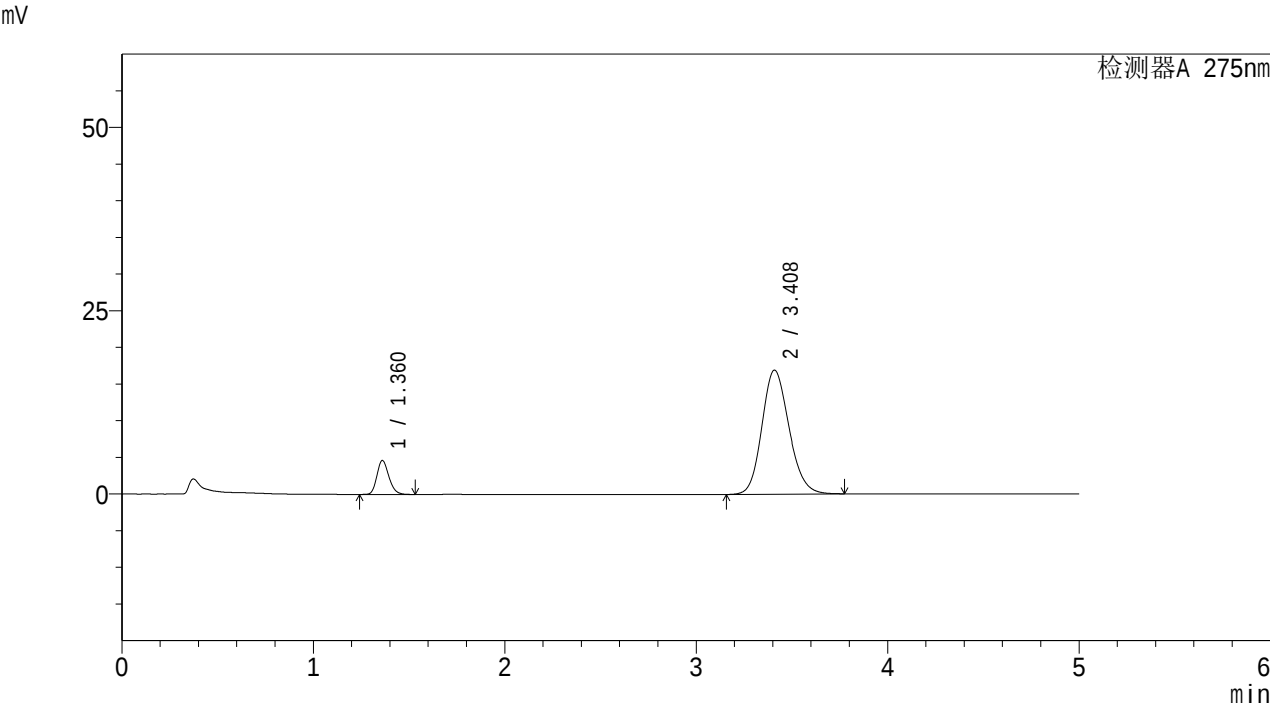

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	20074	10.734	4604	2288	1.196	--
2	3.408	166931	89.266	16910	2800	1.162	11.027
总计		187005	100.000	21514			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-465-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:17:16
处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

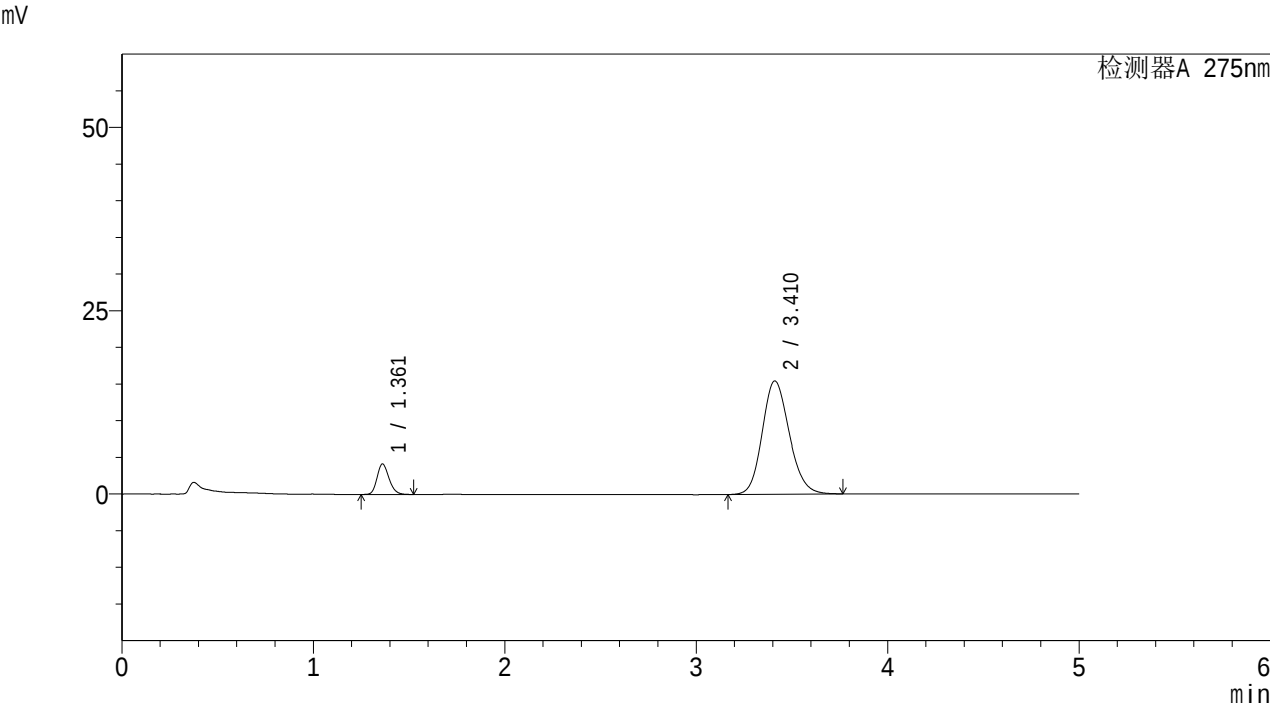

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	17990	10.579	4148	2299	1.193	--
2	3.410	152058	89.421	15450	2819	1.158	11.061
总计		170048	100.000	19598			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-466-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:22:39

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

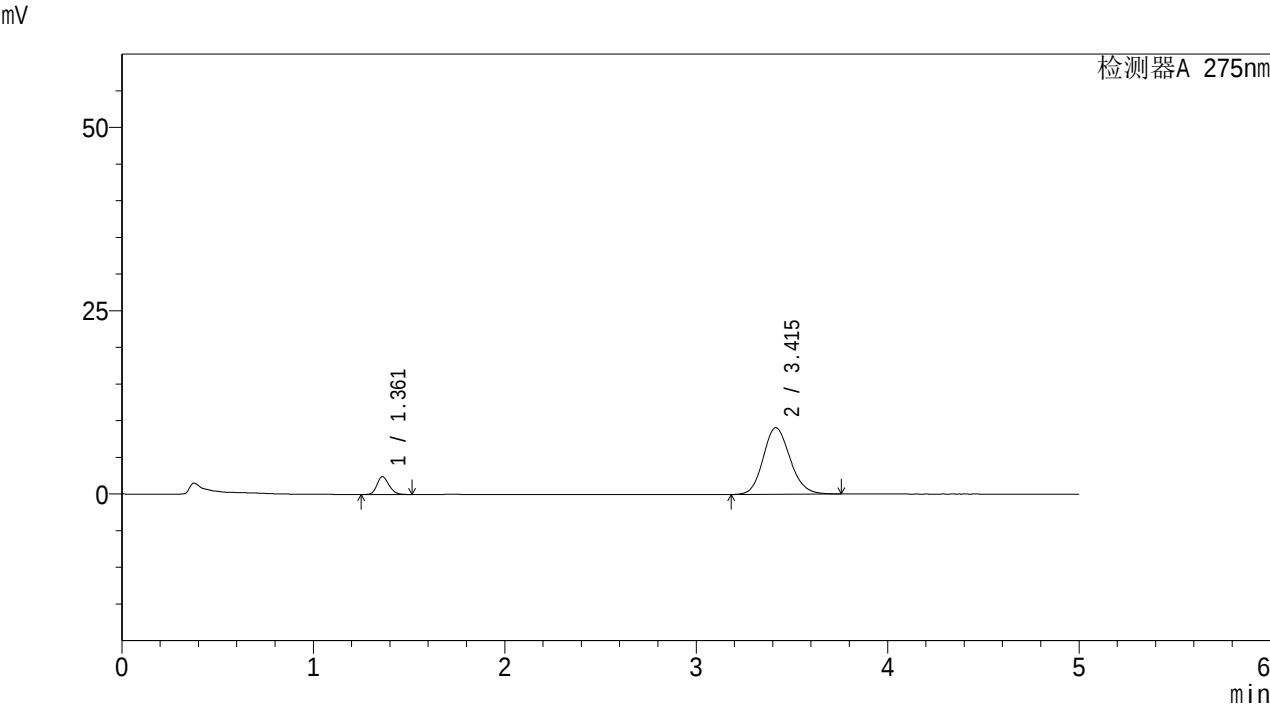

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	10555	10.612	2432	2297	1.192	--
2	3.415	88905	89.388	9085	2850	1.145	11.119
总计		99460	100.000	11518			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-467-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:28:02

处理时间(V2): 2026/05/12 11:58:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

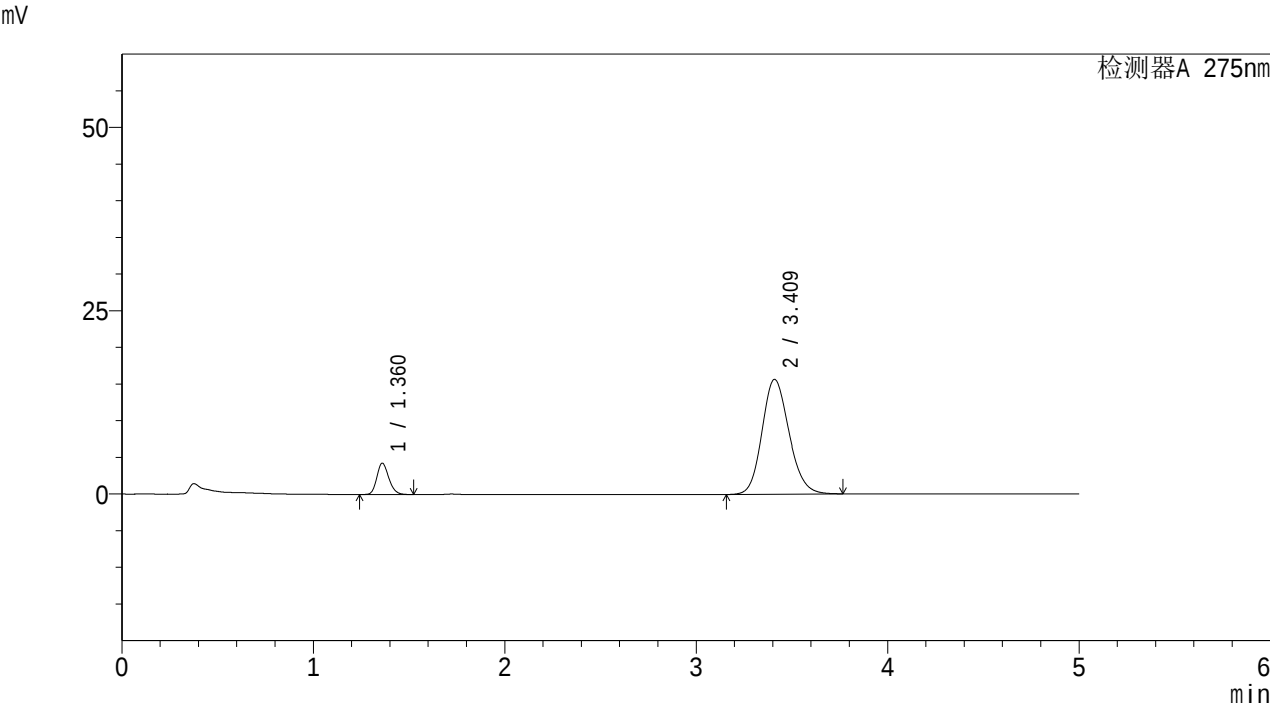

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	18489	10.714	4248	2294	1.192	--
2	3.409	154084	89.286	15645	2816	1.158	11.058
总计		172573	100.000	19892			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-468-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:33:25

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

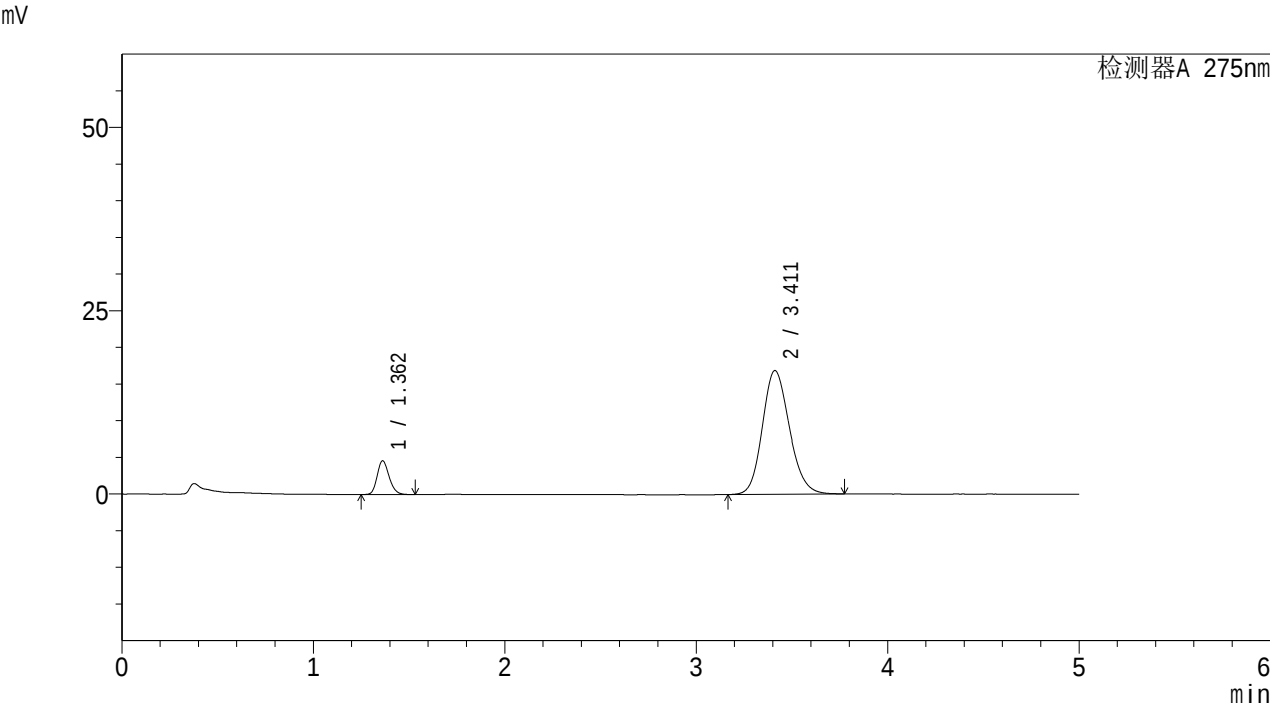

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	19968	10.730	4605	2296	1.192	--
2	3.411	166123	89.270	16869	2814	1.161	11.050
总计		186091	100.000	21474			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-469-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:38:46

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

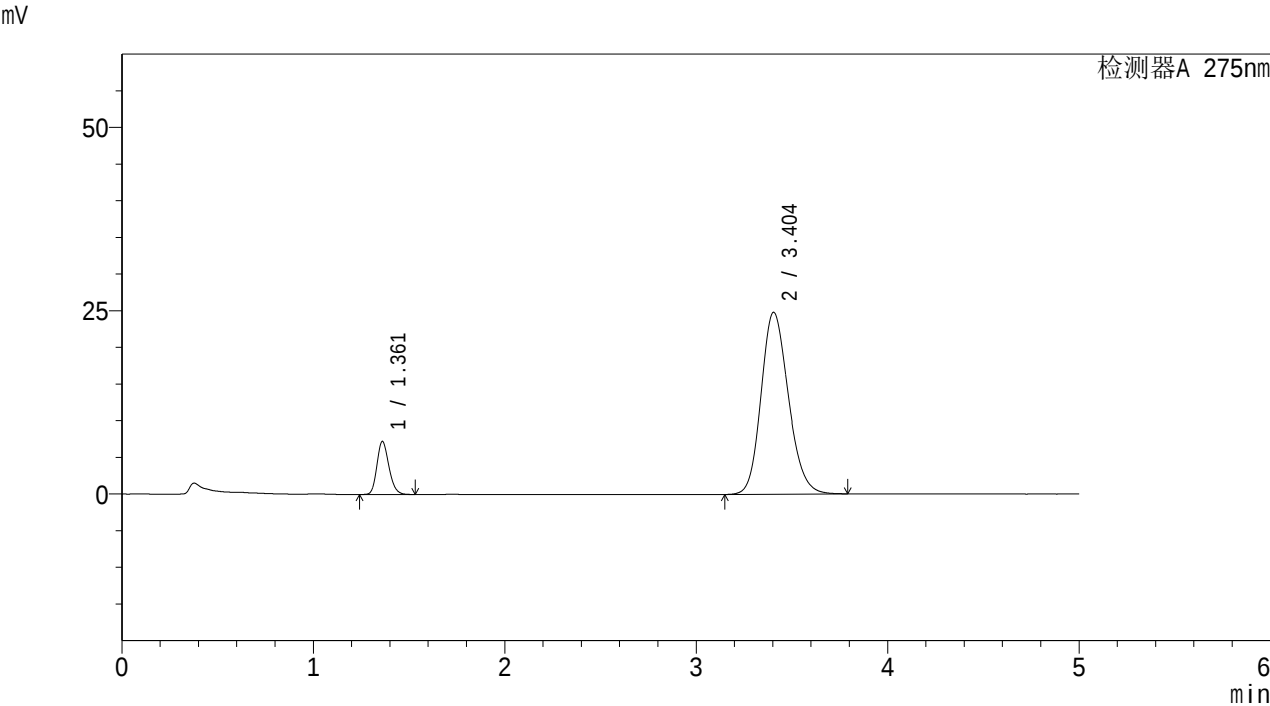

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	31324	11.277	7203	2293	1.193	--
2	3.404	246436	88.723	24823	2751	1.176	10.950
总计		277761	100.000	32026			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-470-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:44:09
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

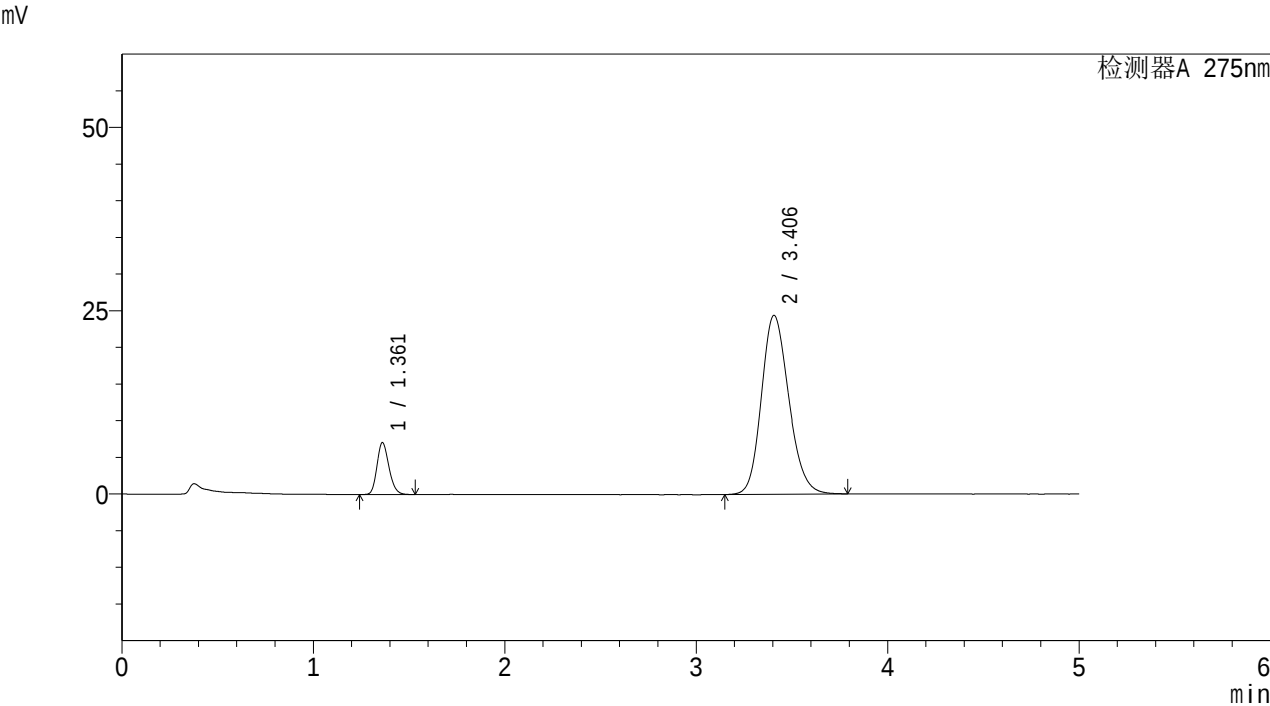

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	30714	11.228	7062	2290	1.194	--
2	3.406	242836	88.772	24413	2745	1.176	10.942
总计		273549	100.000	31475			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-471-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:49:32
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

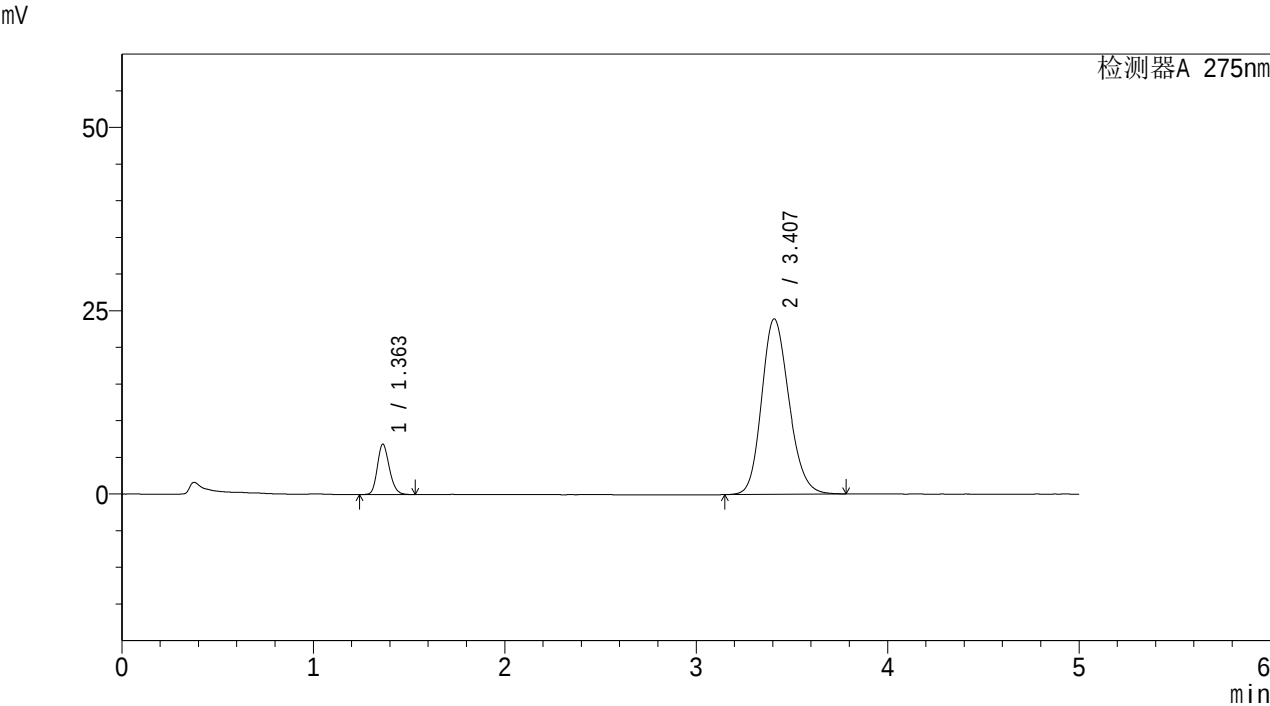

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	29780	11.147	6875	2295	1.193	--
2	3.407	237387	88.853	23933	2762	1.175	10.957
总计		267167	100.000	30809			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-472-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:54:53
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

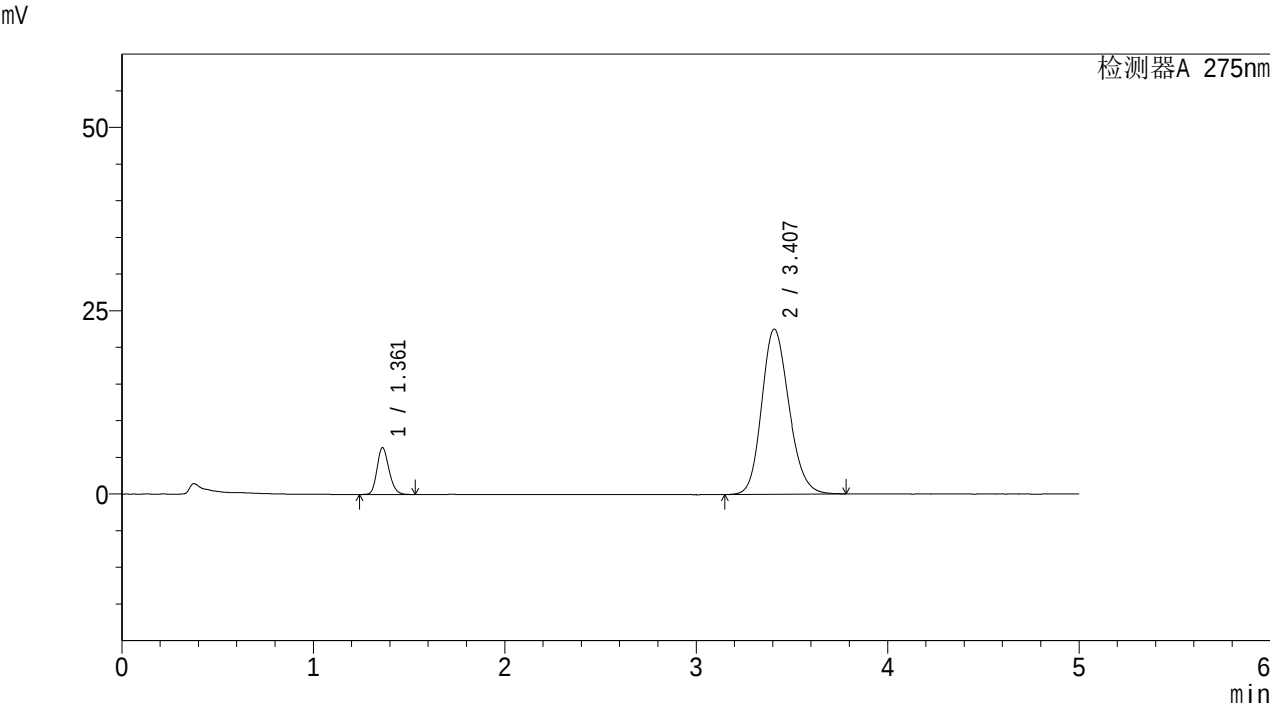

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	27676	11.030	6373	2294	1.192	--
2	3.407	223233	88.970	22525	2767	1.173	10.977
总计		250909	100.000	28898			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-473-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:00:16
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

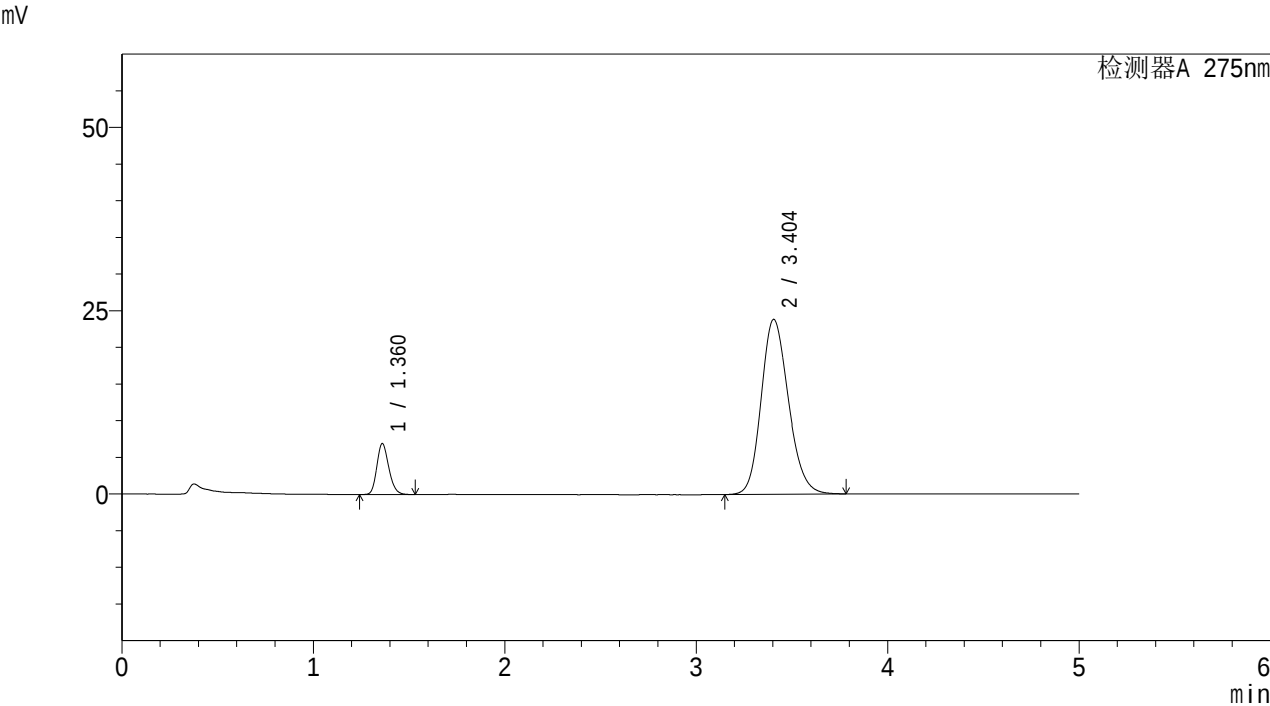

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	30084	11.284	6908	2292	1.193	--
2	3.404	236515	88.716	23867	2763	1.175	10.970
总计		266598	100.000	30775			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-474-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:05:37
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

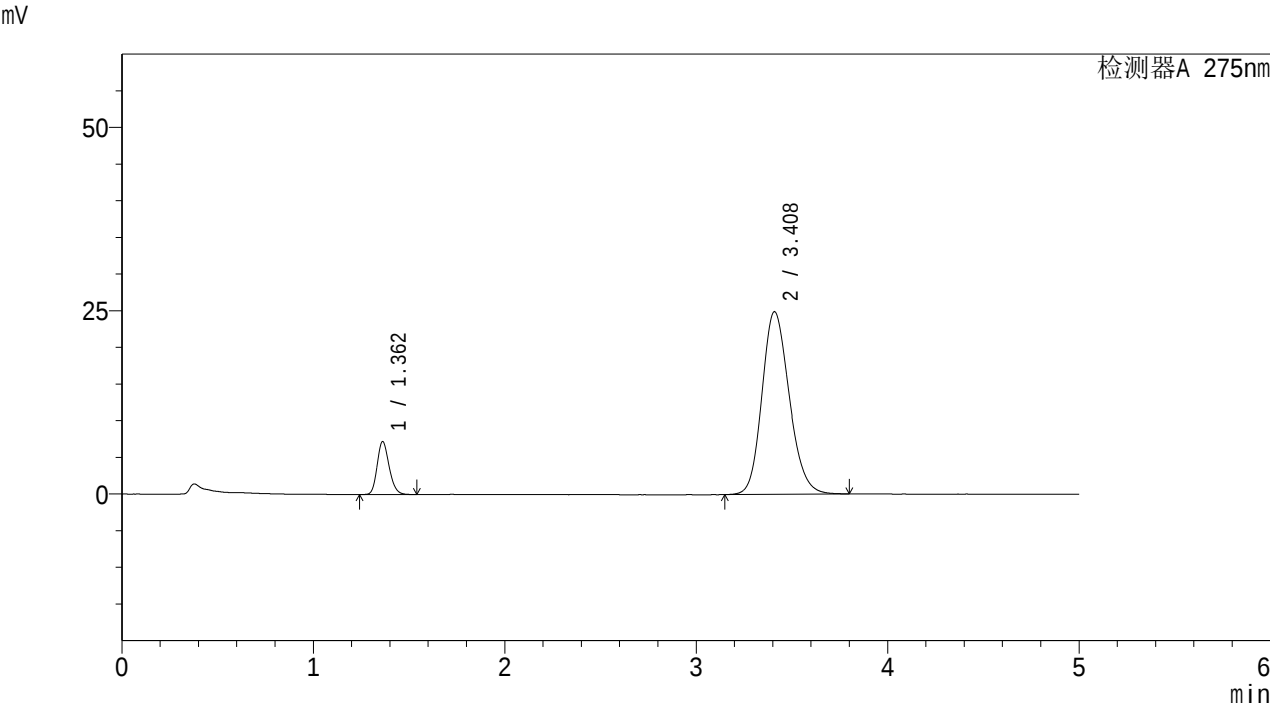

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	31349	11.256	7216	2291	1.194	--
2	3.408	247165	88.744	24877	2764	1.178	10.969
总计		278514	100.000	32093			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-475-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:11:00

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

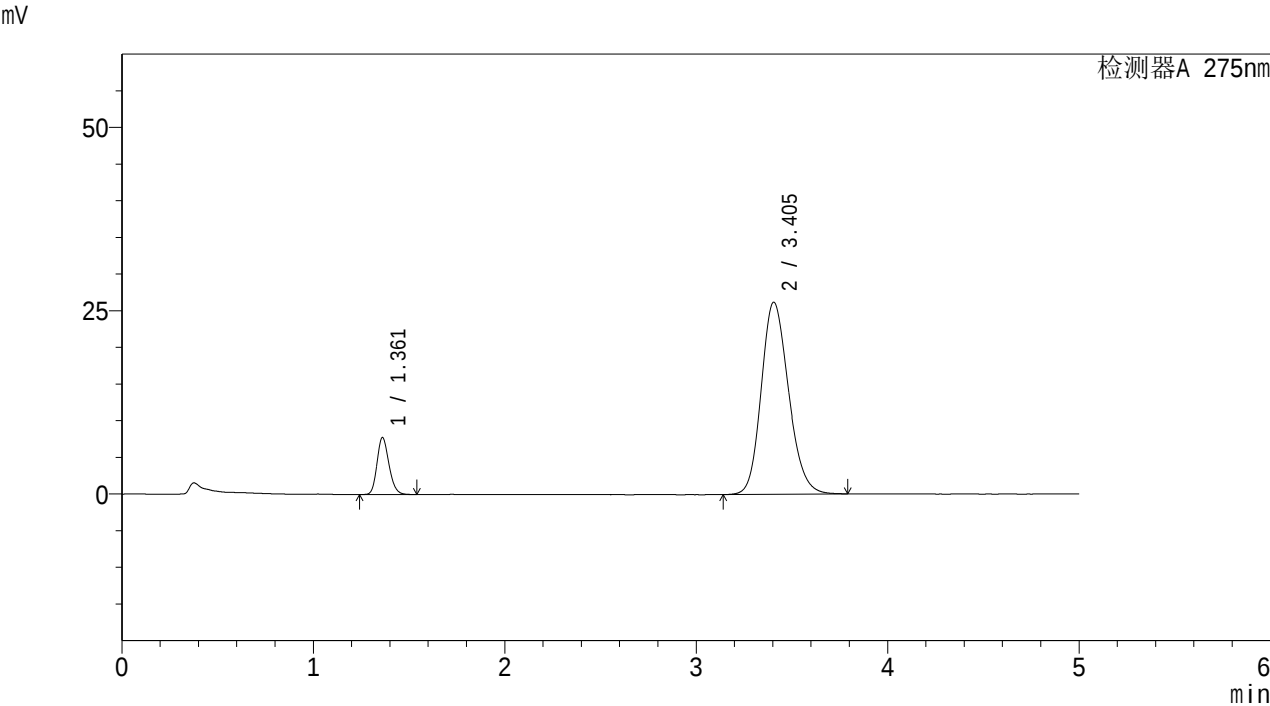

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	33628	11.440	7742	2295	1.192	--
2	3.405	260326	88.560	26205	2747	1.180	10.944
总计		293954	100.000	33946			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-476-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:16:23
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

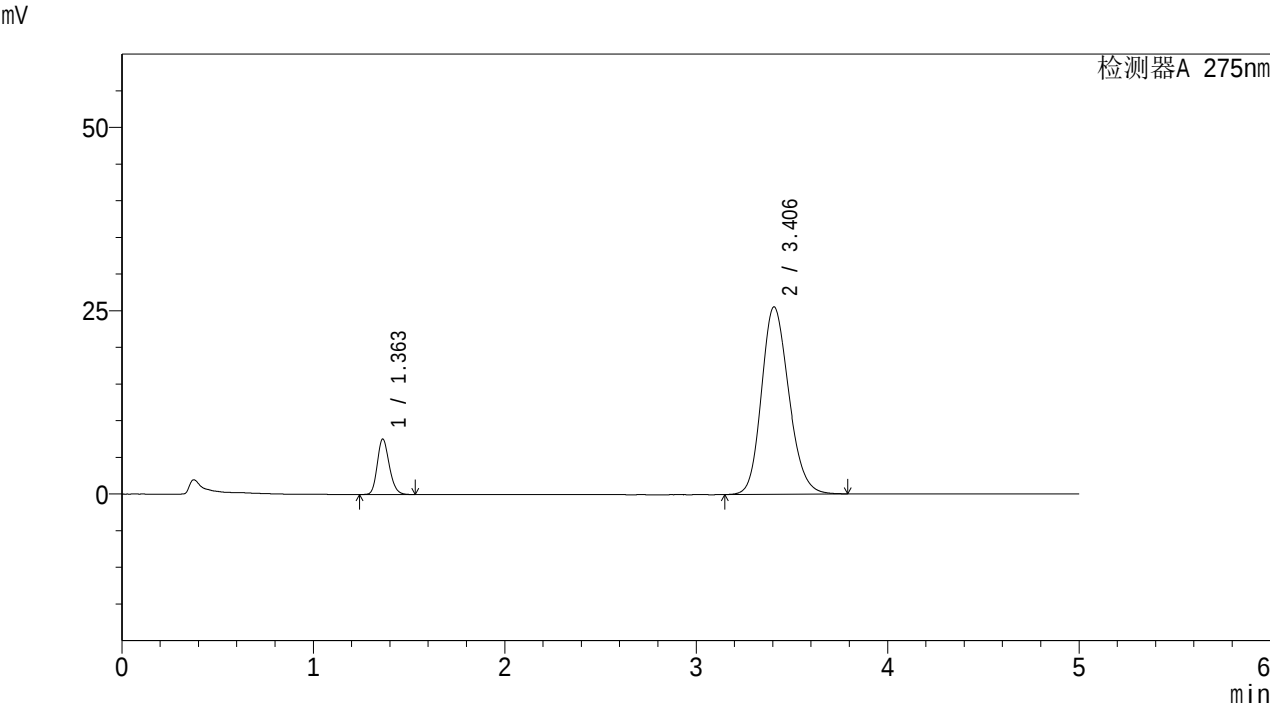

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	32810	11.444	7572	2297	1.191	--
2	3.406	253887	88.556	25569	2752	1.179	10.945
总计		286697	100.000	33141			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-477-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:21:44

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

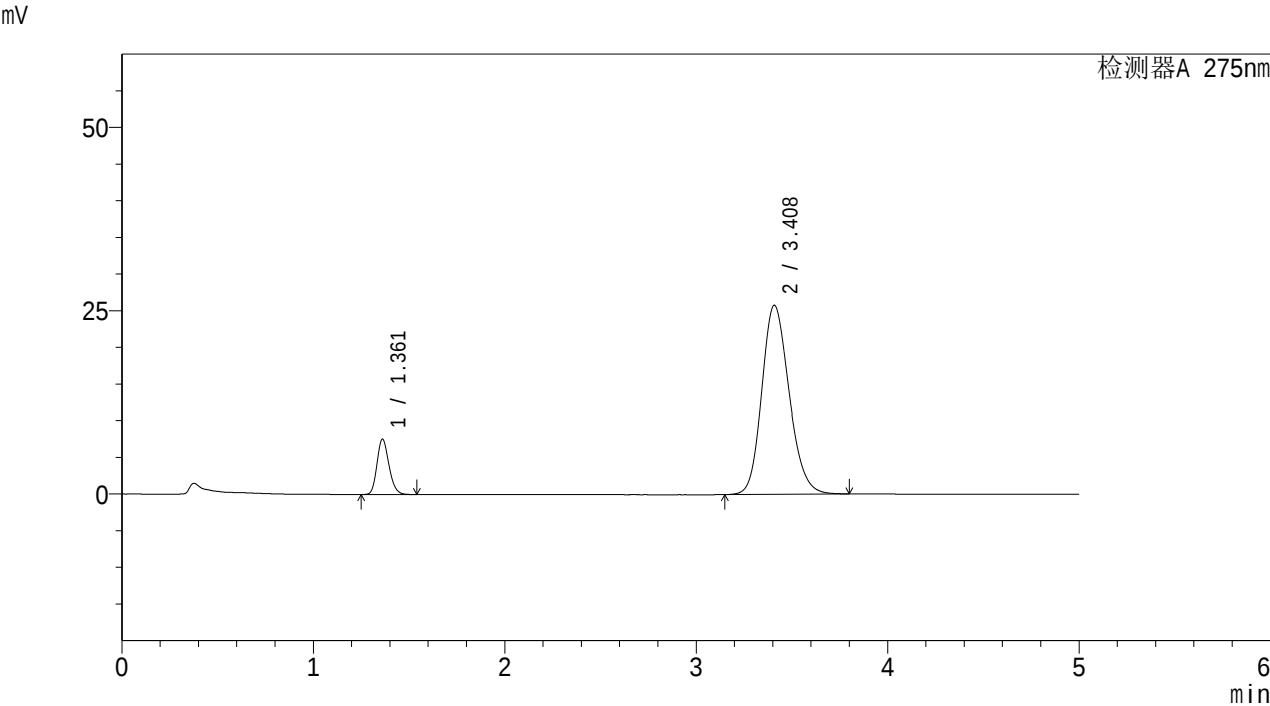

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	32784	11.335	7536	2290	1.193	--
2	3.408	256448	88.665	25777	2750	1.180	10.954
总计		289232	100.000	33313			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-478-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:27:07

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

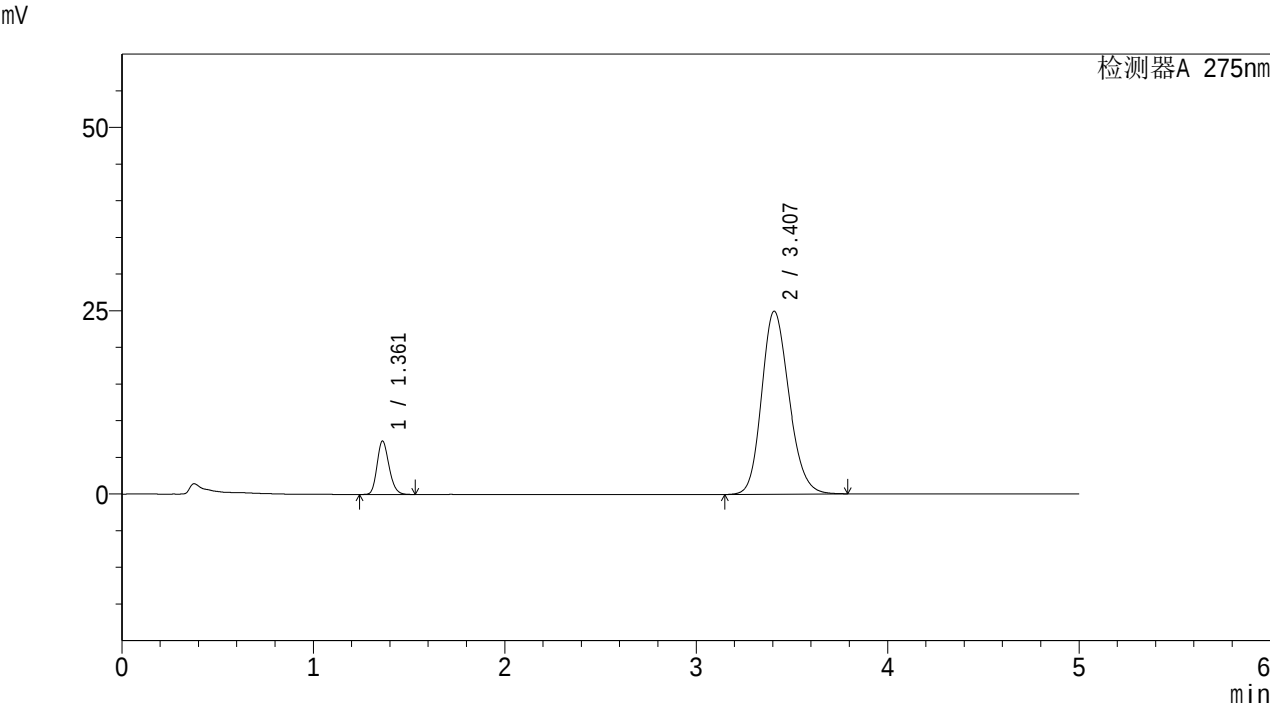

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	31569	11.281	7268	2294	1.193	--
2	3.407	248264	88.719	24962	2747	1.179	10.948
总计		279833	100.000	32230			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-479-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:32:30

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

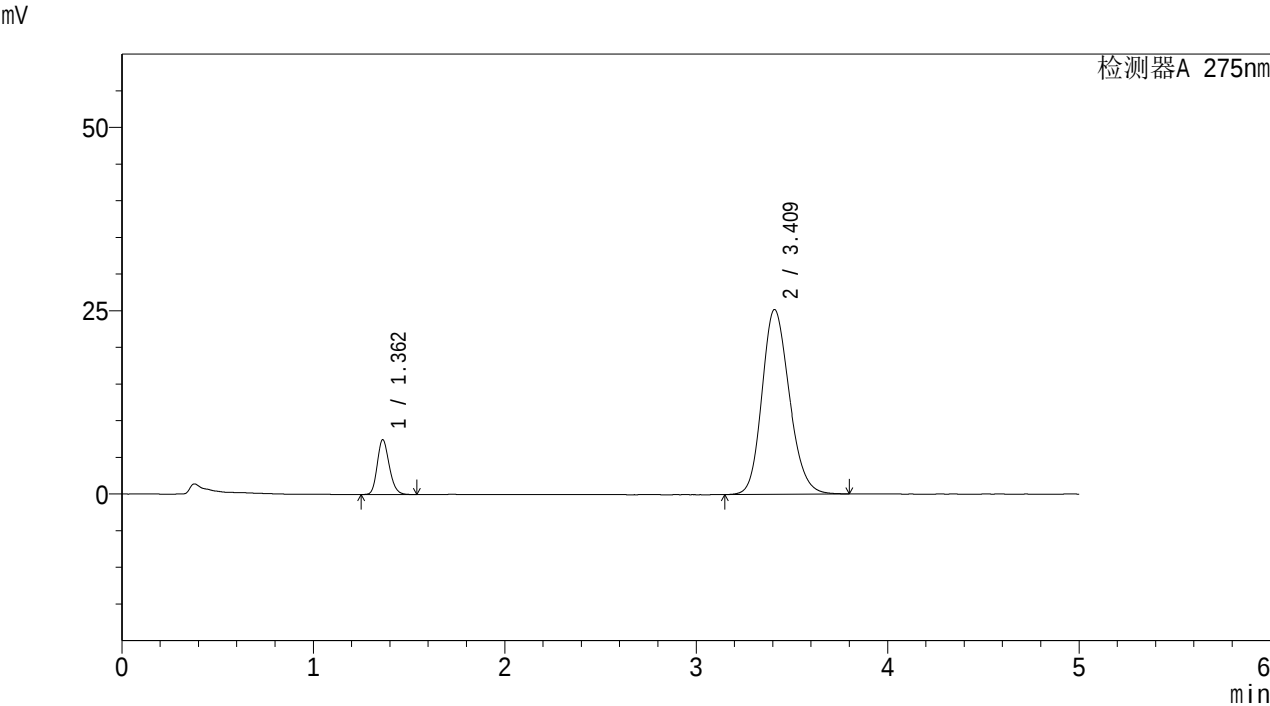

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	32403	11.453	7479	2301	1.193	--
2	3.409	250509	88.547	25175	2756	1.180	10.963
总计		282911	100.000	32653			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-480-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:37:51
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

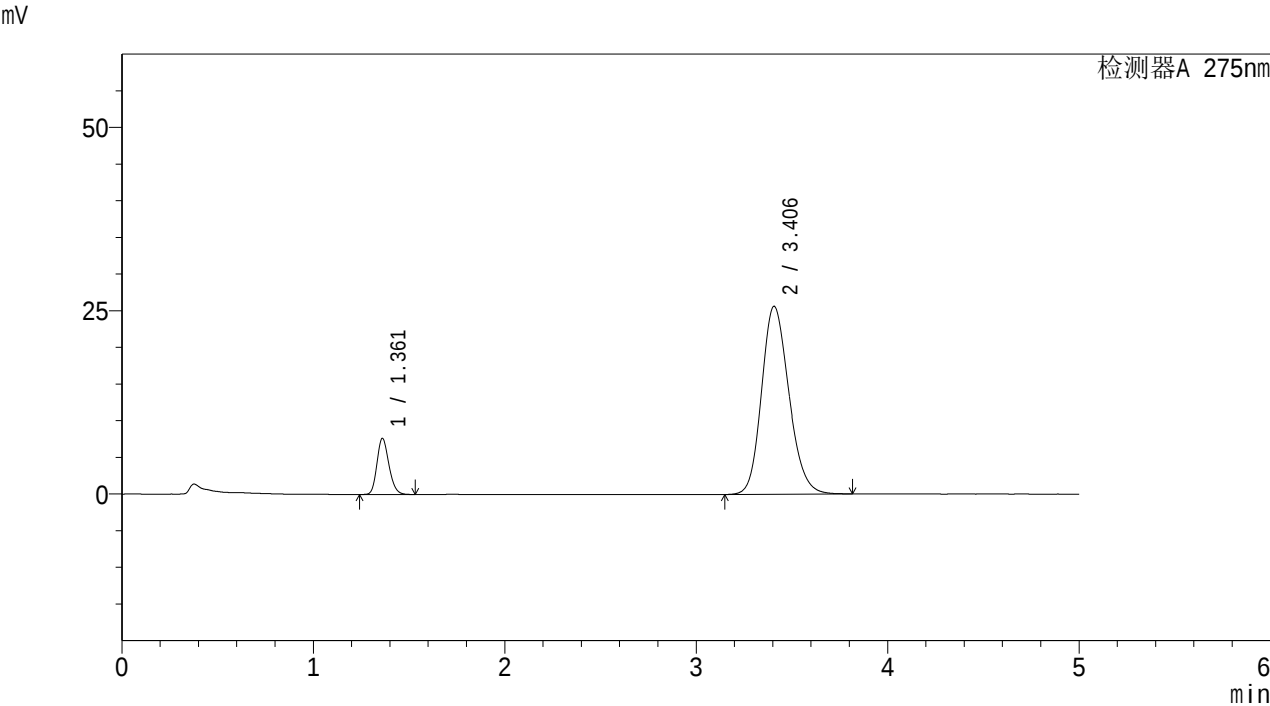

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	33190	11.513	7627	2291	1.193	--
2	3.406	255097	88.487	25646	2745	1.181	10.946
总计		288287	100.000	33273			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-481-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:43:14
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

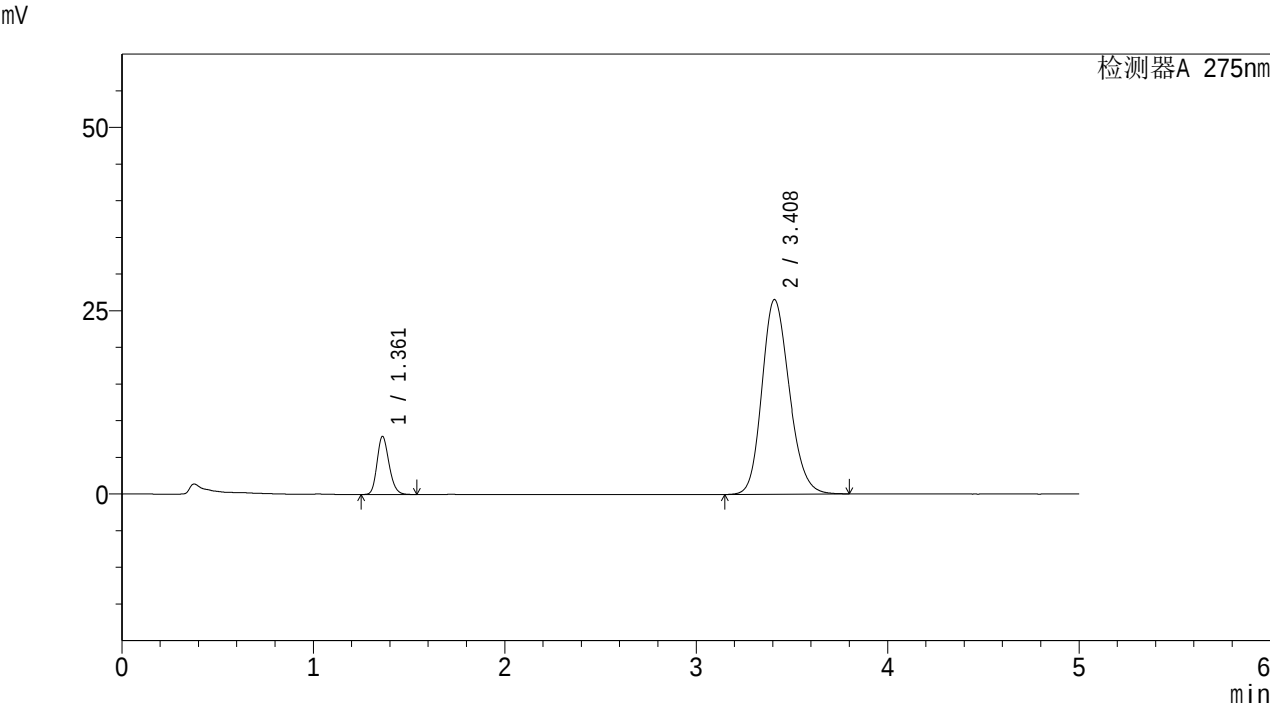

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	34364	11.515	7906	2293	1.194	--
2	3.408	264063	88.485	26530	2749	1.183	10.955
总计		298427	100.000	34436			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-482-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:48:36
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

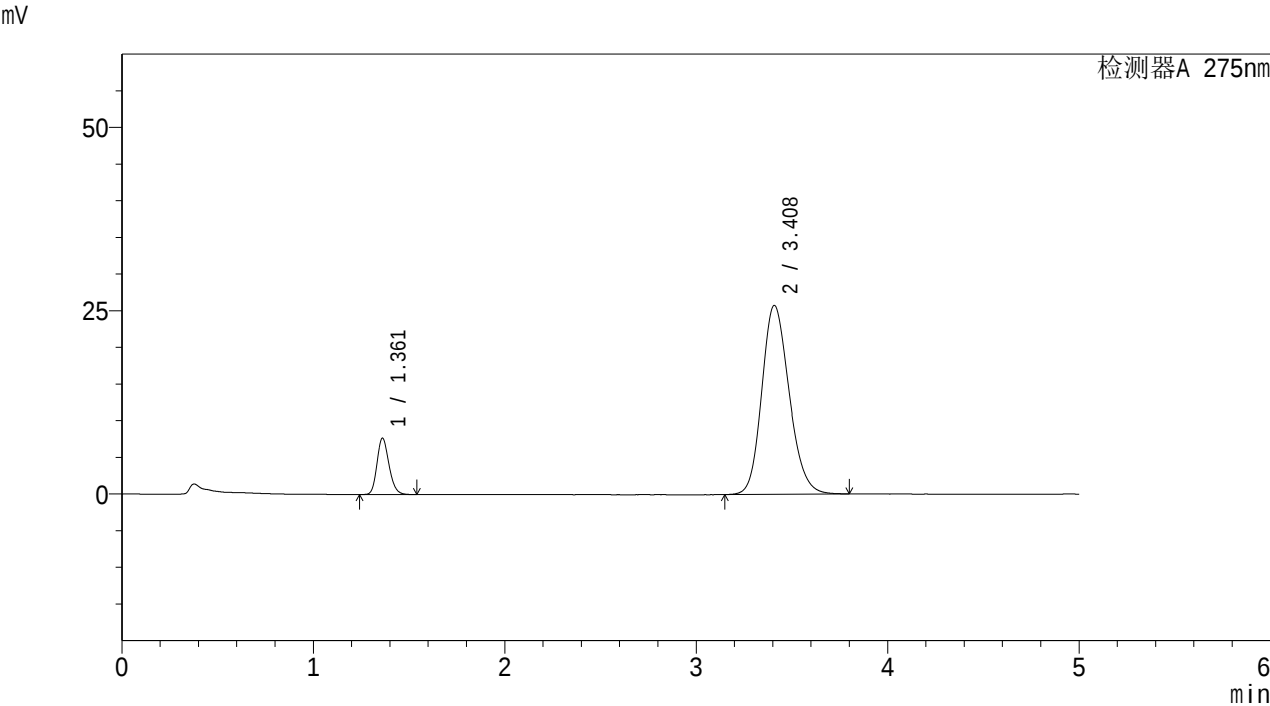

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	33413	11.528	7671	2287	1.193	--
2	3.408	256429	88.472	25762	2742	1.182	10.940
总计		289841	100.000	33433			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-483-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:53:58

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

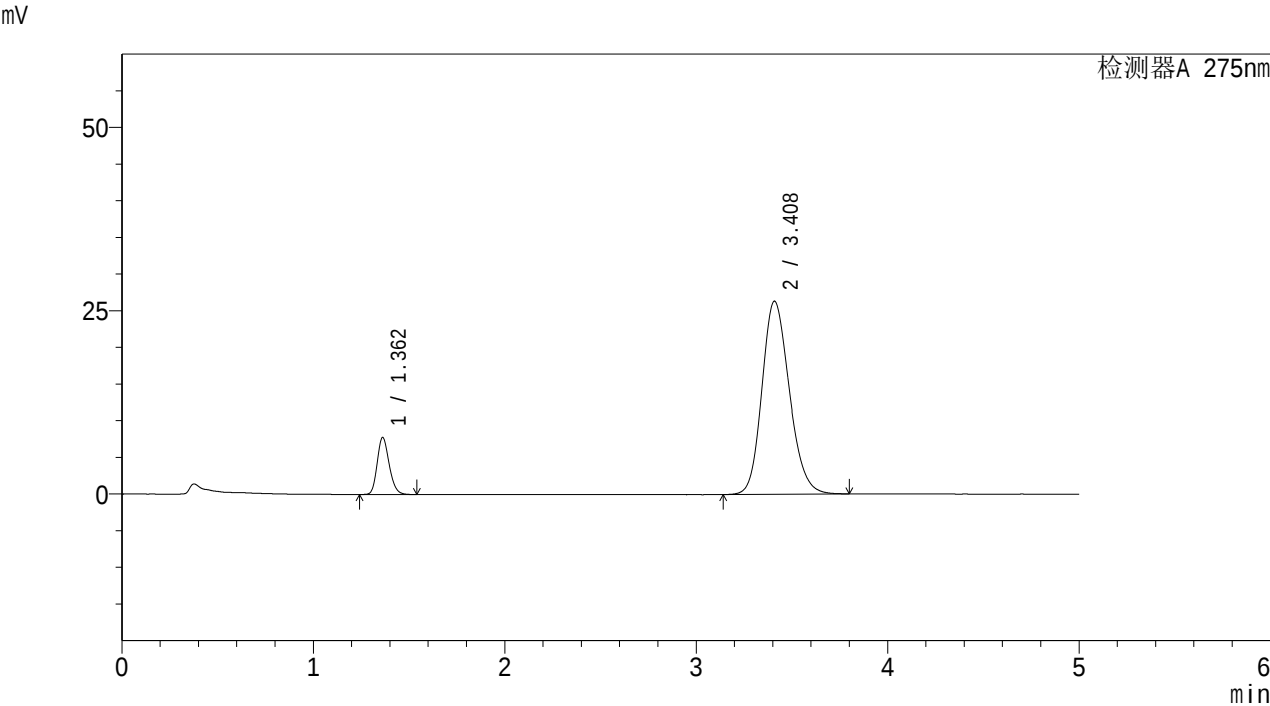

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33736	11.393	7768	2287	1.194	--
2	3.408	262390	88.607	26315	2739	1.183	10.931
总计		296126	100.000	34083			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-484-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:59:21
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>
mV

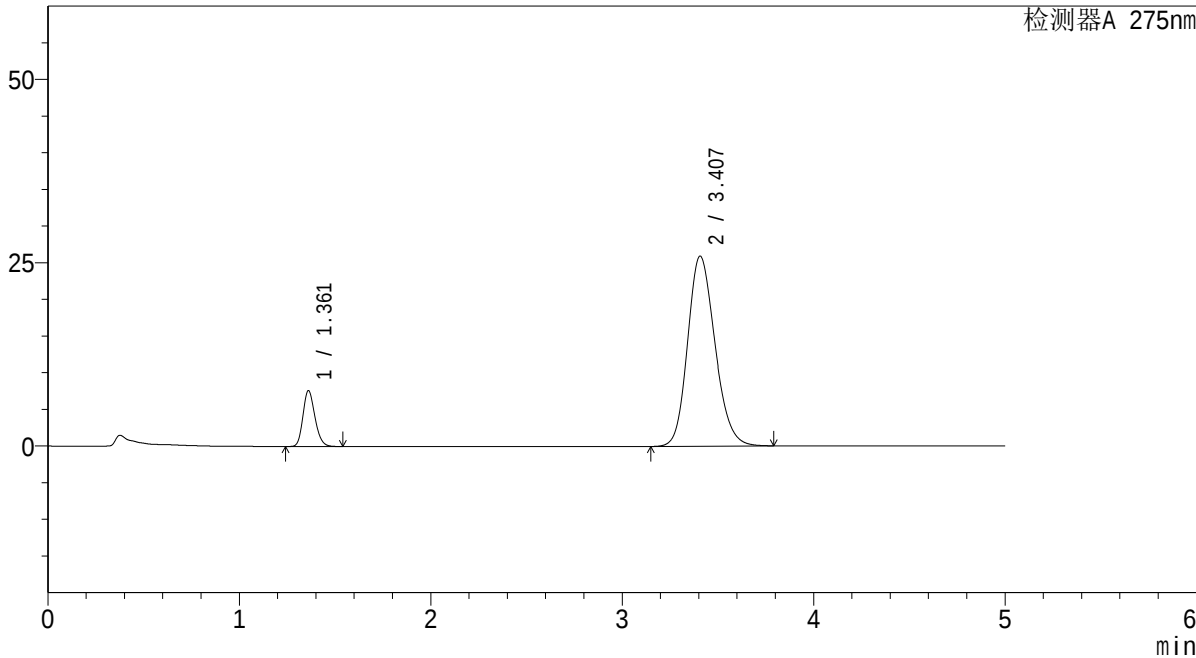

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	33071	11.365	7591	2288	1.196	--
2	3.407	257924	88.635	25938	2743	1.183	10.941
总计		290995	100.000	33529			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-485-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:04:42
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

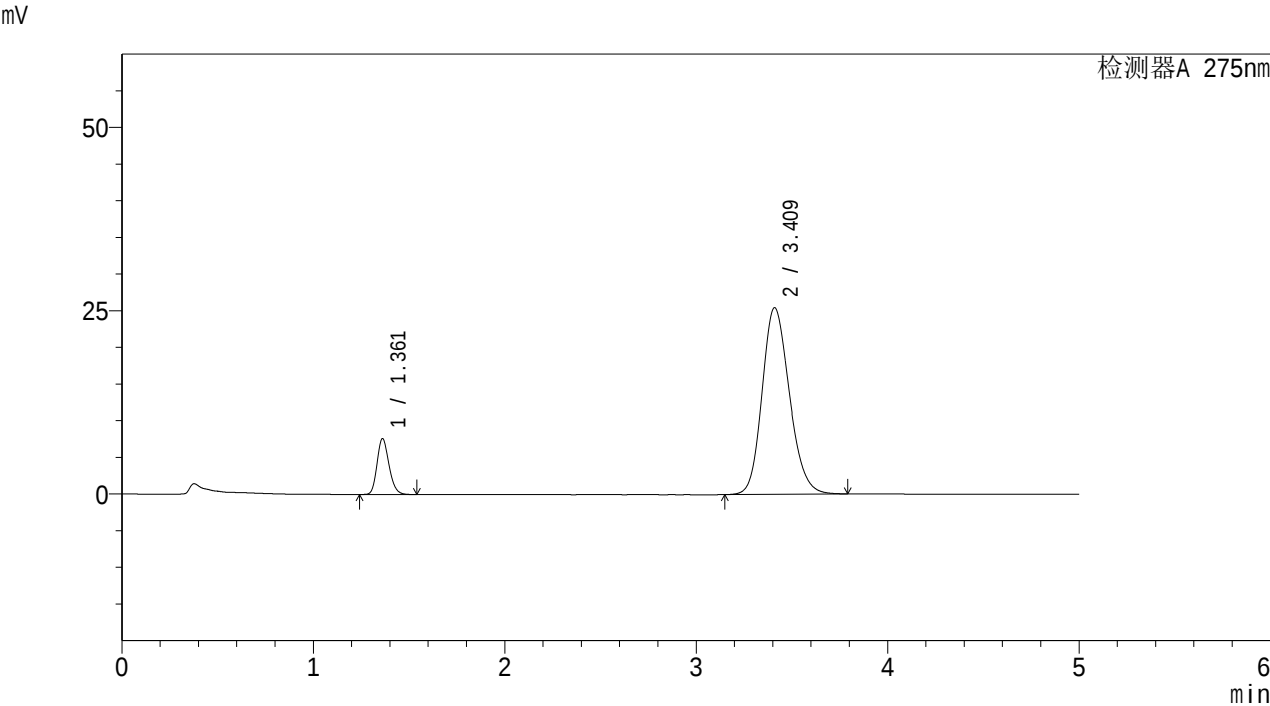

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	33011	11.550	7599	2296	1.194	--
2	3.409	252800	88.450	25416	2756	1.181	10.969
总计		285810	100.000	33016			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-486-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:10:05
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

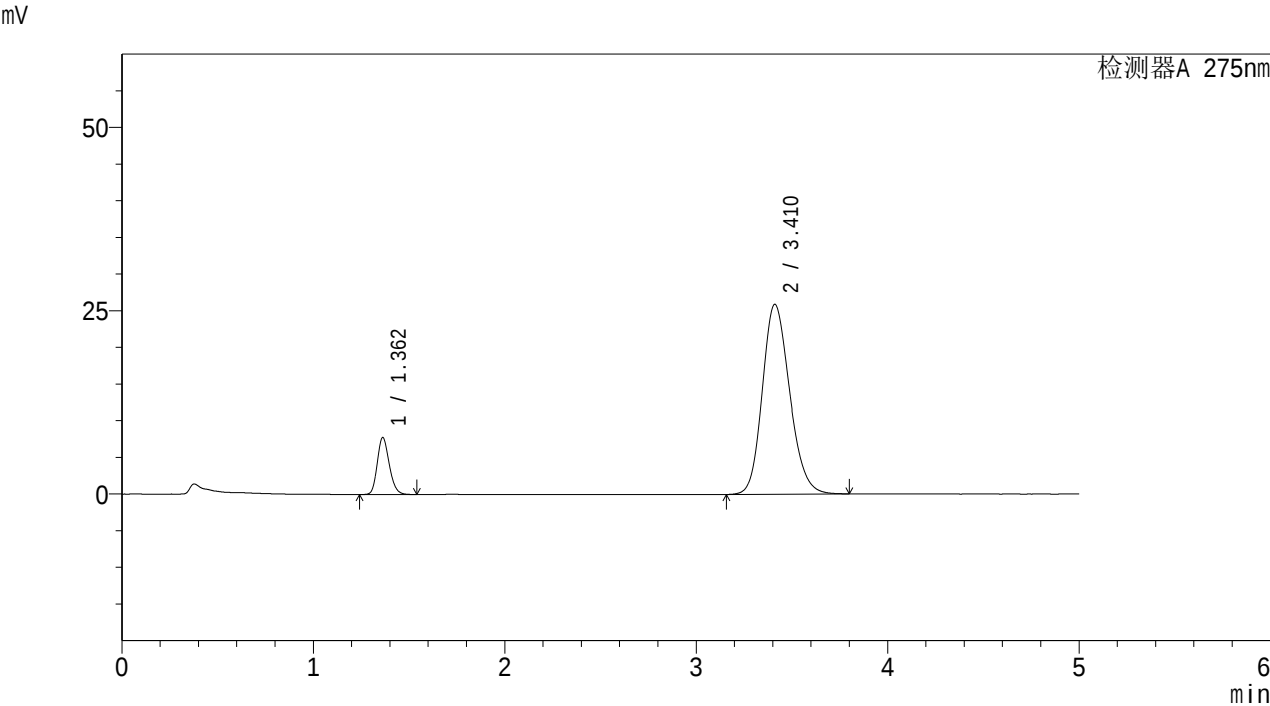

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33705	11.574	7771	2294	1.193	--
2	3.410	257502	88.426	25883	2753	1.182	10.957
总计		291207	100.000	33654			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-487-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:15:27
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

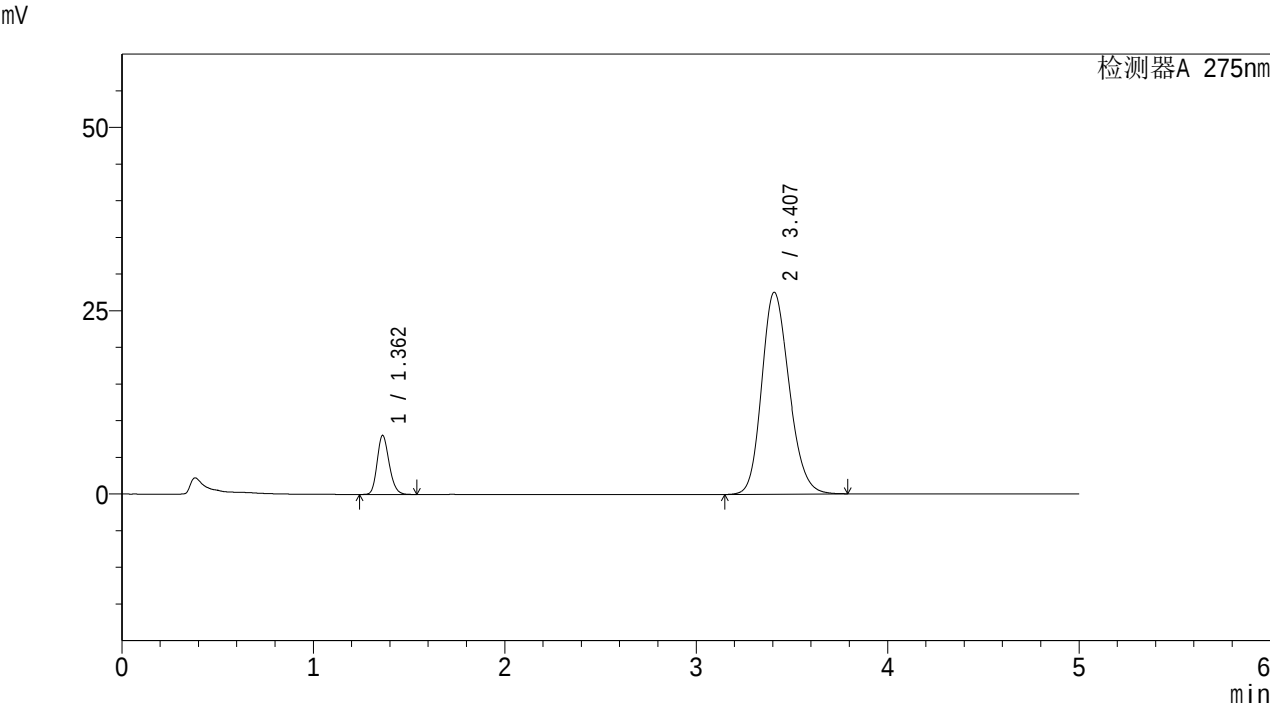

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34977	11.301	8046	2285	1.193	--
2	3.407	274511	88.699	27544	2733	1.186	10.918
总计		309487	100.000	35590			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-488-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:20:49
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

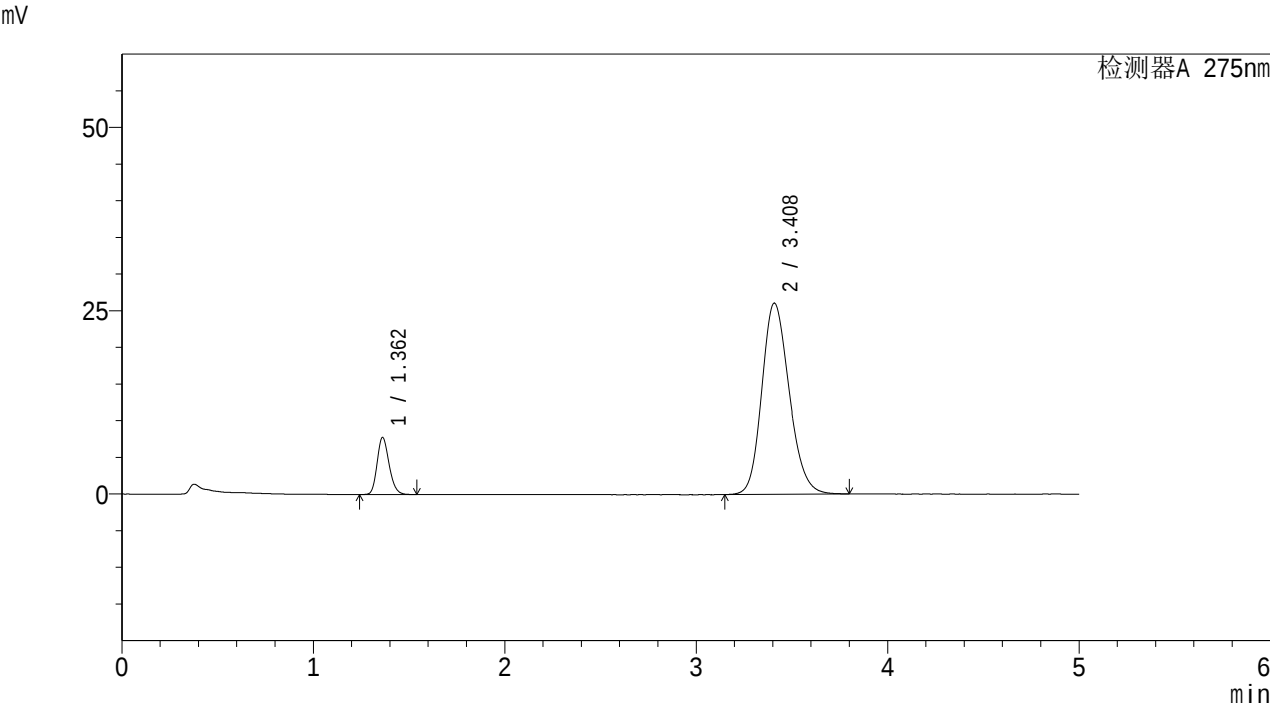

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33846	11.533	7784	2287	1.193	--
2	3.408	259629	88.467	26067	2739	1.183	10.931
总计		293475	100.000	33851			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-489-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:26:11

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

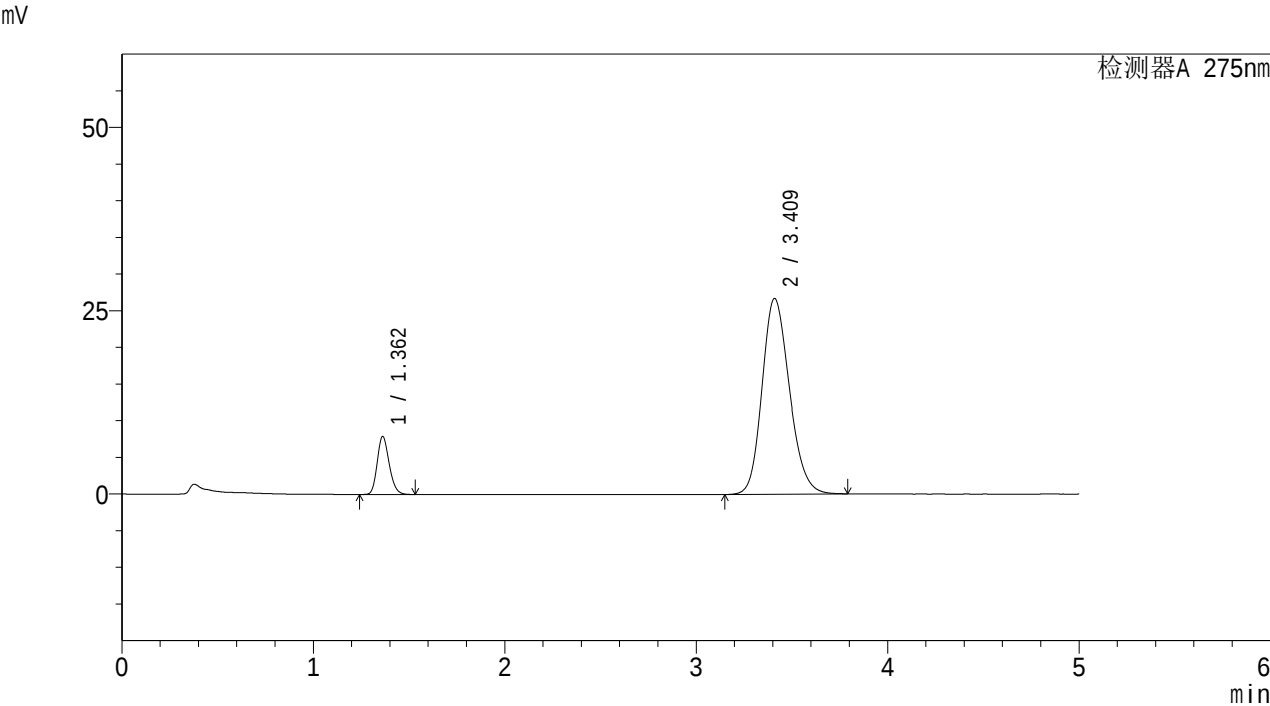

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34300	11.433	7911	2292	1.192	--
2	3.409	265700	88.567	26666	2744	1.184	10.942
总计		300000	100.000	34577			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-490-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:31:32
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

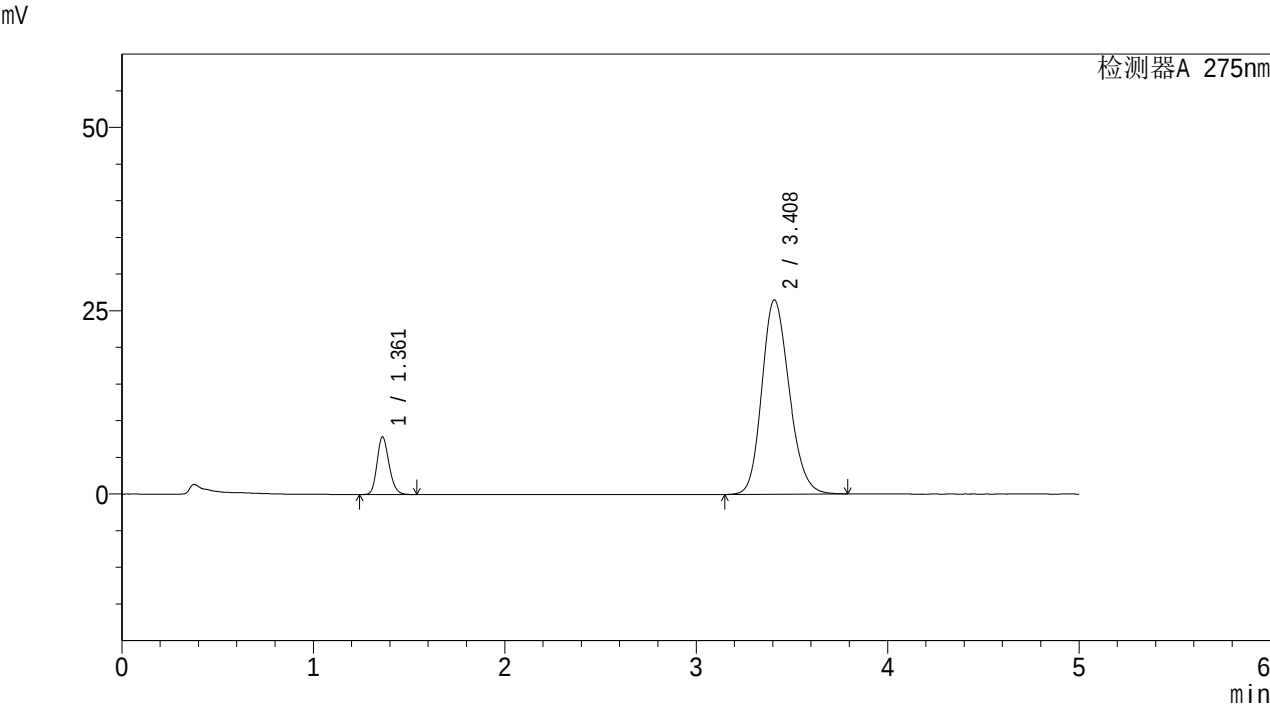

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	34142	11.457	7849	2289	1.193	--
2	3.408	263846	88.543	26500	2740	1.184	10.938
总计		297987	100.000	34349			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-491-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:36:55
处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

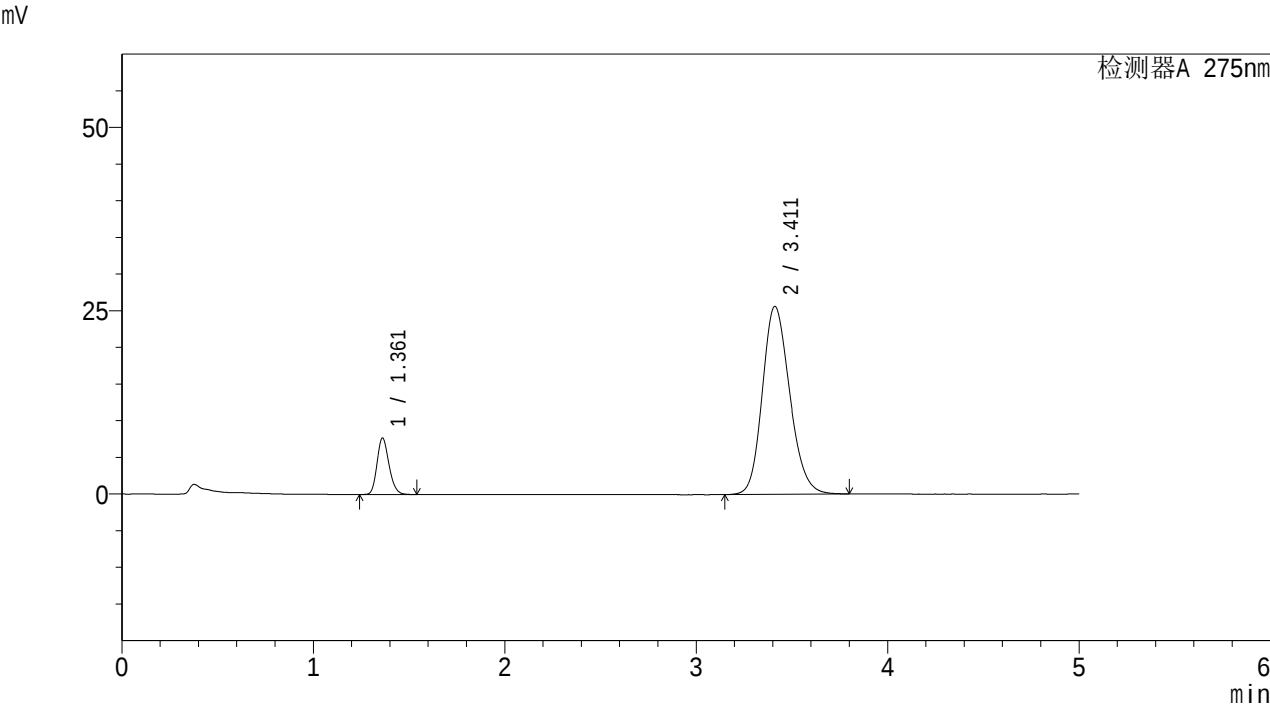

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	33406	11.581	7688	2294	1.195	--
2	3.411	255038	88.419	25617	2748	1.182	10.962
总计		288444	100.000	33305			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-492-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:42:17

处理时间(V2): 2026/05/12 11:59:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

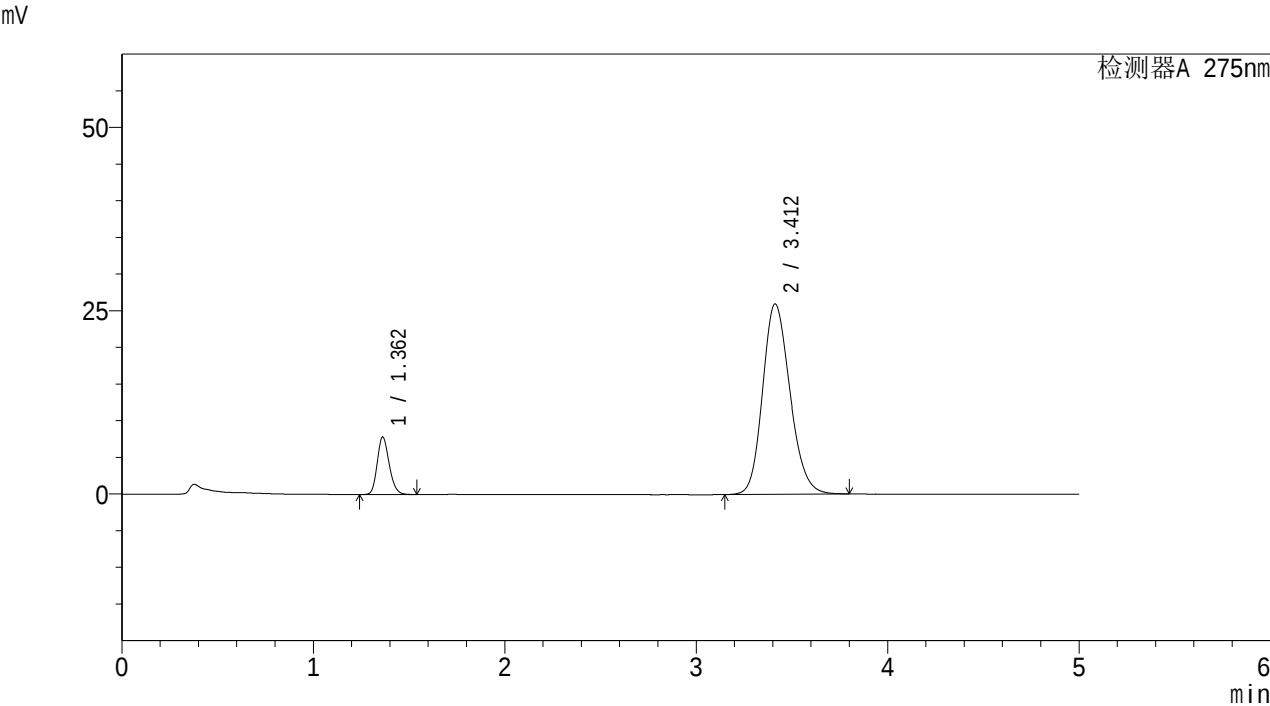

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34025	11.638	7840	2291	1.192	--
2	3.412	258339	88.362	25972	2750	1.181	10.959
总计		292364	100.000	33812			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-493-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:47:38
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

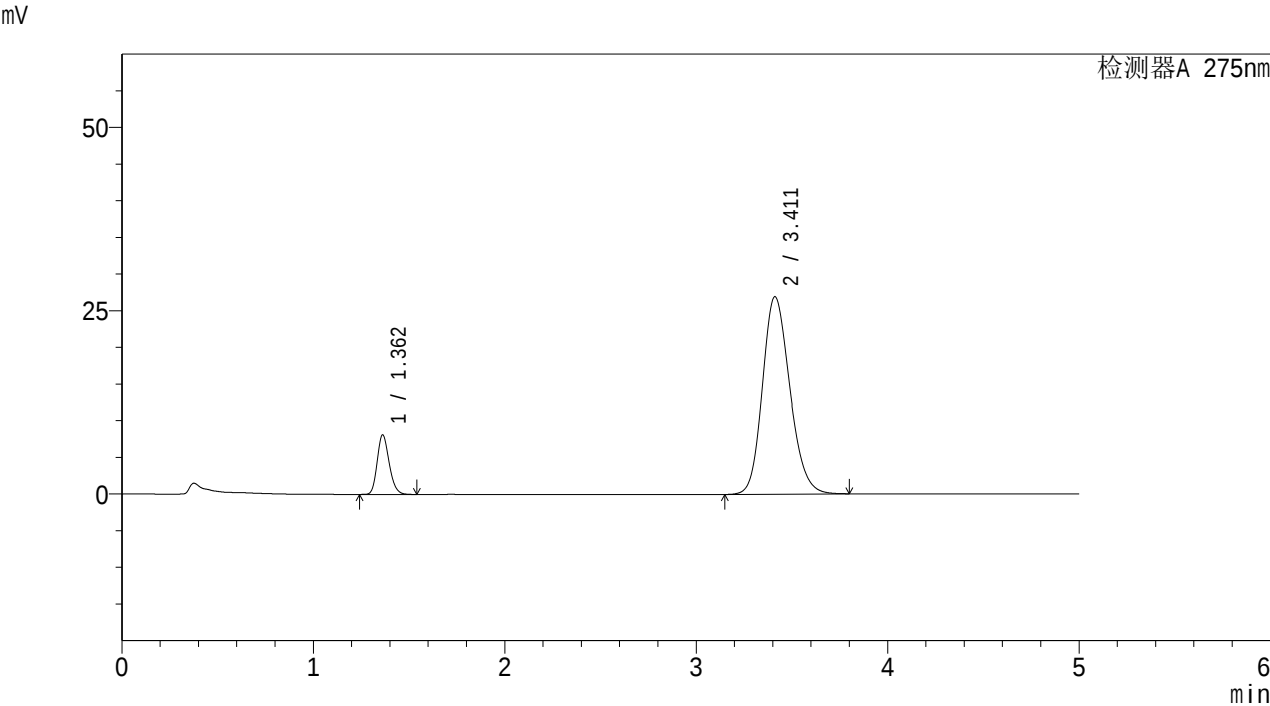

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35249	11.611	8119	2289	1.194	--
2	3.411	268323	88.389	26931	2741	1.185	10.942
总计		303571	100.000	35050			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-494-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:53:01

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

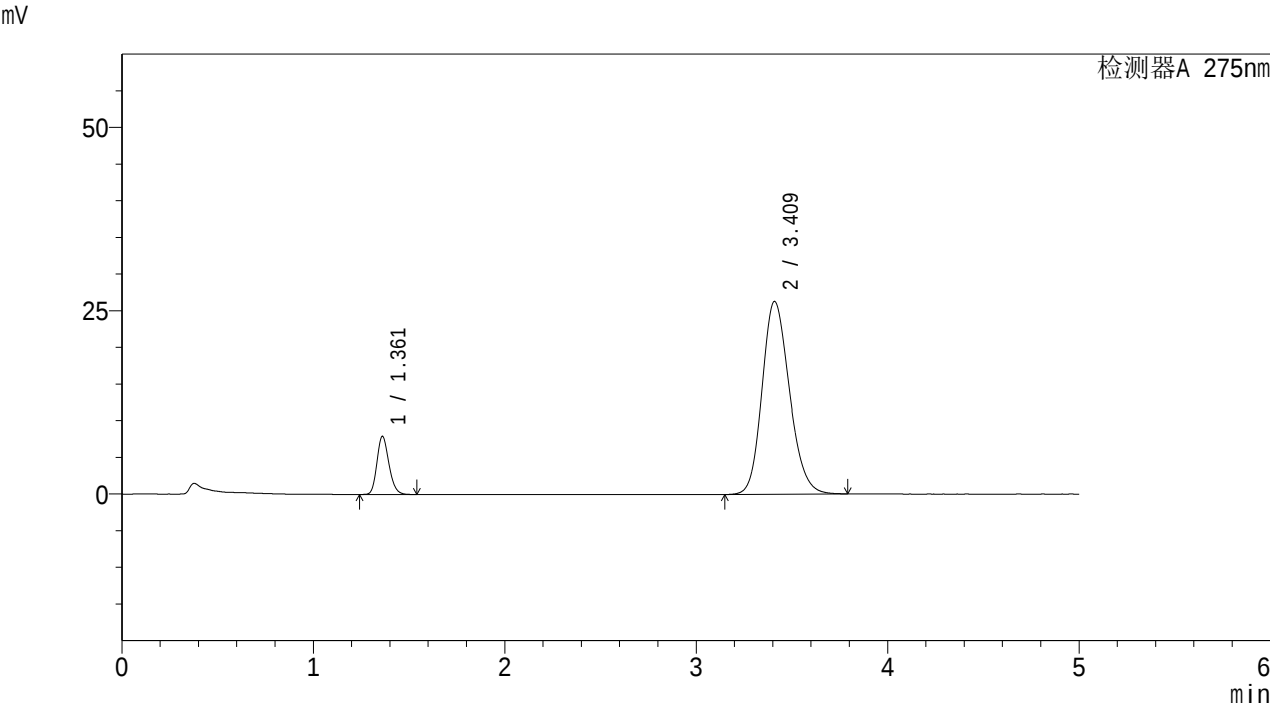

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	34384	11.624	7894	2289	1.194	--
2	3.409	261427	88.376	26263	2748	1.184	10.957
总计		295811	100.000	34157			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-495-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:58:23

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

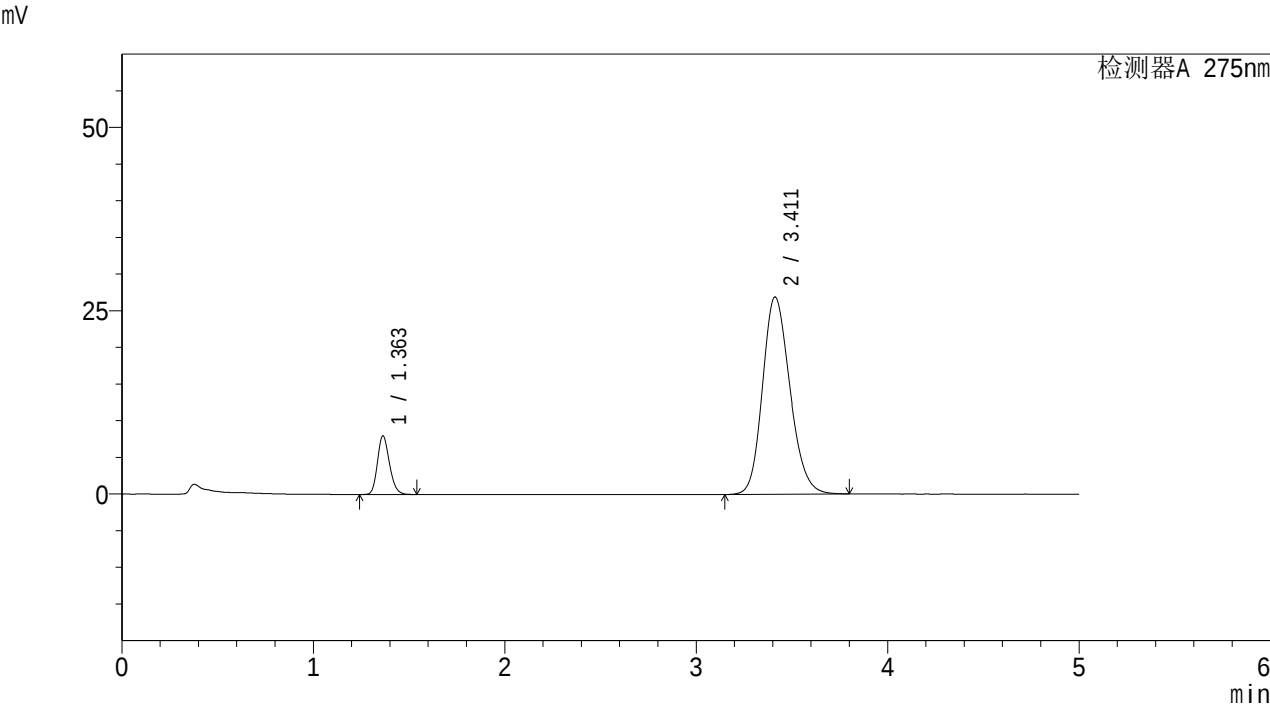

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34737	11.464	8007	2288	1.193	--
2	3.411	268262	88.536	26902	2735	1.185	10.926
总计		302999	100.000	34909			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-496-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:03:45
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>
mV

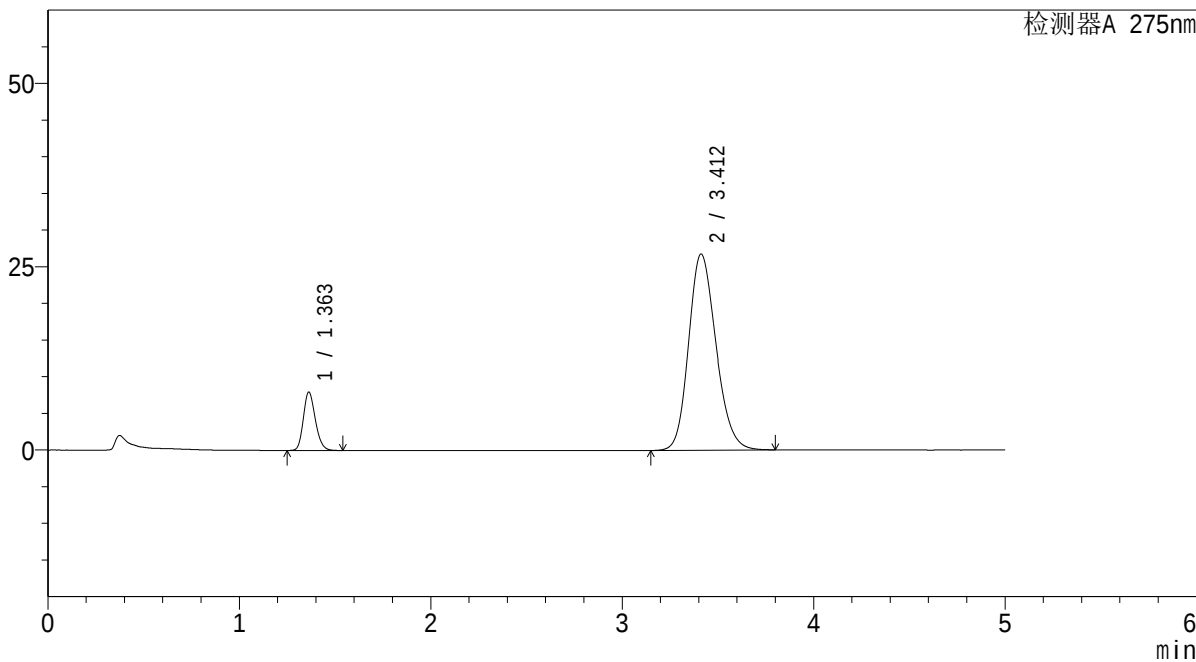

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34604	11.493	7975	2290	1.193	--
2	3.412	266483	88.507	26764	2742	1.185	10.941
总计		301087	100.000	34738			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-497-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:09:07
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

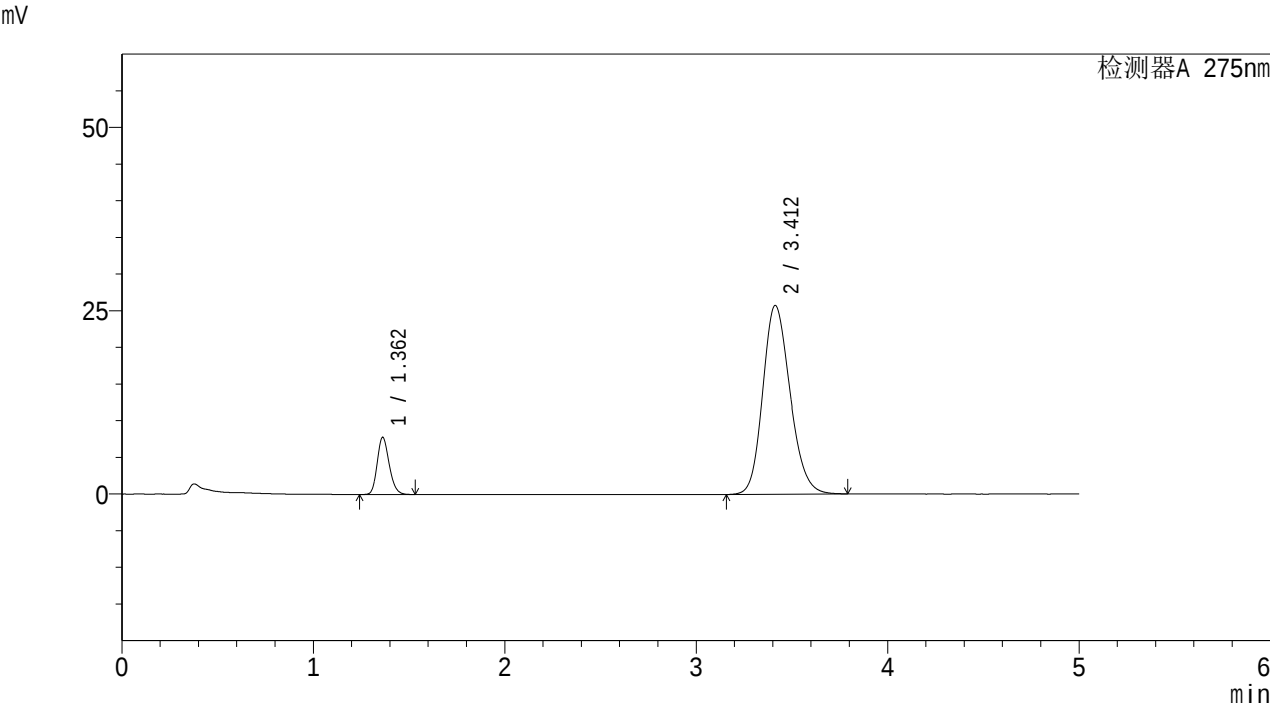

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33789	11.672	7796	2290	1.193	--
2	3.412	255690	88.328	25759	2759	1.183	10.973
总计		289479	100.000	33555			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-498-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:14:27
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

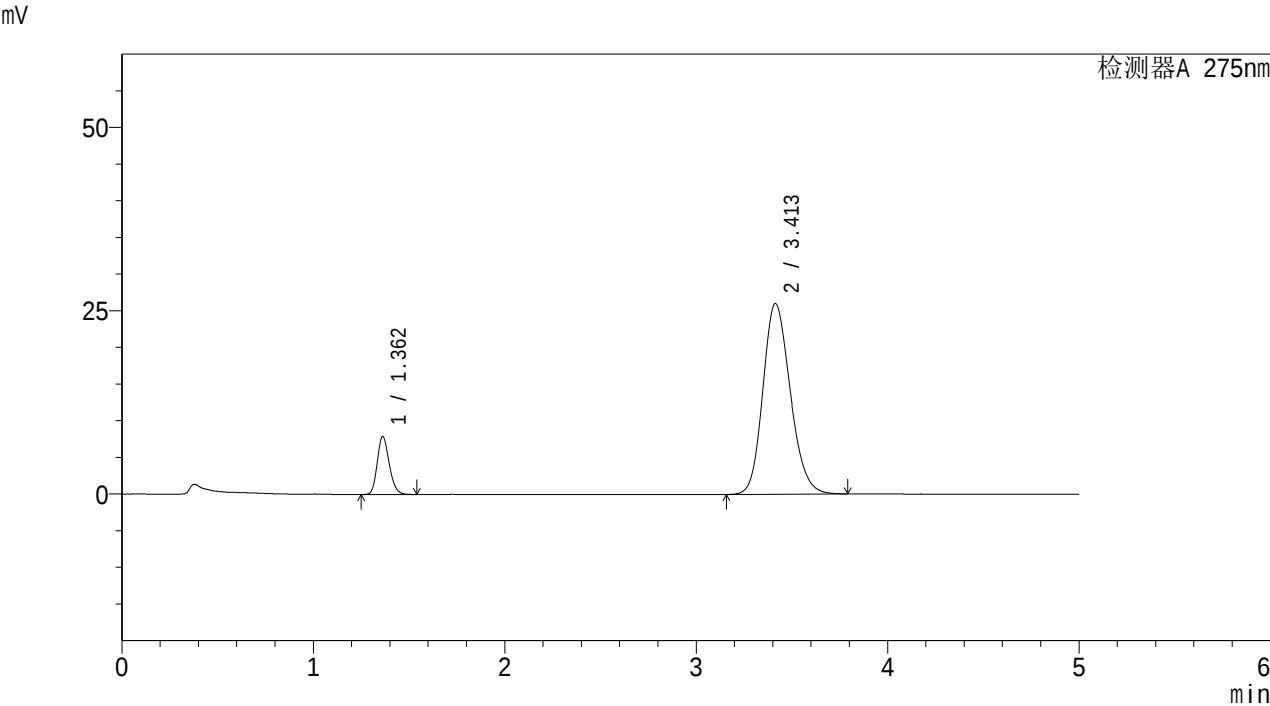

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34325	11.704	7919	2294	1.193	--
2	3.413	258943	88.296	26029	2745	1.183	10.956
总计		293268	100.000	33947			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-499-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:19:49
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

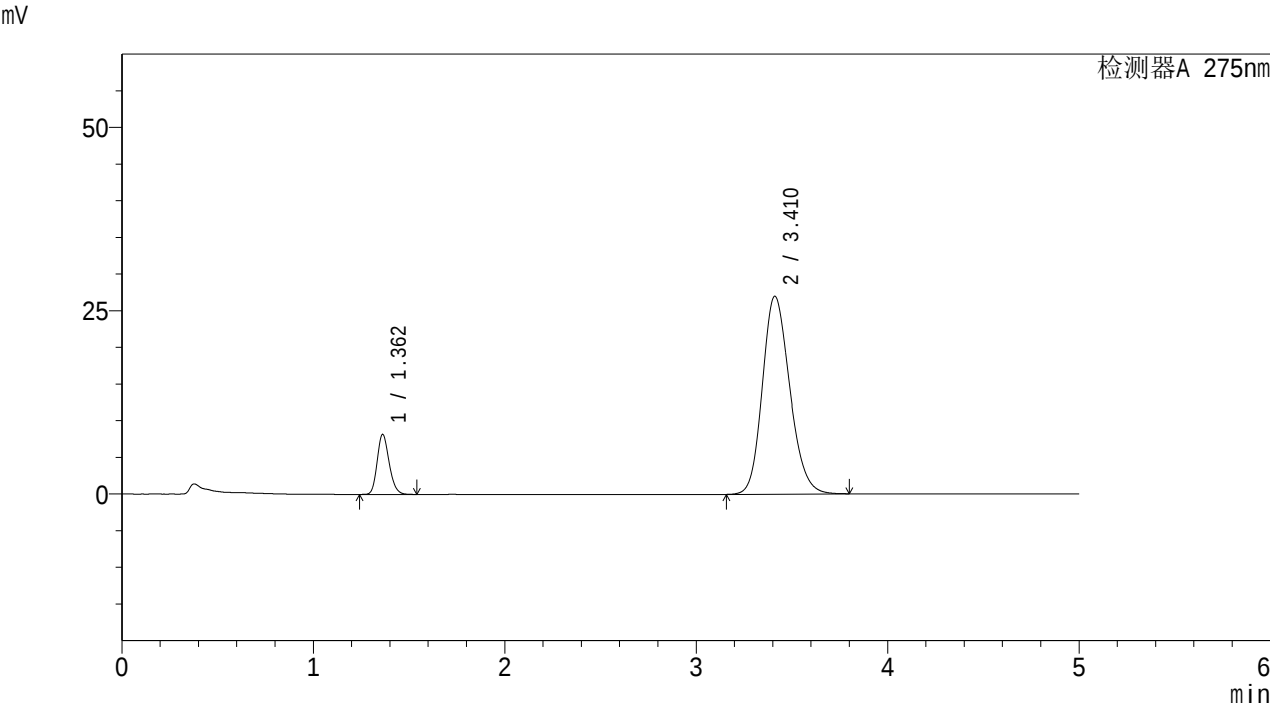

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35502	11.670	8182	2292	1.193	--
2	3.410	268721	88.330	26980	2741	1.187	10.944
总计		304222	100.000	35162			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-500-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:25:12

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

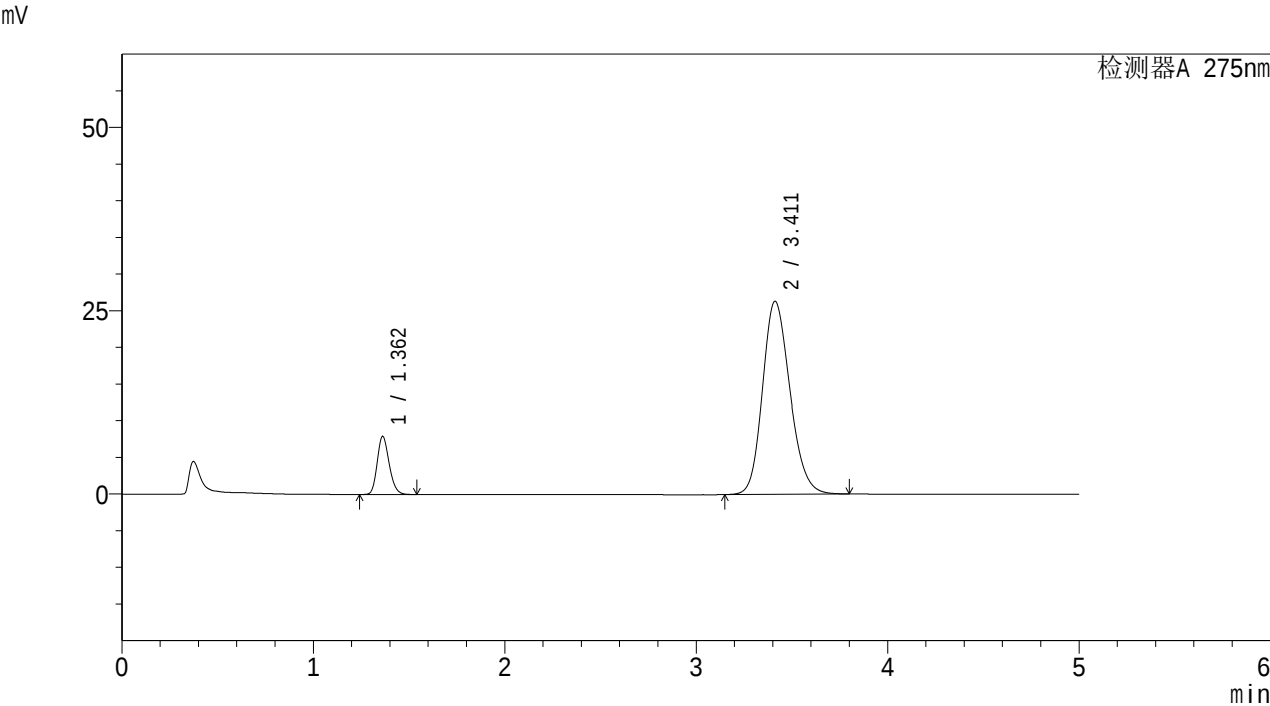

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34418	11.589	7930	2291	1.195	--
2	3.411	262563	88.411	26340	2737	1.184	10.940
总计		296981	100.000	34270			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-501-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:30:34
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

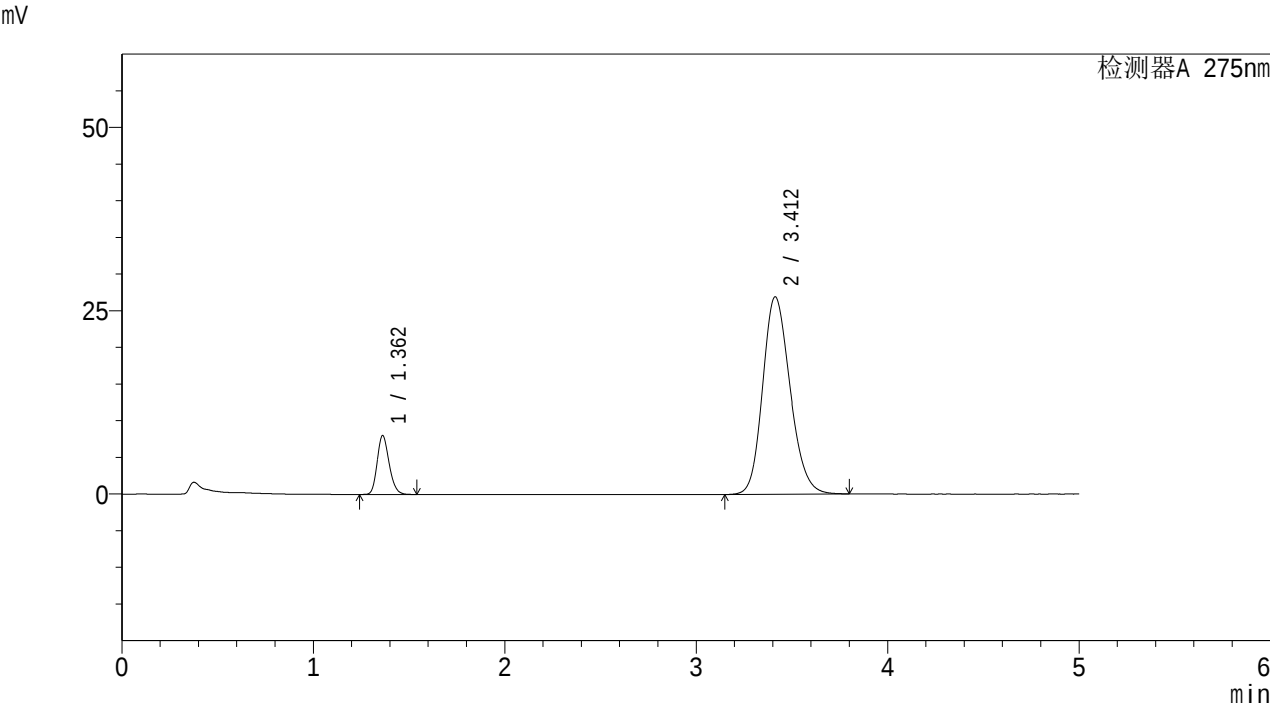

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34791	11.468	8018	2293	1.193	--
2	3.412	268579	88.532	26936	2735	1.186	10.942
总计		303369	100.000	34954			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-502-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:35:56
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

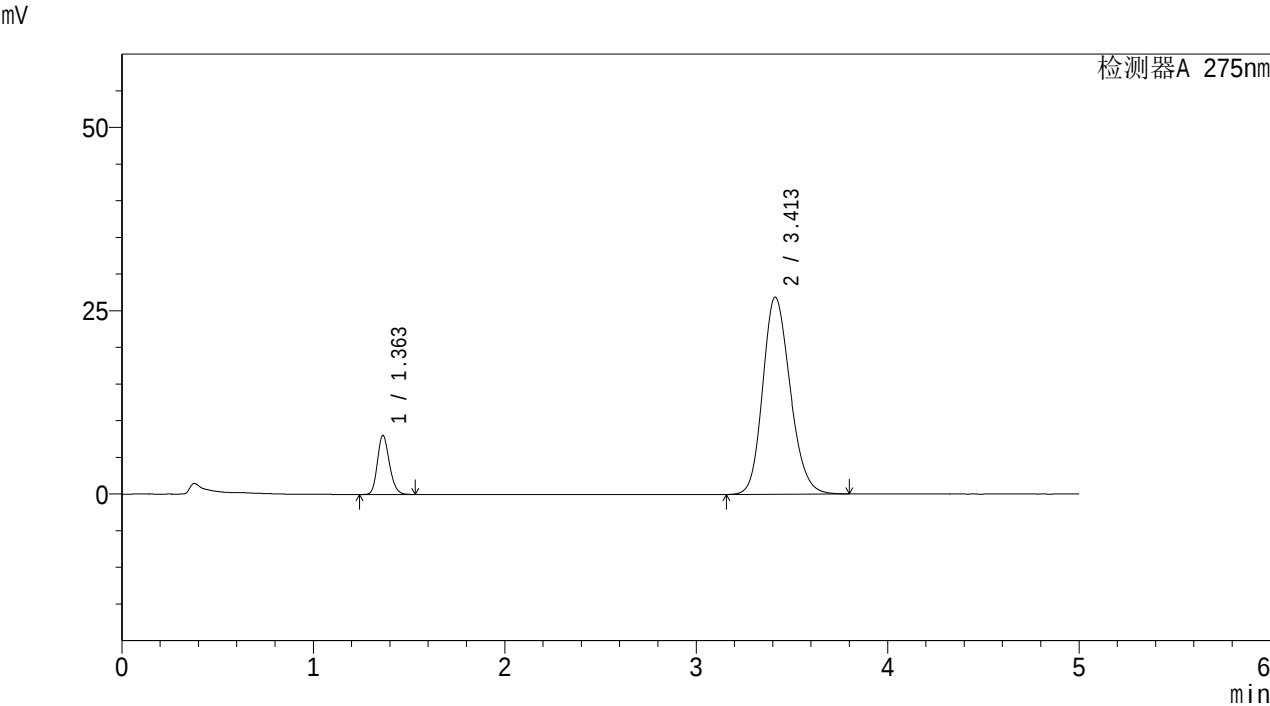

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34903	11.529	8059	2295	1.193	--
2	3.413	267846	88.471	26905	2743	1.185	10.945
总计		302749	100.000	34964			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-503-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:41:18
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

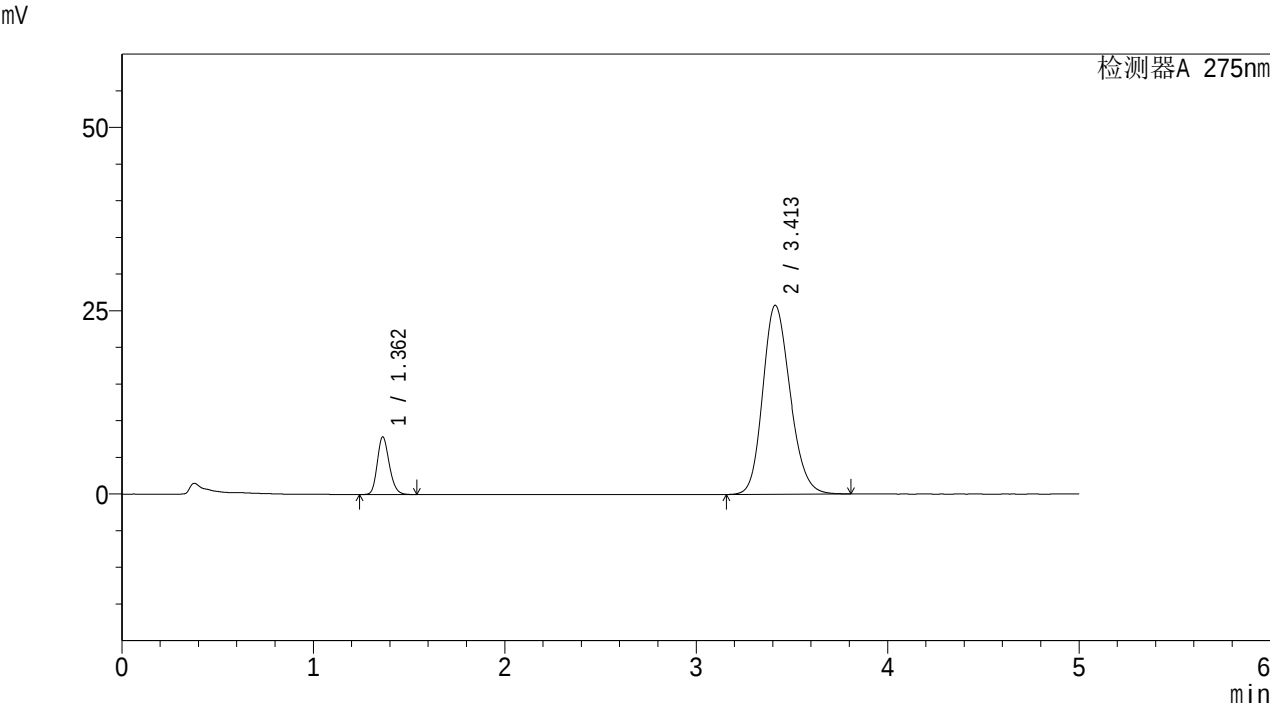

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34105	11.742	7862	2293	1.192	--
2	3.413	256340	88.258	25788	2754	1.184	10.966
总计		290445	100.000	33650			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-504-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:46:40
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

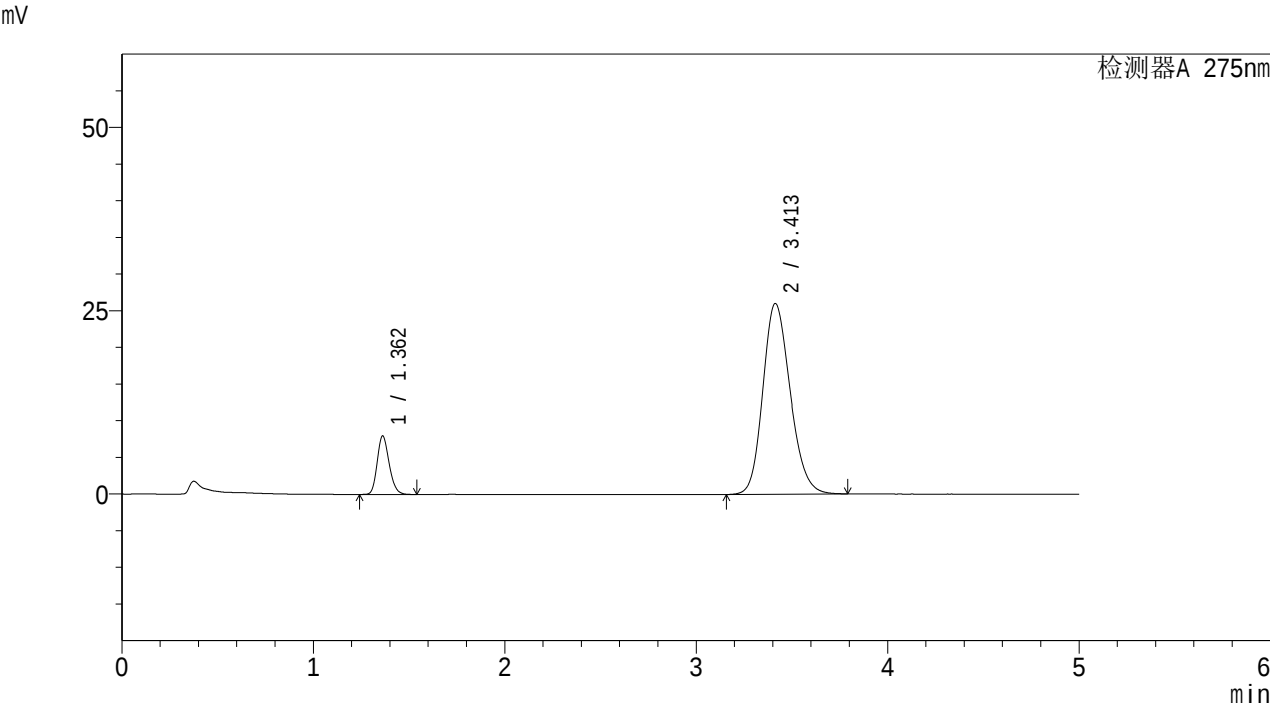

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34612	11.797	7978	2295	1.193	--
2	3.413	258777	88.203	26030	2751	1.183	10.968
总计		293389	100.000	34007			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-505-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:52:02

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

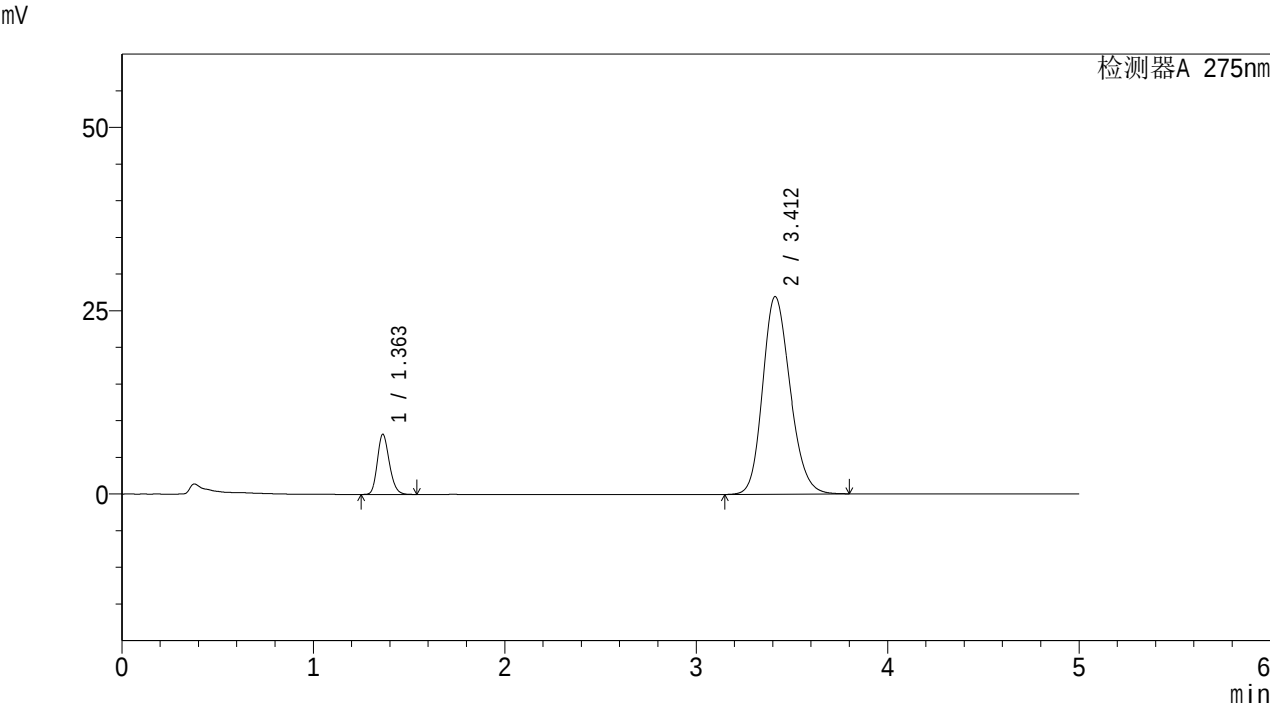

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35635	11.704	8215	2294	1.193	--
2	3.412	268843	88.296	26966	2735	1.186	10.935
总计		304478	100.000	35181			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-506-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:57:25
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

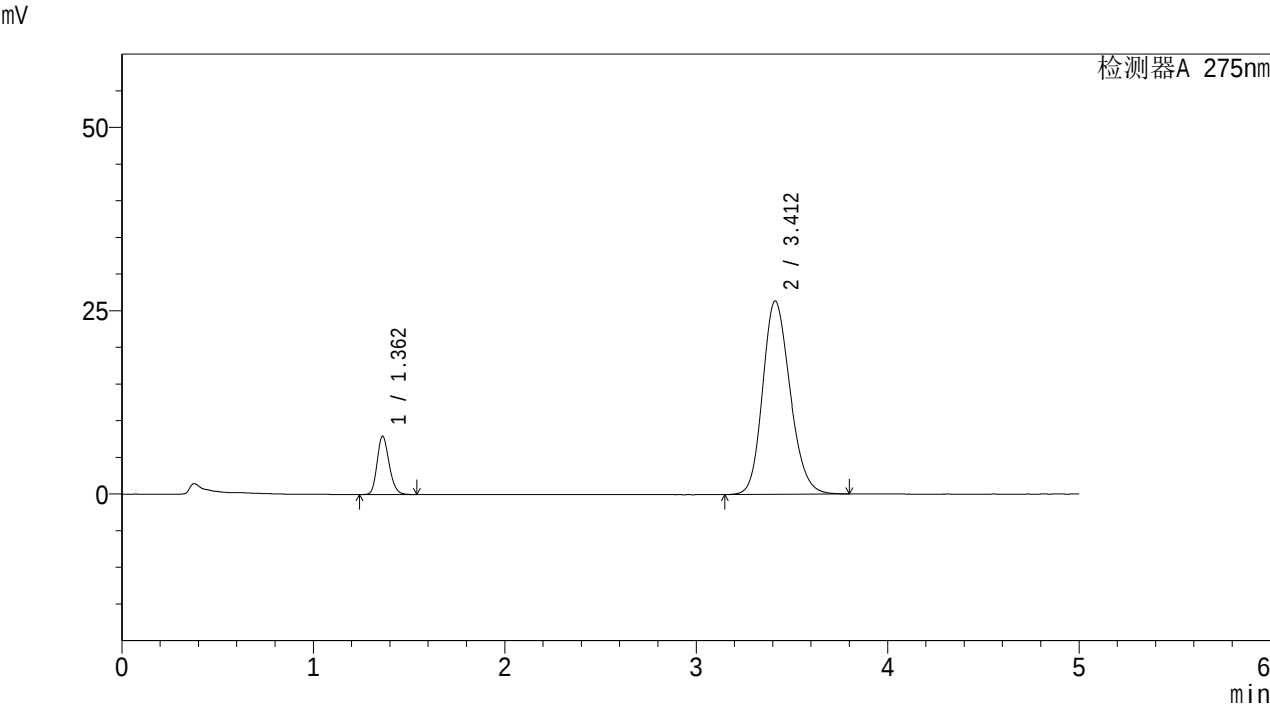

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34513	11.613	7948	2289	1.193	--
2	3.412	262694	88.387	26376	2740	1.184	10.947
总计		297207	100.000	34325			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-507-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 07:02:47
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

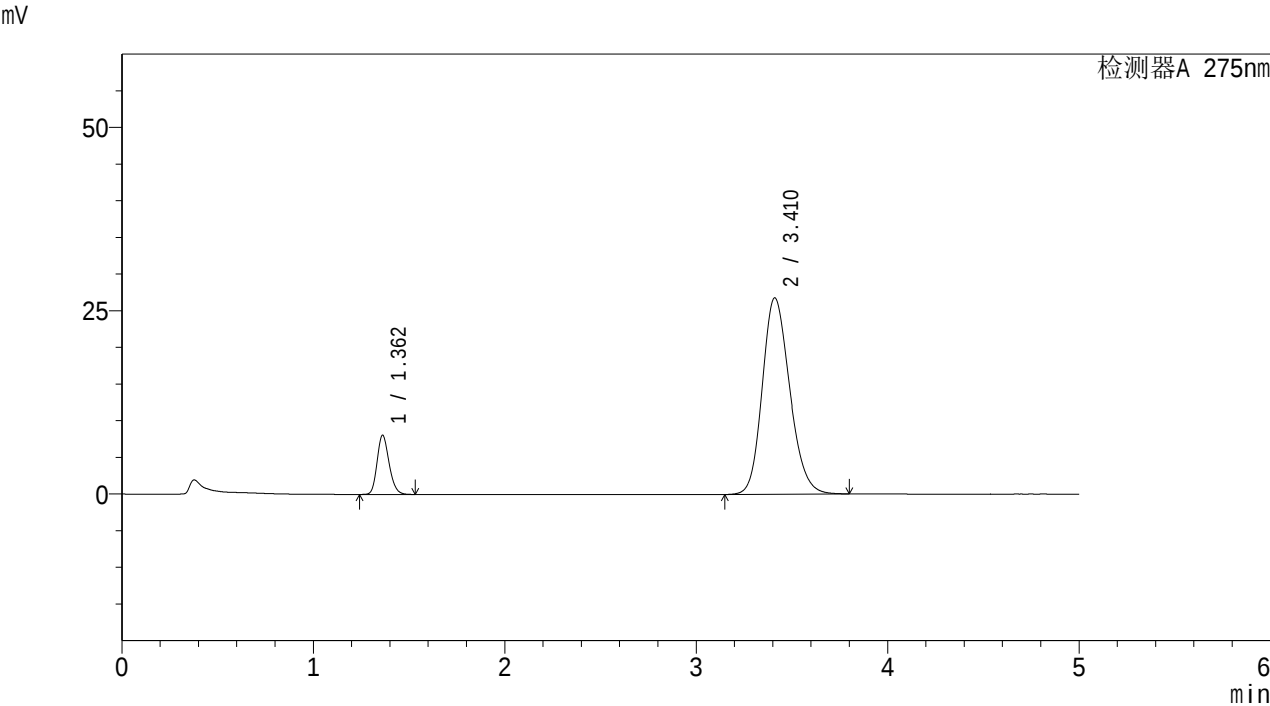

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35034	11.588	8059	2284	1.193	--
2	3.410	267303	88.412	26753	2728	1.188	10.921
总计		302337	100.000	34812			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-508-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:08:10

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

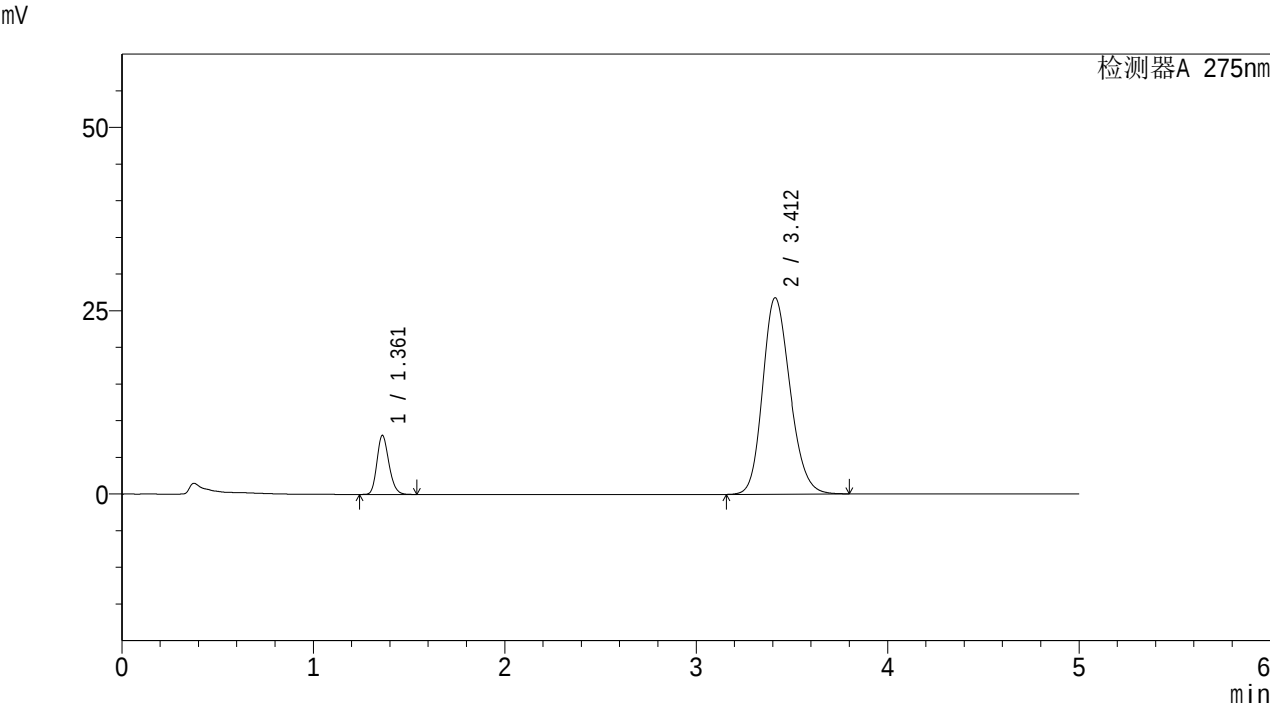

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.361	34909	11.571	8021	2289	1.195	--
2	3.412	266797	88.429	26800	2743	1.186	10.960
总计		301706	100.000	34821			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-509-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:13:32

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

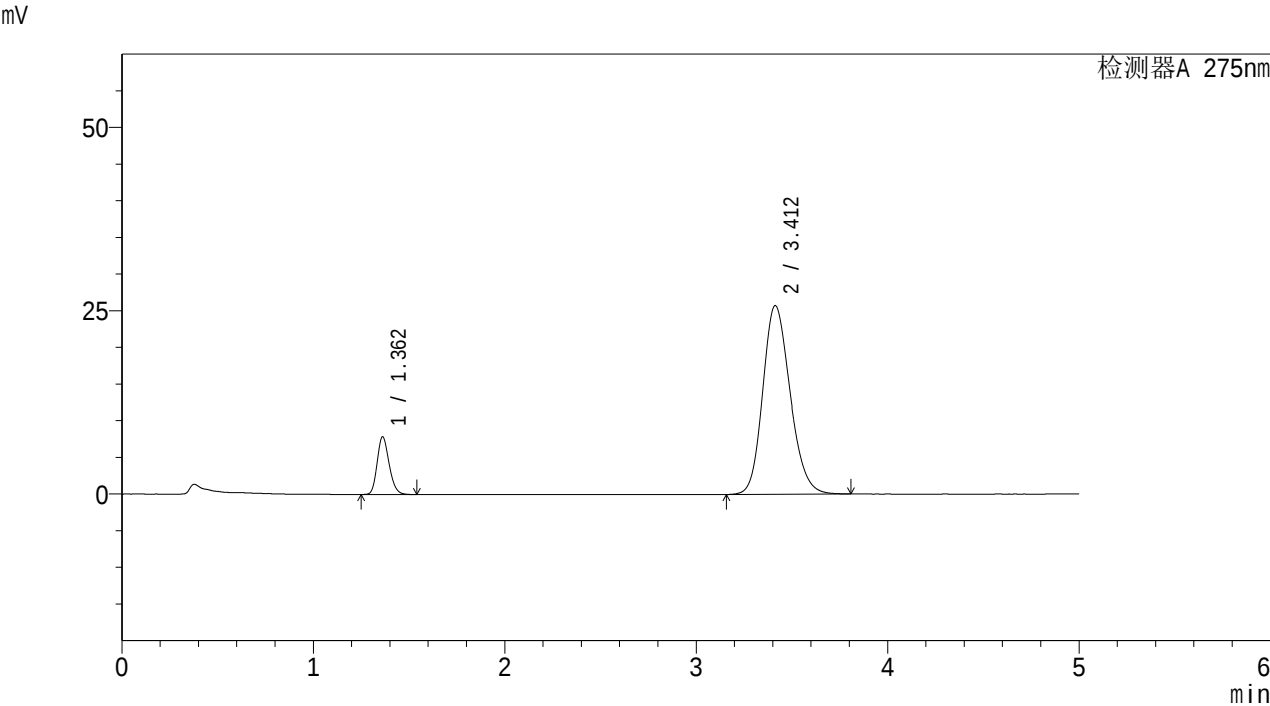

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34148	11.769	7868	2292	1.194	--
2	3.412	256000	88.231	25744	2749	1.184	10.963
总计		290148	100.000	33611			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-510-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 07:18:54
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

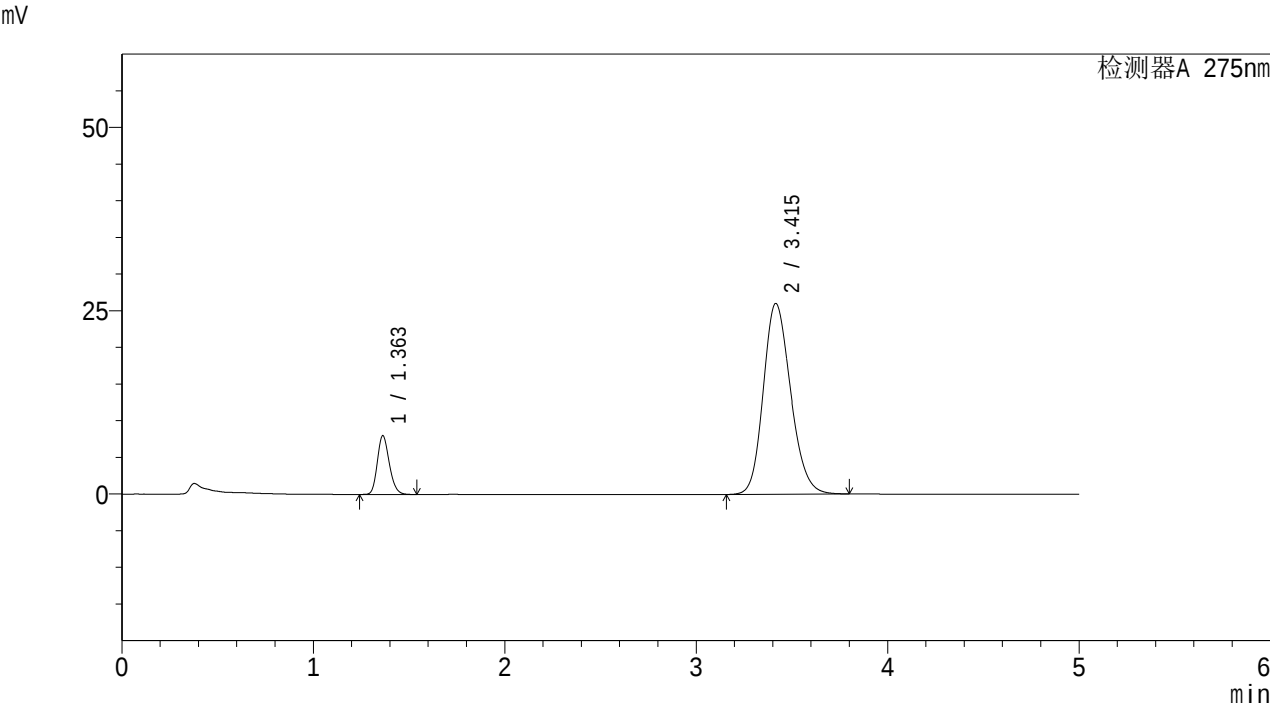

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34799	11.853	8017	2290	1.194	--
2	3.415	258784	88.147	26027	2754	1.184	10.969
总计		293583	100.000	34044			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-511-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:24:18

处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

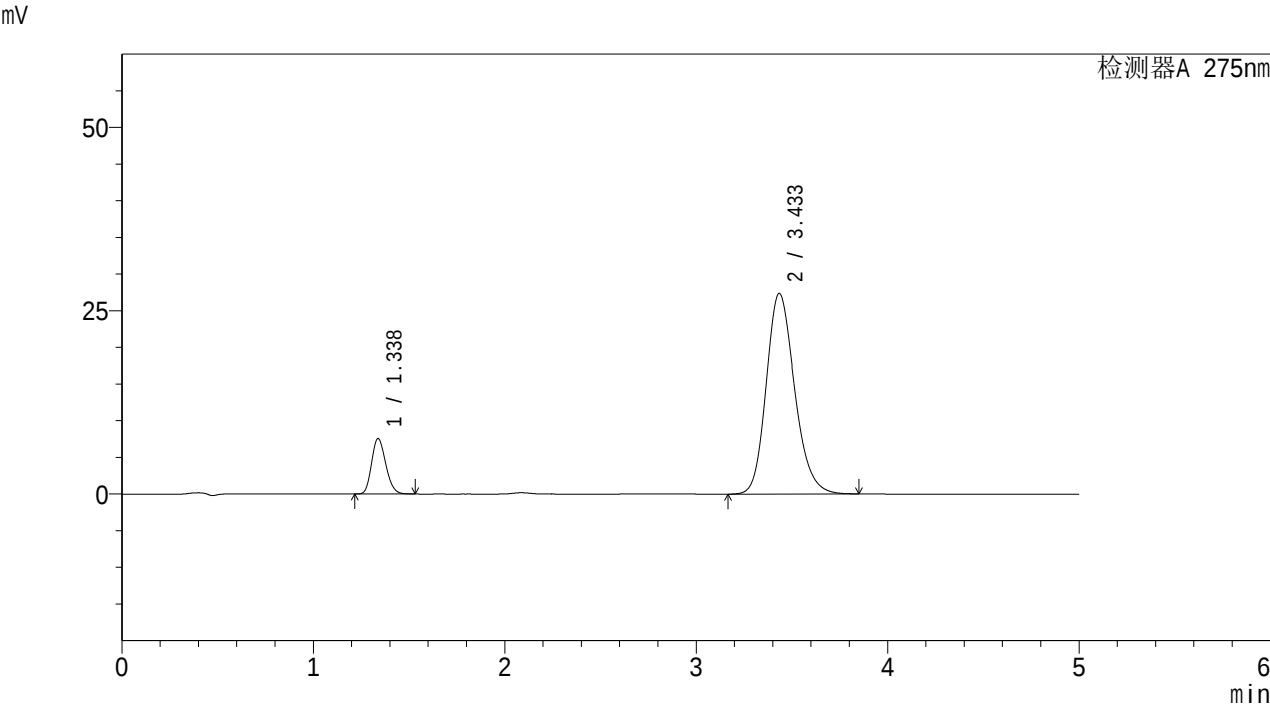

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	38856	12.080	7573	1559	1.186	--
2	3.433	282813	87.920	27348	2616	1.197	10.371
总计		321669	100.000	34921			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-12/27-512-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 07:29:40
处理时间(V2): 2026/05/12 12:00:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

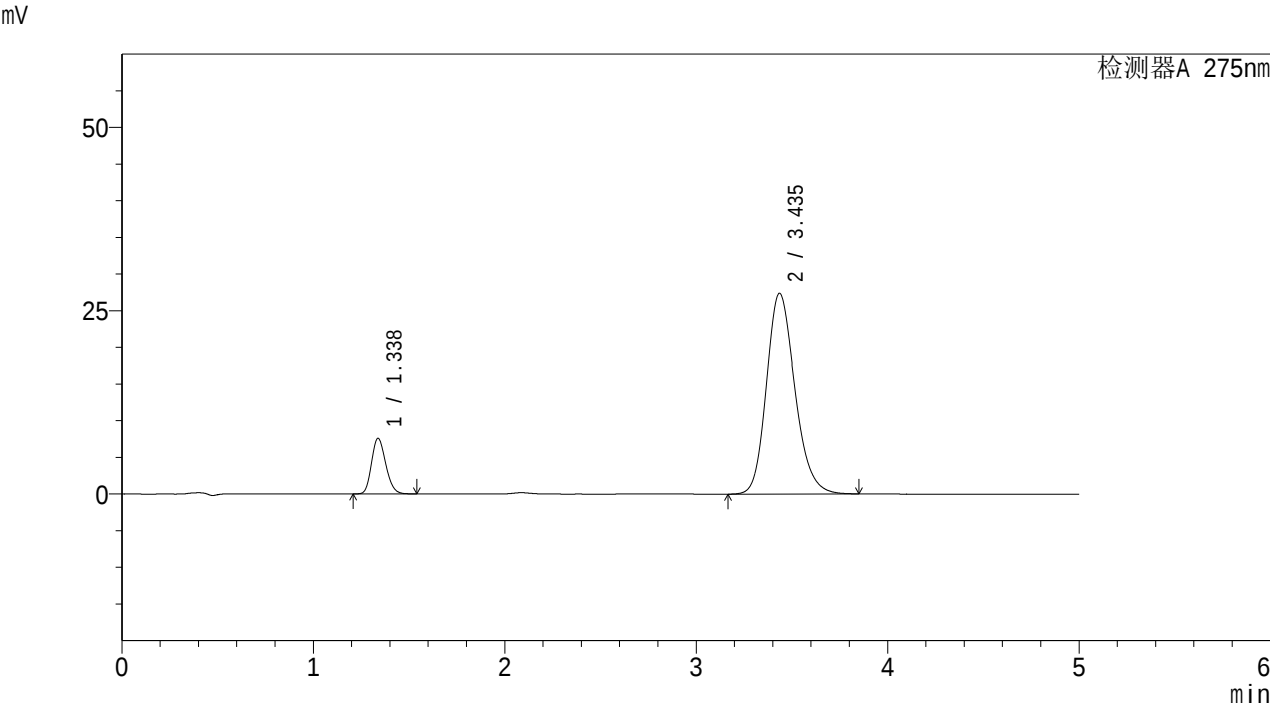

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	39001	12.109	7585	1553	1.188	--
2	3.435	283086	87.891	27352	2614	1.197	10.367
总计		322087	100.000	34937			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2