



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	35438	35472	35408	35440	35483	35448	0.09
2	10.99	36485	36437				36461	0.10

单位质量响应值		RSD%	判断
3252.11	3317.65	1.42	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	7425	-	7425	20.282	17.89	10.08	20.28	17.88	10.08
	2	6554	-	6554	17.903			17.90		
	3	6379	-	6379	17.425			17.42		
	4	5429	-	5429	14.830			14.83		
	5	6902	-	6902	18.854			18.85		
	6	6602	-	6602	18.034			18.03		
10min	1	13645	-	13645	37.273	35.91	3.19	37.31	35.94	3.20
	2	13010	-	13010	35.538			35.57		
	3	13076	-	13076	35.718			35.75		
	4	12537	-	12537	34.246			34.27		
	5	12996	-	12996	35.500			35.53		
	6	13606	-	13606	37.166			37.20		
15min	1	16755	-	16755	45.768	44.83	2.32	45.86	44.92	2.32
	2	16249	-	16249	44.386			44.47		
	3	16380	-	16380	44.744			44.83		
	4	15824	-	15824	43.225			43.31		
	5	16363	-	16363	44.697			44.79		
	6	16891	-	16891	46.140			46.23		
20min	1	19129	-	19129	52.253	50.73	2.85	52.43	50.89	2.85
	2	18347	-	18347	50.117			50.28		
	3	18374	-	18374	50.190			50.35		
	4	18005	-	18005	49.183			49.34		
	5	18242	-	18242	49.830			49.99		
	6	19324	-	19324	52.786			52.95		
30min	1	21471	-	21471	58.650	57.91	2.12	58.91	58.16	2.13
	2	20983	-	20983	57.317			57.56		
	3	21165	-	21165	57.814			58.06		
	4	20670	-	20670	56.462			56.70		
	5	20967	-	20967	57.274			57.52		
	6	21943	-	21943	59.940			60.20		
45min	1	23999	-	23999	65.556	64.90	1.99	65.91	65.25	1.99
	2	23399	-	23399	63.917			64.26		
	3	23764	-	23764	64.914			65.26		
	4	23318	-	23318	63.696			64.03		
	5	23507	-	23507	64.212			64.56		
	6	24573	-	24573	67.124			67.48		
60min	1	25581	-	25581	69.877	69.46	1.80	70.34	69.92	1.80
	2	25220	-	25220	68.891			69.34		
	3	25493	-	25493	69.637			70.09		
	4	24991	-	24991	68.266			68.70		
	5	25059	-	25059	68.451			68.90		
	6	26231	-	26231	71.653			72.12		
90min	1	27706	-	27706	75.682	75.12	2.04	76.26	75.69	2.04
	2	27259	-	27259	74.461			75.02		
	3	27453	-	27453	74.991			75.56		
	4	27221	-	27221	74.357			74.91		
	5	26870	-	26870	73.398			73.96		
	6	28494	-	28494	77.834			78.42		
120min	1	29134	-	29134	79.583	78.92	2.12	80.29	79.62	2.12
	2	28512	-	28512	77.883			78.57		
	3	29256	-	29256	79.916			80.61		
	4	28463	-	28463	77.750			78.42		
	5	28180	-	28180	76.977			77.66		
	6	29809	-	29809	81.426			82.14		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	29429	-	29429	80.388	79.72	1.93	81.23	80.55	1.93
	2	28922	-	28922	79.003			79.82		
	3	29344	-	29344	80.156			80.98		
	4	28819	-	28819	78.722			79.53		
	5	28501	-	28501	77.853			78.67		
	6	30096	-	30096	82.210			83.06		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	265748	265812	265850	266758	266380	266110	0.17
2	11.10	275839	275936				275888	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
24503.68	24854.77	1.01	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	38971	-	38971	14.198	12.82	8.88	14.20	12.82	8.86
	2	35393	-	35393	12.895			12.89		
	3	34656	-	34656	12.626			12.63		
	4	29548	-	29548	10.765			10.77		
	5	36178	-	36178	13.181			13.18		
	6	36316	-	36316	13.231			13.23		
10min	1	62382	-	62382	22.728	22.21	2.85	22.75	22.23	2.85
	2	60957	-	60957	22.209			22.23		
	3	61233	-	61233	22.309			22.33		
	4	58484	-	58484	21.308			21.33		
	5	59539	-	59539	21.692			21.71		
	6	63142	-	63142	23.005			23.03		
15min	1	72607	-	72607	26.453	26.85	5.77	26.51	26.91	5.76
	2	81775	-	81775	29.793			29.85		
	3	72597	-	72597	26.449			26.51		
	4	70526	-	70526	25.695			25.75		
	5	70239	-	70239	25.590			25.65		
	6	74427	-	74427	27.116			27.18		
20min	1	78444	-	78444	28.580	28.52	1.68	28.69	28.62	1.69
	2	78138	-	78138	28.468			28.58		
	3	77943	-	77943	28.397			28.50		
	4	77336	-	77336	28.176			28.27		
	5	77079	-	77079	28.082			28.18		
	6	80752	-	80752	29.421			29.53		
30min	1	85418	-	85418	31.121	31.33	1.37	31.27	31.48	1.37
	2	85862	-	85862	31.282			31.44		
	3	86607	-	86607	31.554			31.70		
	4	84973	-	84973	30.958			31.10		
	5	85040	-	85040	30.983			31.13		
	6	88038	-	88038	32.075			32.23		
45min	1	91623	-	91623	33.381	33.75	1.76	33.59	33.95	1.75
	2	91385	-	91385	33.295			33.50		
	3	92491	-	92491	33.698			33.90		
	4	91074	-	91074	33.181			33.38		
	5	94131	-	94131	34.295			34.49		
	6	95078	-	95078	34.640			34.85		
60min	1	94566	-	94566	34.454	34.98	1.29	34.71	35.24	1.29
	2	96120	-	96120	35.020			35.28		
	3	96770	-	96770	35.256			35.51		
	4	95078	-	95078	34.640			34.89		
	5	95525	-	95525	34.803			35.06		
	6	97962	-	97962	35.691			35.96		
90min	1	98786	-	98786	35.991	36.37	1.42	36.31	36.68	1.42
	2	98961	-	98961	36.055			36.38		
	3	100563	-	100563	36.638			36.96		
	4	99815	-	99815	36.366			36.67		
	5	98509	-	98509	35.890			36.20		
	6	102248	-	102248	37.252			37.58		
120min	1	102060	-	102060	37.184	37.25	0.82	37.56	37.62	0.83
	2	102431	-	102431	37.319			37.70		
	3	102301	-	102301	37.272			37.65		
	4	101504	-	101504	36.981			37.35		
	5	101399	-	101399	36.943			37.32		
	6	103710	-	103710	37.785			38.17		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	102232	-	102232	37.246	37.45	0.60	37.69	37.89	0.60
	2	103239	-	103239	37.613			38.06		
	3	103525	-	103525	37.718			38.16		
	4	102447	-	102447	37.325			37.75		
	5	102052	-	102052	37.181			37.62		
	6	103178	-	103178	37.591			38.04		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	36261	36355	36467	36444	36439	36393	0.24
2	10.99	37334	37315				37324	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
3338.81		3396.18		1.21	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	5630	-	5630	15.001	15.67	6.98	15.00	15.67	6.99
	2	5432	-	5432	14.474			14.47		
	3	5580	-	5580	14.868			14.87		
	4	6469	-	6469	17.237			17.24		
	5	5913	-	5913	15.755			15.76		
	6	6253	-	6253	16.661			16.66		
10min	1	12366	-	12366	32.949	33.01	1.06	32.97	33.04	1.07
	2	12235	-	12235	32.600			32.62		
	3	12276	-	12276	32.710			32.73		
	4	12603	-	12603	33.581			33.61		
	5	12429	-	12429	33.117			33.14		
	6	12431	-	12431	33.123			33.15		
15min	1	15687	-	15687	41.798	41.88	0.49	41.88	41.96	0.49
	2	15649	-	15649	41.697			41.78		
	3	15675	-	15675	41.766			41.85		
	4	15664	-	15664	41.737			41.82		
	5	15832	-	15832	42.185			42.27		
	6	15790	-	15790	42.073			42.16		
20min	1	17783	-	17783	47.383	47.56	0.65	47.53	47.71	0.64
	2	17844	-	17844	47.546			47.69		
	3	17869	-	17869	47.612			47.76		
	4	17765	-	17765	47.335			47.49		
	5	18067	-	18067	48.140			48.29		
	6	17769	-	17769	47.346			47.50		
30min	1	20600	-	20600	54.889	55.08	1.44	55.12	55.31	1.44
	2	20782	-	20782	55.374			55.60		
	3	20644	-	20644	55.006			55.23		
	4	20418	-	20418	54.404			54.64		
	5	21196	-	21196	56.477			56.71		
	6	20382	-	20382	54.308			54.54		
45min	1	23209	-	23209	61.841	61.87	1.43	62.16	62.19	1.43
	2	23496	-	23496	62.606			62.93		
	3	23198	-	23198	61.812			62.13		
	4	22875	-	22875	60.951			61.27		
	5	23690	-	23690	63.122			63.45		
	6	22855	-	22855	60.898			61.22		
60min	1	24852	-	24852	66.219	66.24	1.08	66.64	66.67	1.07
	2	24998	-	24998	66.608			67.03		
	3	24945	-	24945	66.466			66.89		
	4	24534	-	24534	65.371			65.80		
	5	25245	-	25245	67.266			67.70		
	6	24587	-	24587	65.513			65.94		
90min	1	27048	-	27048	72.070	72.05	1.33	72.60	72.58	1.33
	2	27339	-	27339	72.845			73.38		
	3	27093	-	27093	72.190			72.72		
	4	26608	-	26608	70.898			71.43		
	5	27500	-	27500	73.274			73.82		
	6	26648	-	26648	71.004			71.54		
120min	1	28351	-	28351	75.542	75.45	1.04	76.20	76.11	1.03
	2	28520	-	28520	75.992			76.65		
	3	28429	-	28429	75.750			76.40		
	4	27885	-	27885	74.300			74.95		
	5	28658	-	28658	76.360			77.03		
	6	28057	-	28057	74.758			75.41		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	28678	-	28678	76.413	76.26	1.14	77.19	77.04	1.14
	2	28897	-	28897	76.997			77.78		
	3	28798	-	28798	76.733			77.51		
	4	28210	-	28210	75.166			75.94		
	5	28925	-	28925	77.071			77.86		
	6	28225	-	28225	75.206			75.98		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	273409	273384	274055	273818	273998	273733	0.12
2	11.10	283113	282709				282911	0.11
单位质量响应值				RSD%	判断			
25205.62				0.79	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	33370	-	33370	11.837	12.36	4.20	11.84	12.36	4.20
	2	34042	-	34042	12.076			12.08		
	3	33488	-	33488	11.879			11.88		
	4	36192	-	36192	12.839			12.84		
	5	35021	-	35021	12.423			12.42		
	6	36891	-	36891	13.086			13.09		
10min	1	58773	-	58773	20.849	20.97	1.02	20.87	20.99	1.03
	2	58660	-	58660	20.809			20.83		
	3	58576	-	58576	20.779			20.80		
	4	58971	-	58971	20.919			20.94		
	5	59726	-	59726	21.187			21.21		
	6	60014	-	60014	21.289			21.31		
15min	1	69990	-	69990	24.828	24.88	0.50	24.88	24.94	0.51
	2	70280	-	70280	24.931			24.99		
	3	69859	-	69859	24.781			24.84		
	4	69870	-	69870	24.785			24.84		
	5	70109	-	70109	24.870			24.93		
	6	70785	-	70785	25.110			25.17		
20min	1	76091	-	76091	26.992	27.17	0.66	27.09	27.27	0.66
	2	76264	-	76264	27.053			27.15		
	3	76339	-	76339	27.080			27.18		
	4	76531	-	76531	27.148			27.25		
	5	76885	-	76885	27.274			27.37		
	6	77461	-	77461	27.478			27.58		
30min	1	84396	-	84396	29.938	30.03	0.33	30.08	30.18	0.32
	2	84991	-	84991	30.149			30.29		
	3	84503	-	84503	29.976			30.12		
	4	84365	-	84365	29.927			30.07		
	5	84863	-	84863	30.104			30.25		
	6	84847	-	84847	30.098			30.24		
45min	1	89755	-	89755	31.839	32.05	0.70	32.03	32.24	0.70
	2	89933	-	89933	31.902			32.09		
	3	91158	-	91158	32.337			32.53		
	4	91049	-	91049	32.298			32.49		
	5	90417	-	90417	32.074			32.27		
	6	89799	-	89799	31.855			32.05		
60min	1	93670	-	93670	33.228	33.63	0.73	33.47	33.88	0.73
	2	94709	-	94709	33.596			33.84		
	3	95823	-	95823	33.992			34.24		
	4	94984	-	94984	33.694			33.94		
	5	94903	-	94903	33.665			33.91		
	6	94730	-	94730	33.604			33.85		
90min	1	94248	-	94248	33.433	34.87	2.09	33.73	35.18	2.08
	2	99216	-	99216	35.195			35.50		
	3	99188	-	99188	35.185			35.49		
	4	98935	-	98935	35.096			35.40		
	5	99929	-	99929	35.448			35.75		
	6	98325	-	98325	34.879			35.18		
120min	1	97097	-	97097	34.444	35.05	2.40	34.80	35.41	2.38
	2	95886	-	95886	34.014			34.37		
	3	97052	-	97052	34.428			34.79		
	4	101159	-	101159	35.885			36.25		
	5	100915	-	100915	35.798			36.16		
	6	100673	-	100673	35.712			36.07		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	93824	-	93824	33.283	35.30	3.48	33.69	35.72	3.46
	2	100484	-	100484	35.645			36.06		
	3	101964	-	101964	36.170			36.59		
	4	102794	-	102794	36.465			36.89		
	5	101191	-	101191	35.896			36.32		
	6	96857	-	96857	34.358			34.78		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	37011	37095	37164	37178	37129	37115	0.18
2	10.99	36445	36384				36414	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
3405.05				1.93	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	5814	-	5814	15.531	13.31	20.08	15.53	13.31	20.07
	2	5189	-	5189	13.862			13.86		
	3	4506	-	4506	12.037			12.04		
	4	3605	-	3605	9.630			9.63		
	5	4439	-	4439	11.858			11.86		
	6	6341	-	6341	16.939			16.94		
10min	1	12634	-	12634	33.750	31.95	5.05	33.78	31.97	5.06
	2	12045	-	12045	32.177			32.20		
	3	11930	-	11930	31.870			31.89		
	4	11238	-	11238	30.021			30.04		
	5	11308	-	11308	30.208			30.23		
	6	12599	-	12599	33.657			33.69		
15min	1	16050	-	16050	42.876	41.45	2.67	42.96	41.53	2.68
	2	15687	-	15687	41.906			41.98		
	3	15530	-	15530	41.487			41.56		
	4	15210	-	15210	40.632			40.70		
	5	14888	-	14888	39.772			39.84		
	6	15742	-	15742	42.053			42.14		
20min	1	18102	-	18102	48.358	47.21	1.97	48.51	47.35	1.98
	2	17764	-	17764	47.455			47.60		
	3	17635	-	17635	47.110			47.25		
	4	17638	-	17638	47.118			47.25		
	5	17054	-	17054	45.558			45.69		
	6	17833	-	17833	47.639			47.79		
30min	1	20968	-	20968	56.014	55.15	1.35	56.25	55.37	1.35
	2	20700	-	20700	55.298			55.52		
	3	20516	-	20516	54.806			55.03		
	4	20847	-	20847	55.691			55.90		
	5	20176	-	20176	53.898			54.11		
	6	20658	-	20658	55.186			55.42		
45min	1	23710	-	23710	63.339	62.38	1.17	63.67	62.70	1.17
	2	23358	-	23358	62.398			62.72		
	3	23187	-	23187	61.942			62.25		
	4	23639	-	23639	63.149			63.45		
	5	23026	-	23026	61.511			61.81		
	6	23191	-	23191	61.952			62.28		
60min	1	25603	-	25603	68.396	66.92	1.43	68.83	67.34	1.43
	2	25160	-	25160	67.212			67.63		
	3	24852	-	24852	66.389			66.80		
	4	25235	-	25235	67.413			67.82		
	5	24593	-	24593	65.698			66.10		
	6	24865	-	24865	66.424			66.85		
90min	1	27503	-	27503	73.471	72.60	1.07	74.02	73.12	1.07
	2	27403	-	27403	73.204			73.74		
	3	27021	-	27021	72.184			72.71		
	4	27372	-	27372	73.121			73.64		
	5	26783	-	26783	71.548			72.06		
	6	26969	-	26969	72.045			72.58		
120min	1	29070	-	29070	77.657	76.19	1.45	78.33	76.84	1.45
	2	28639	-	28639	76.506			77.16		
	3	28246	-	28246	75.456			76.10		
	4	28915	-	28915	77.243			77.89		
	5	28156	-	28156	75.216			75.85		
	6	28102	-	28102	75.071			75.73		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	29119	-	29119	77.788	76.75	1.05	78.59	77.52	1.05
	2	28828	-	28828	77.011			77.79		
	3	28504	-	28504	76.145			76.92		
	4	29015	-	29015	77.510			78.28		
	5	28402	-	28402	75.873			76.63		
	6	28507	-	28507	76.153			76.94		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	281443	281586	281550	281615	280630	281365	0.15
2	11.10	278281	278203				278242	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
25908.38		25066.85		2.34	数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	31070	-	31070	10.963	9.61	19.56	10.96	9.61	19.55
	2	30479	-	30479	10.755			10.75		
	3	24580	-	24580	8.673			8.67		
	4	19692	-	19692	6.948			6.95		
	5	23887	-	23887	8.429			8.43		
	6	33667	-	33667	11.880			11.88		
10min	1	57931	-	57931	20.441	19.67	4.39	20.46	19.69	4.41
	2	56573	-	56573	19.962			19.98		
	3	55494	-	55494	19.581			19.60		
	4	52437	-	52437	18.503			18.51		
	5	53481	-	53481	18.871			18.89		
	6	58636	-	58636	20.690			20.71		
15min	1	69342	-	69342	24.468	23.97	1.88	24.52	24.02	1.89
	2	68868	-	68868	24.300			24.35		
	3	67569	-	67569	23.842			23.89		
	4	66677	-	66677	23.527			23.57		
	5	66268	-	66268	23.383			23.43		
	6	68812	-	68812	24.281			24.33		
20min	1	76255	-	76255	26.907	26.52	2.92	27.00	26.60	2.93
	2	75663	-	75663	26.698			26.79		
	3	75019	-	75019	26.471			26.56		
	4	74133	-	74133	26.158			26.24		
	5	71636	-	71636	25.277			25.36		
	6	78171	-	78171	27.583			27.68		
30min	1	84192	-	84192	29.708	29.45	0.80	29.85	29.58	0.82
	2	84229	-	84229	29.721			29.86		
	3	83308	-	83308	29.396			29.53		
	4	82802	-	82802	29.217			29.34		
	5	82688	-	82688	29.177			29.30		
	6	83542	-	83542	29.478			29.62		
45min	1	90952	-	90952	32.093	31.83	1.11	32.28	32.02	1.09
	2	91179	-	91179	32.173			32.36		
	3	90750	-	90750	32.022			32.20		
	4	90017	-	90017	31.763			31.94		
	5	89919	-	89919	31.728			31.90		
	6	88465	-	88465	31.215			31.41		
60min	1	94497	-	94497	33.344	32.99	0.74	33.58	33.22	0.75
	2	94109	-	94109	33.207			33.45		
	3	93503	-	93503	32.993			33.23		
	4	92806	-	92806	32.747			32.97		
	5	92990	-	92990	32.812			33.04		
	6	92987	-	92987	32.811			33.05		
90min	1	98138	-	98138	34.629	34.36	0.69	34.93	34.65	0.70
	2	98260	-	98260	34.672			34.97		
	3	96825	-	96825	34.165			34.45		
	4	97066	-	97066	34.250			34.53		
	5	97138	-	97138	34.276			34.56		
	6	96750	-	96750	34.139			34.44		
120min	1	101374	-	101374	35.770	35.03	1.43	36.12	35.38	1.44
	2	100563	-	100563	35.484			35.84		
	3	98354	-	98354	34.705			35.05		
	4	98503	-	98503	34.757			35.10		
	5	97671	-	97671	34.464			34.80		
	6	99220	-	99220	35.010			35.36		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	98920	-	98920	34.904	35.18	0.66	35.32	35.59	0.64
	2	100658	-	100658	35.518			35.93		
	3	100056	-	100056	35.305			35.71		
	4	99191	-	99191	35.000			35.40		
	5	100003	-	100003	35.287			35.68		
	6	99390	-	99390	35.070			35.48		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-2-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:23:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

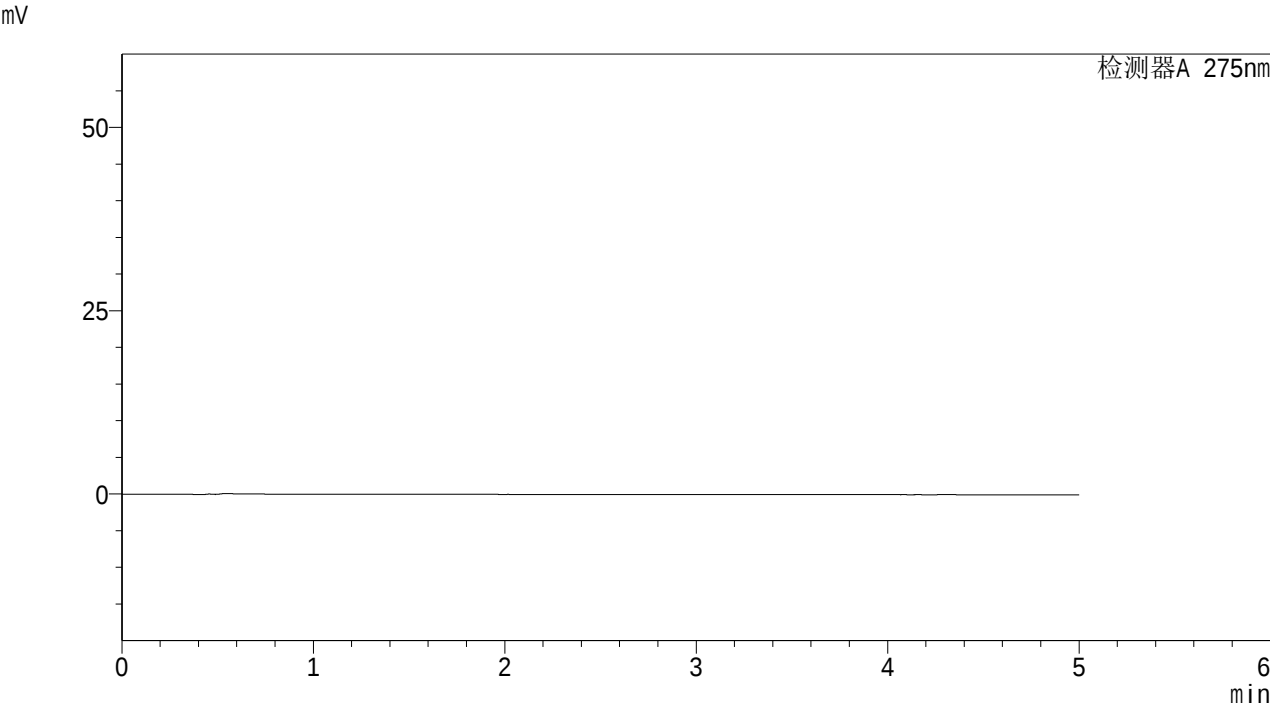

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-3-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:29:02
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

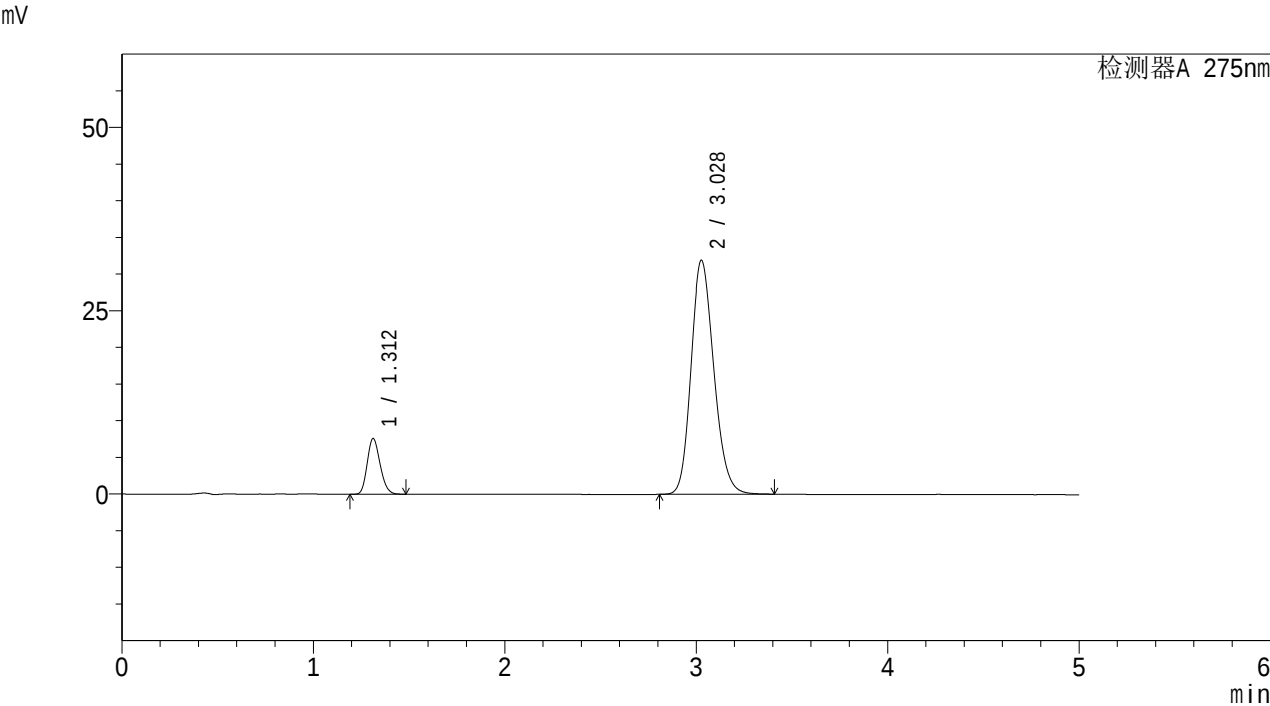

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.312	35438	11.766	7599	1812	1.184	--
2	3.028	265748	88.234	31903	3089	1.178	10.055
总计		301186	100.000	39502			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-4-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:34:26
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

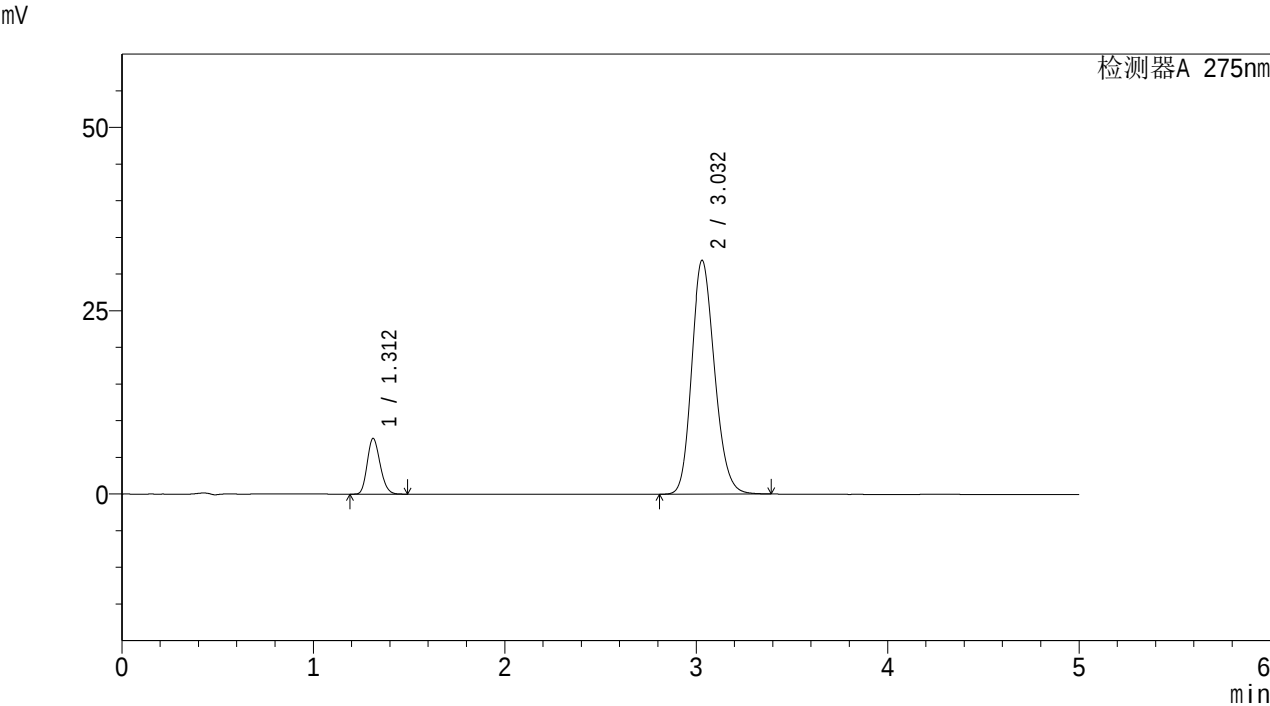

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.312	35472	11.774	7601	1813	1.184	--
2	3.032	265812	88.226	31895	3088	1.177	10.069
总计		301284	100.000	39496			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-5-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:39:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

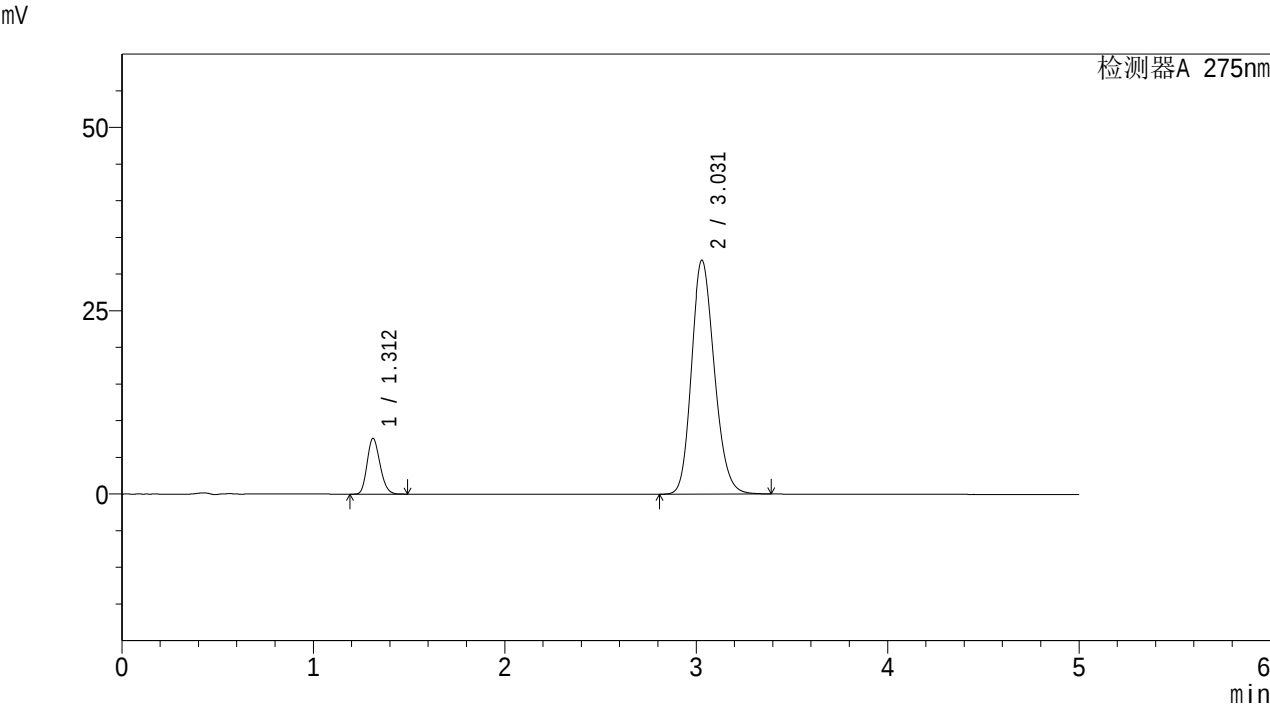

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.312	35408	11.753	7592	1816	1.186	--
2	3.031	265850	88.247	31921	3085	1.176	10.069
总计		301258	100.000	39513			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-6-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 16:45:13

处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

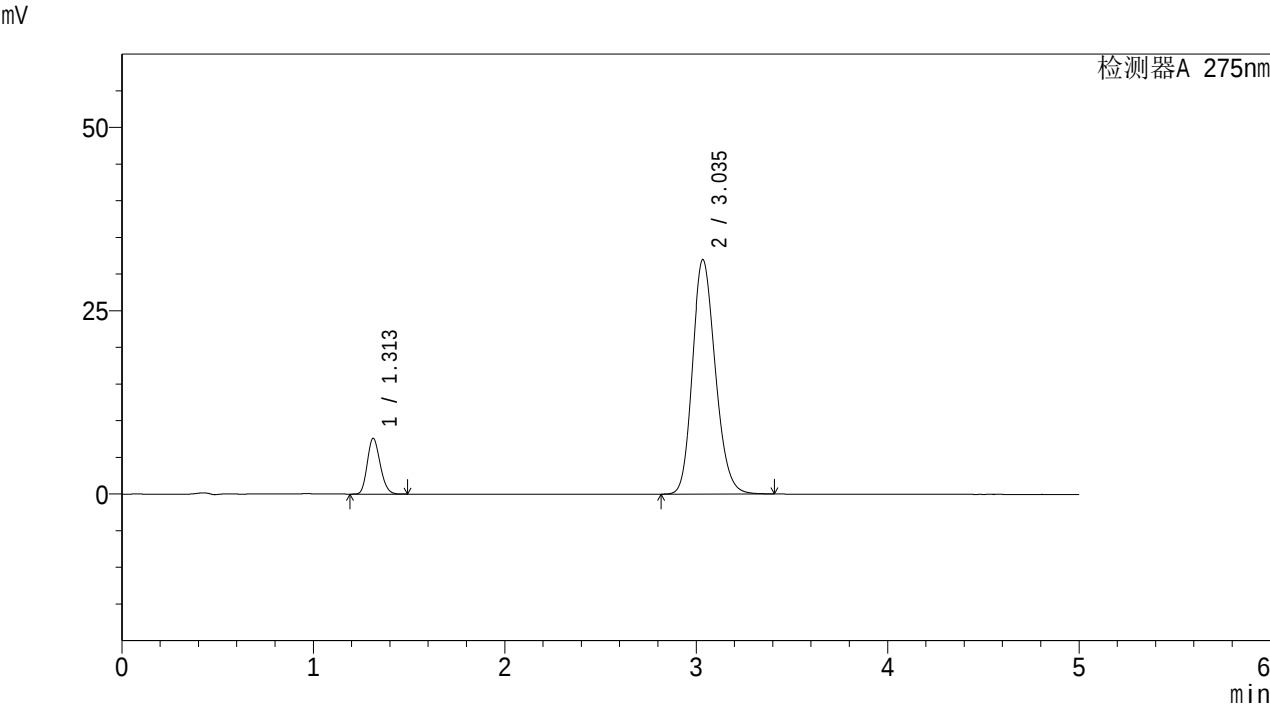

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.313	35440	11.727	7610	1817	1.183	--
2	3.035	266758	88.273	31941	3090	1.176	10.086
总计		302198	100.000	39551			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-7-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:50:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

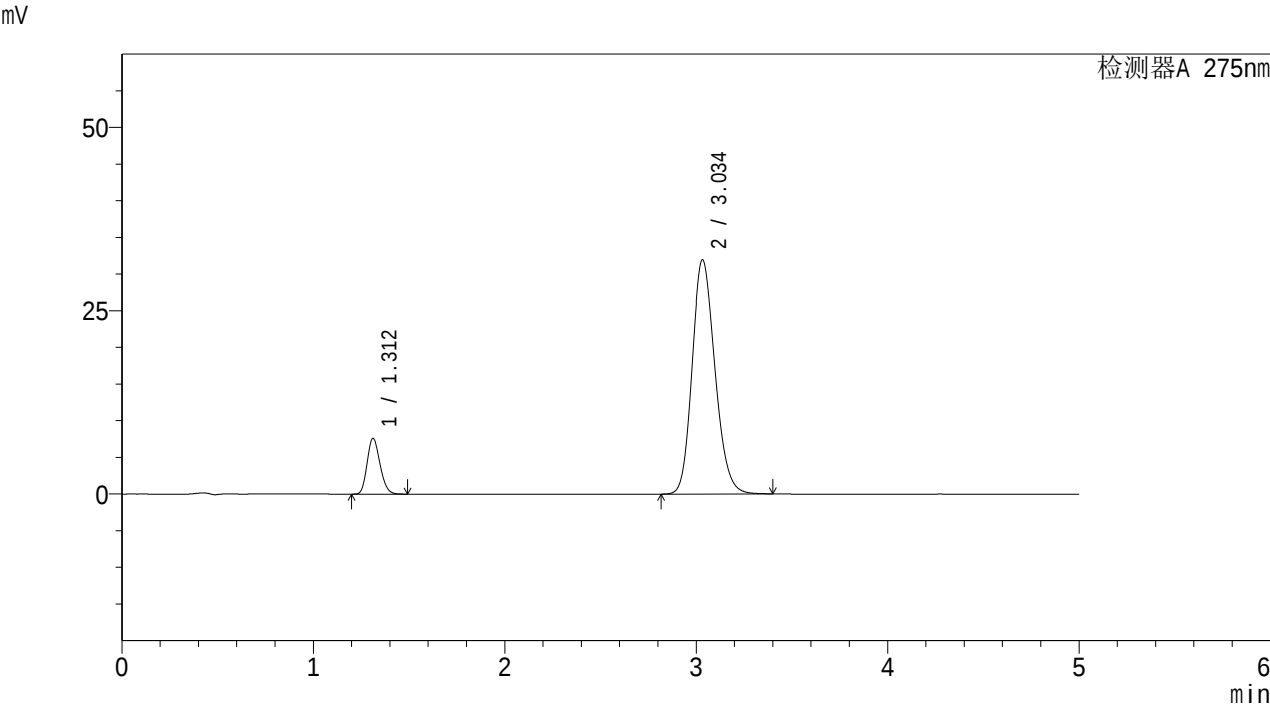

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.312	35483	11.755	7606	1812	1.184	--
2	3.034	266380	88.245	31896	3086	1.176	10.077
总计		301863	100.000	39502			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-8-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:56:00
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

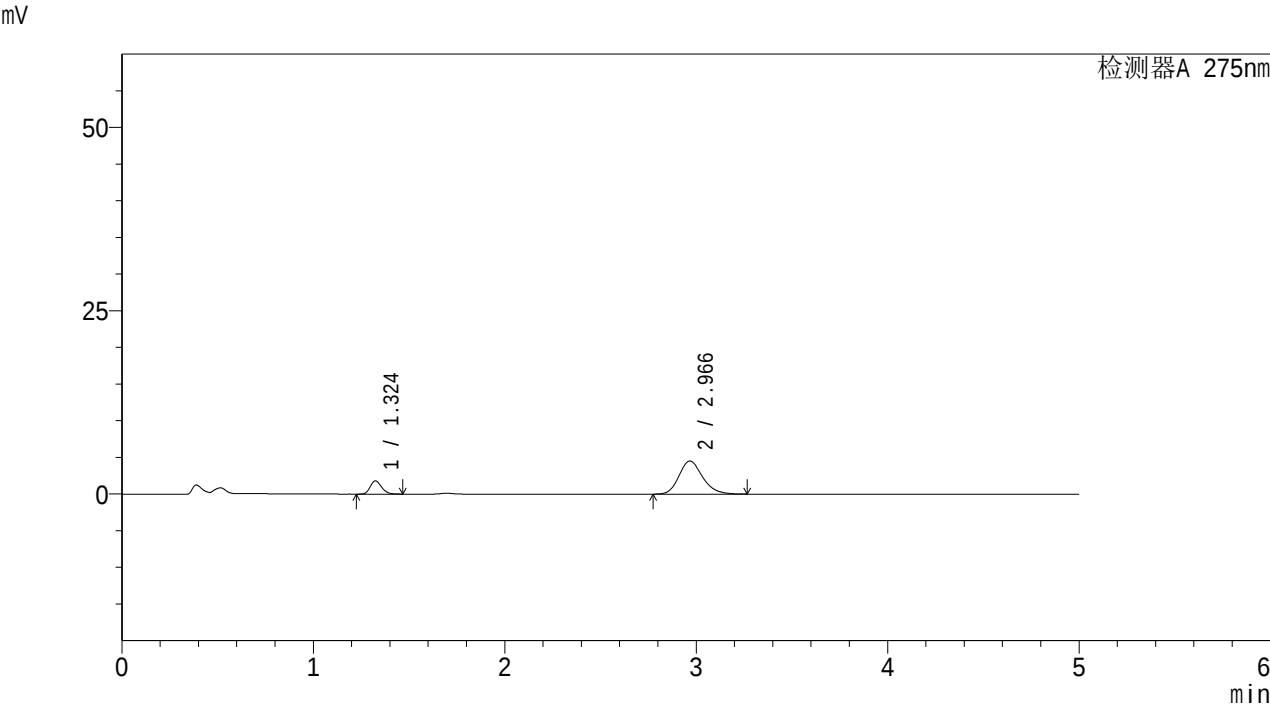

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.324	7425	16.003	1797	2383	1.202	--
2	2.966	38971	83.997	4506	2792	1.197	9.863
总计		46396	100.000	6303			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-9-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:01:23
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

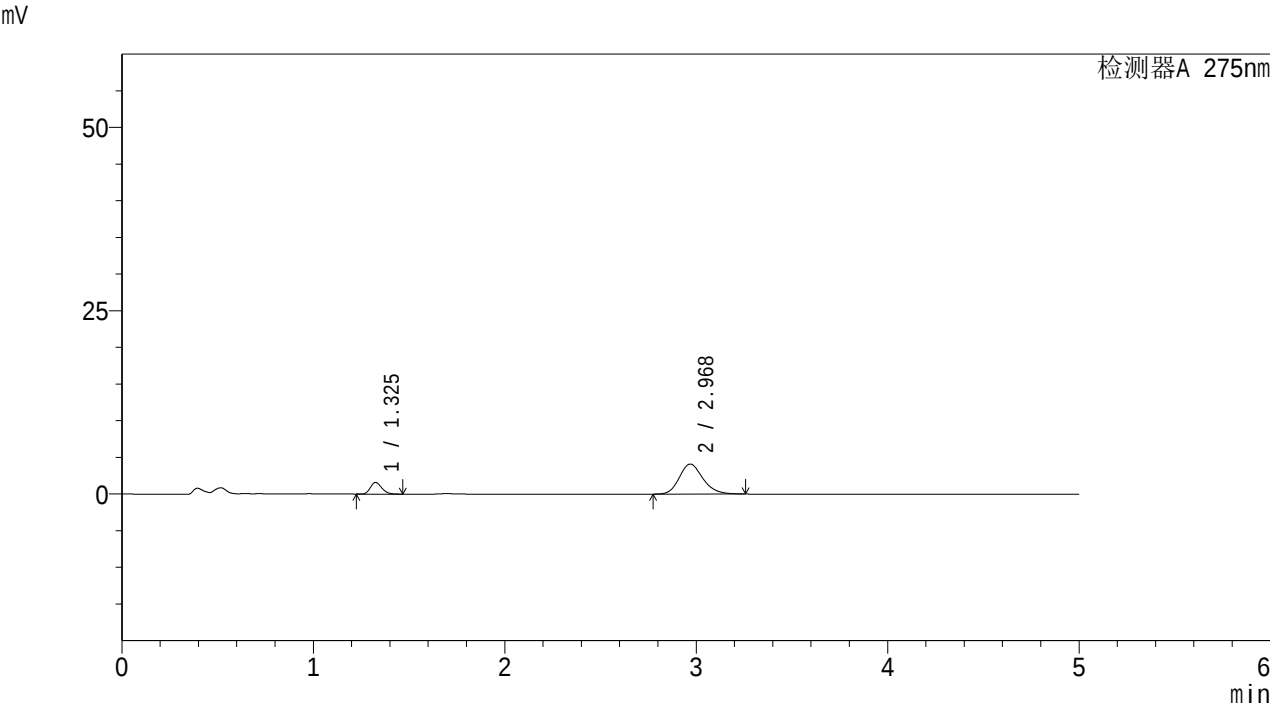

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	6554	15.625	1586	2393	1.201	--
2	2.968	35393	84.375	4087	2781	1.192	9.856
总计		41947	100.000	5673			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-10-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:06:45
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

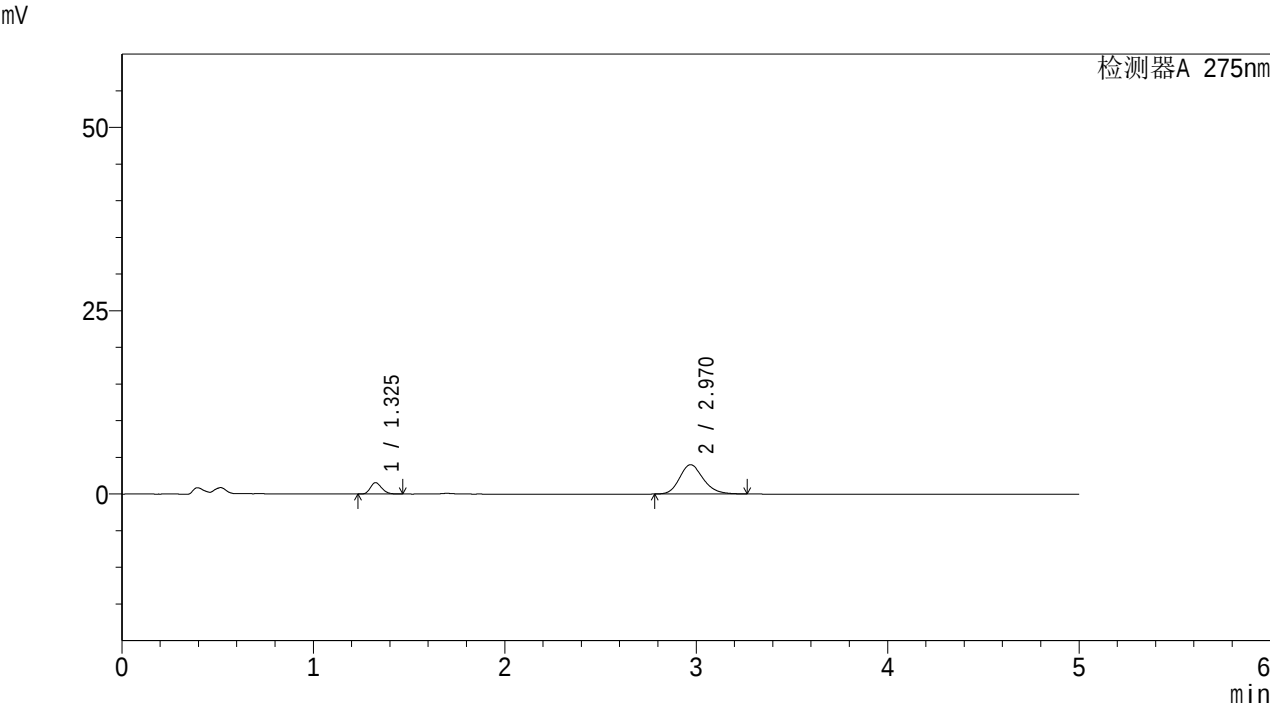

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	6379	15.545	1541	2395	1.207	--
2	2.970	34656	84.455	4002	2781	1.194	9.863
总计		41035	100.000	5543			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-11-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:12:09

处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

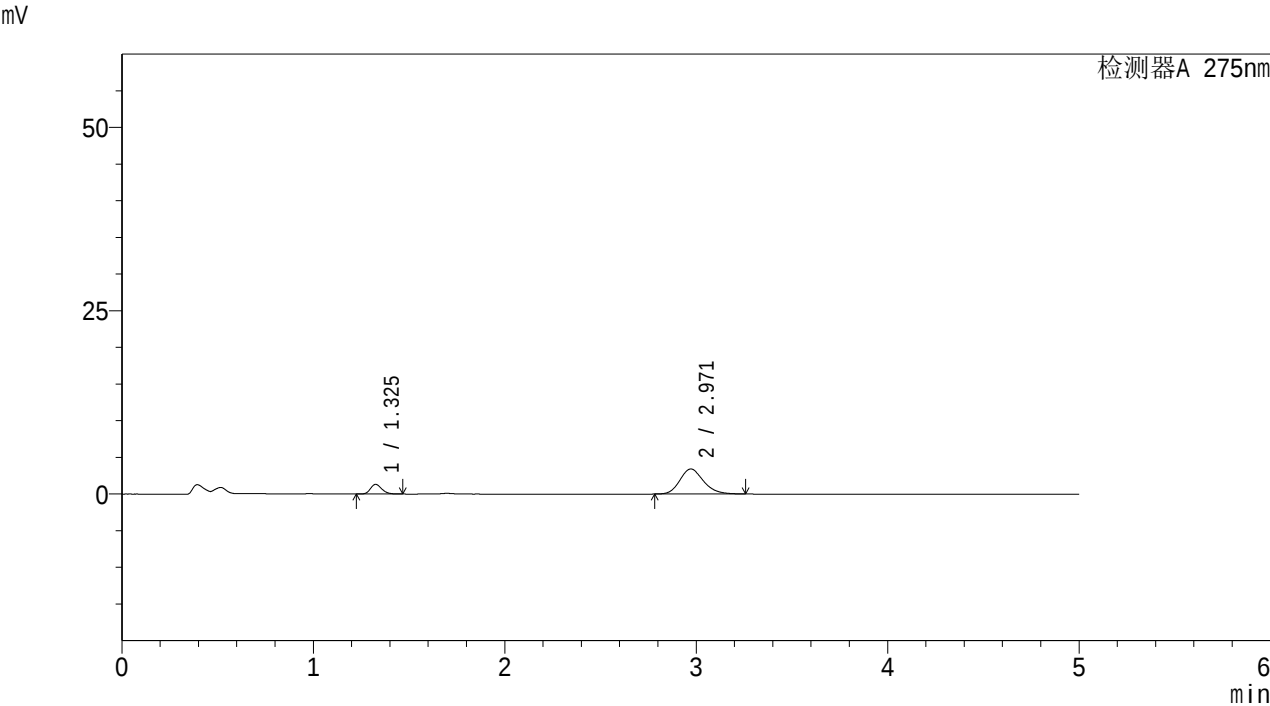

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	5429	15.522	1308	2380	1.201	--
2	2.971	29548	84.478	3414	2784	1.192	9.860
总计		34977	100.000	4723			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-12-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:17:32
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

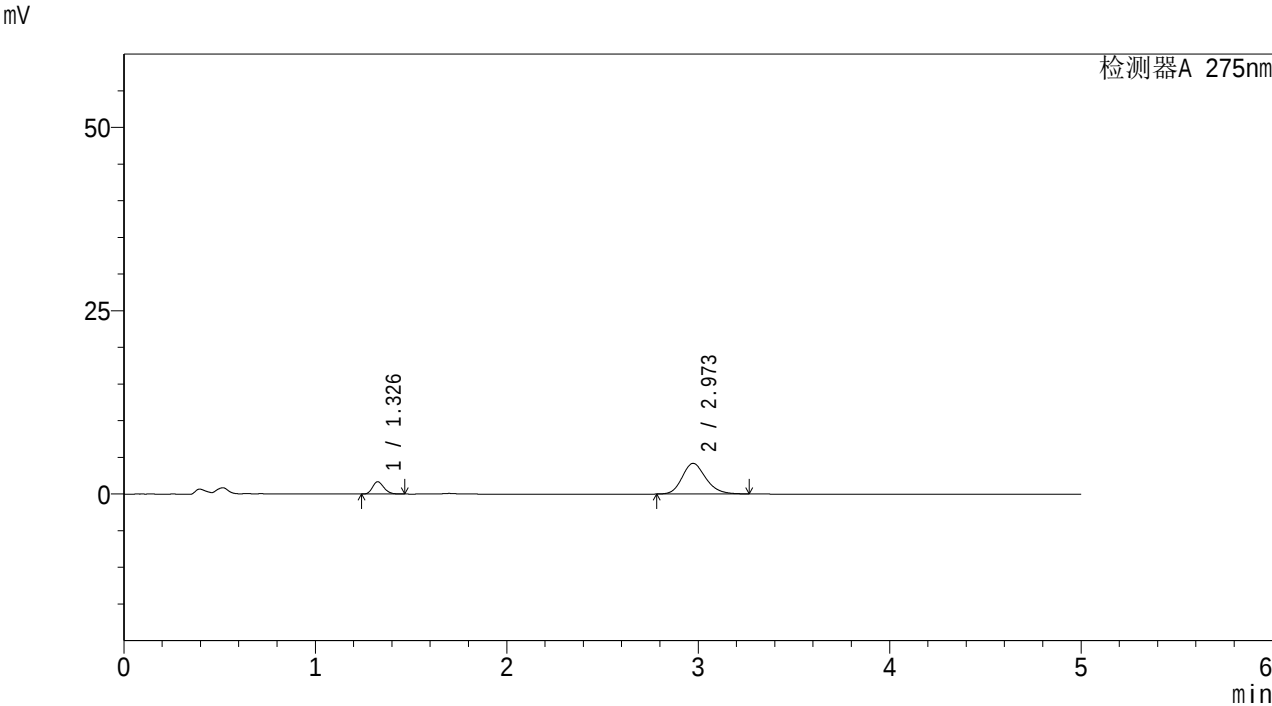

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	6902	16.021	1663	2390	1.206	--
2	2.973	36178	83.979	4181	2808	1.192	9.897
总计		43080	100.000	5844			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-13-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:22:54
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

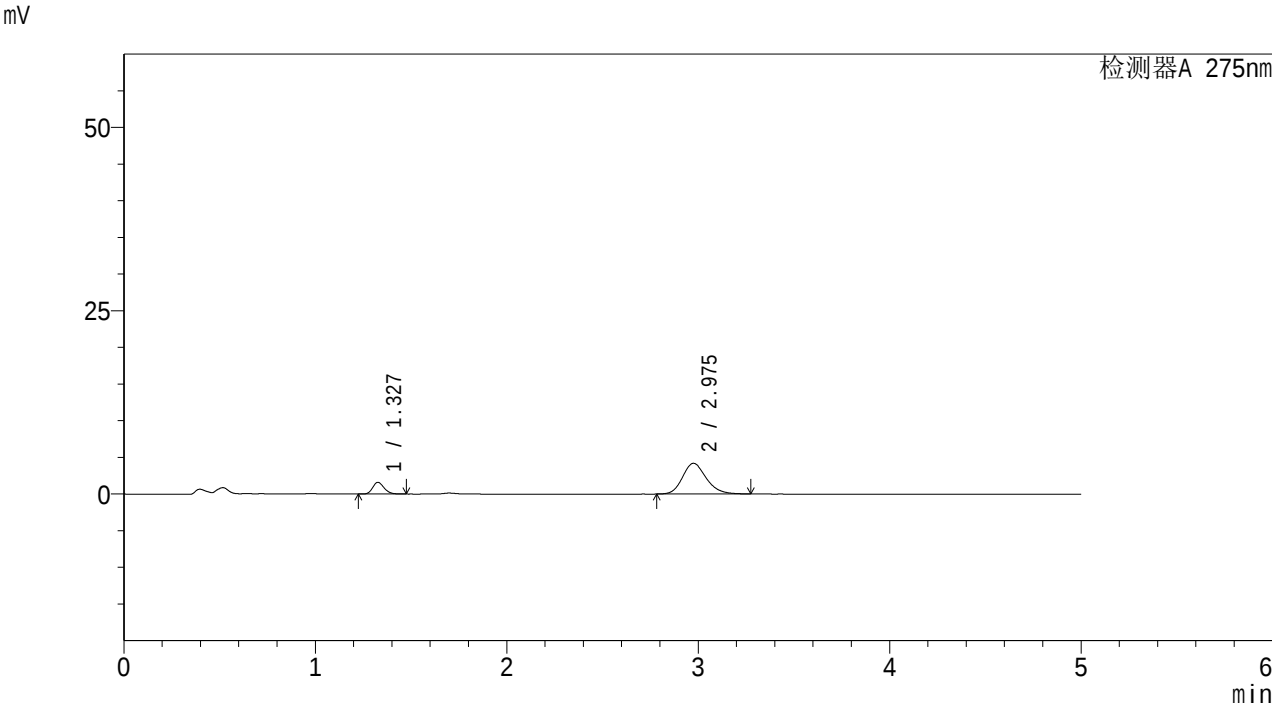

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	6602	15.382	1587	2383	1.202	--
2	2.975	36316	84.618	4182	2786	1.194	9.865
总计		42918	100.000	5769			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-14-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:28:15

处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

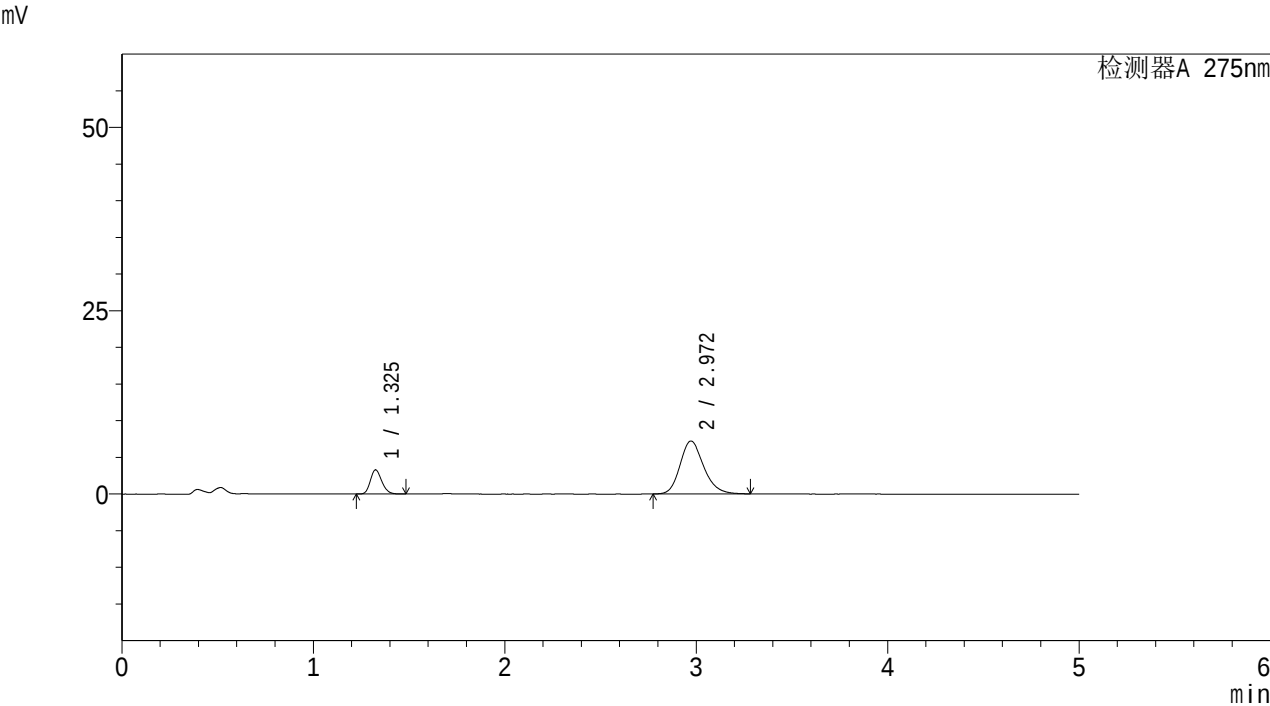

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	13645	17.948	3278	2371	1.201	--
2	2.972	62382	82.052	7224	2810	1.202	9.889
总计		76027	100.000	10502			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-15-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:33:39

处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

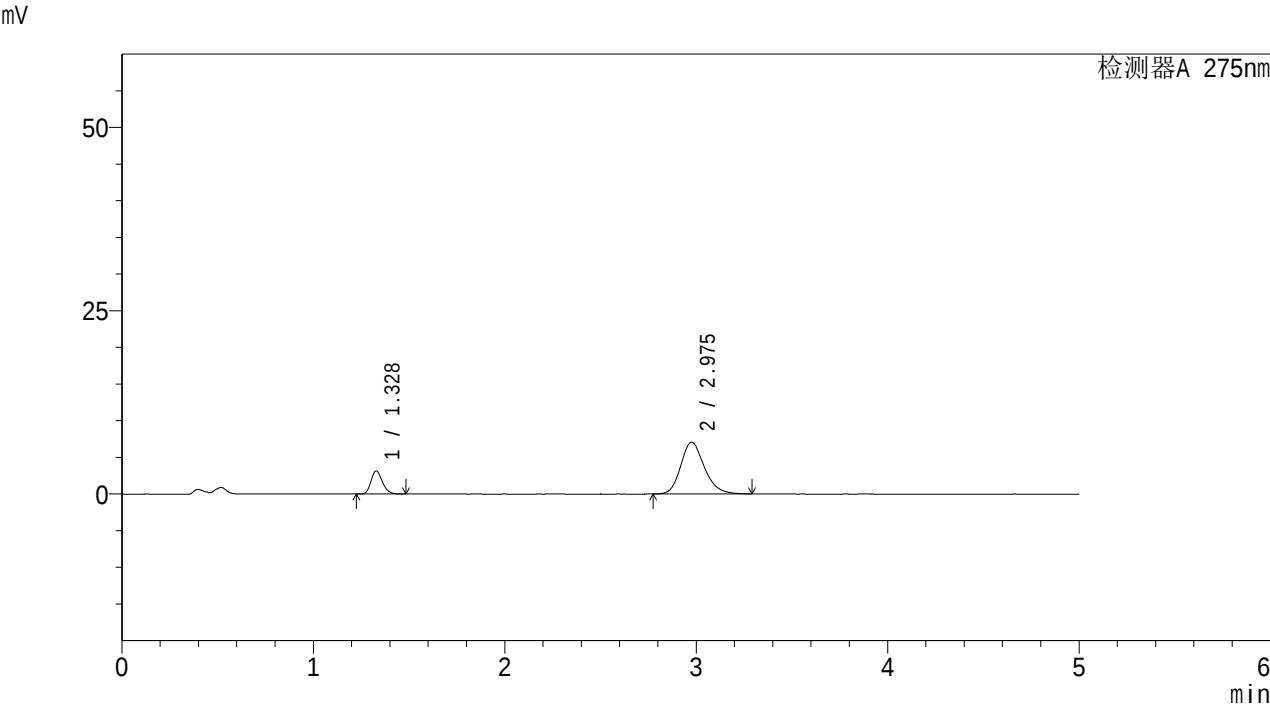

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	13010	17.589	3149	2393	1.204	--
2	2.975	60957	82.411	7042	2821	1.205	9.902
总计		73967	100.000	10191			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-16-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:39:00
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

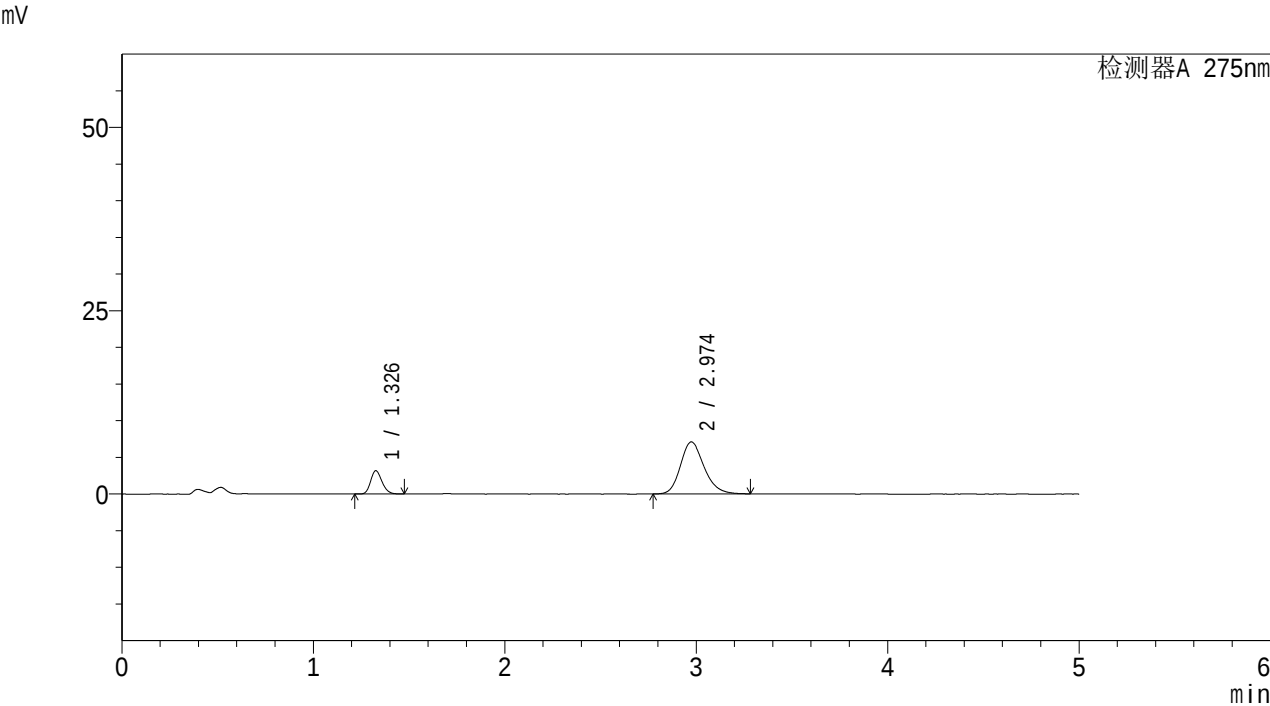

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	13076	17.597	3145	2387	1.201	--
2	2.974	61233	82.403	7091	2817	1.204	9.904
总计		74310	100.000	10236			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-17-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:44:23
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

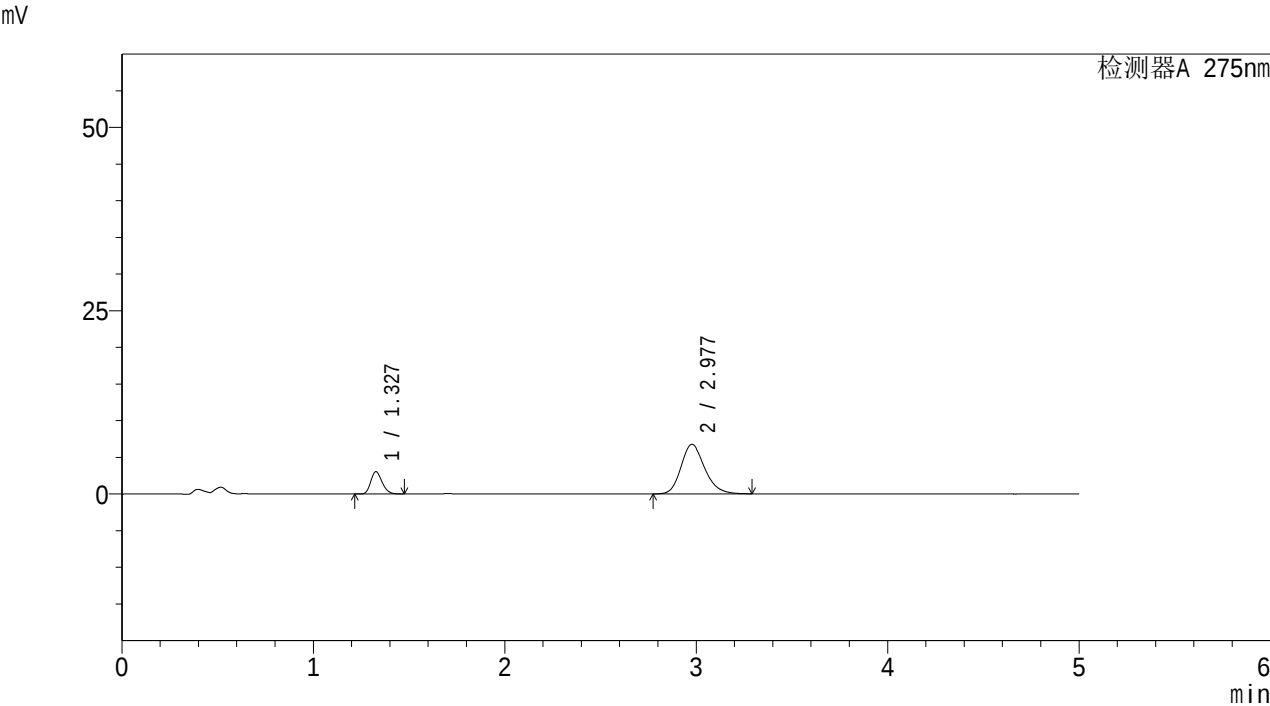

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	12537	17.652	3023	2386	1.198	--
2	2.977	58484	82.348	6753	2812	1.202	9.905
总计		71021	100.000	9776			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-18-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:49:46
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

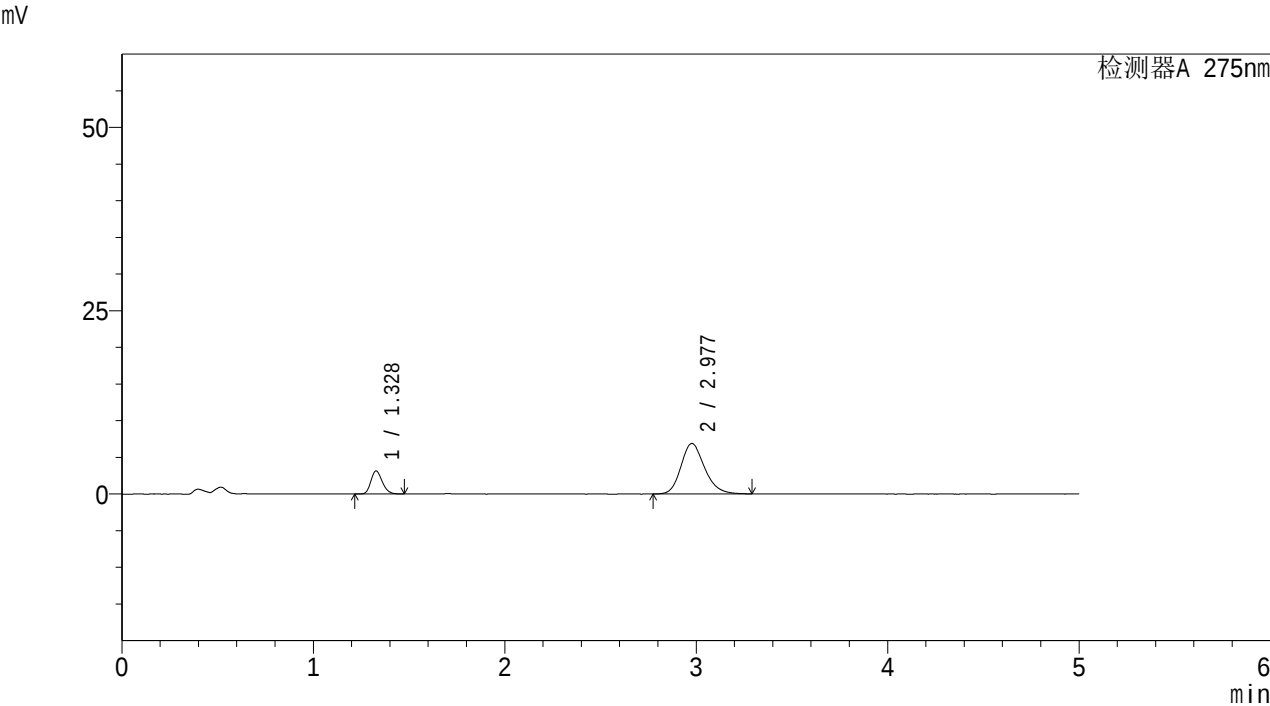

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	12996	17.917	3140	2382	1.197	--
2	2.977	59539	82.083	6870	2812	1.202	9.894
总计		72535	100.000	10011			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-19-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:55:07

处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

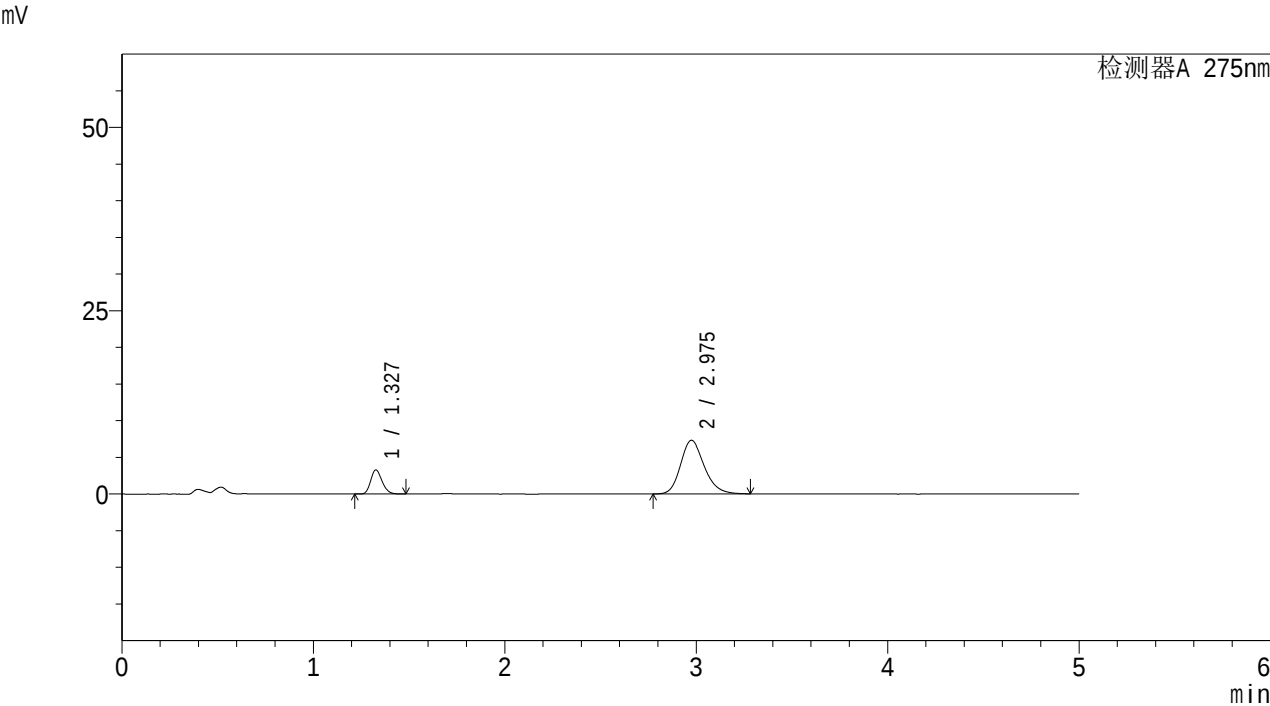

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	13606	17.728	3268	2385	1.206	--
2	2.975	63142	82.272	7304	2816	1.206	9.902
总计		76748	100.000	10572			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-20-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:00:30

处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

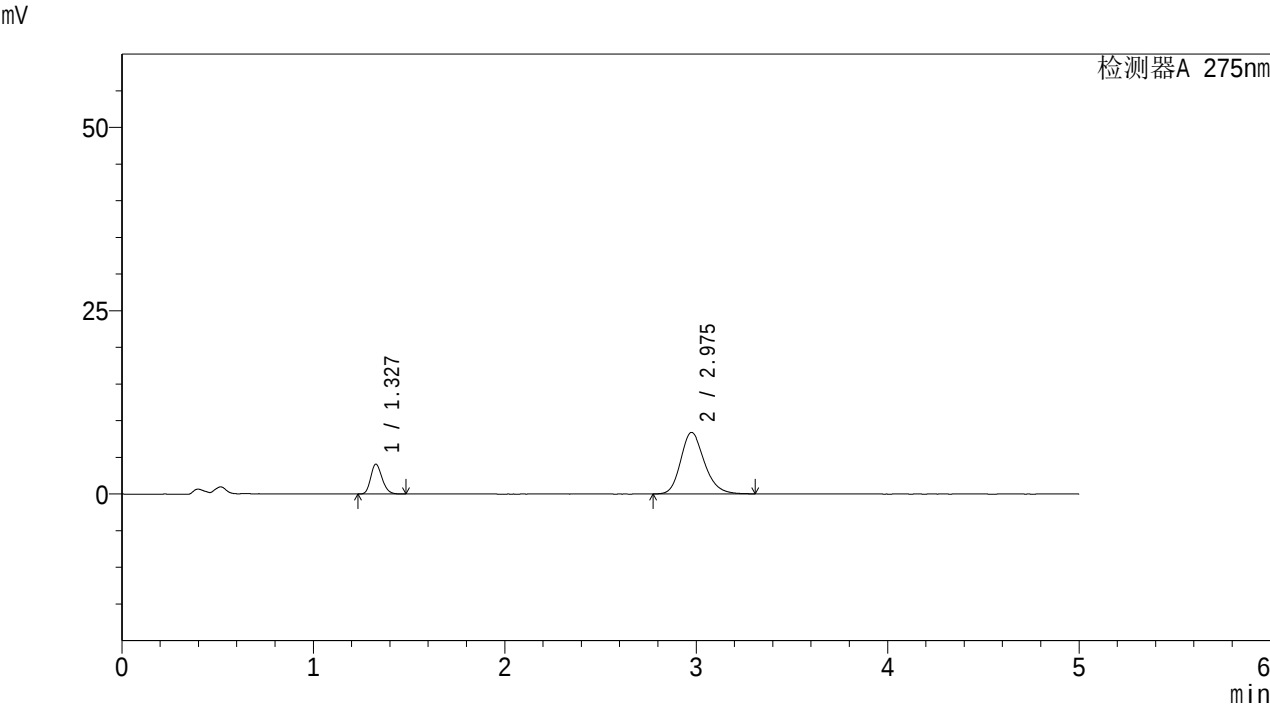

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	16755	18.750	4038	2391	1.200	--
2	2.975	72607	81.250	8380	2823	1.209	9.916
总计		89362	100.000	12418			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-21-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:05:52
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

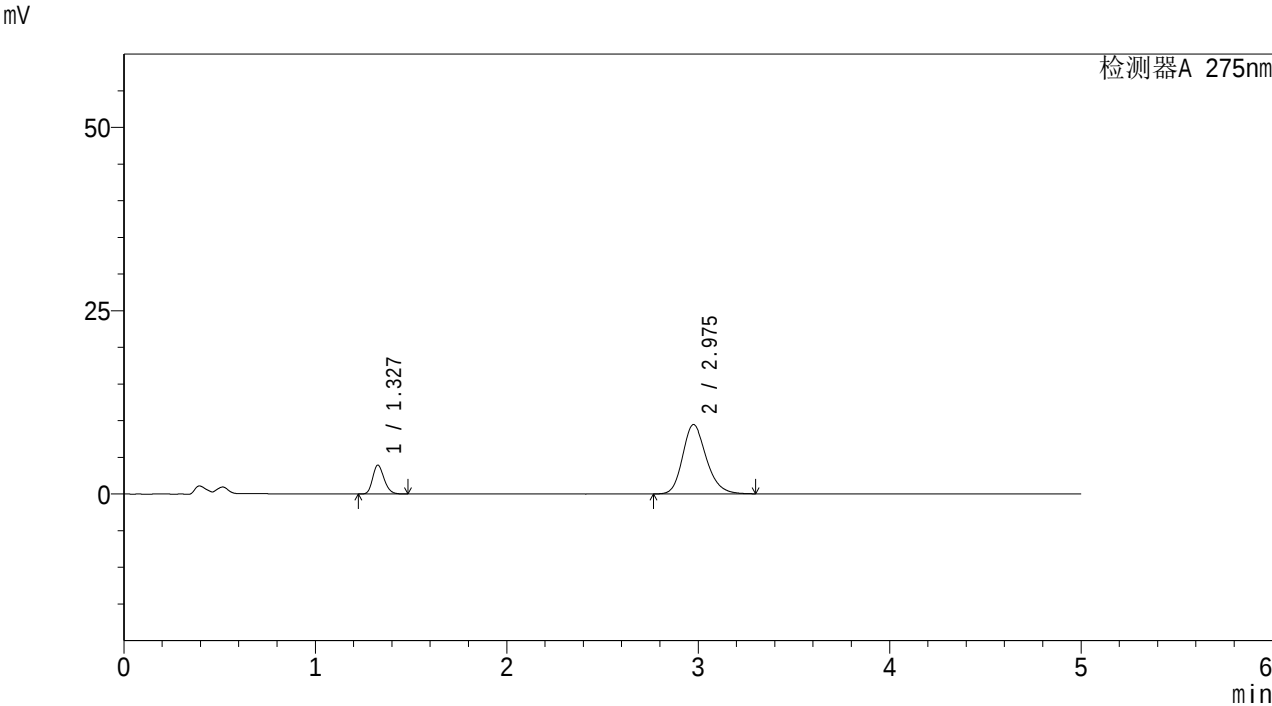

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	16249	16.576	3906	2386	1.205	--
2	2.975	81775	83.424	9447	2821	1.210	9.911
总计		98024	100.000	13354			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-22-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:11:15
处理时间(V2): 2026/05/14 19:53:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

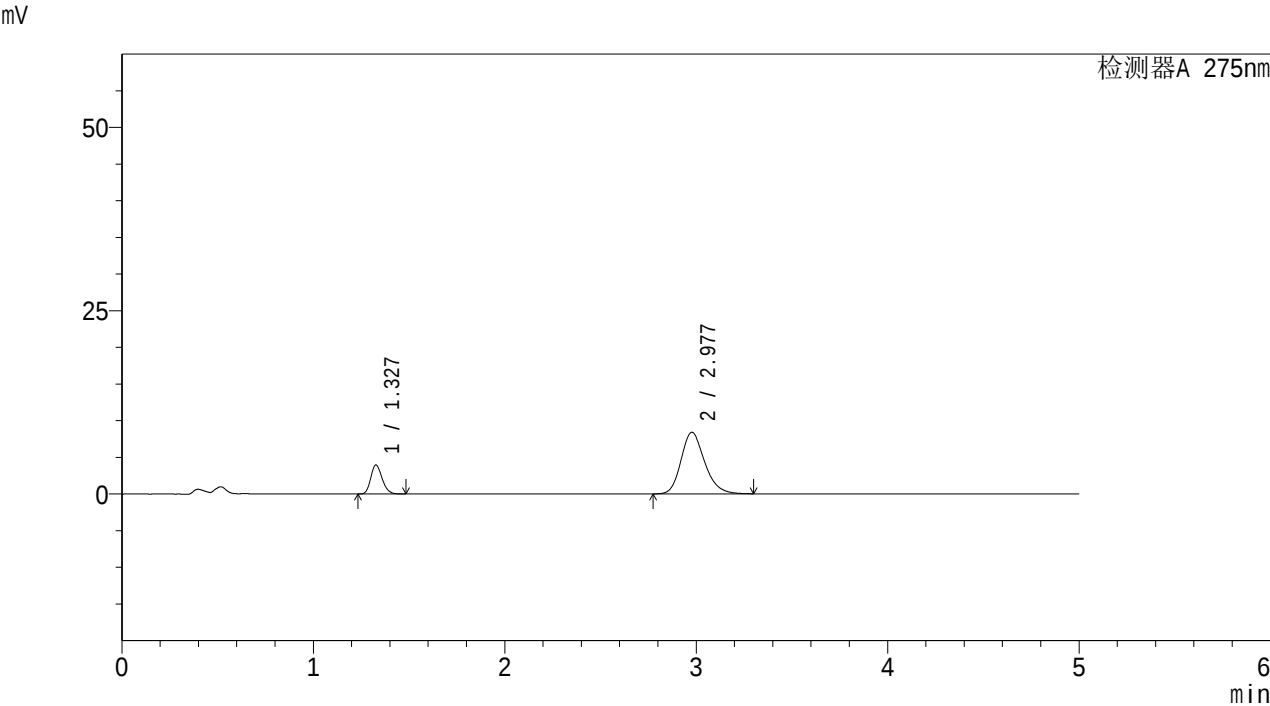

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	16380	18.409	3942	2384	1.201	--
2	2.977	72597	81.591	8392	2825	1.208	9.918
总计		88977	100.000	12334			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-23-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:16:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

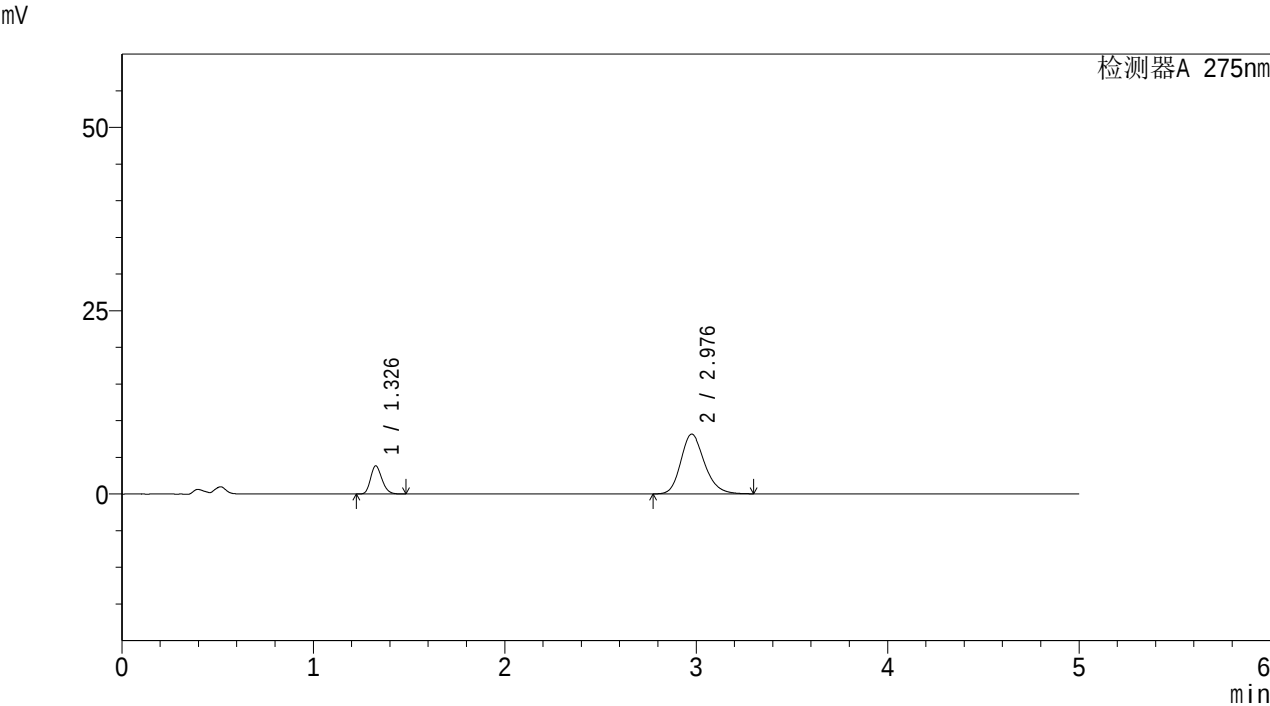

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	15824	18.326	3791	2377	1.206	--
2	2.976	70526	81.674	8138	2817	1.208	9.908
总计		86350	100.000	11929			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-24-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:22:00
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

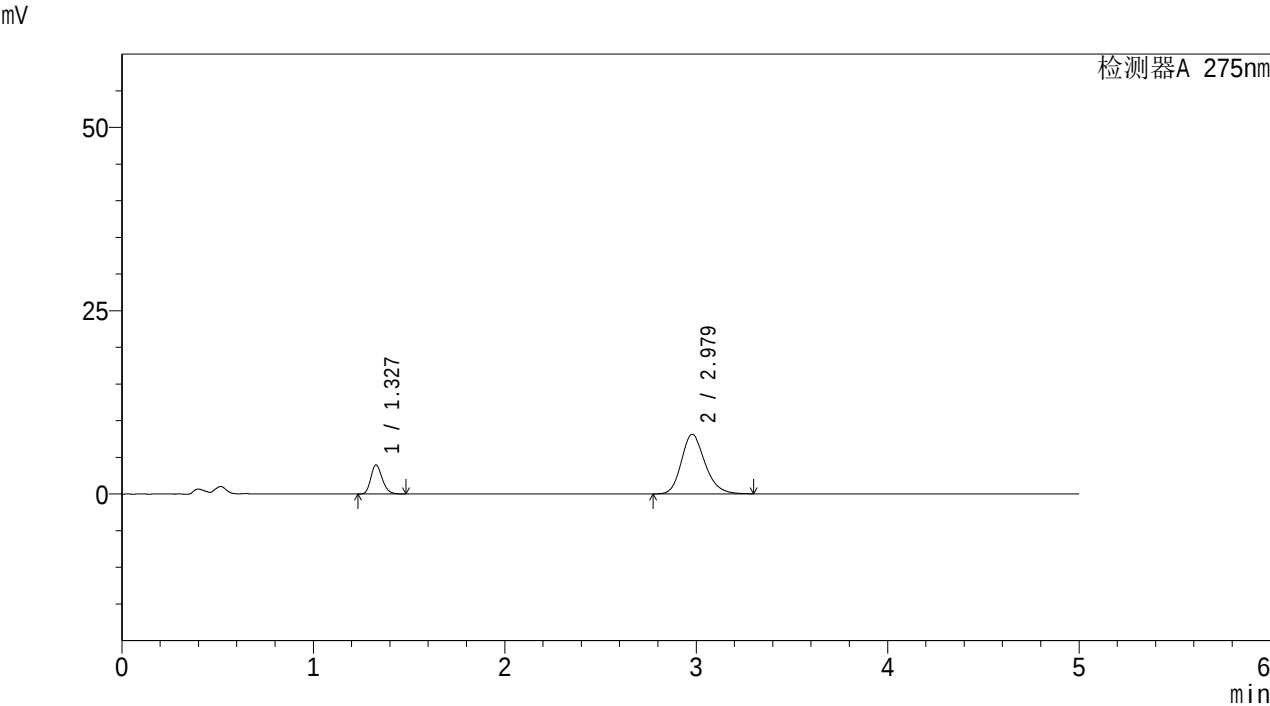

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	16363	18.895	3945	2384	1.202	--
2	2.979	70239	81.105	8128	2823	1.208	9.918
总计		86602	100.000	12073			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-25-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:27:23

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

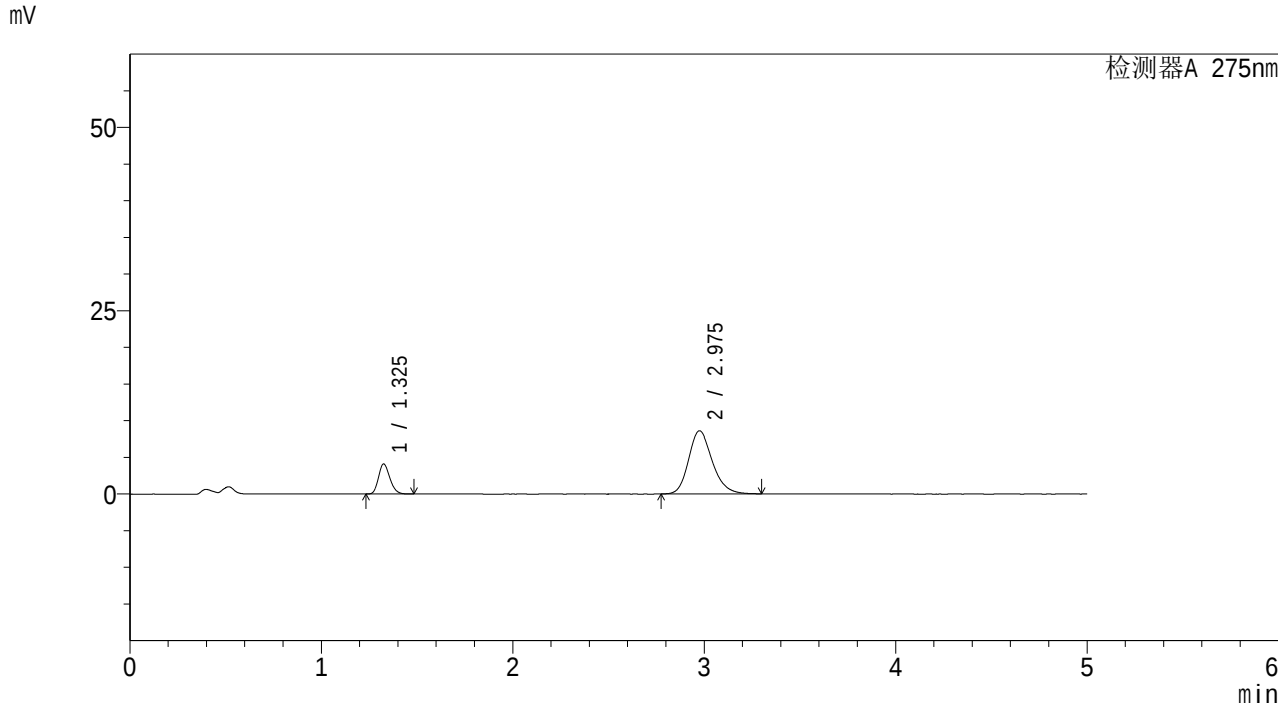

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	16891	18.497	4062	2386	1.201	--
2	2.975	74427	81.503	8601	2817	1.209	9.914
总计		91318	100.000	12664			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-26-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:32:45
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

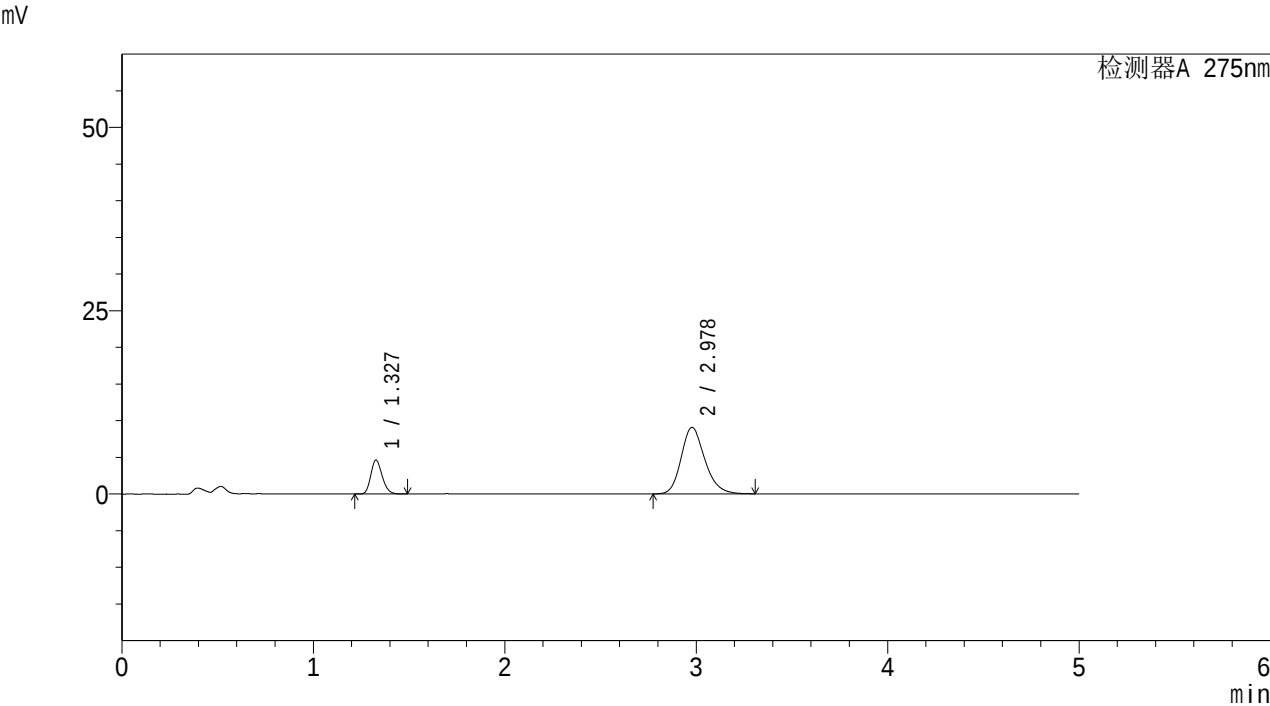

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	19129	19.605	4612	2391	1.199	--
2	2.978	78444	80.395	9067	2830	1.210	9.929
总计		97572	100.000	13679			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-27-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:38:09

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

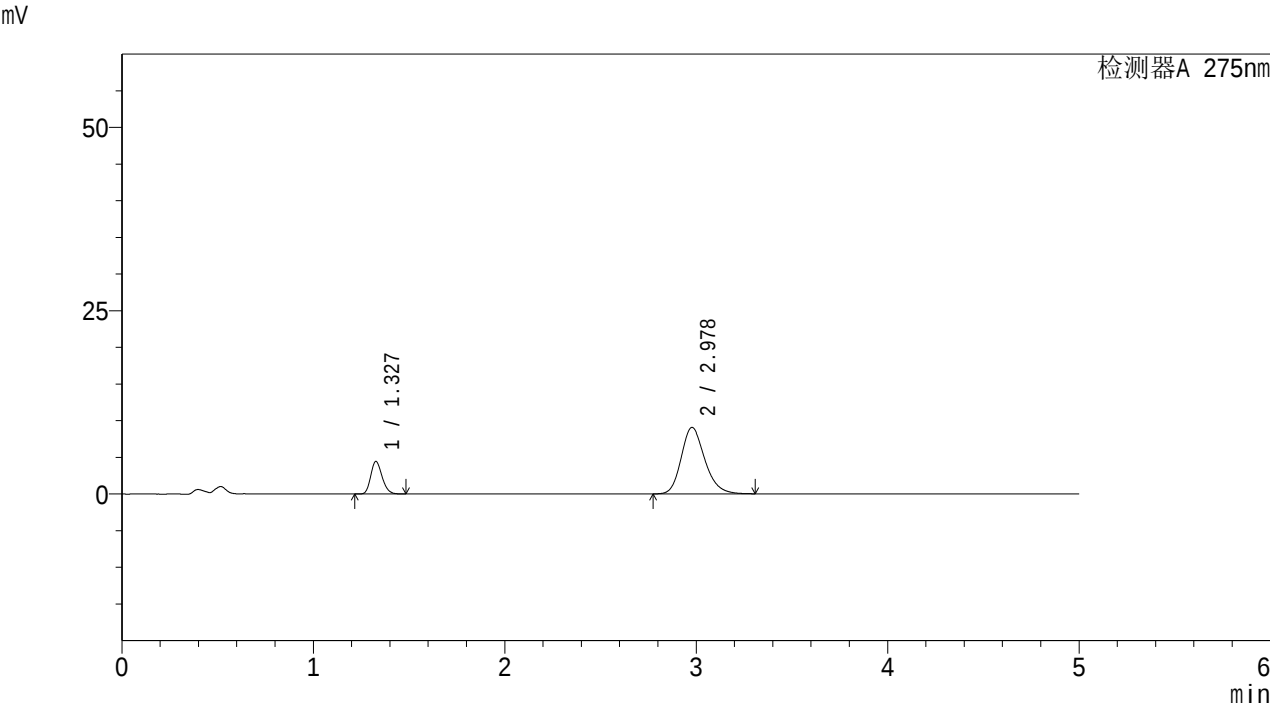

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	18347	19.015	4413	2387	1.201	--
2	2.978	78138	80.985	9062	2841	1.210	9.942
总计		96484	100.000	13475			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-28-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:43:32

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

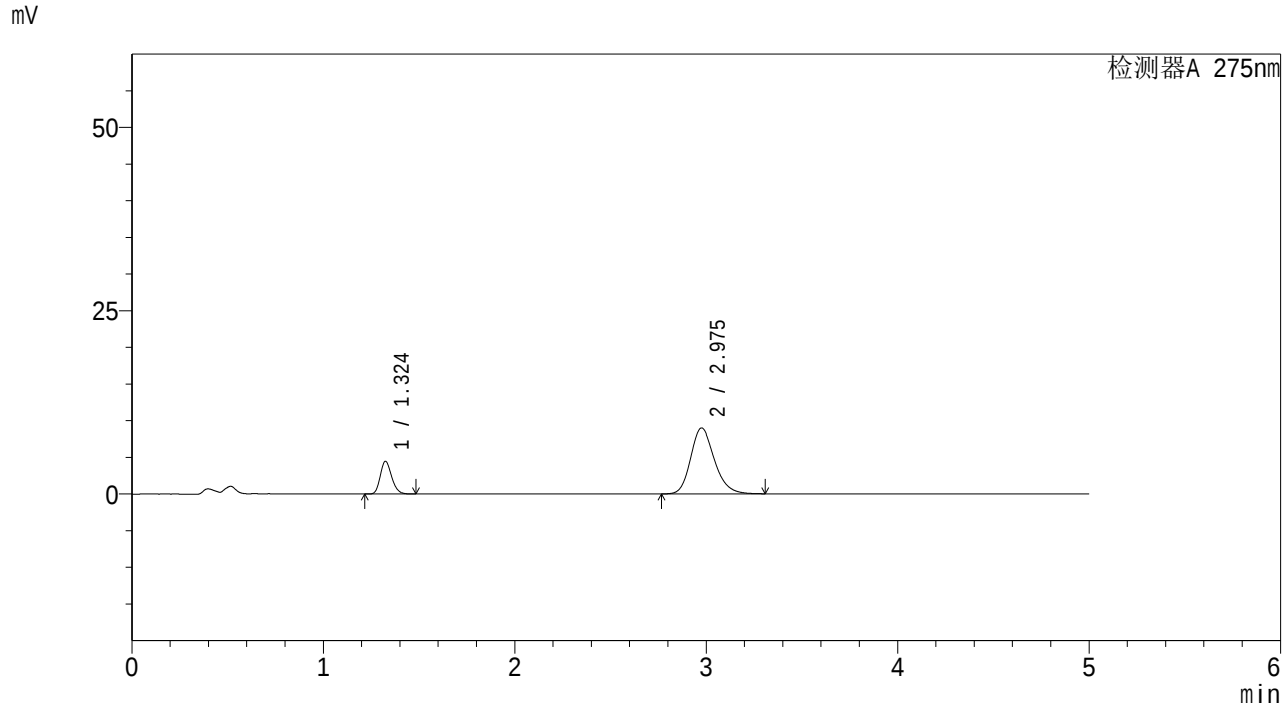

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.324	18374	19.077	4439	2379	1.205	--
2	2.975	77943	80.923	8986	2813	1.208	9.915
总计		96317	100.000	13425			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-29-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:48:54
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

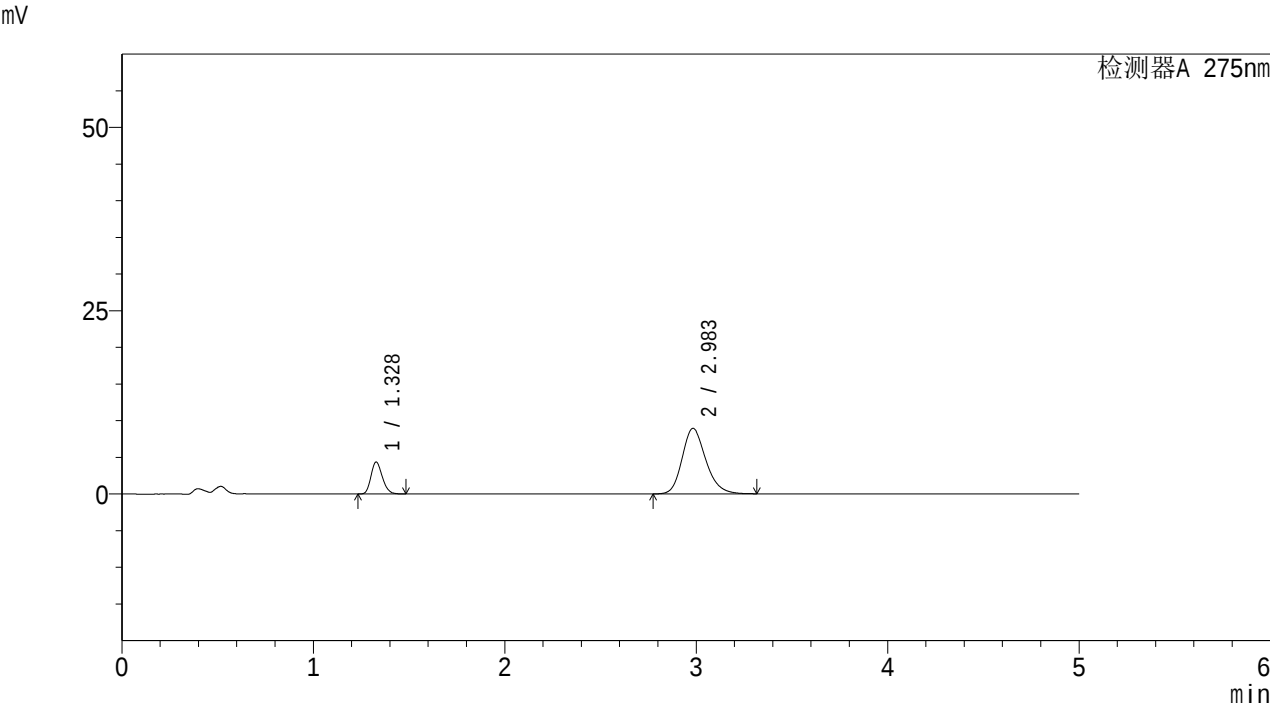

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	18005	18.885	4352	2389	1.201	--
2	2.983	77336	81.115	8929	2831	1.208	9.941
总计		95341	100.000	13281			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-30-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:54:17

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

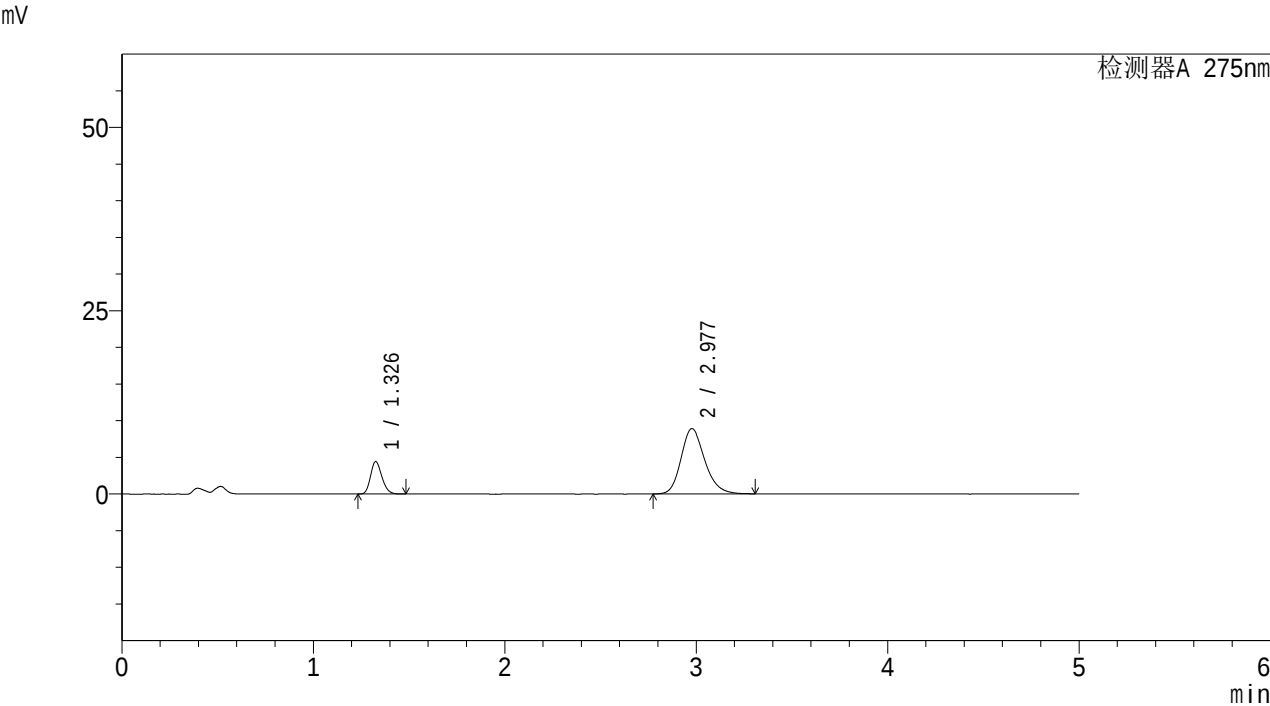

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	18242	19.137	4381	2393	1.205	--
2	2.977	77079	80.863	8904	2823	1.210	9.933
总计		95321	100.000	13285			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-31-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:59:40

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

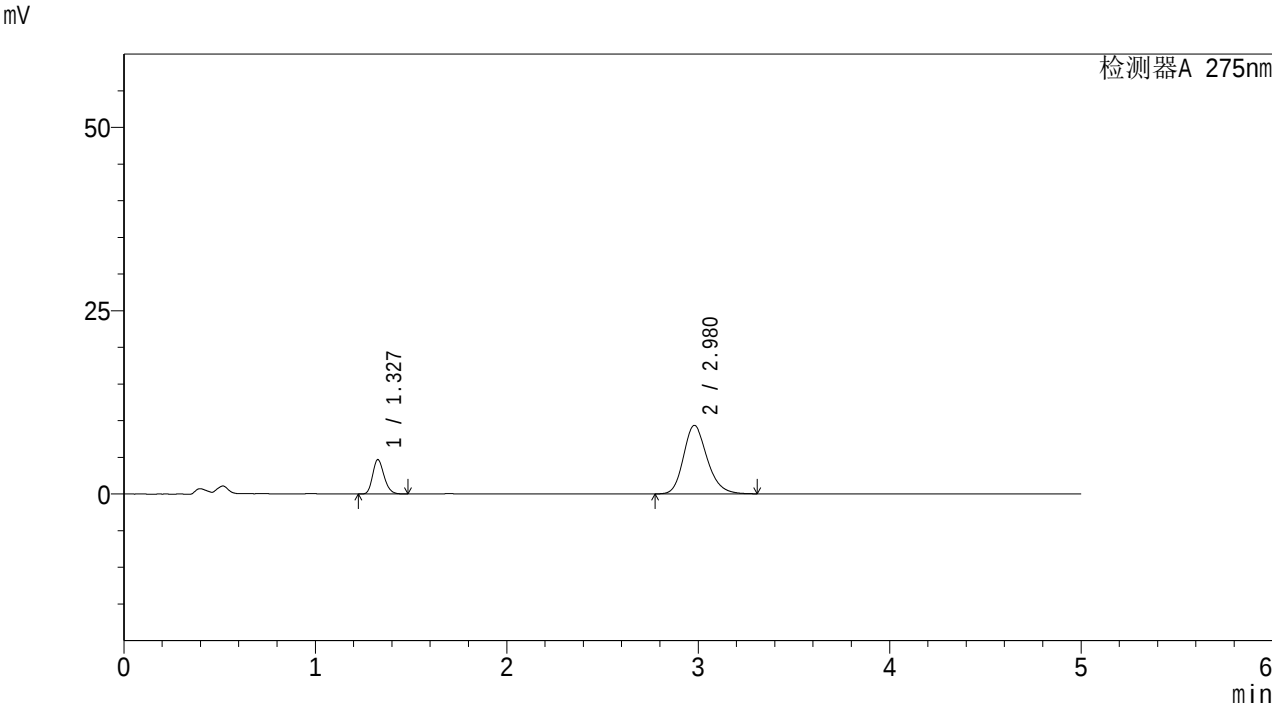

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	19324	19.309	4647	2391	1.203	--
2	2.980	80752	80.691	9347	2831	1.208	9.943
总计		100076	100.000	13994			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-32-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:05:03
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

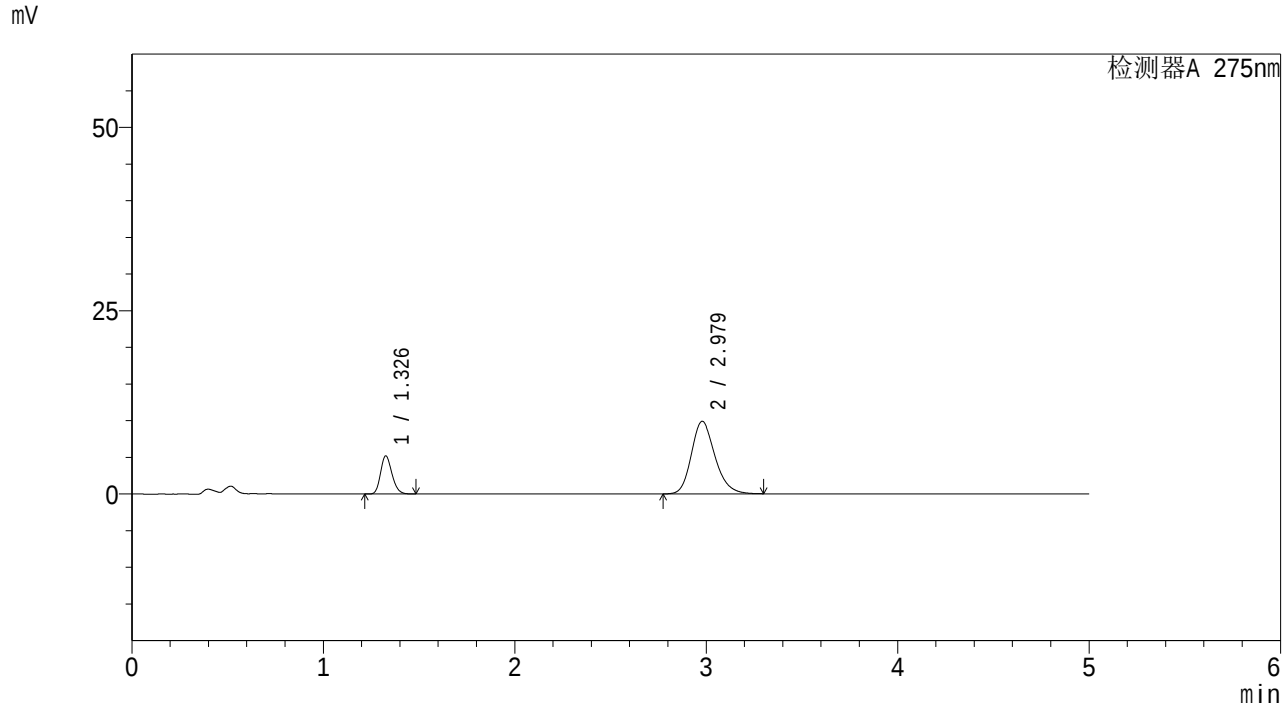

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	21471	20.087	5149	2383	1.200	--
2	2.979	85418	79.913	9899	2834	1.208	9.942
总计		106889	100.000	15048			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-33-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:10:26
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

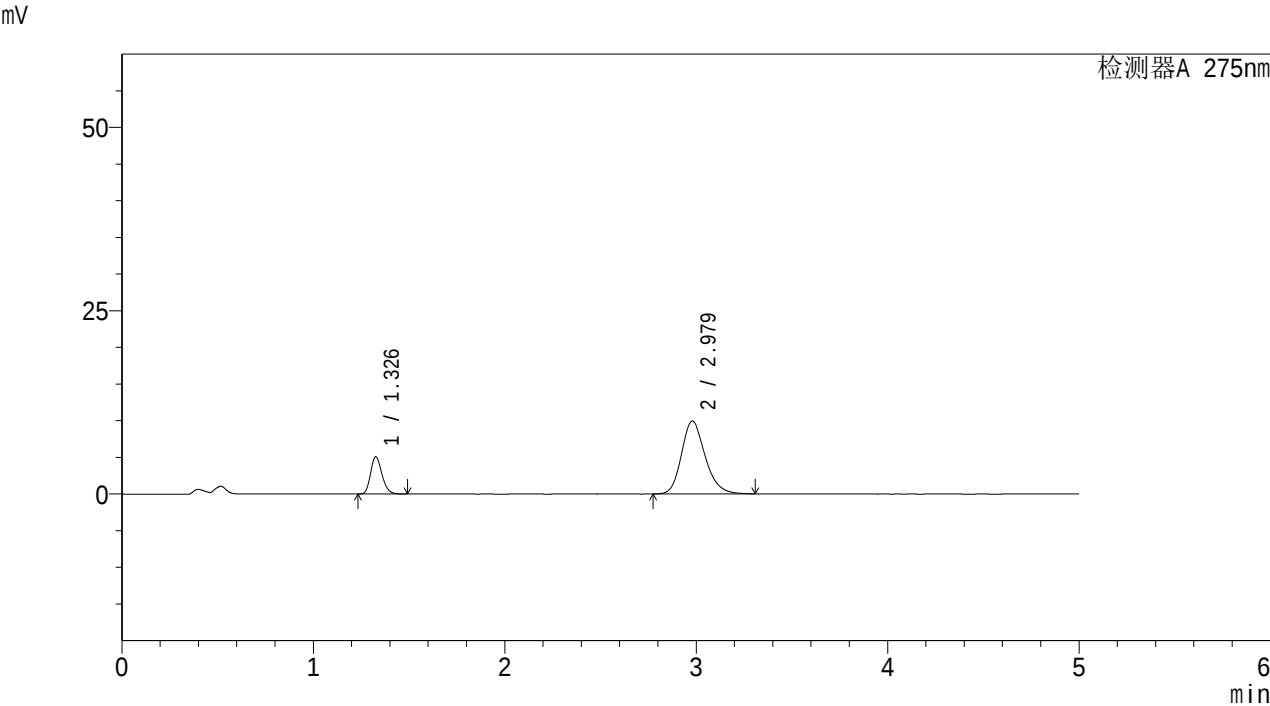

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	20983	19.638	5031	2384	1.204	--
2	2.979	85862	80.362	9934	2827	1.209	9.937
总计		106844	100.000	14966			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-34-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:15:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

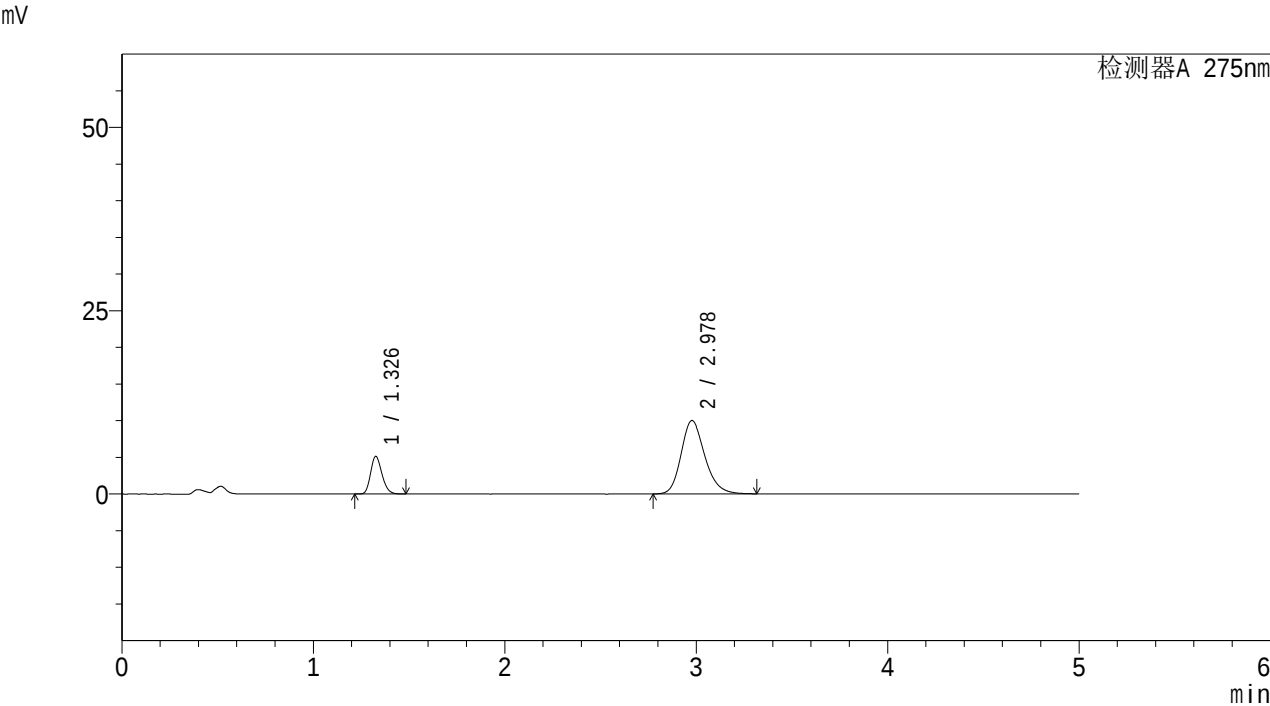

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	21165	19.638	5088	2391	1.202	--
2	2.978	86607	80.362	10004	2826	1.213	9.933
总计		107772	100.000	15092			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-35-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:21:12
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

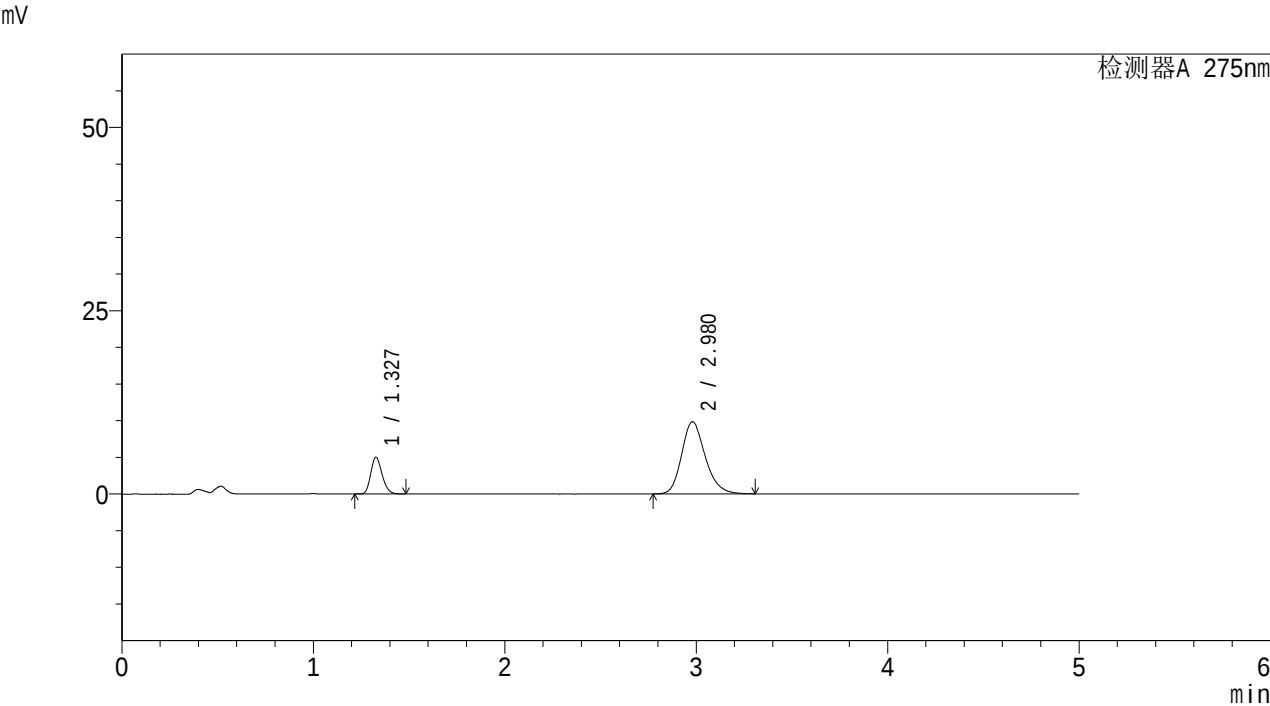

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	20670	19.566	4981	2392	1.200	--
2	2.980	84973	80.434	9839	2834	1.211	9.946
总计		105642	100.000	14820			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-36-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:26:35
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

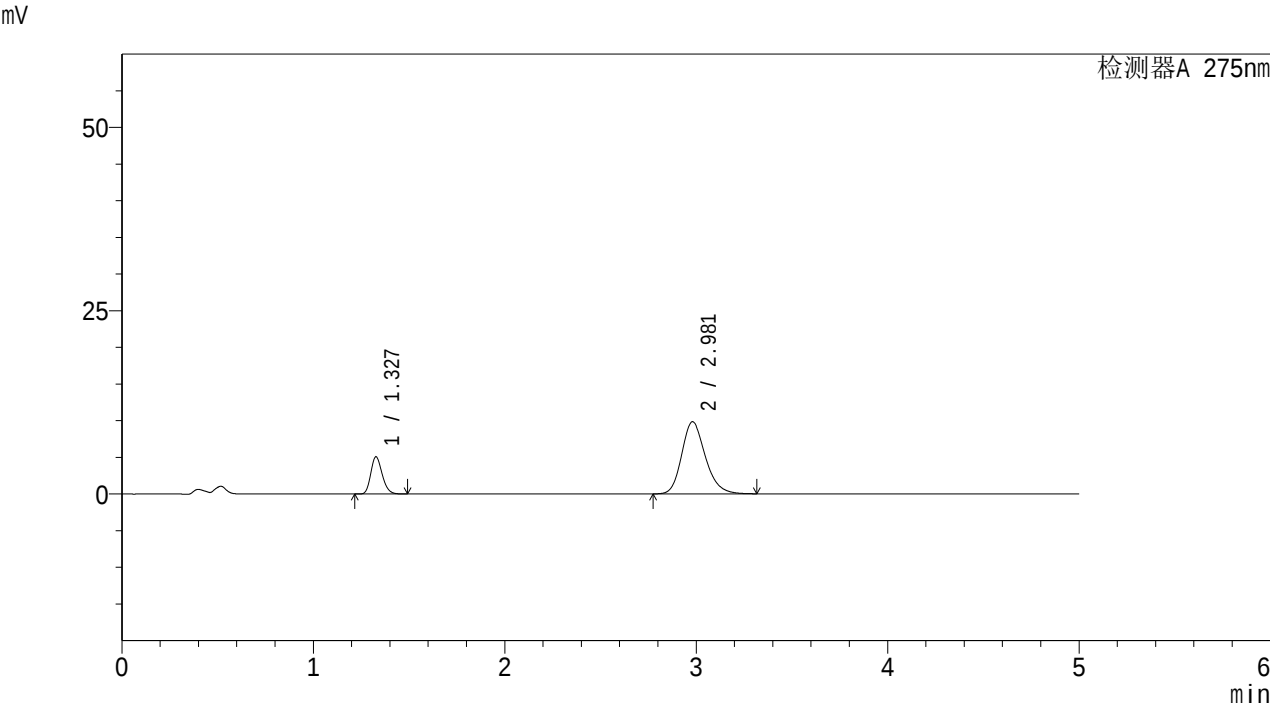

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	20967	19.779	5051	2386	1.205	--
2	2.981	85040	80.221	9846	2835	1.209	9.942
总计		106006	100.000	14897			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-37-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:31:57
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

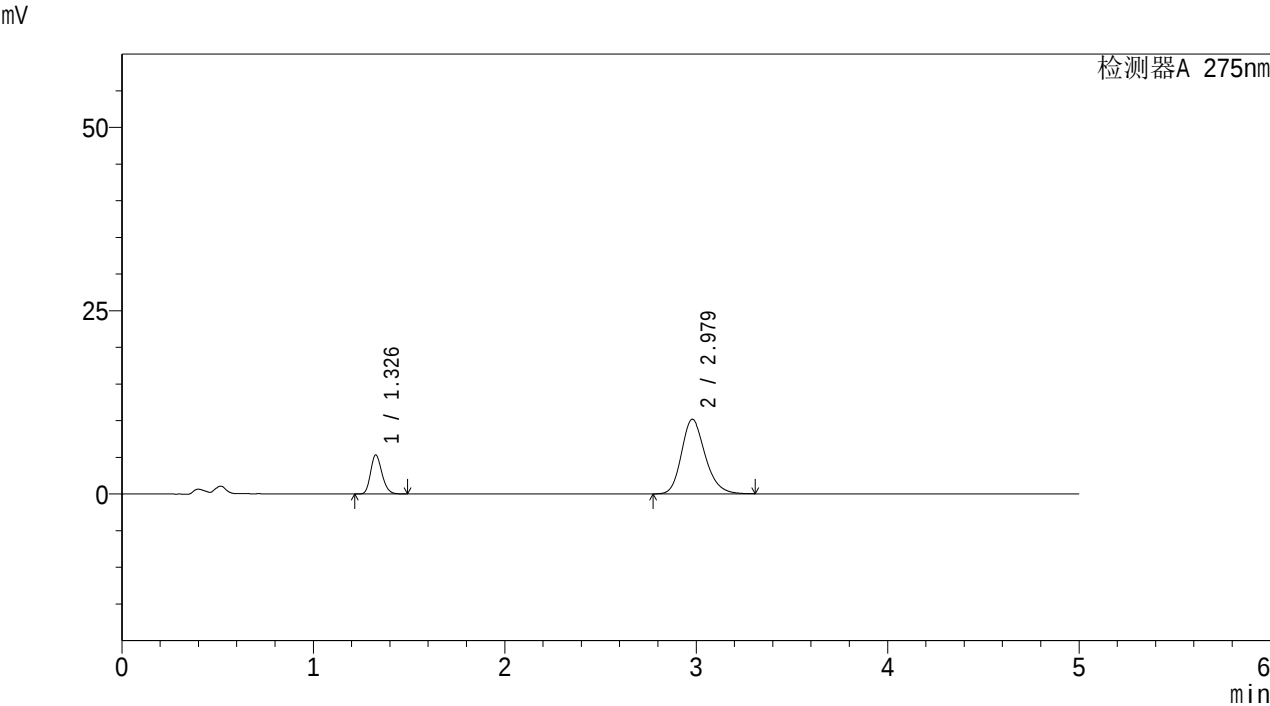

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	21943	19.951	5264	2385	1.202	--
2	2.979	88038	80.049	10185	2828	1.212	9.939
总计		109980	100.000	15449			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-38-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:37:21
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

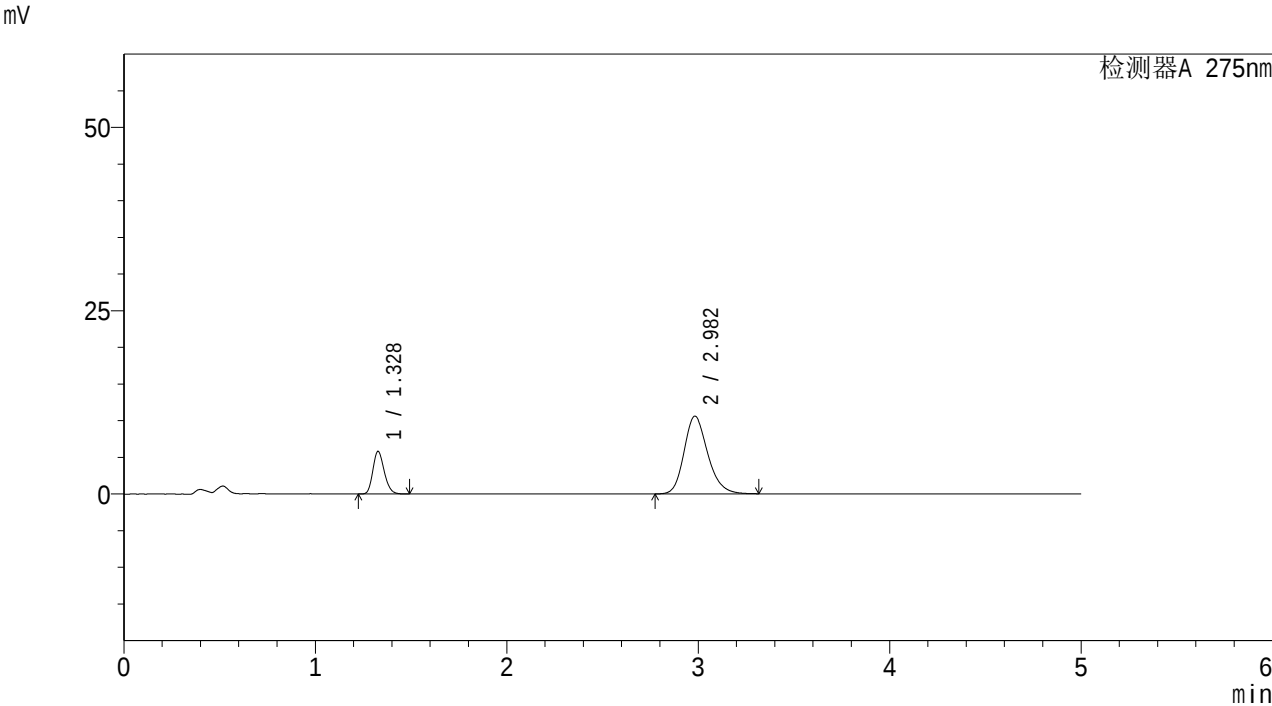

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	23999	20.757	5793	2390	1.199	--
2	2.982	91623	79.243	10596	2842	1.212	9.957
总计		115622	100.000	16390			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-39-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:42:44
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

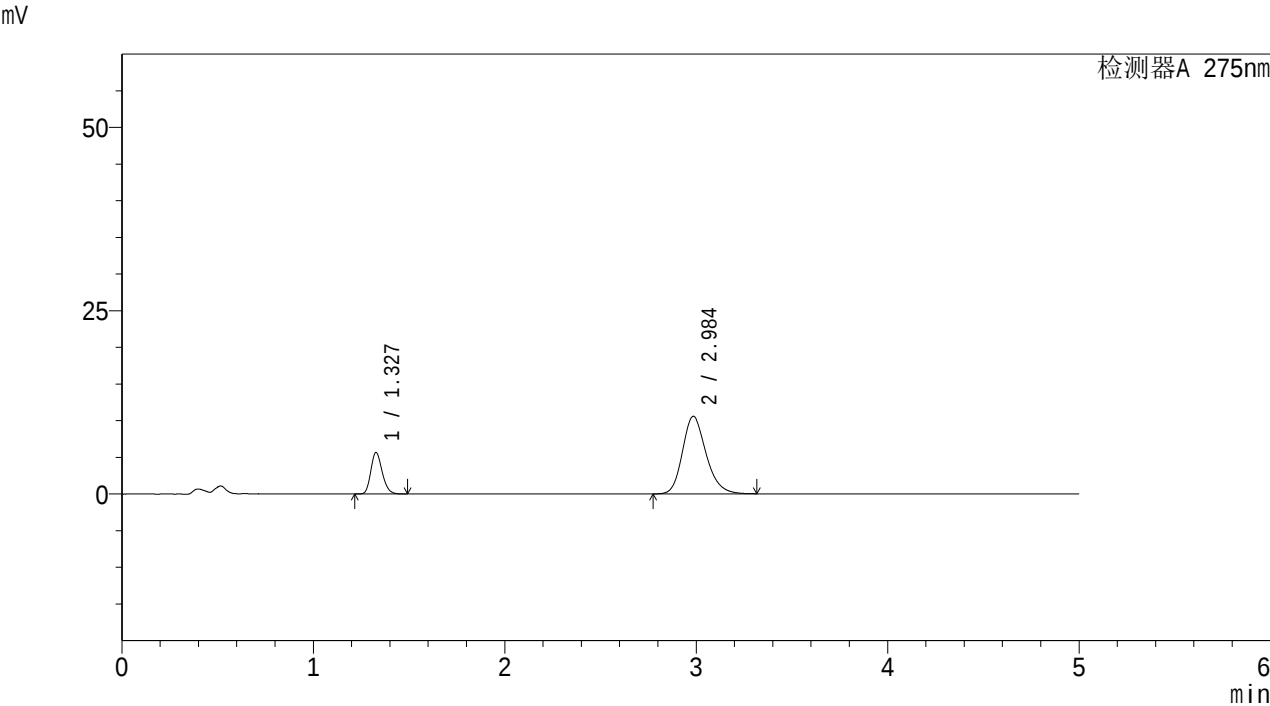

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	23399	20.385	5643	2394	1.202	--
2	2.984	91385	79.615	10560	2845	1.211	9.973
总计		114784	100.000	16203			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-40-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:48:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

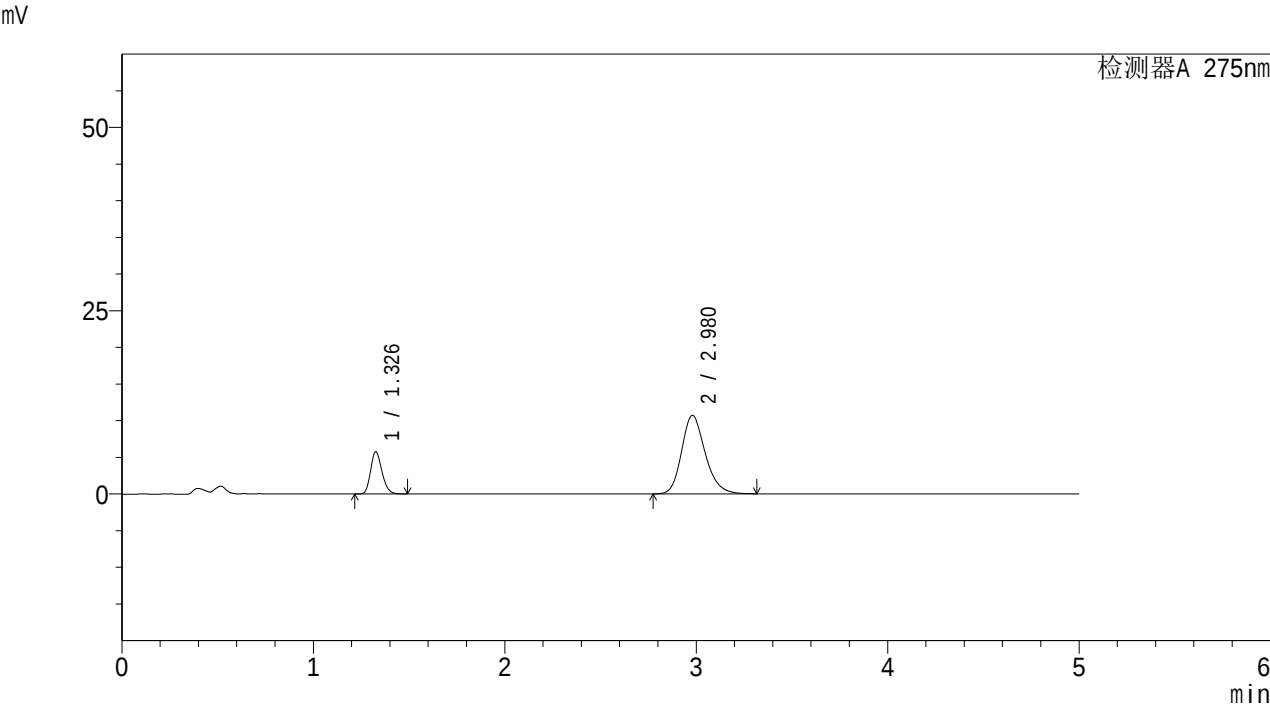

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	23764	20.441	5699	2386	1.205	--
2	2.980	92491	79.559	10710	2840	1.212	9.955
总计		116255	100.000	16409			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-41-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:53:30
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

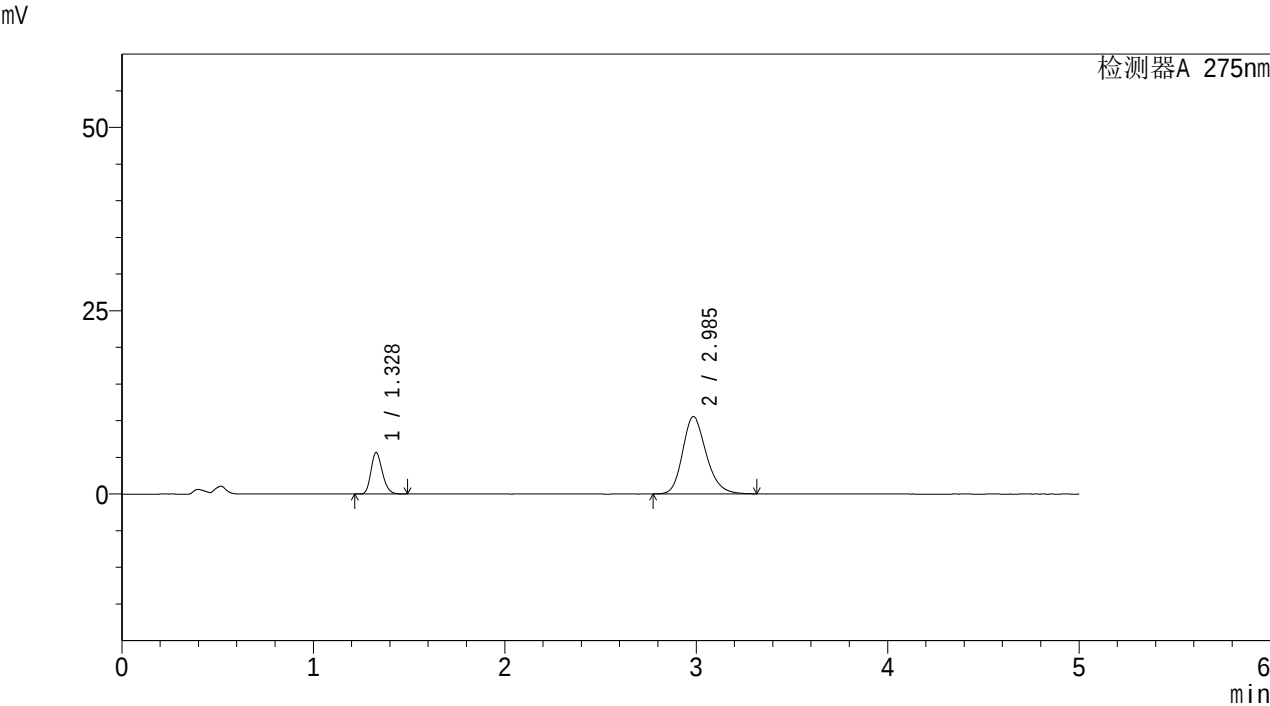

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	23318	20.384	5646	2398	1.201	--
2	2.985	91074	79.616	10534	2851	1.211	9.979
总计		114393	100.000	16180			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-42-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:58:52
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

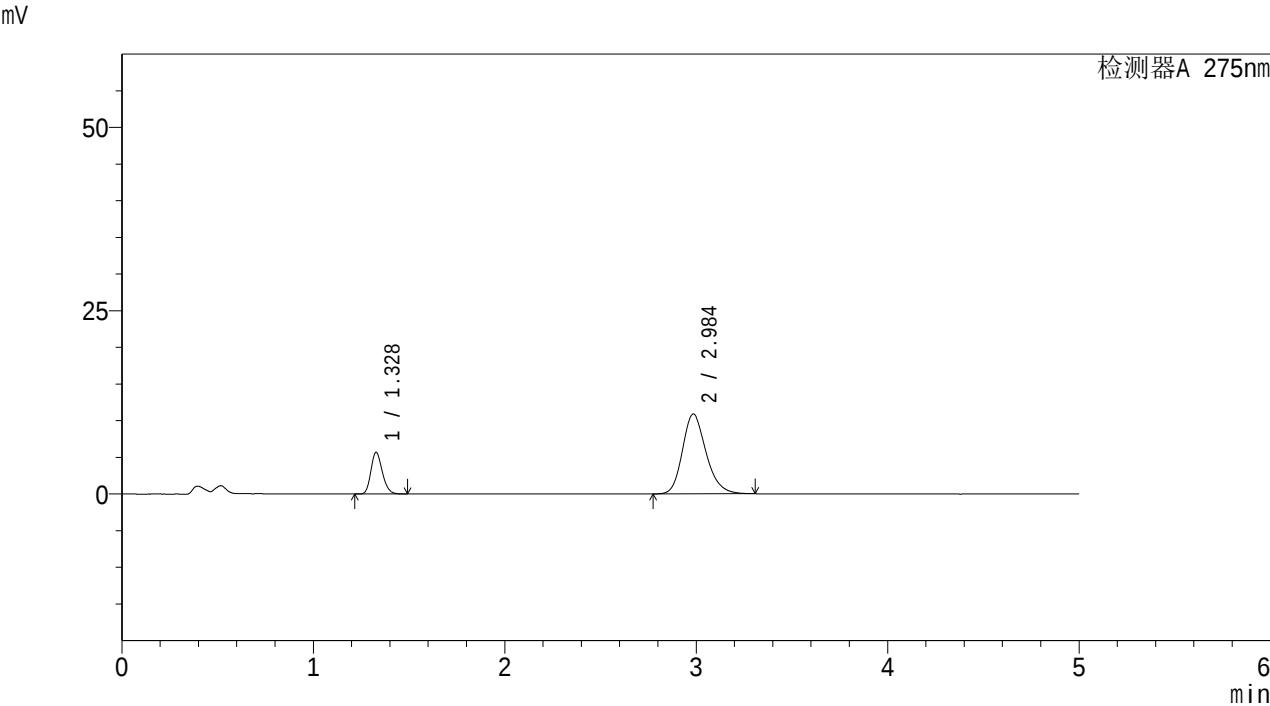

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	23507	19.983	5680	2391	1.201	--
2	2.984	94131	80.017	10867	2841	1.212	9.960
总计		117638	100.000	16546			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-43-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:04:14

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

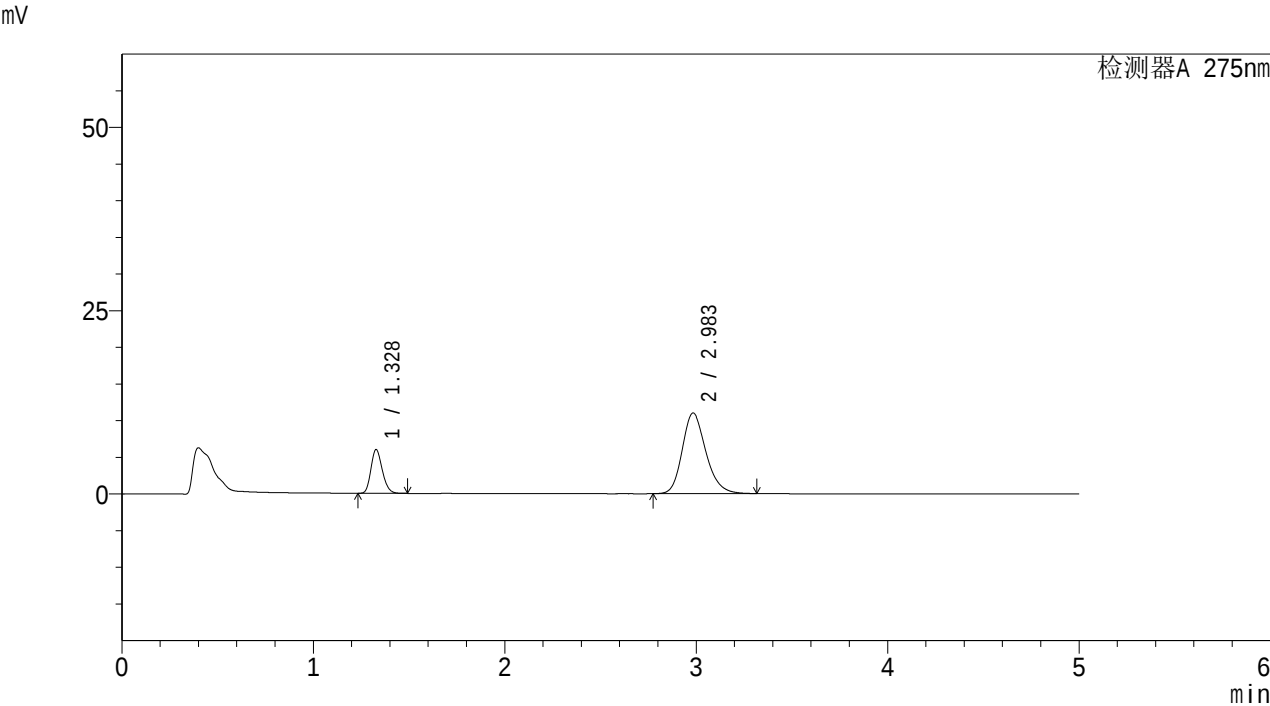

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	24573	20.537	5954	2404	1.201	--
2	2.983	95078	79.463	10983	2839	1.213	9.963
总计		119650	100.000	16937			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-44-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:09:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

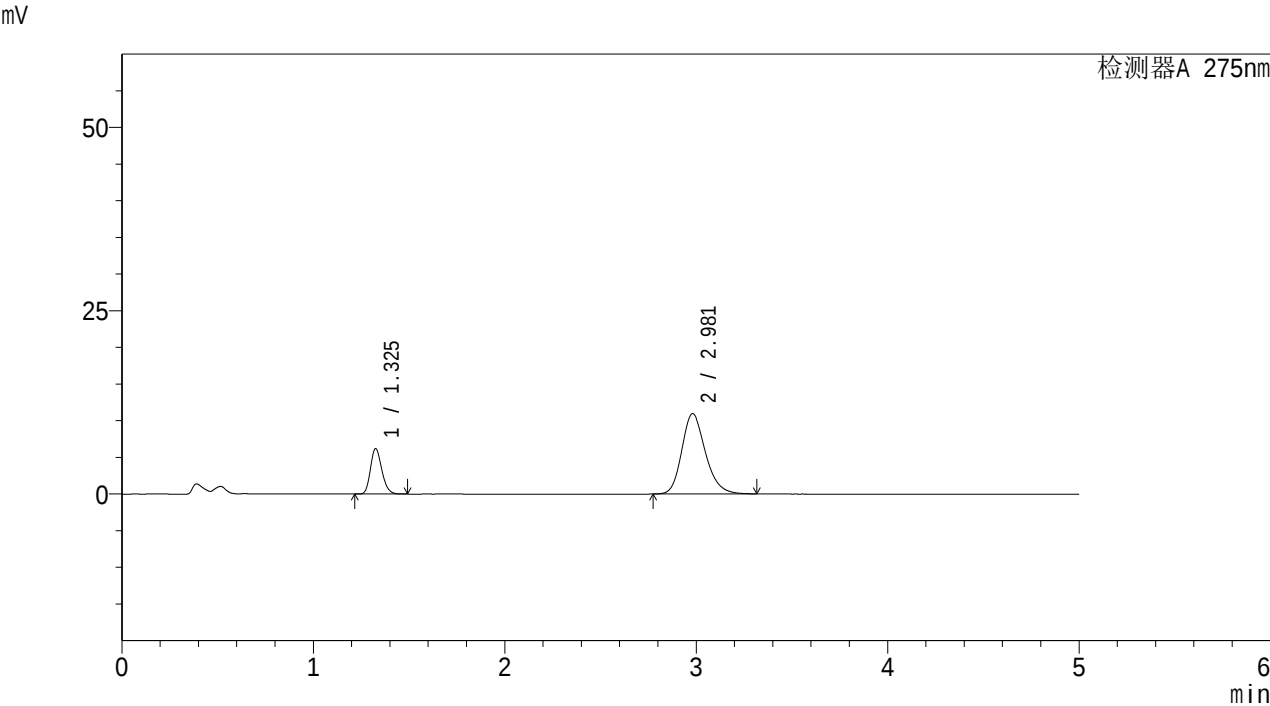

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	25581	21.292	6156	2393	1.204	--
2	2.981	94566	78.708	10957	2838	1.213	9.968
总计		120148	100.000	17113			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-45-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:14:59

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

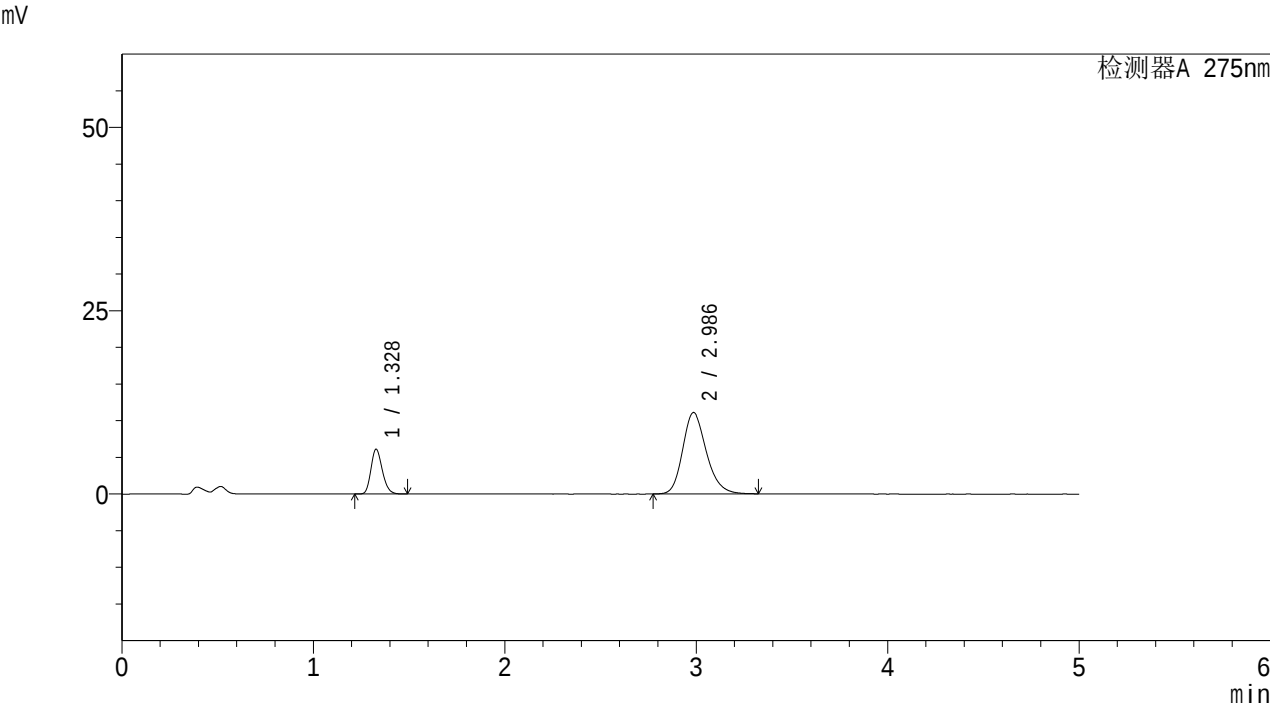

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	25220	20.785	6099	2397	1.200	--
2	2.986	96120	79.215	11098	2840	1.214	9.968
总计		121340	100.000	17197			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-46-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:20:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:54:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

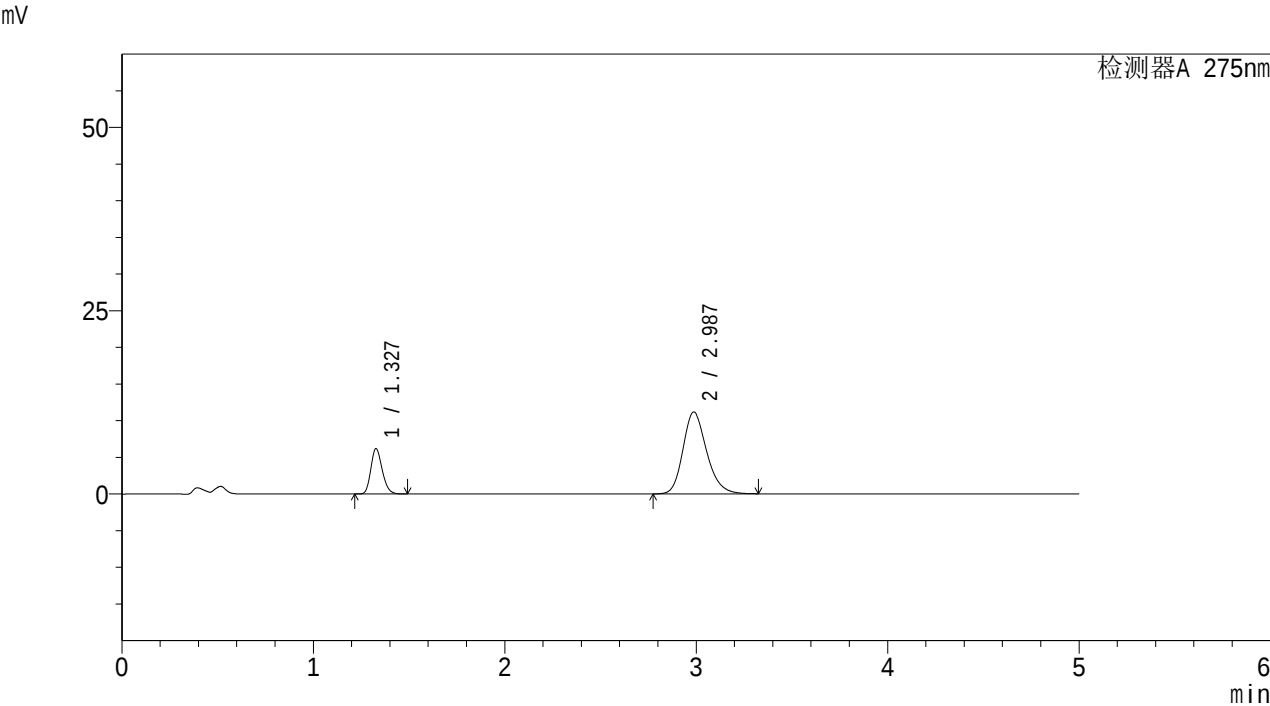

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	25493	20.851	6156	2387	1.200	--
2	2.987	96770	79.149	11181	2842	1.213	9.973
总计		122263	100.000	17337			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-47-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:25:45

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

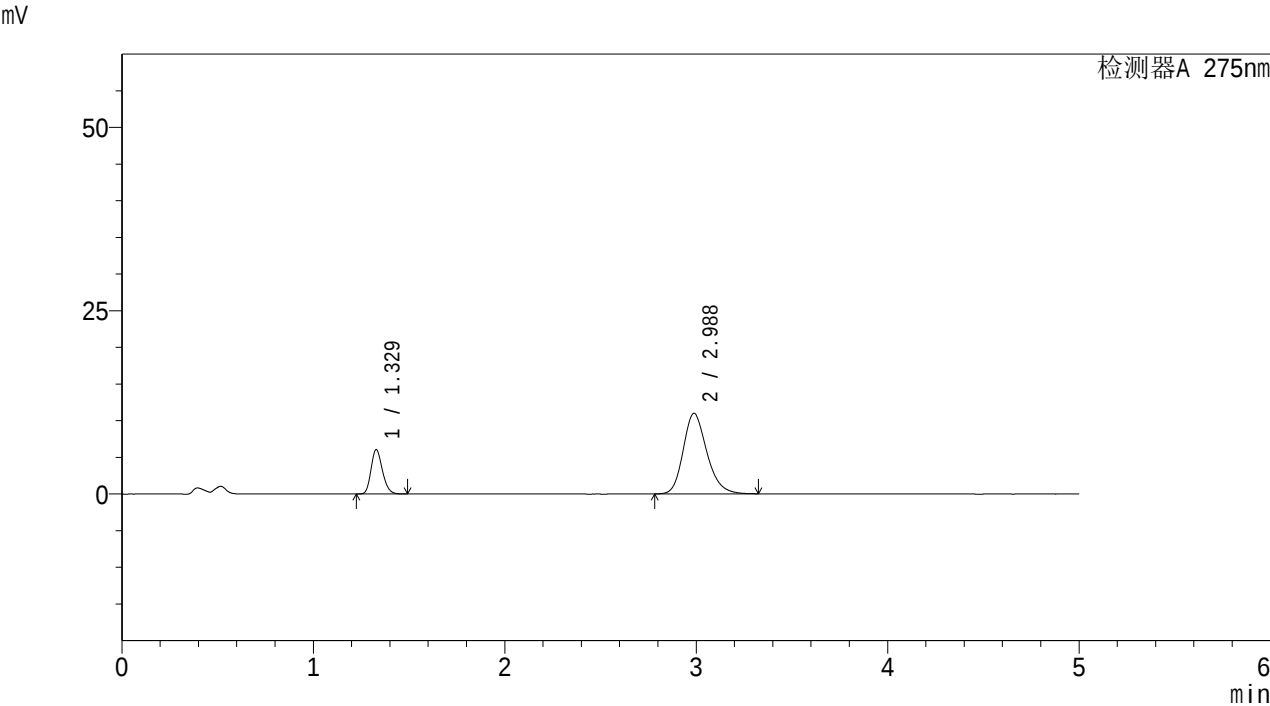

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	24991	20.814	6047	2394	1.200	--
2	2.988	95078	79.186	10992	2845	1.214	9.977
总计		120069	100.000	17039			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-48-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:31:07

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

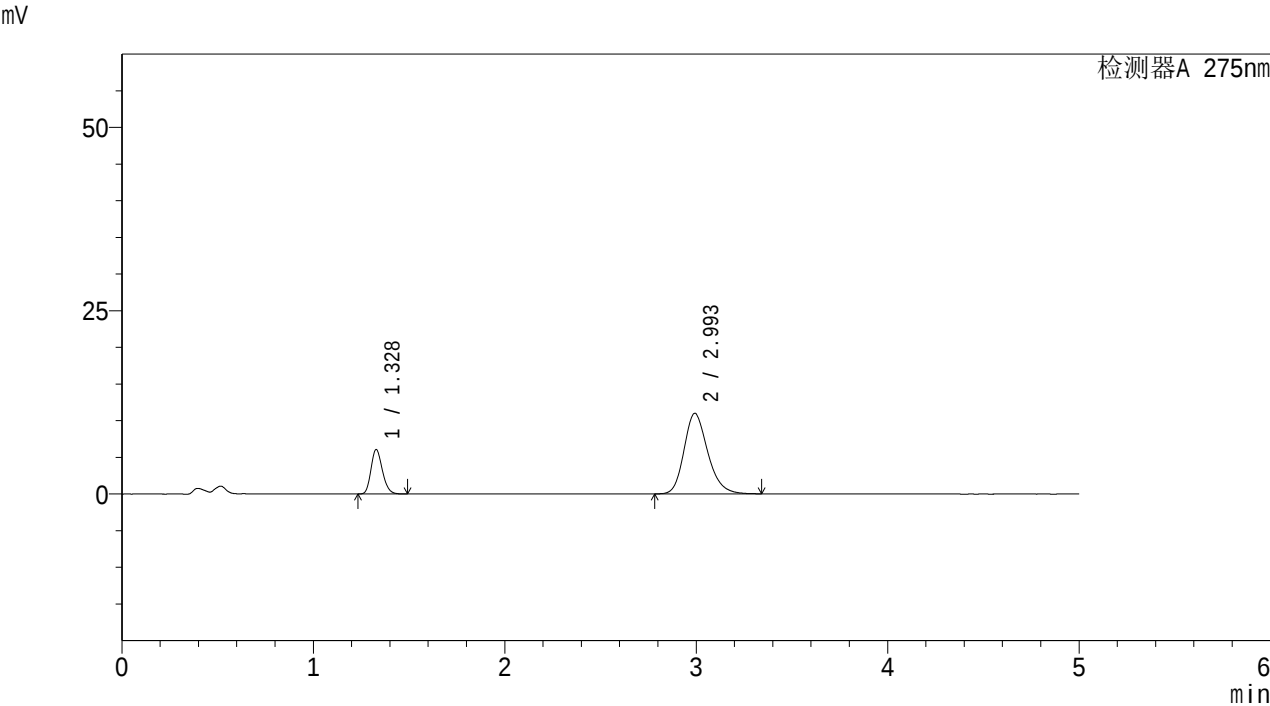

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	25059	20.782	6057	2387	1.197	--
2	2.993	95525	79.218	10976	2837	1.216	9.982
总计		120585	100.000	17033			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-49-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:36:29

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

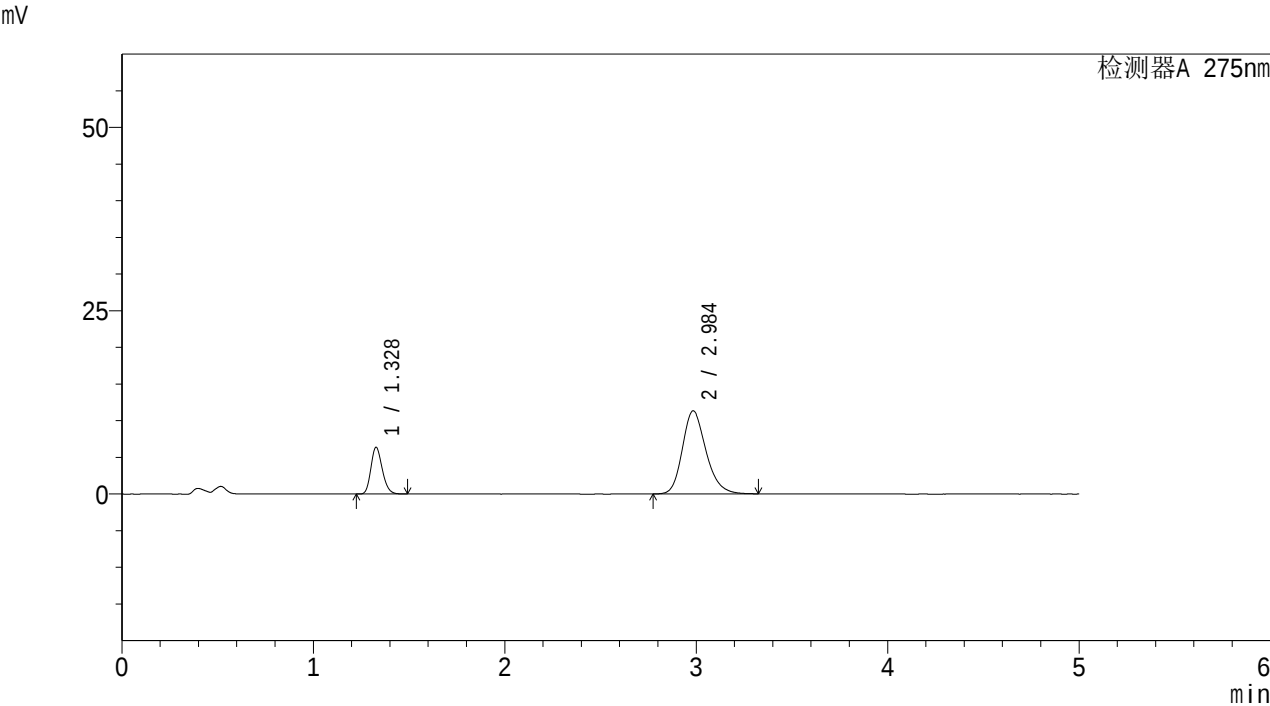

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	26231	21.121	6348	2393	1.199	--
2	2.984	97962	78.879	11313	2843	1.216	9.963
总计		124194	100.000	17661			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-50-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:41:53
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

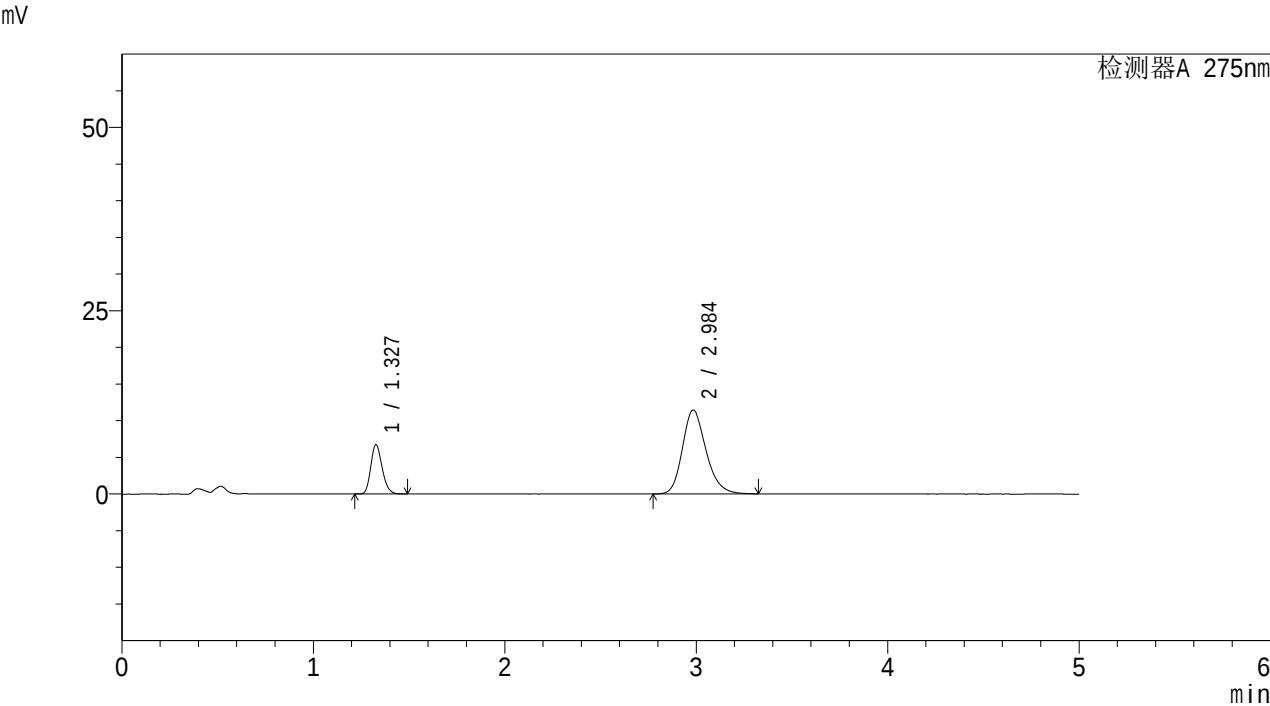

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	27706	21.903	6689	2398	1.201	--
2	2.984	98786	78.097	11416	2851	1.214	9.983
总计		126492	100.000	18106			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-51-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:47:17

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

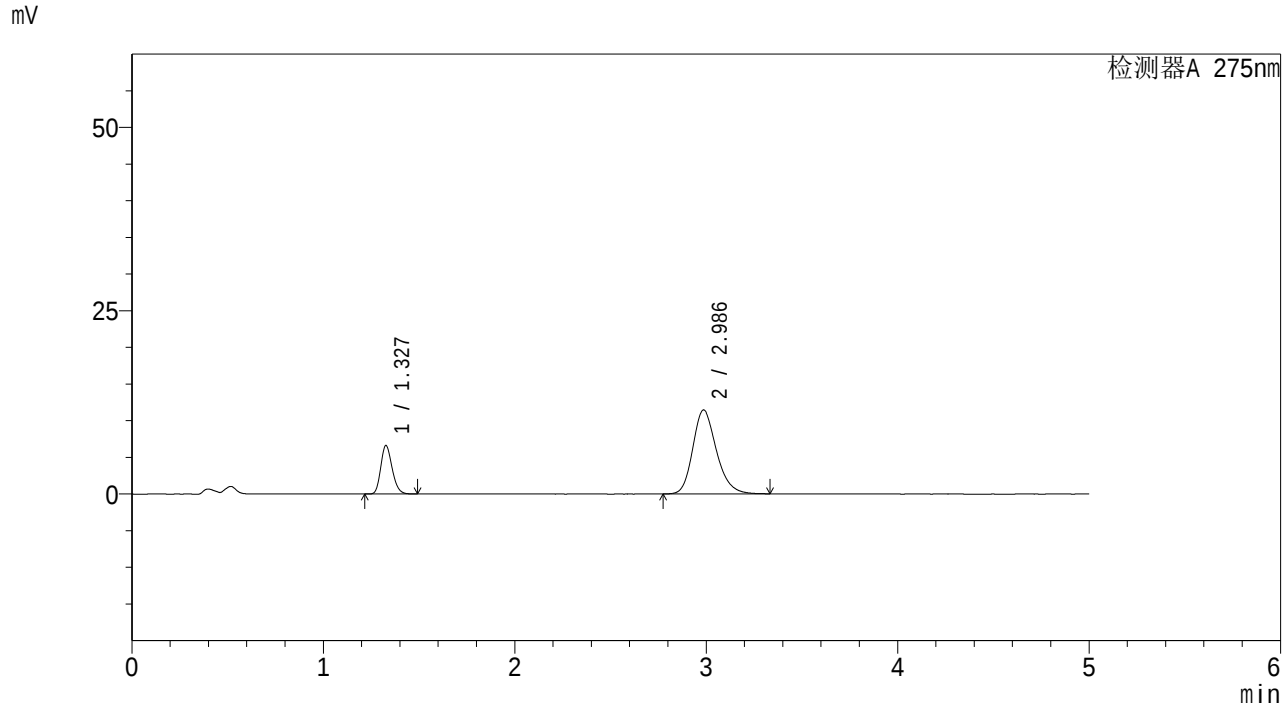

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	27259	21.596	6575	2394	1.200	--
2	2.986	98961	78.404	11446	2851	1.216	9.989
总计		126219	100.000	18022			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-52-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:52:40
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

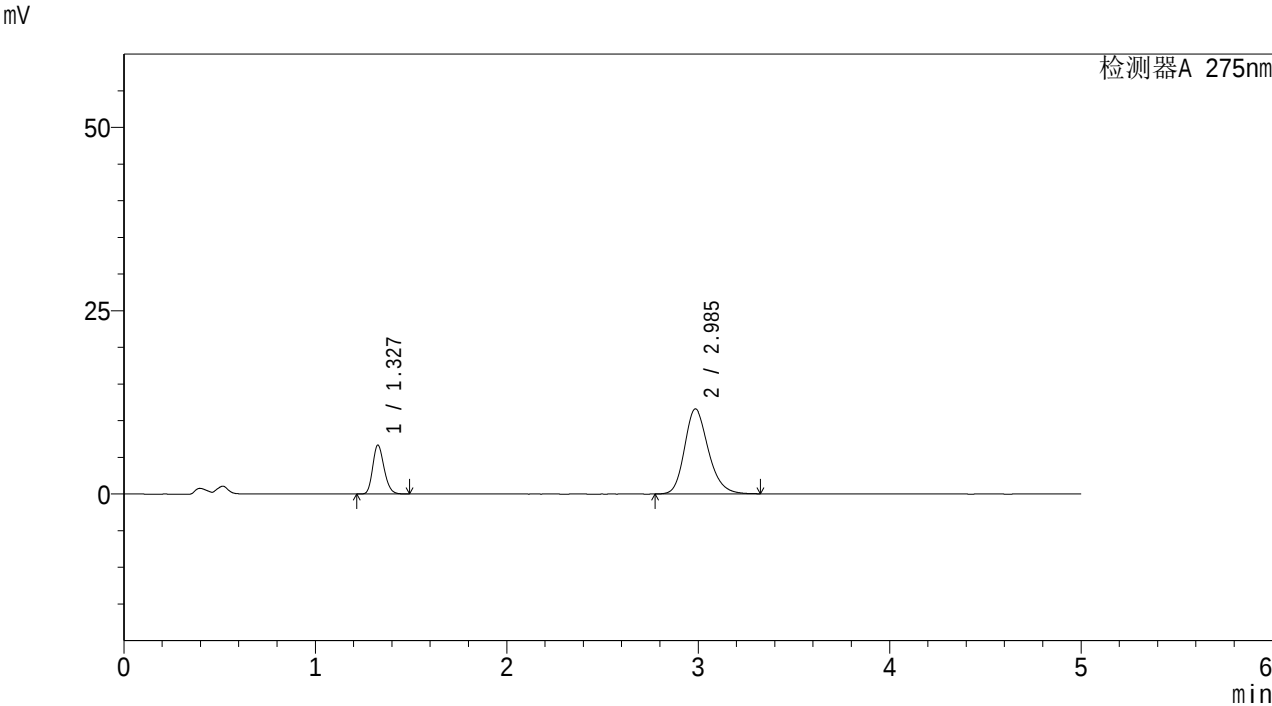

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	27453	21.445	6623	2400	1.200	--
2	2.985	100563	78.555	11583	2827	1.215	9.964
总计		128017	100.000	18206			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-53-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:58:04
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

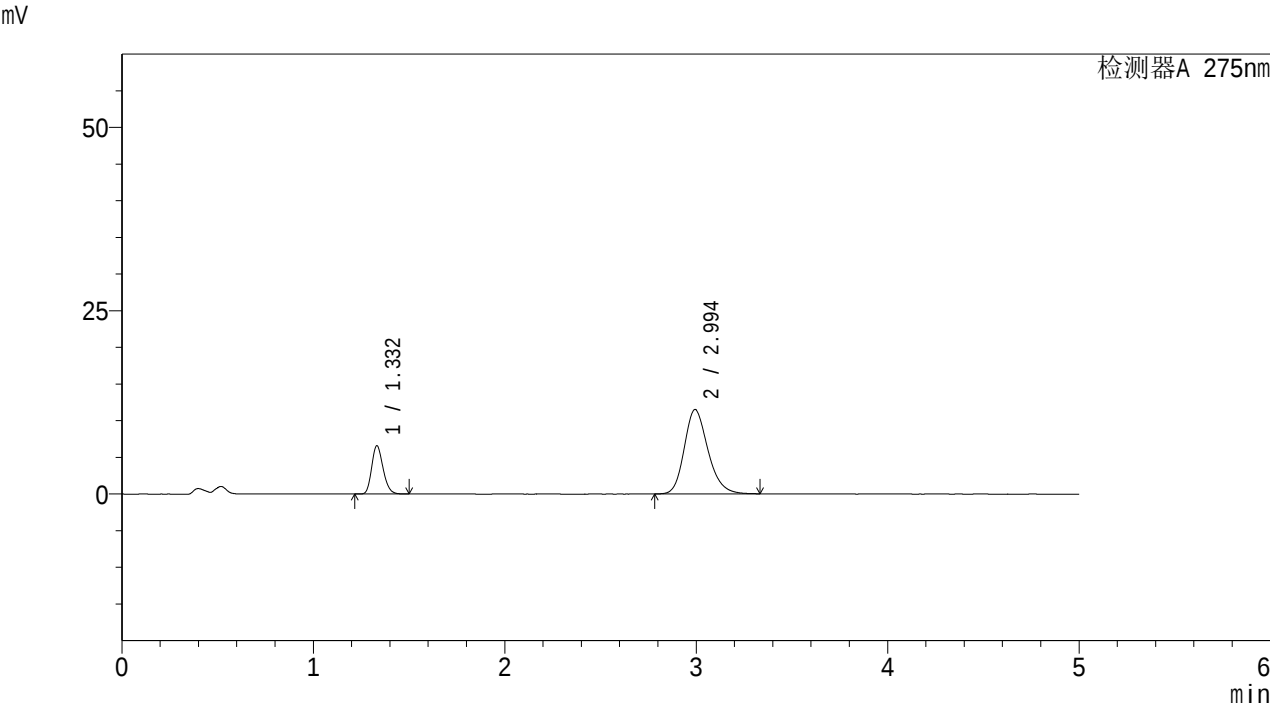

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	27221	21.428	6578	2401	1.201	--
2	2.994	99815	78.572	11513	2845	1.215	9.975
总计		127036	100.000	18091			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-54-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:03:27

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

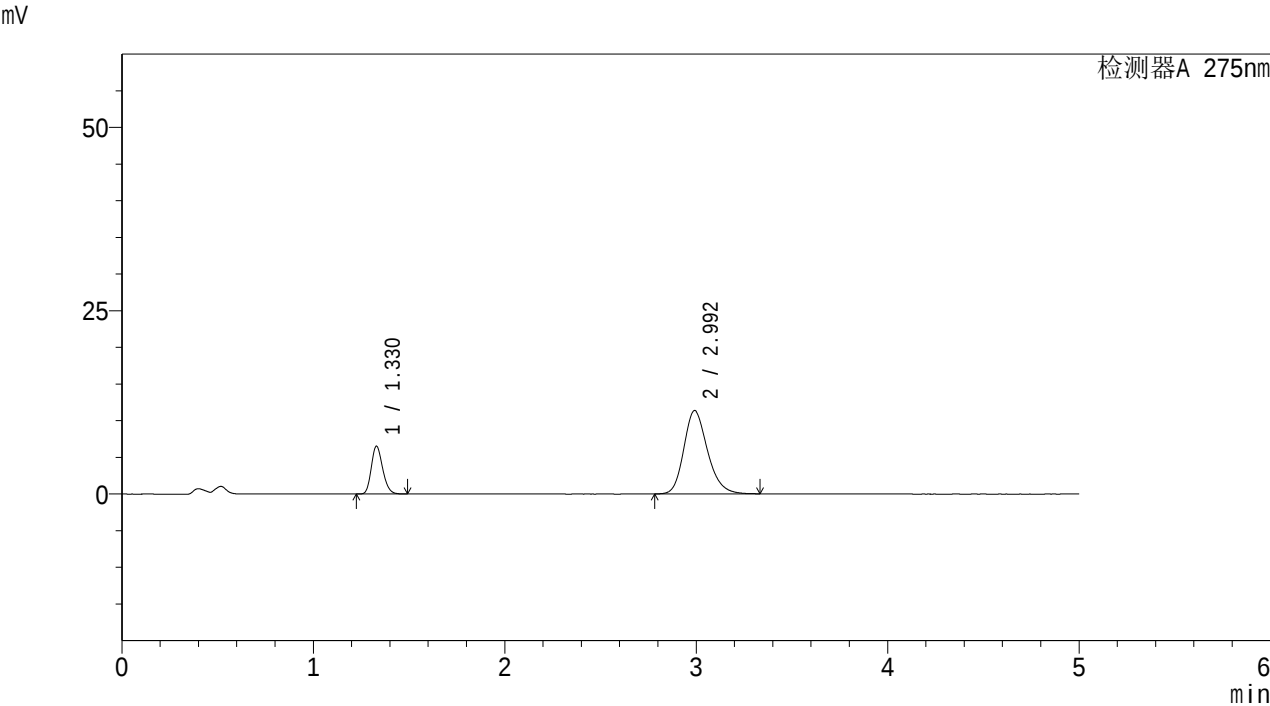

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	26870	21.431	6529	2407	1.200	--
2	2.992	98509	78.569	11359	2845	1.215	9.988
总计		125379	100.000	17889			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-55-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:08:51

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

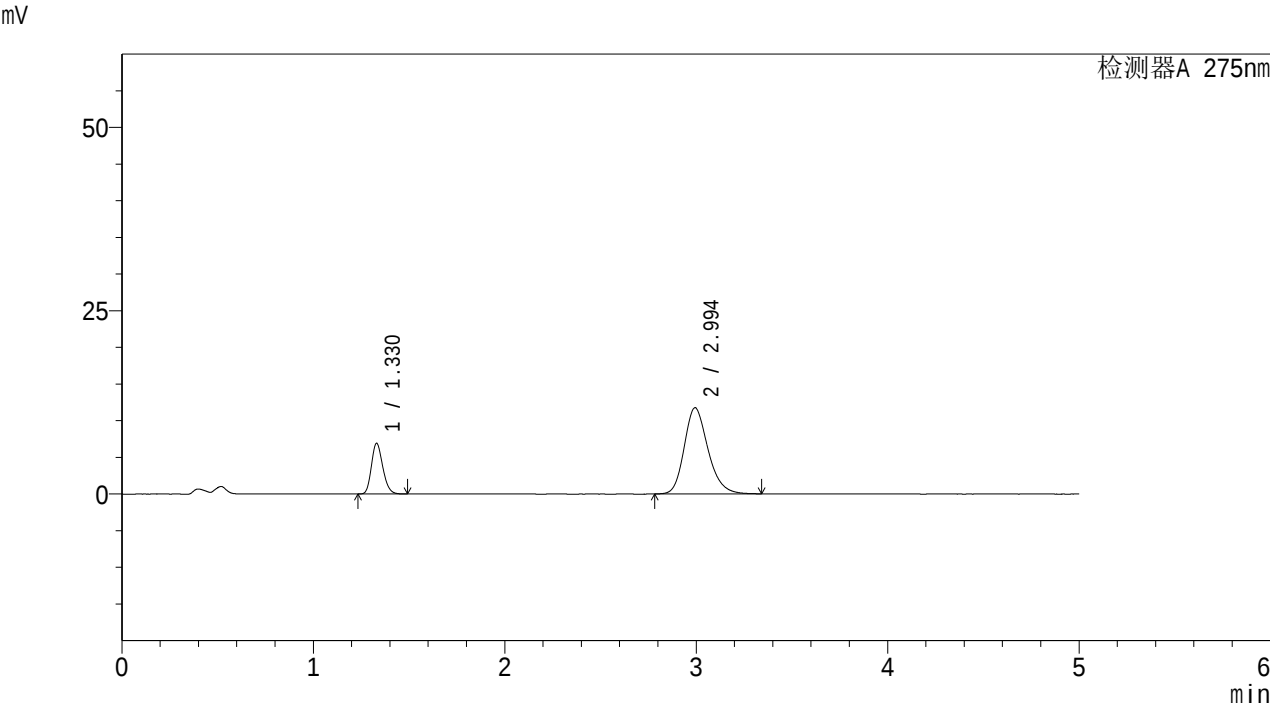

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28494	21.794	6917	2406	1.200	--
2	2.994	102248	78.206	11753	2834	1.217	9.977
总计		130742	100.000	18670			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-56-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:14:14
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

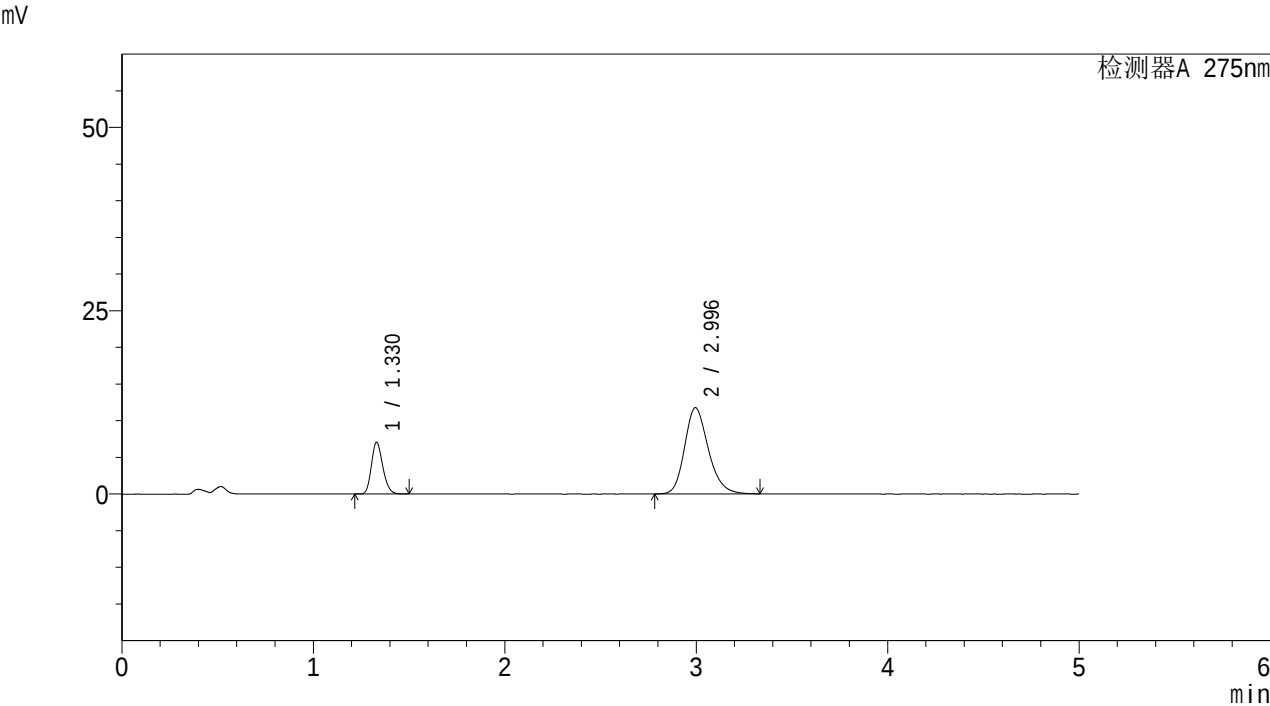

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	29134	22.207	7058	2396	1.198	--
2	2.996	102060	77.793	11779	2848	1.216	9.995
总计		131194	100.000	18837			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-57-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:19:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

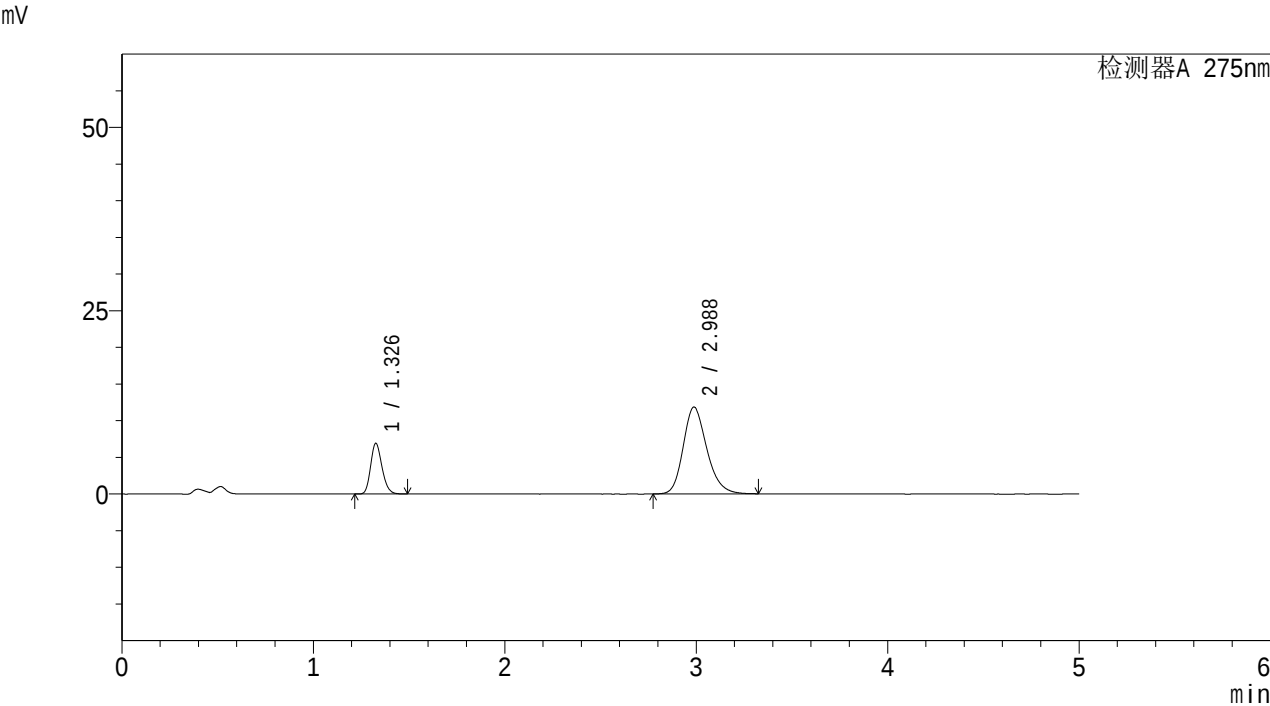

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	28512	21.774	6852	2393	1.202	--
2	2.988	102431	78.226	11853	2852	1.214	10.004
总计		130942	100.000	18705			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-58-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:24:59
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

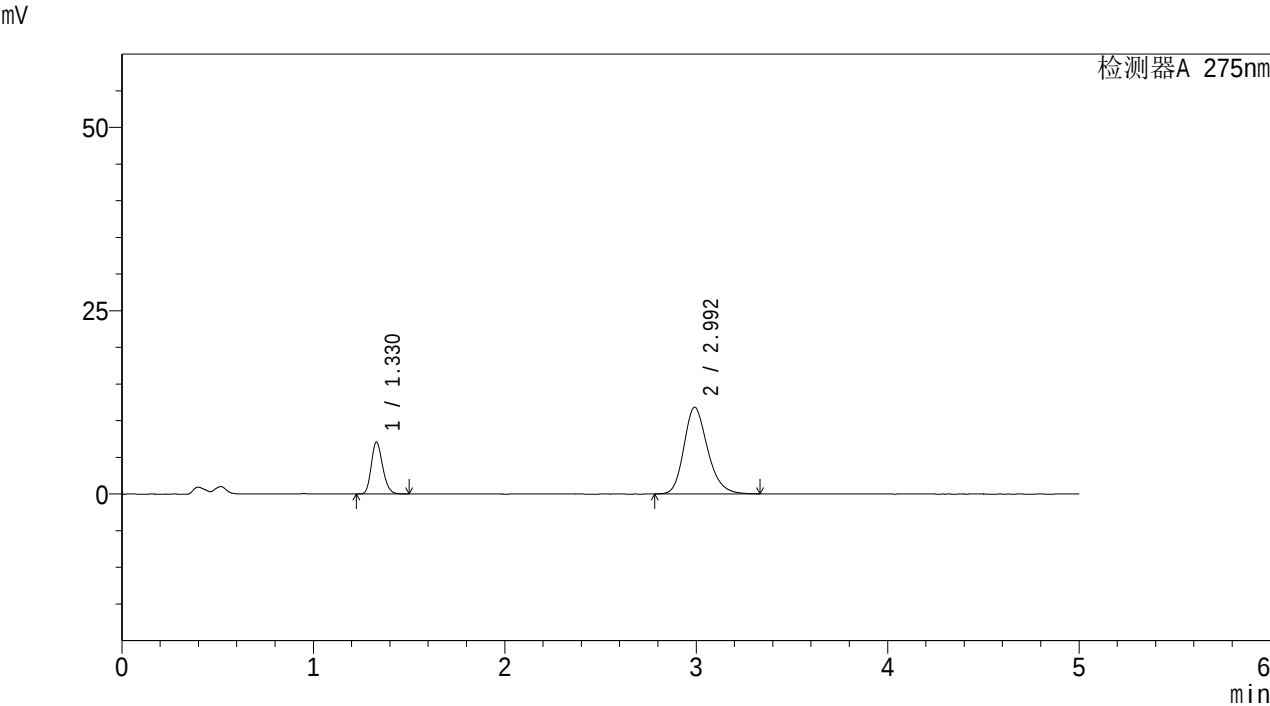

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	29256	22.238	7097	2402	1.199	--
2	2.992	102301	77.762	11812	2856	1.215	10.000
总计		131558	100.000	18909			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-59-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:30:21

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

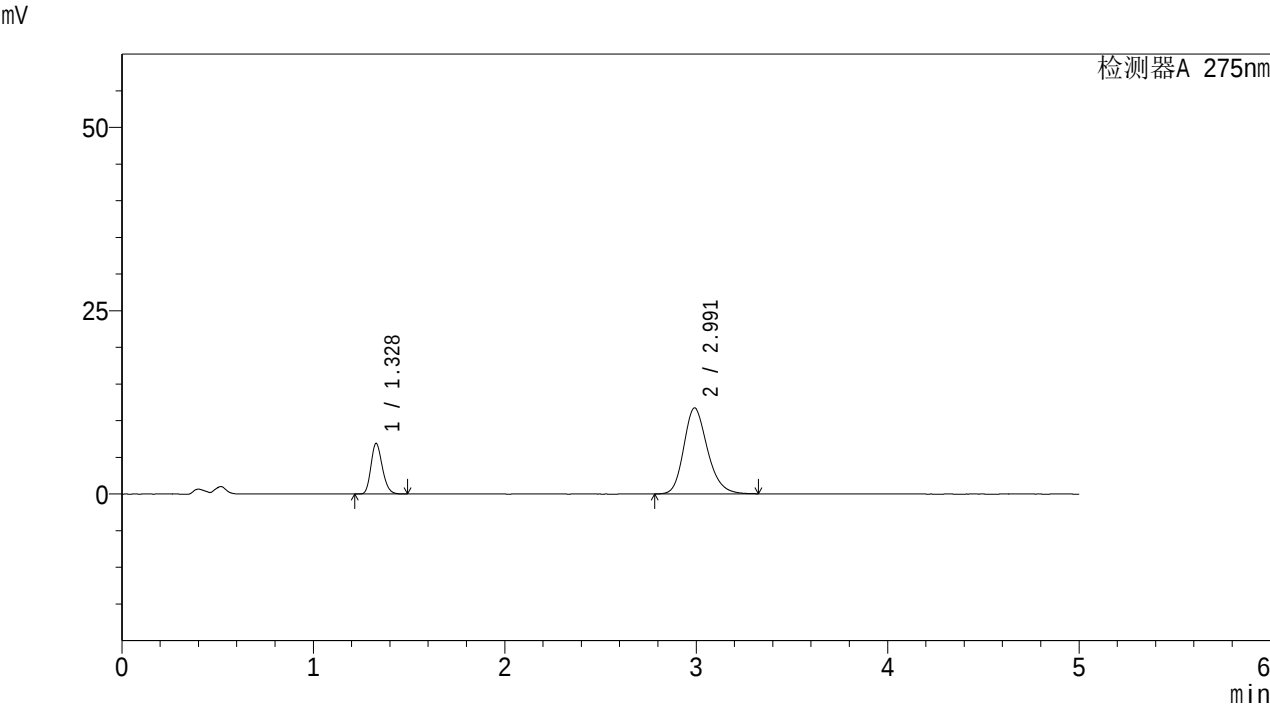

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	28463	21.900	6889	2396	1.200	--
2	2.991	101504	78.100	11720	2847	1.213	9.997
总计		129967	100.000	18609			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-60-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:35:44

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

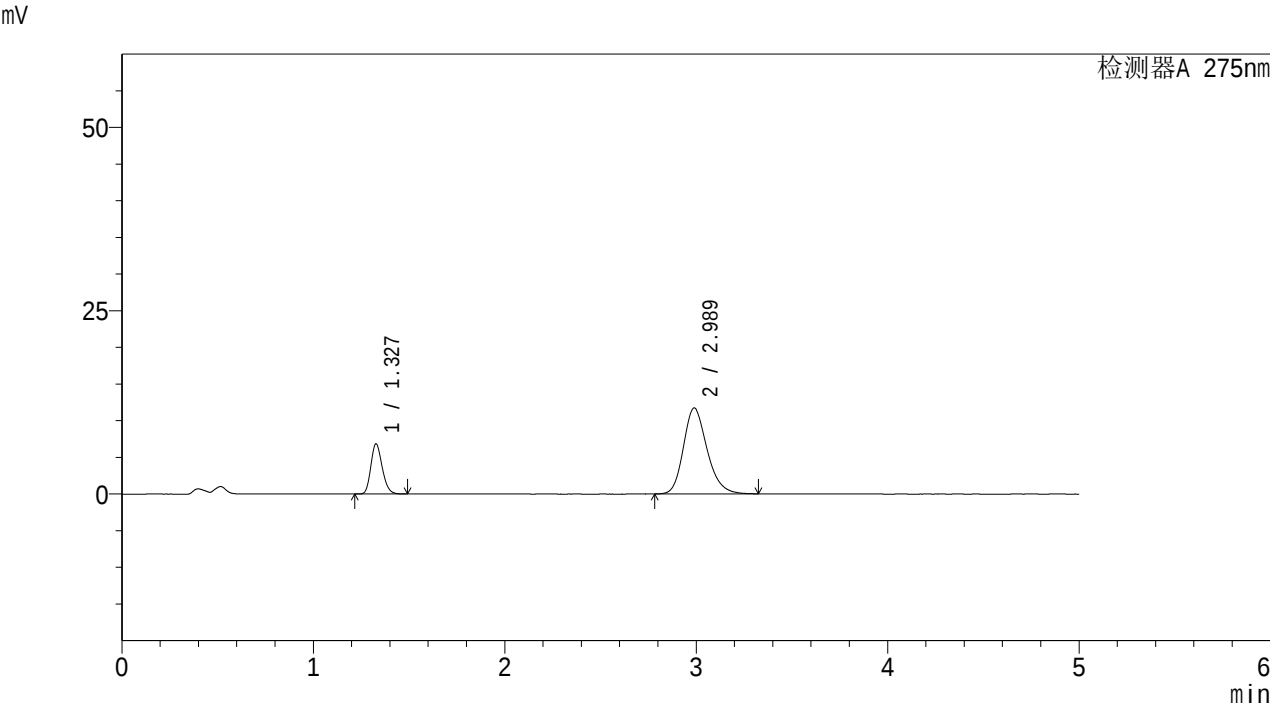

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	28180	21.747	6811	2397	1.202	--
2	2.989	101399	78.253	11731	2851	1.215	10.000
总计		129579	100.000	18542			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-61-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:41:06
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

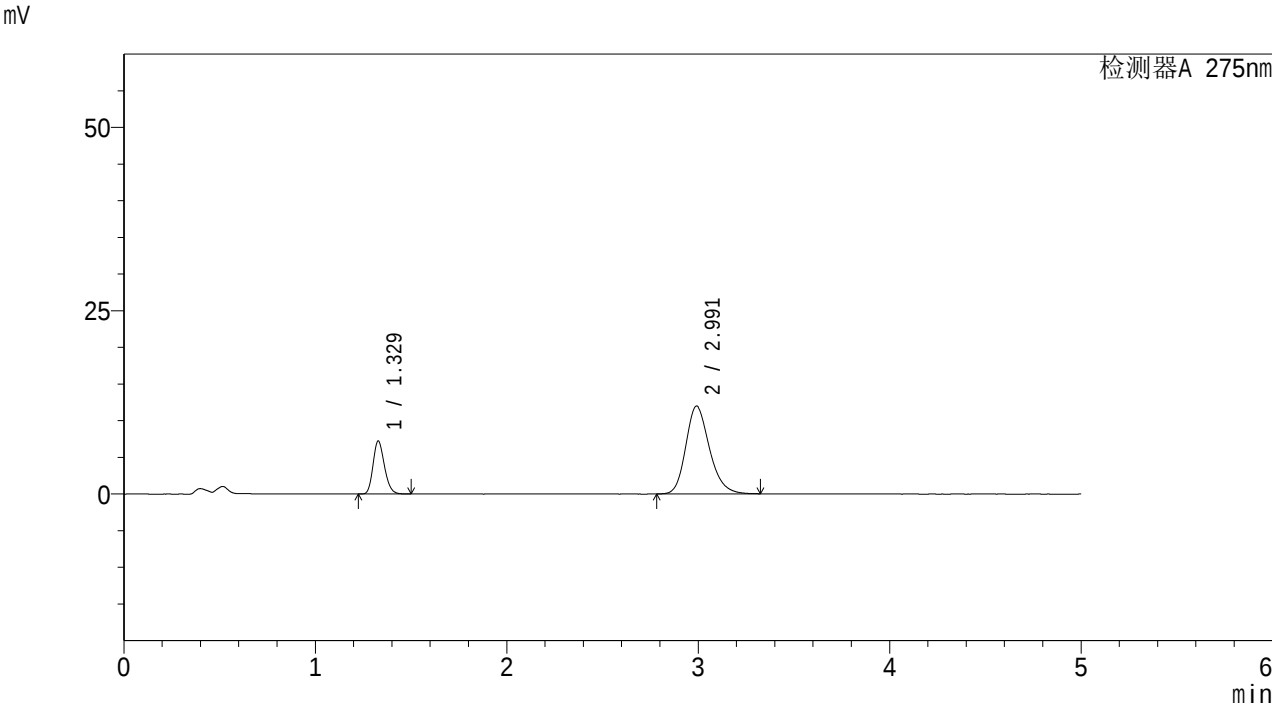

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	29809	22.326	7217	2400	1.199	--
2	2.991	103710	77.674	11973	2846	1.215	9.993
总计		133519	100.000	19190			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-62-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:46:30

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

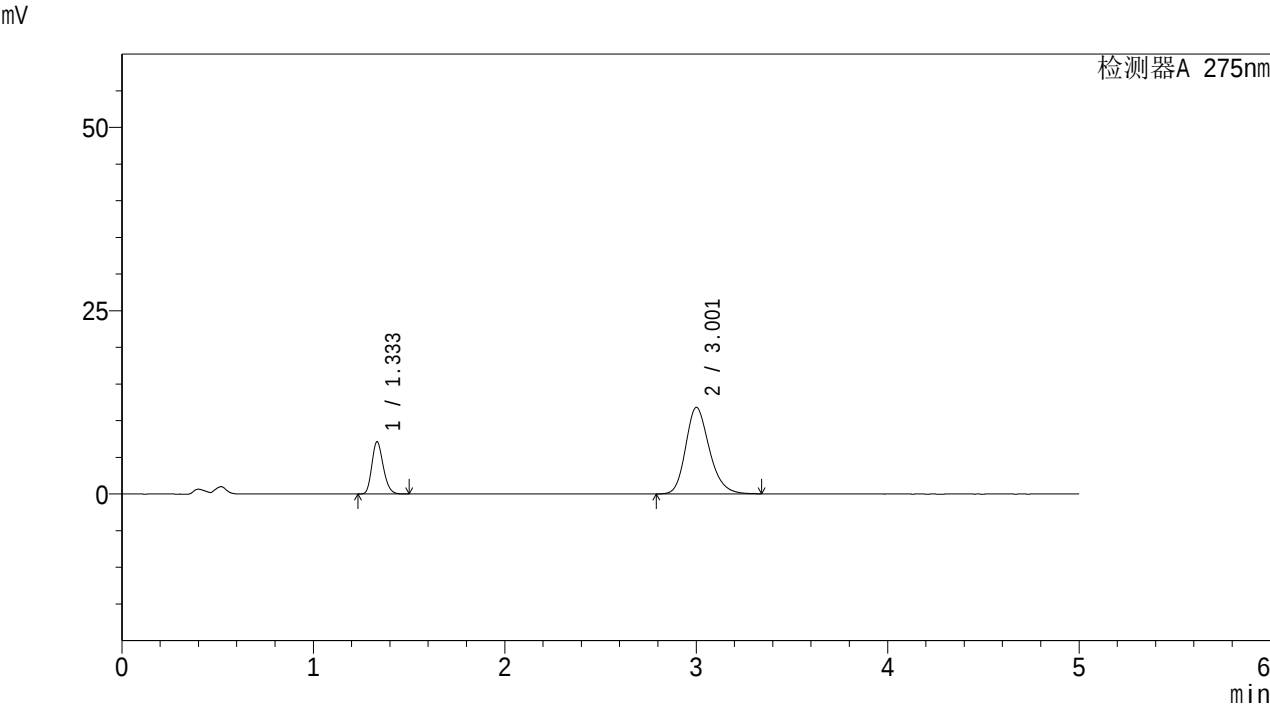

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.333	29429	22.352	7095	2401	1.202	--
2	3.001	102232	77.648	11800	2875	1.217	10.031
总计		131661	100.000	18895			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-63-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:51:53
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

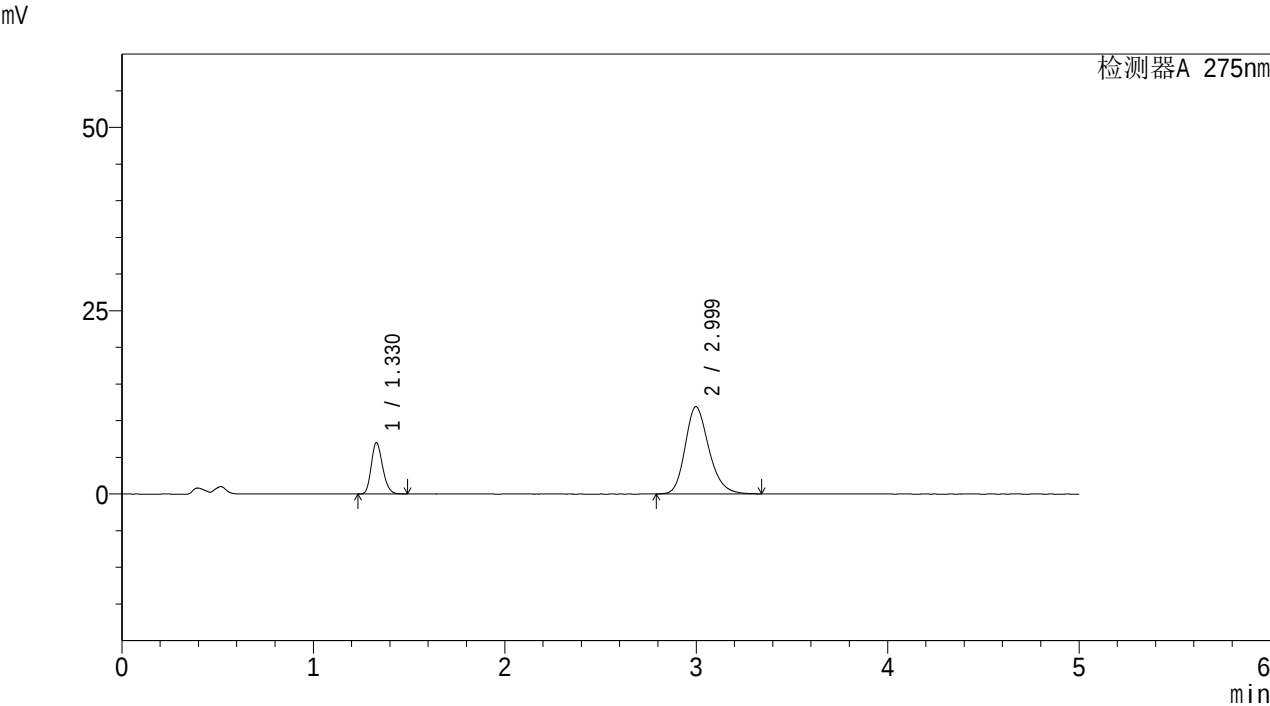

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28922	21.884	7018	2401	1.198	--
2	2.999	103239	78.116	11904	2852	1.216	10.020
总计		132160	100.000	18922			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-64-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:57:15

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

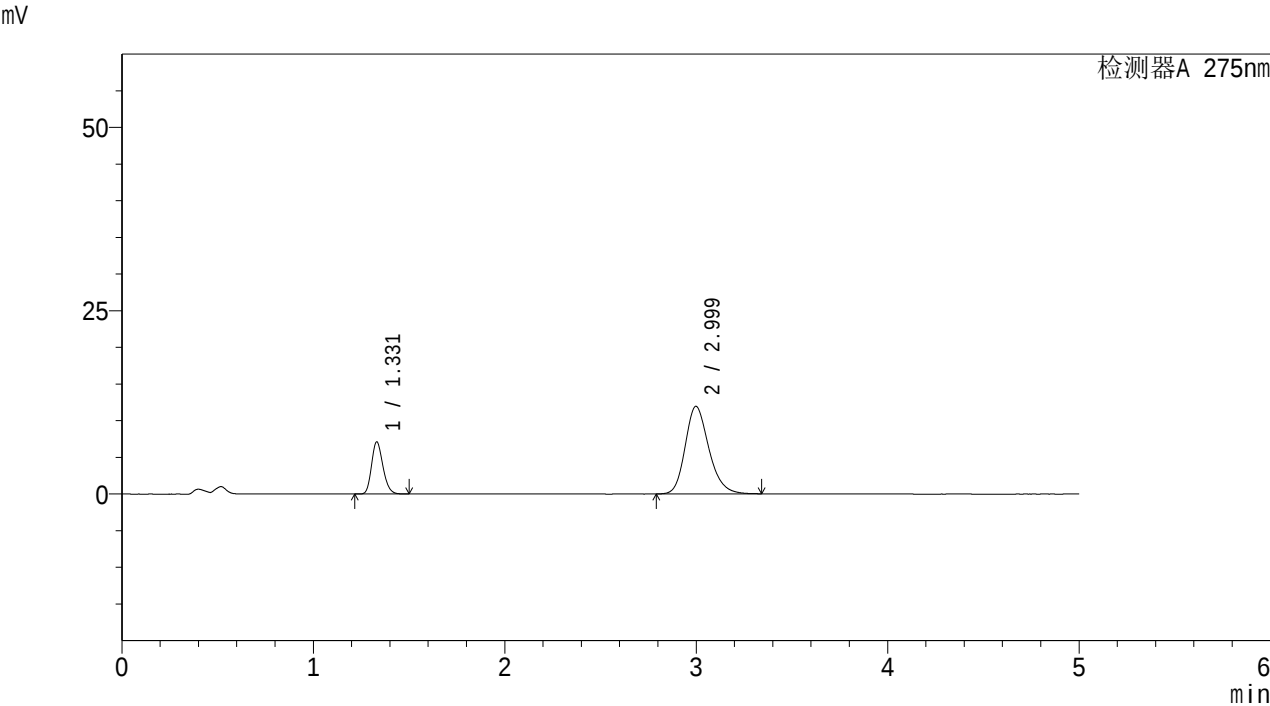

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	29344	22.085	7111	2403	1.200	--
2	2.999	103525	77.915	11964	2864	1.215	10.022
总计		132869	100.000	19074			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-65-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:02:39
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

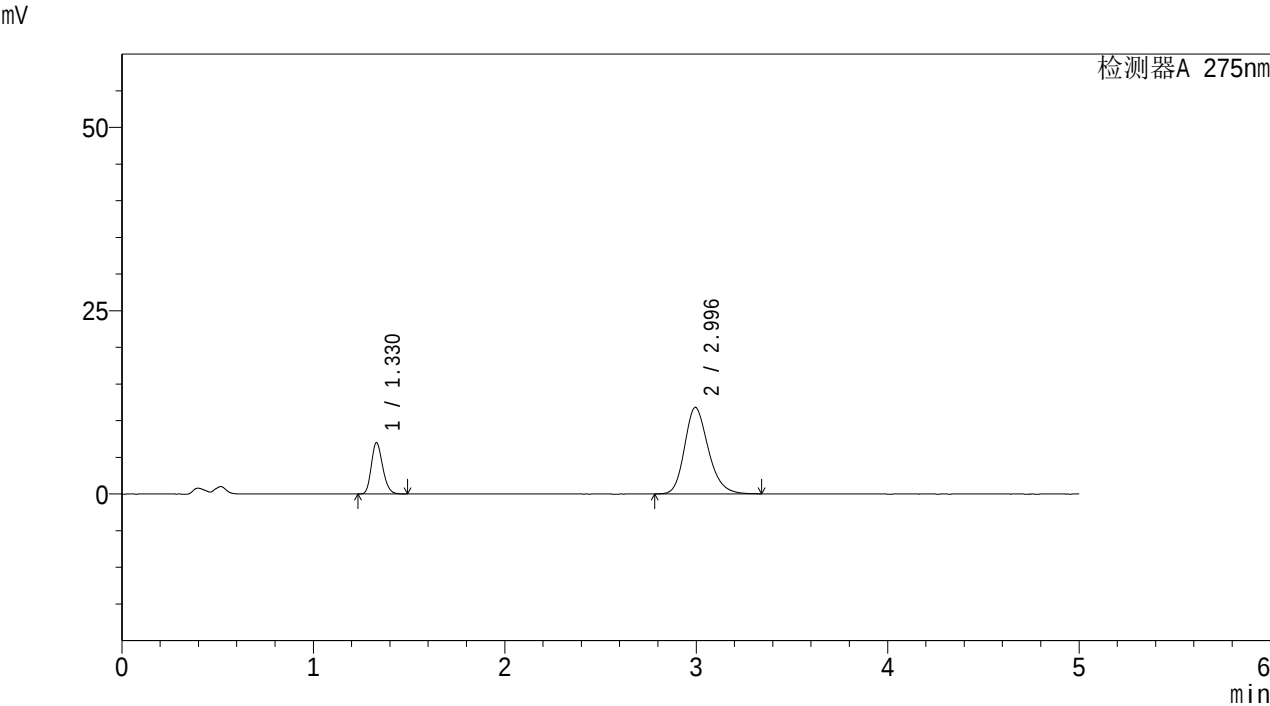

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28819	21.955	7006	2411	1.200	--
2	2.996	102447	78.045	11815	2846	1.216	10.006
总计		131265	100.000	18821			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-66-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:08:02

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

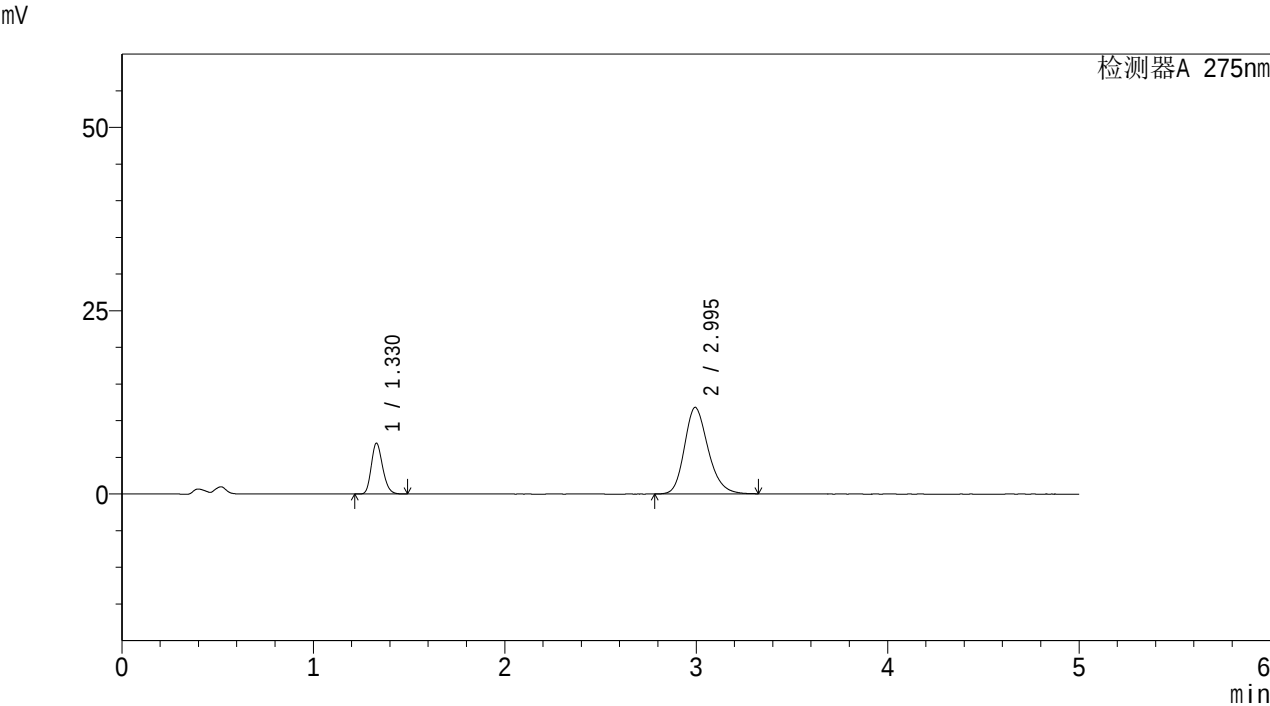

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28501	21.831	6931	2411	1.197	--
2	2.995	102052	78.169	11802	2857	1.215	10.017
总计		130553	100.000	18733			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-67-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:13:25

处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

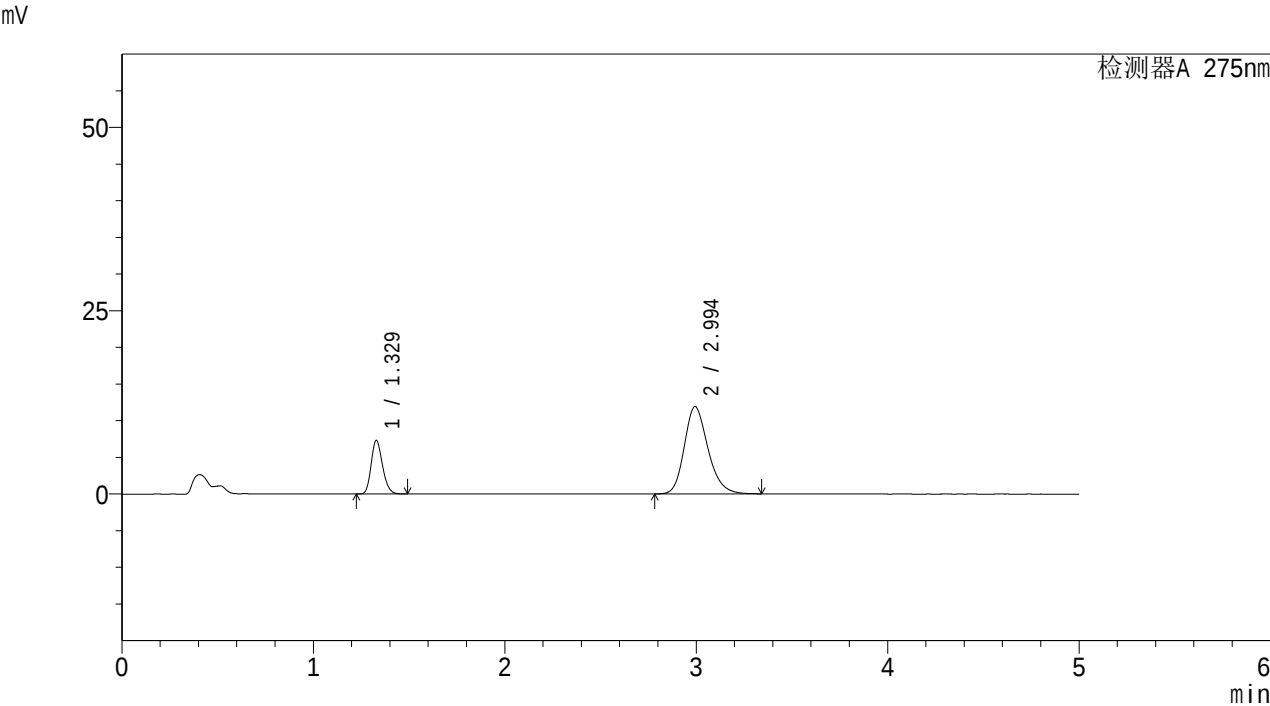

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	30096	22.582	7311	2405	1.197	--
2	2.994	103178	77.418	11914	2858	1.216	10.017
总计		133275	100.000	19225			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-68-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:18:48
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

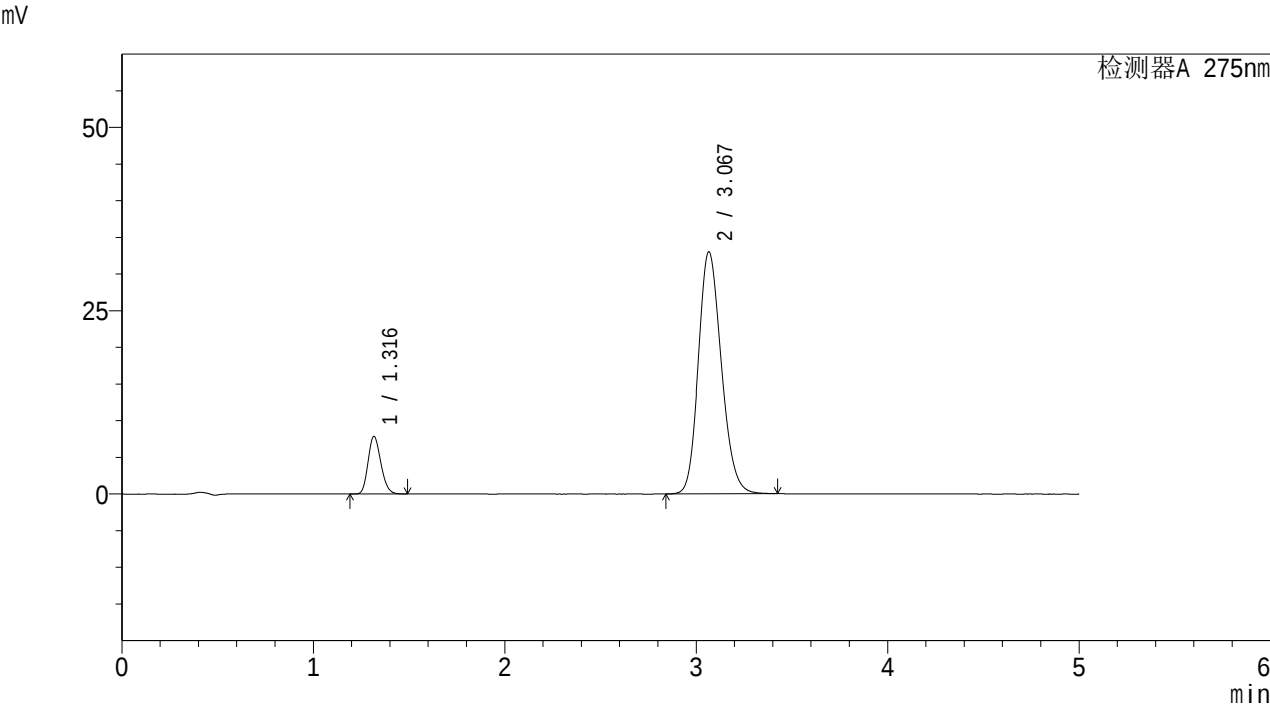

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	36485	11.682	7826	1844	1.187	--
2	3.067	275839	88.318	32952	3135	1.174	10.245
总计		312324	100.000	40777			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-69-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:24:12
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

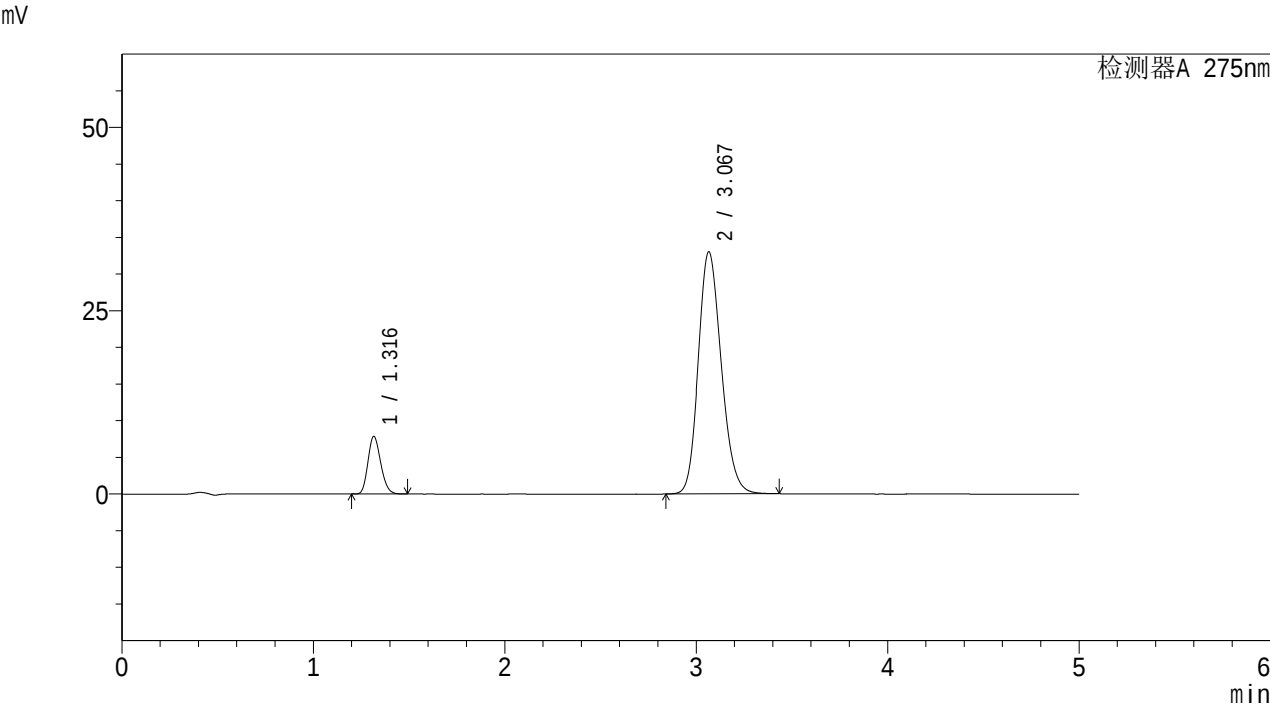

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	36437	11.665	7844	1848	1.184	--
2	3.067	275936	88.335	32975	3138	1.174	10.255
总计		312374	100.000	40819			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-70-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:29:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:55:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

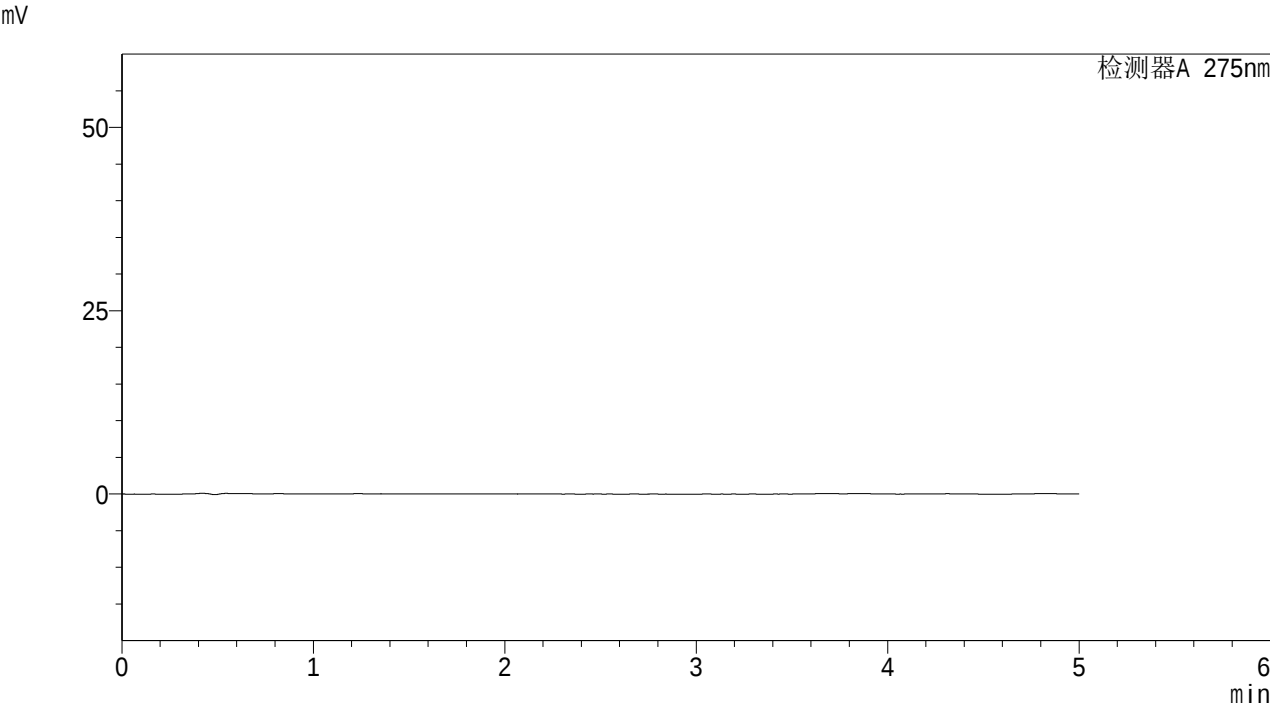

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-71-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:35:02
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

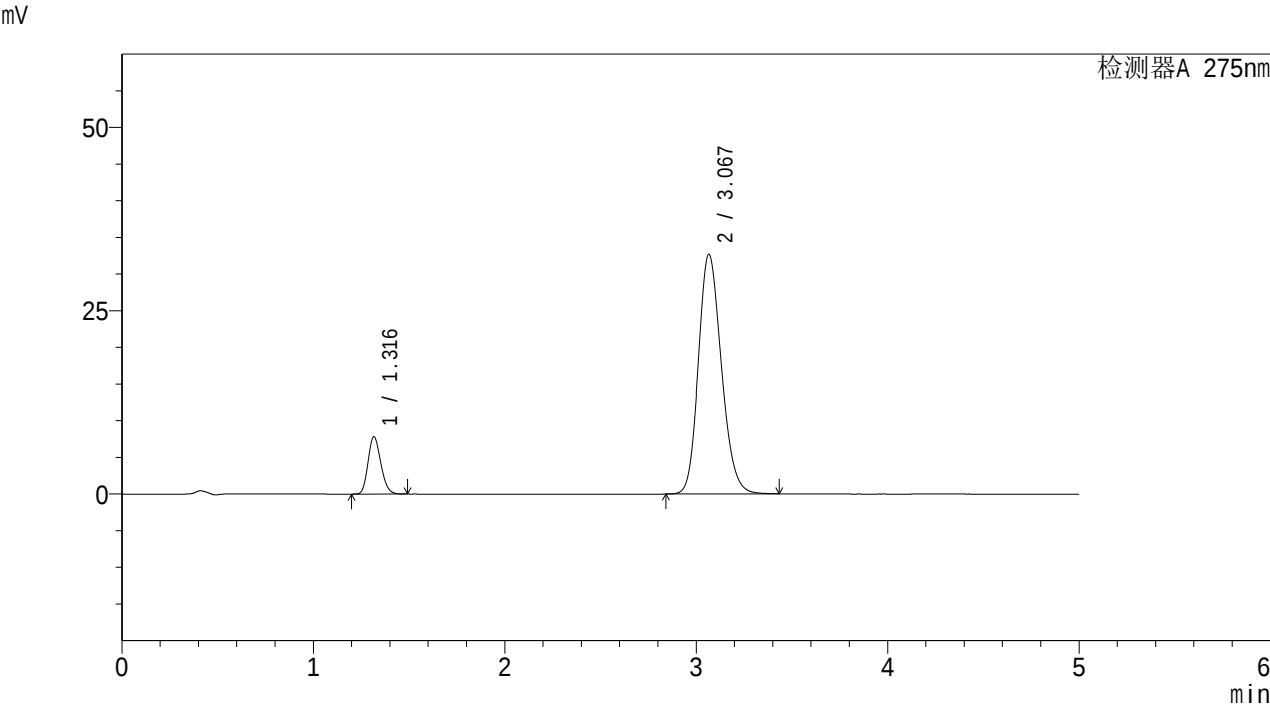

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	36261	11.710	7795	1849	1.184	--
2	3.067	273409	88.290	32621	3132	1.174	10.248
总计		309670	100.000	40416			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-72-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:40:26
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

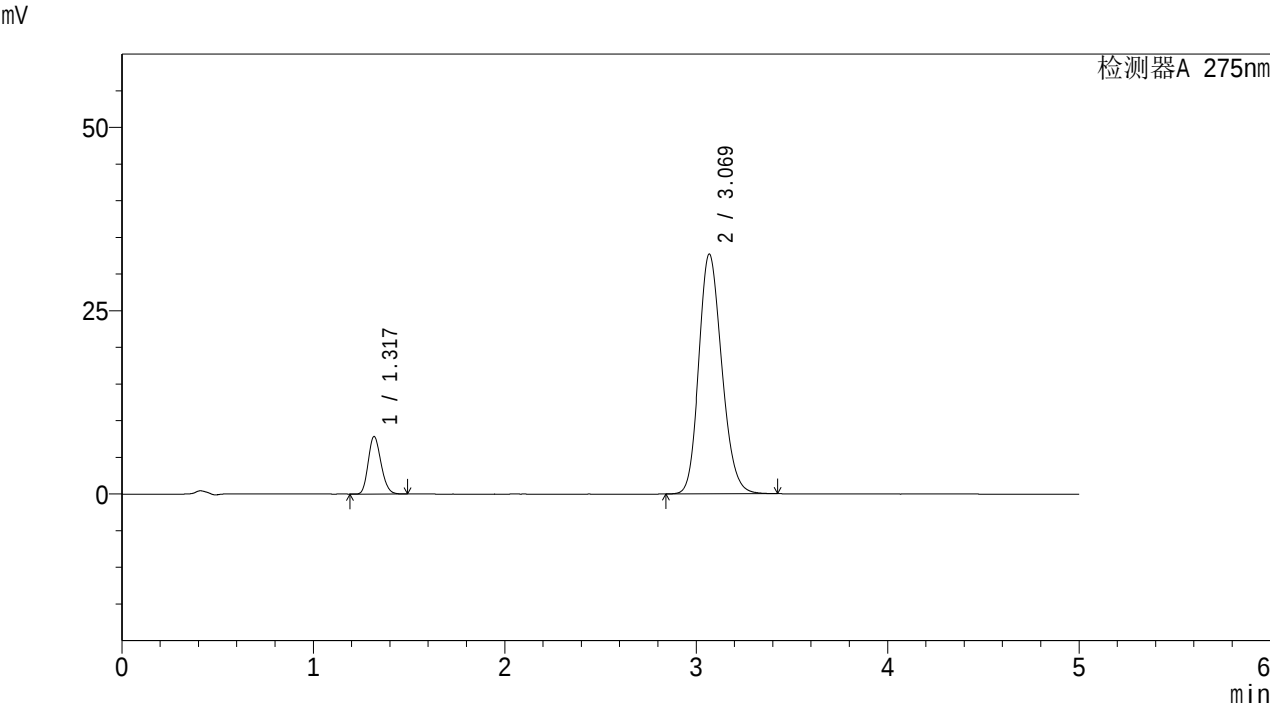

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.317	36355	11.737	7784	1852	1.184	--
2	3.069	273384	88.263	32684	3141	1.174	10.261
总计		309739	100.000	40468			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-73-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:45:51
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

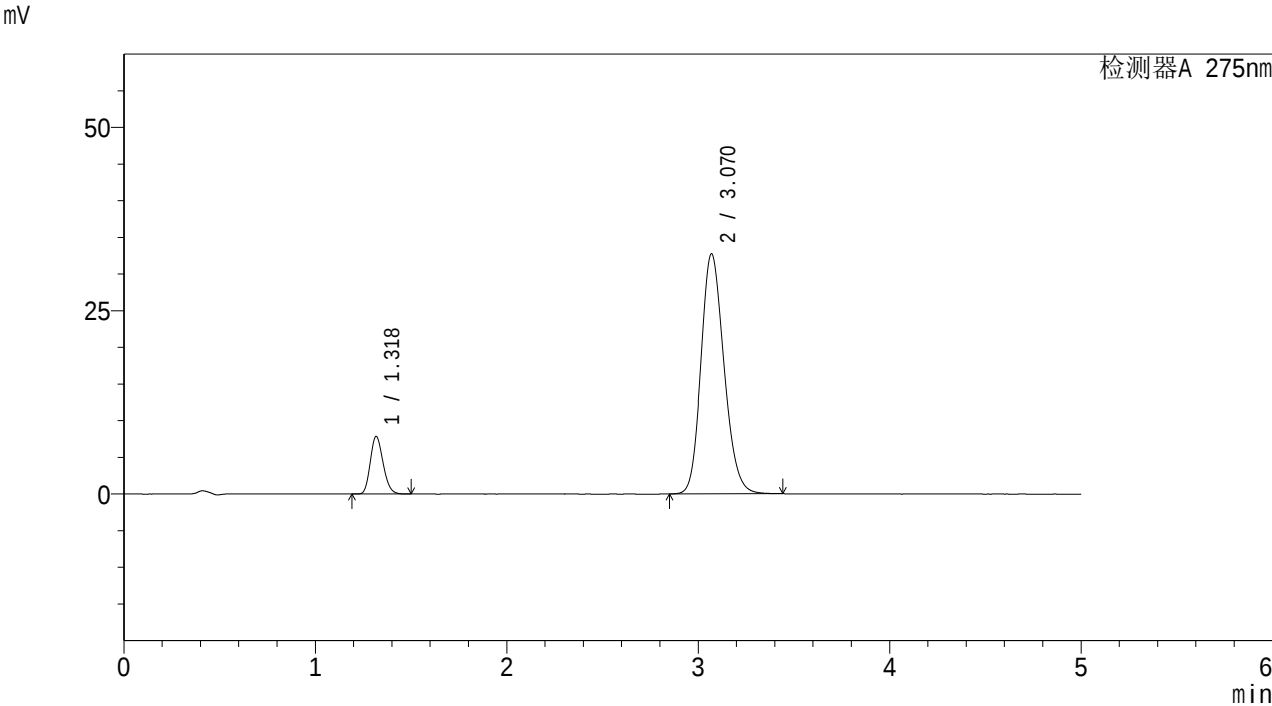

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.318	36467	11.744	7793	1849	1.185	--
2	3.070	274055	88.256	32741	3137	1.174	10.253
总计		310522	100.000	40534			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-74-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:51:16
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

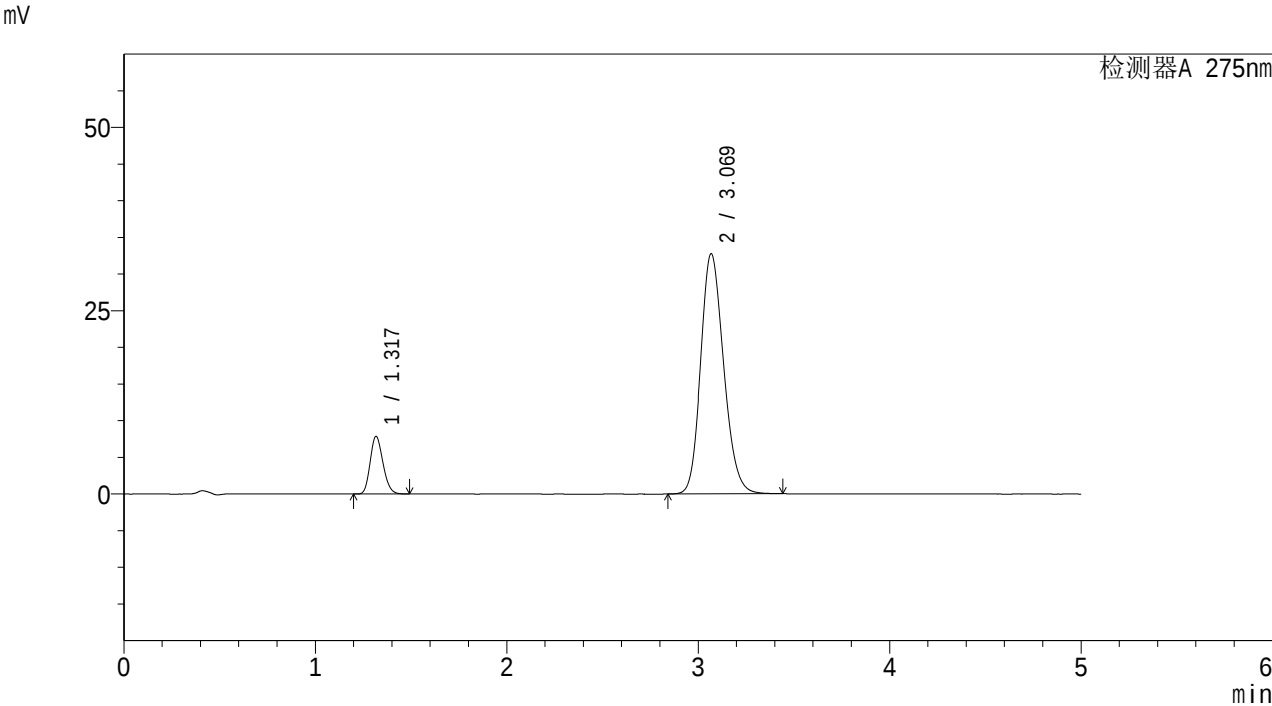

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.317	36444	11.746	7811	1848	1.186	--
2	3.069	273818	88.254	32707	3138	1.174	10.253
总计		310262	100.000	40518			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-75-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:56:41

处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

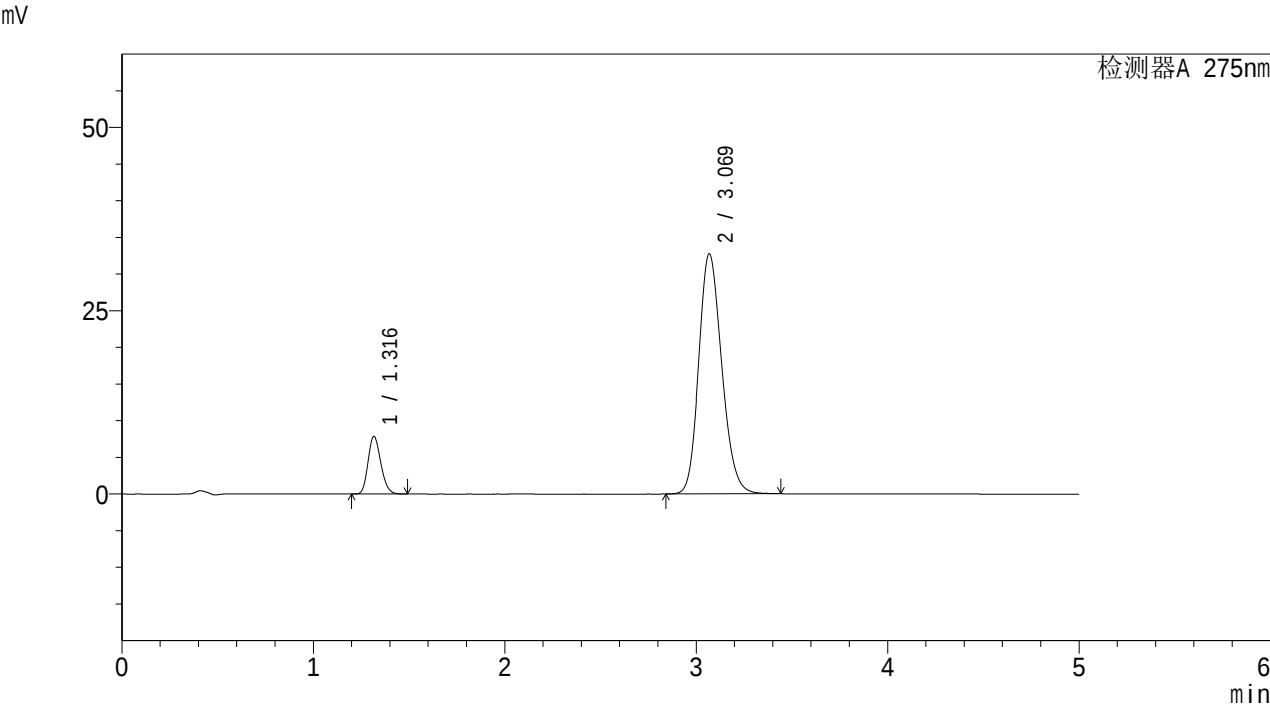

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.316	36439	11.738	7832	1848	1.184	--
2	3.069	273998	88.262	32723	3136	1.174	10.259
总计		310437	100.000	40555			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-76-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:02:05

处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

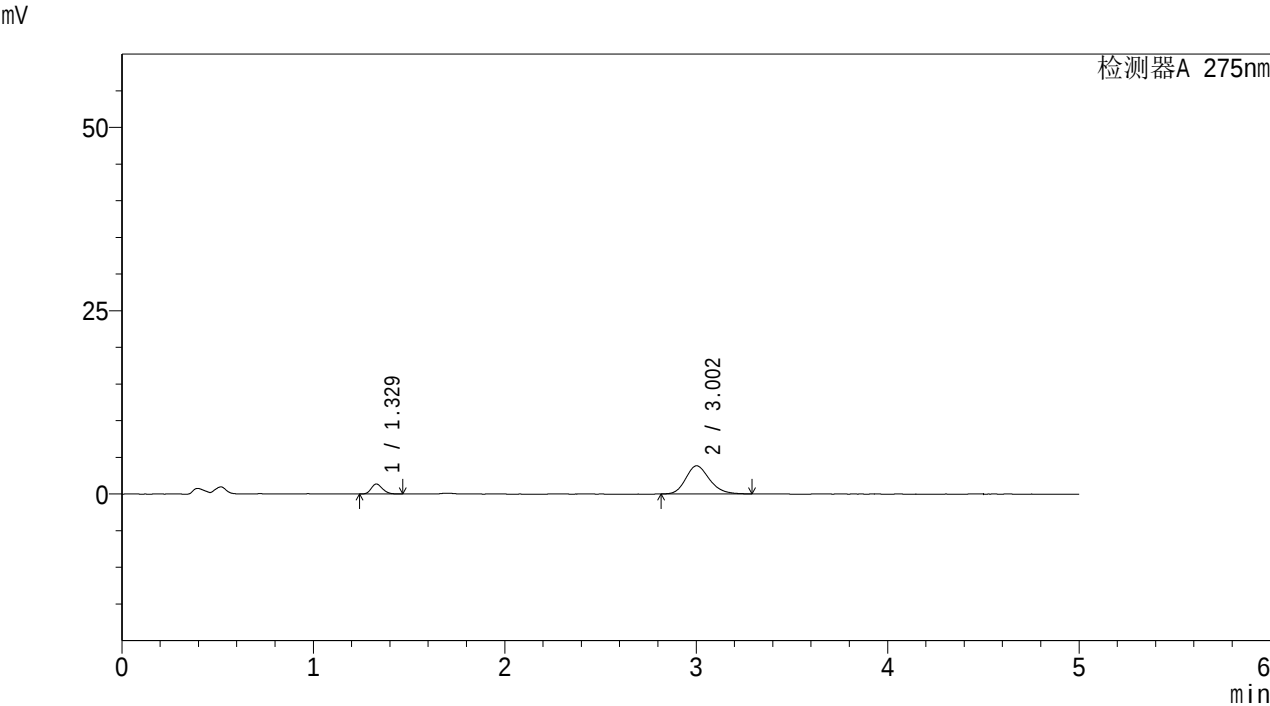

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	5630	14.437	1366	2387	1.190	--
2	3.002	33370	85.563	3844	2827	1.188	9.997
总计		39000	100.000	5210			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-77-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:07:29
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

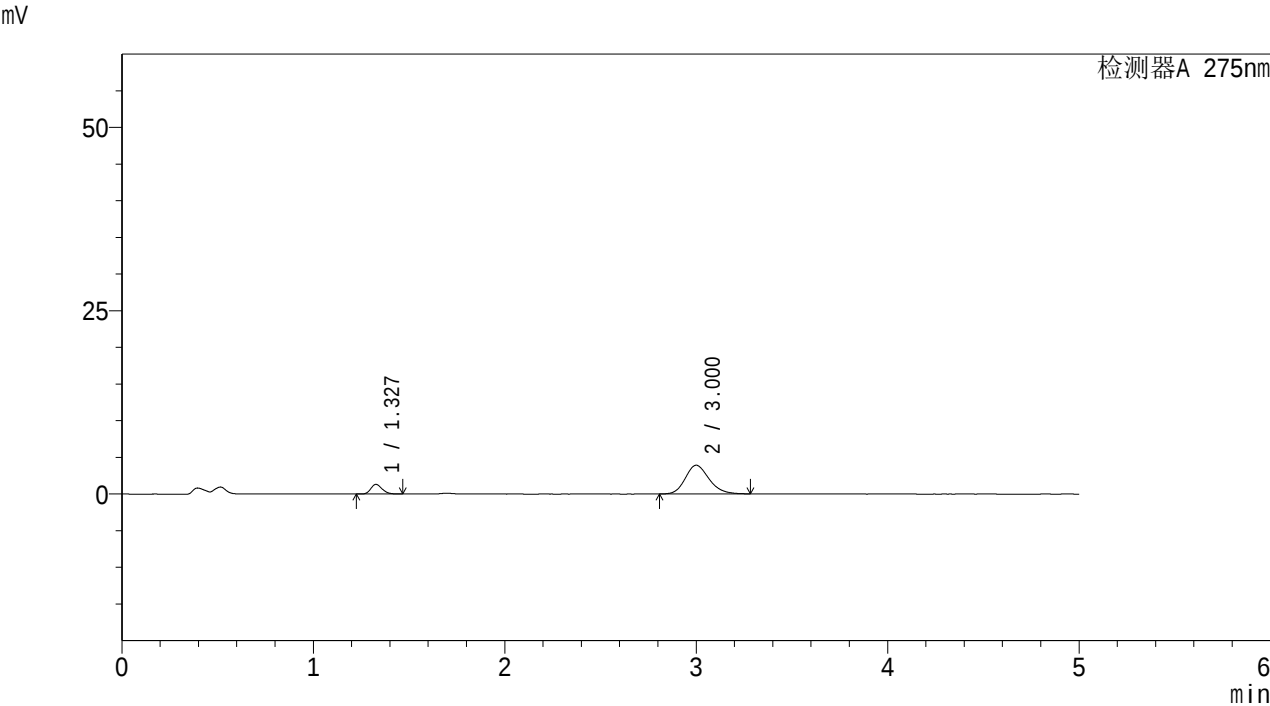

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	5432	13.761	1312	2400	1.195	--
2	3.000	34042	86.239	3915	2815	1.184	10.002
总计		39474	100.000	5227			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-78-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:12:52

处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

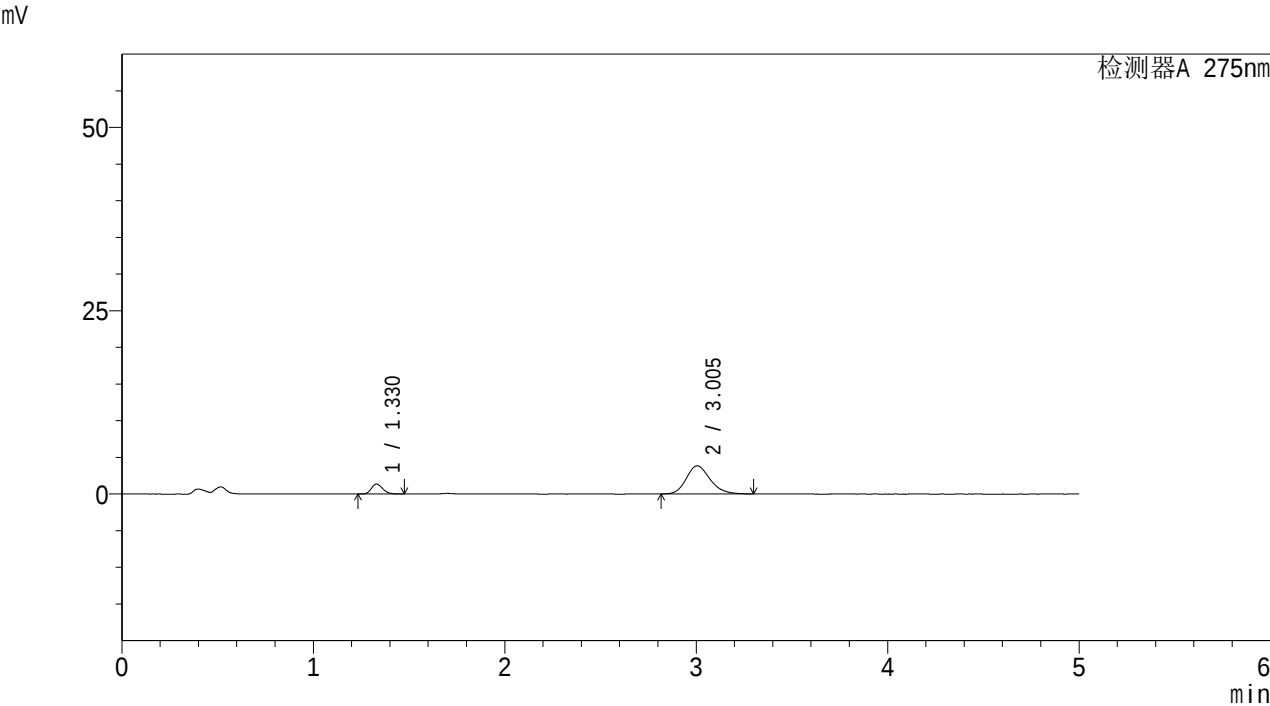

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	5580	14.283	1356	2400	1.194	--
2	3.005	33488	85.717	3850	2821	1.188	10.004
总计		39068	100.000	5205			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-79-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:18:16
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

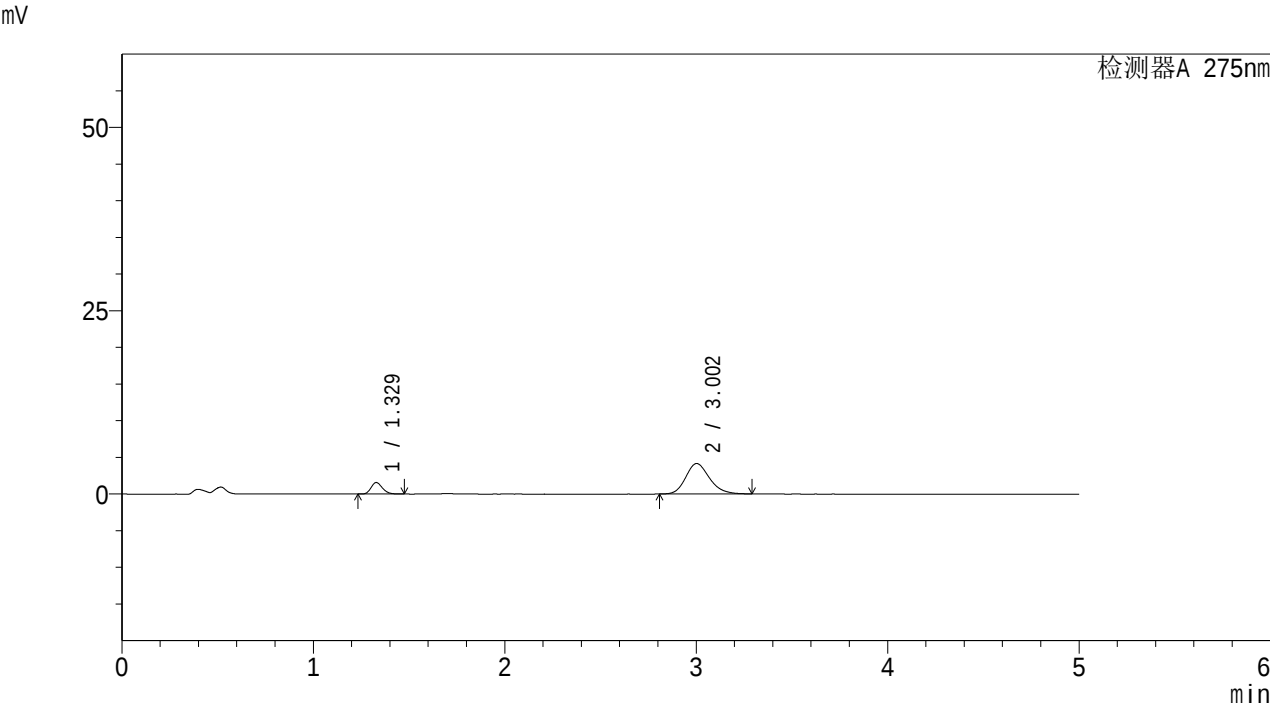

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	6469	15.164	1569	2402	1.193	--
2	3.002	36192	84.836	4157	2822	1.190	10.007
总计		42661	100.000	5726			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-80-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:23:39
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

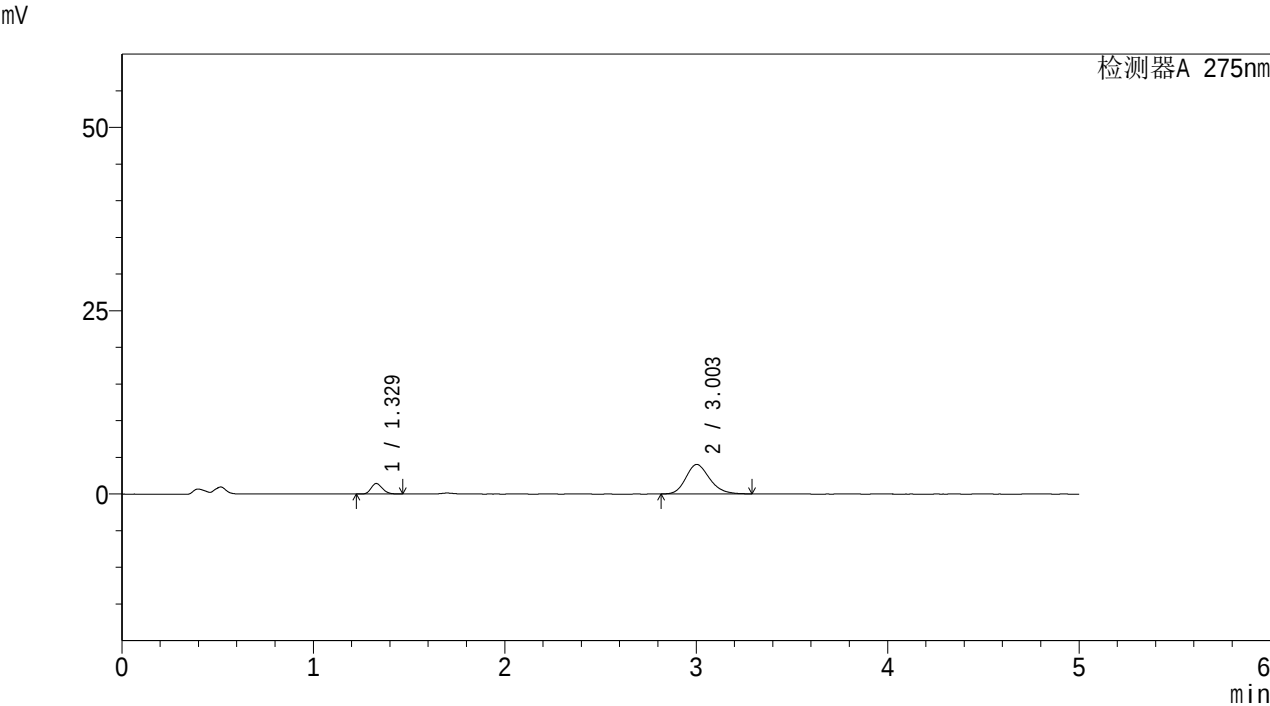

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	5913	14.445	1436	2412	1.196	--
2	3.003	35021	85.555	4031	2817	1.188	10.011
总计		40934	100.000	5468			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-81-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:29:03
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

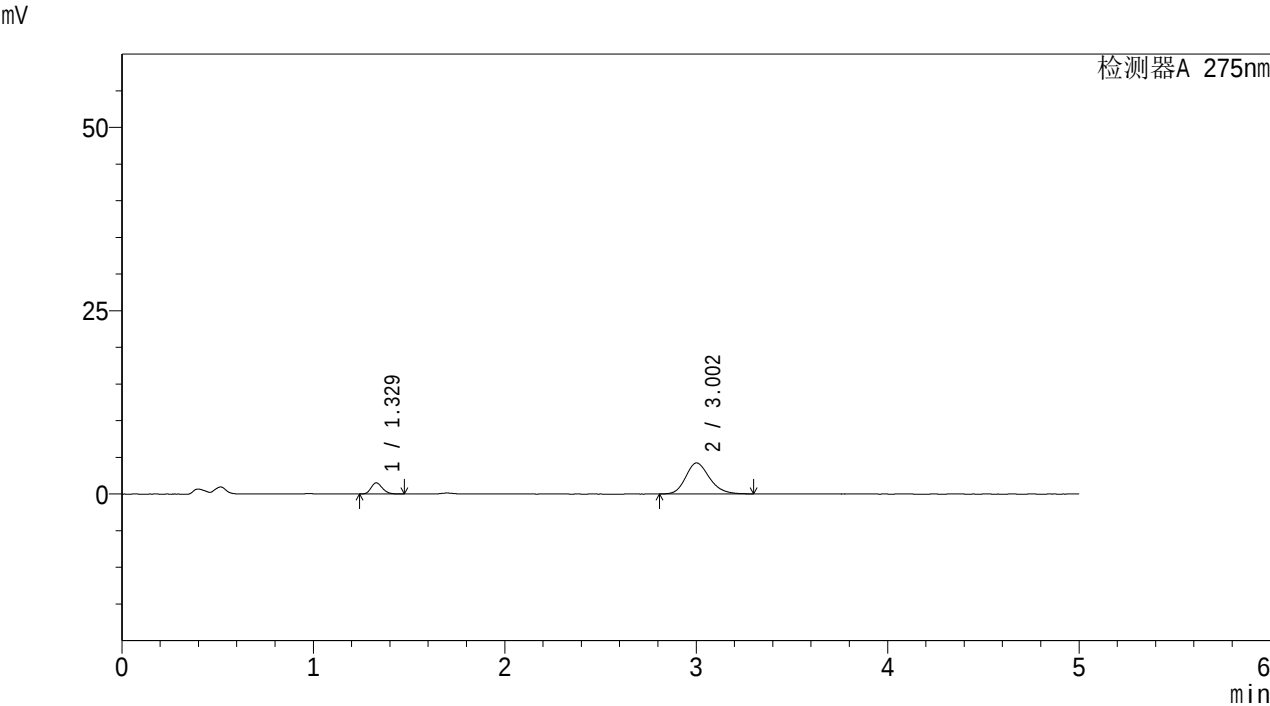

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	6253	14.493	1519	2412	1.192	--
2	3.002	36891	85.507	4234	2810	1.193	10.000
总计		43144	100.000	5753			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-82-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:34:27
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

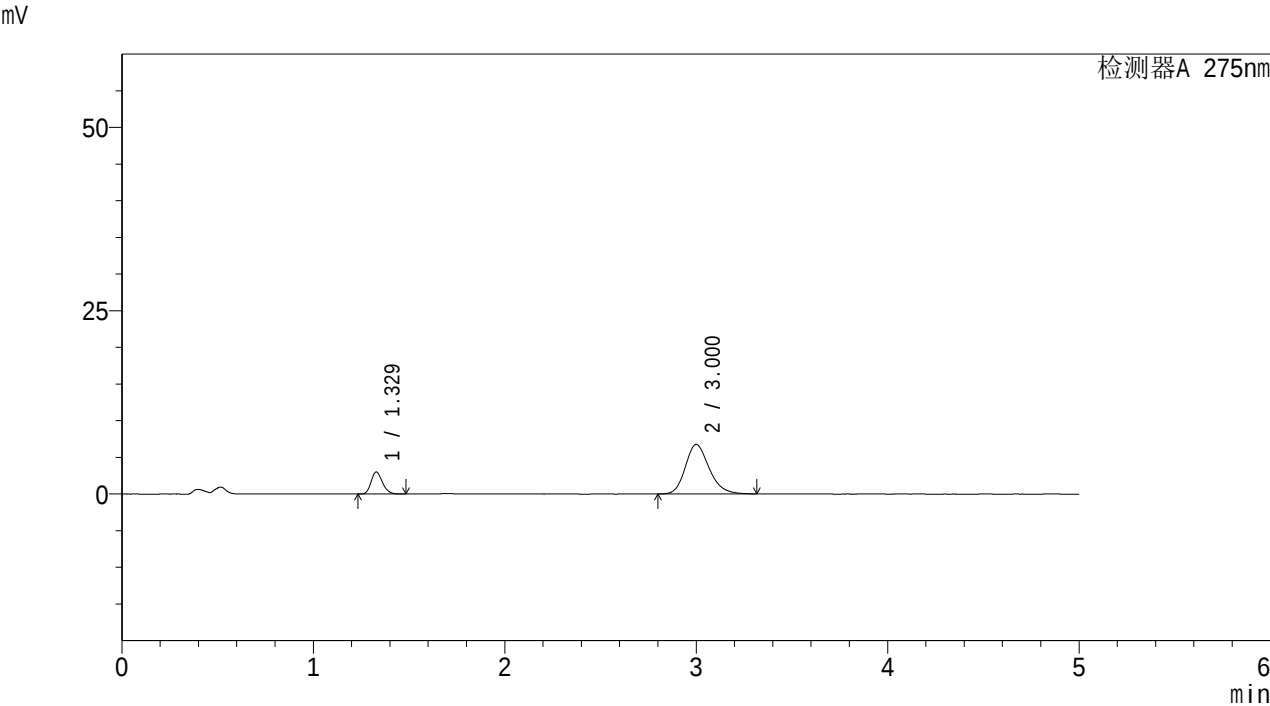

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	12366	17.383	3001	2407	1.201	--
2	3.000	58773	82.617	6752	2832	1.201	10.014
总计		71139	100.000	9753			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-83-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:39:51
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

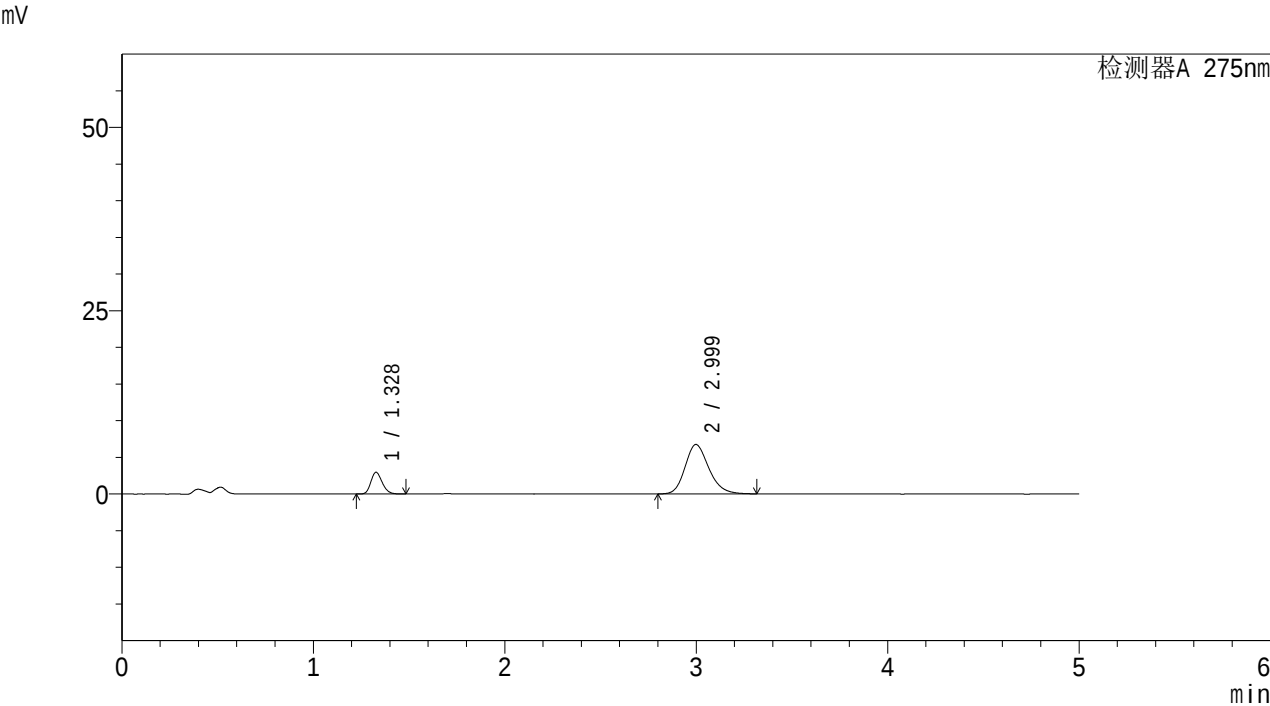

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	12235	17.258	2961	2406	1.200	--
2	2.999	58660	82.742	6749	2829	1.201	10.014
总计		70895	100.000	9709			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-84-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:45:14
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

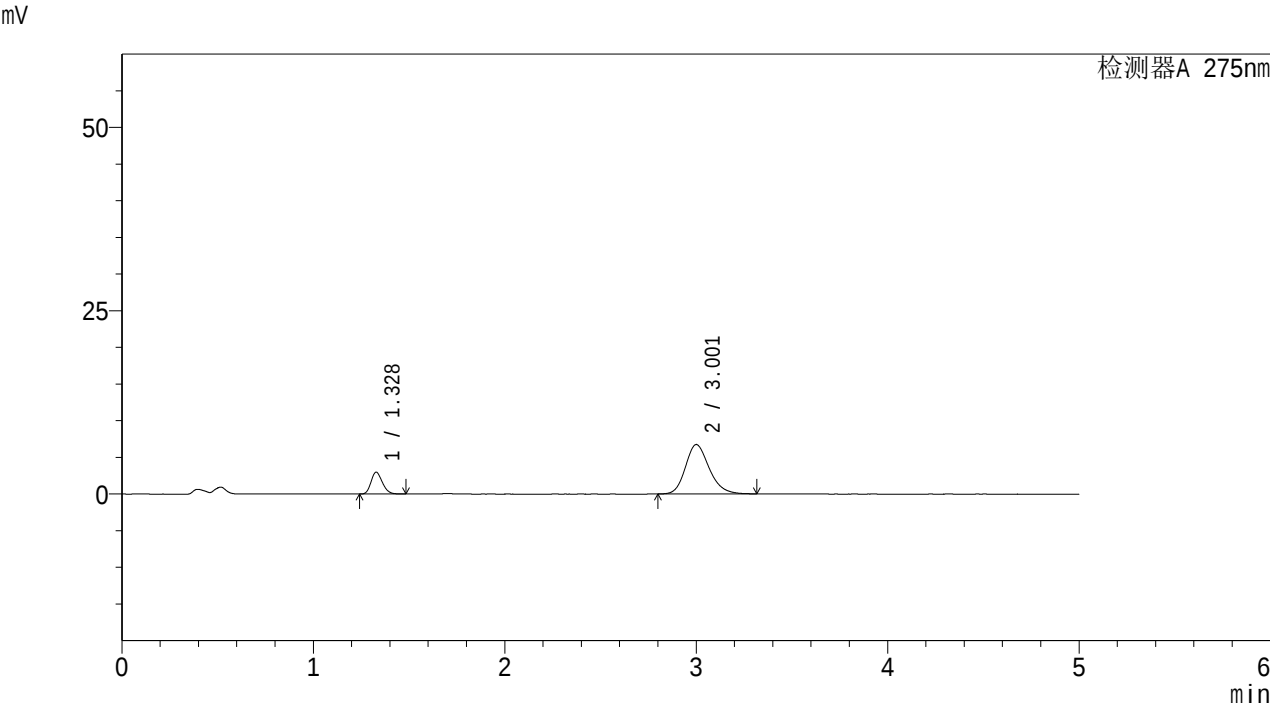

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	12276	17.327	2978	2399	1.199	--
2	3.001	58576	82.673	6731	2838	1.200	10.021
总计		70852	100.000	9709			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-85-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:50:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

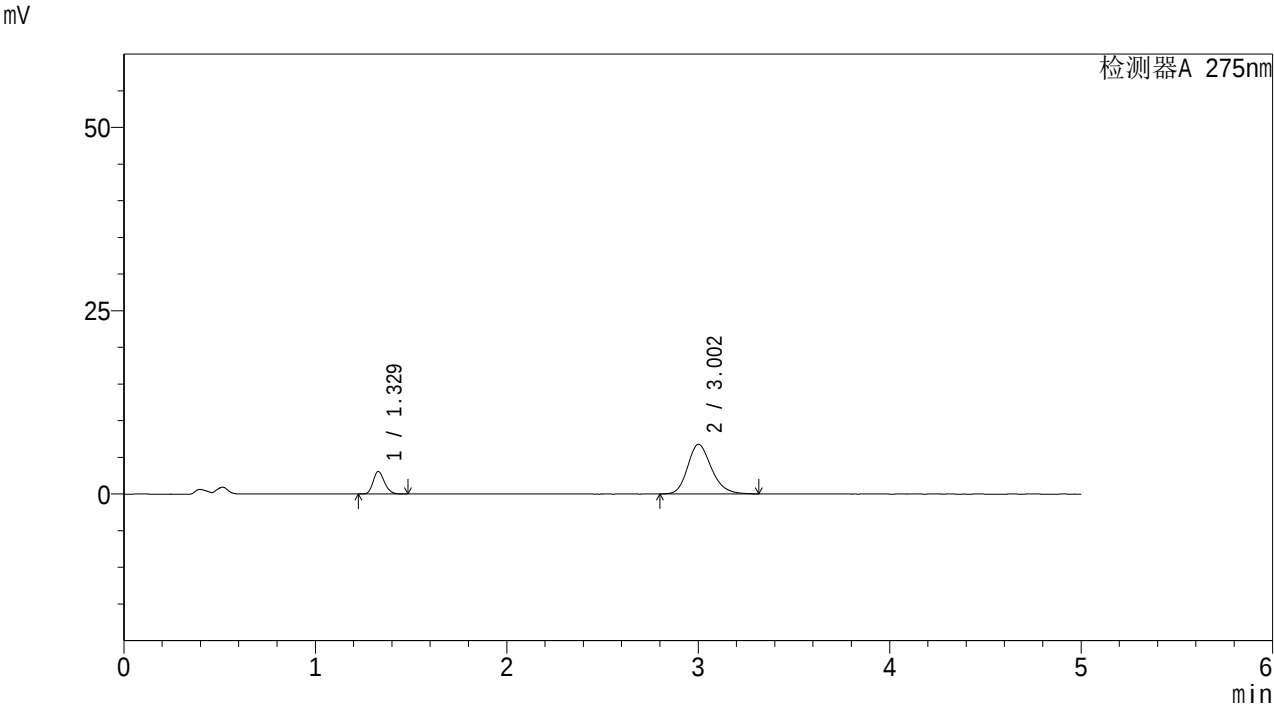

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	12603	17.608	3064	2412	1.196	--
2	3.002	58971	82.392	6771	2830	1.200	10.019
总计		71574	100.000	9836			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-86-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:56:01
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

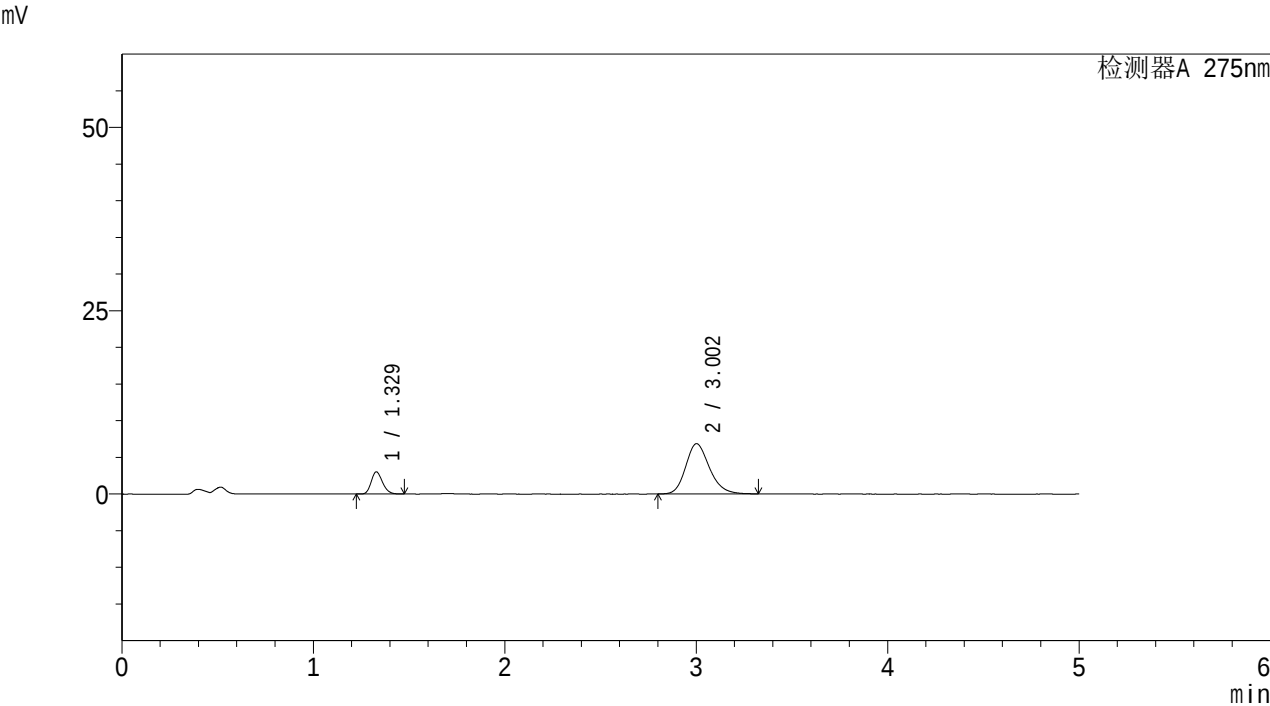

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	12429	17.225	3026	2410	1.198	--
2	3.002	59726	82.775	6857	2831	1.202	10.017
总计		72154	100.000	9883			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-87-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:01:25
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

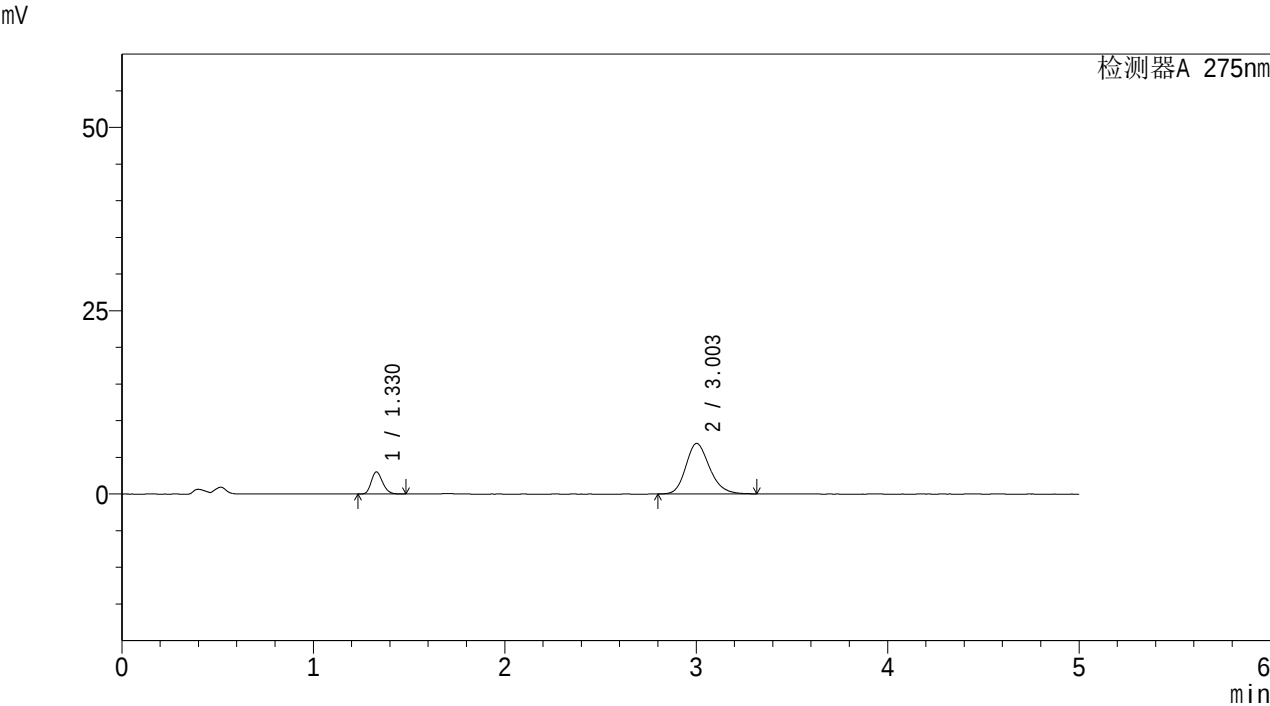

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	12431	17.159	3027	2411	1.197	--
2	3.003	60014	82.841	6906	2835	1.200	10.022
总计		72445	100.000	9933			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-88-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:06:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

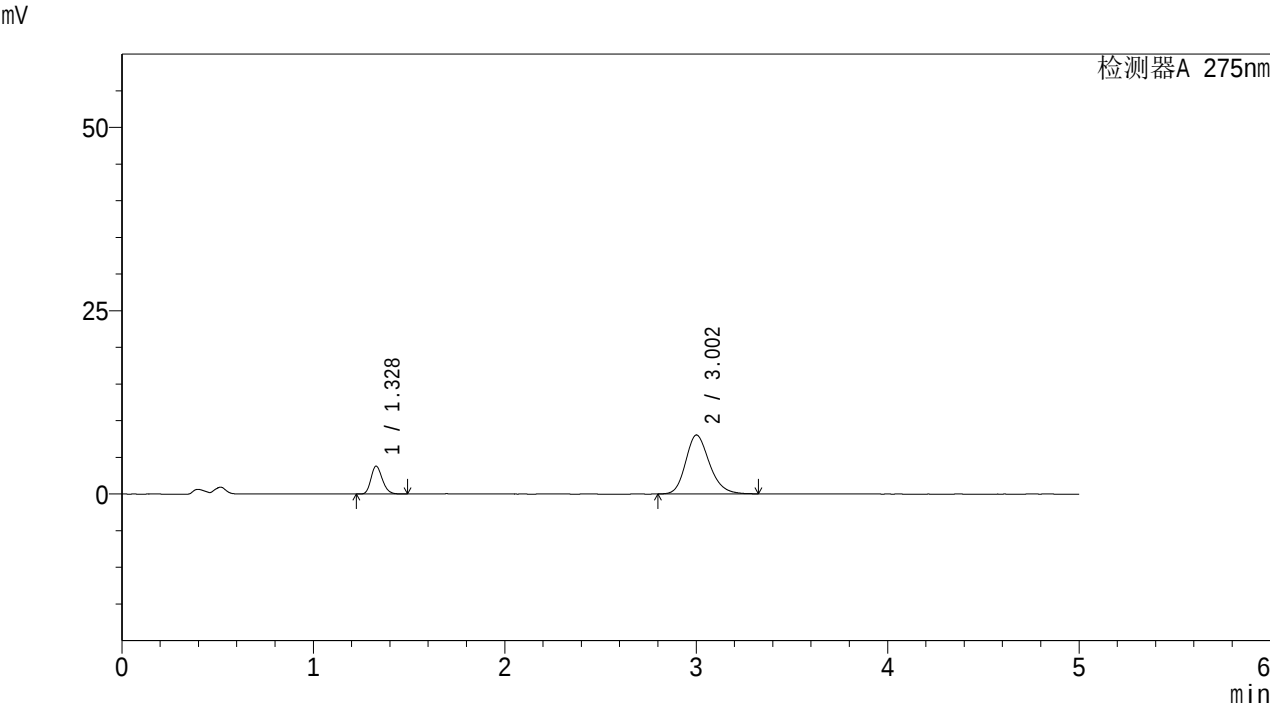

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	15687	18.310	3802	2408	1.201	--
2	3.002	69990	81.690	8042	2842	1.204	10.036
总计		85677	100.000	11845			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-89-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:12:13
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

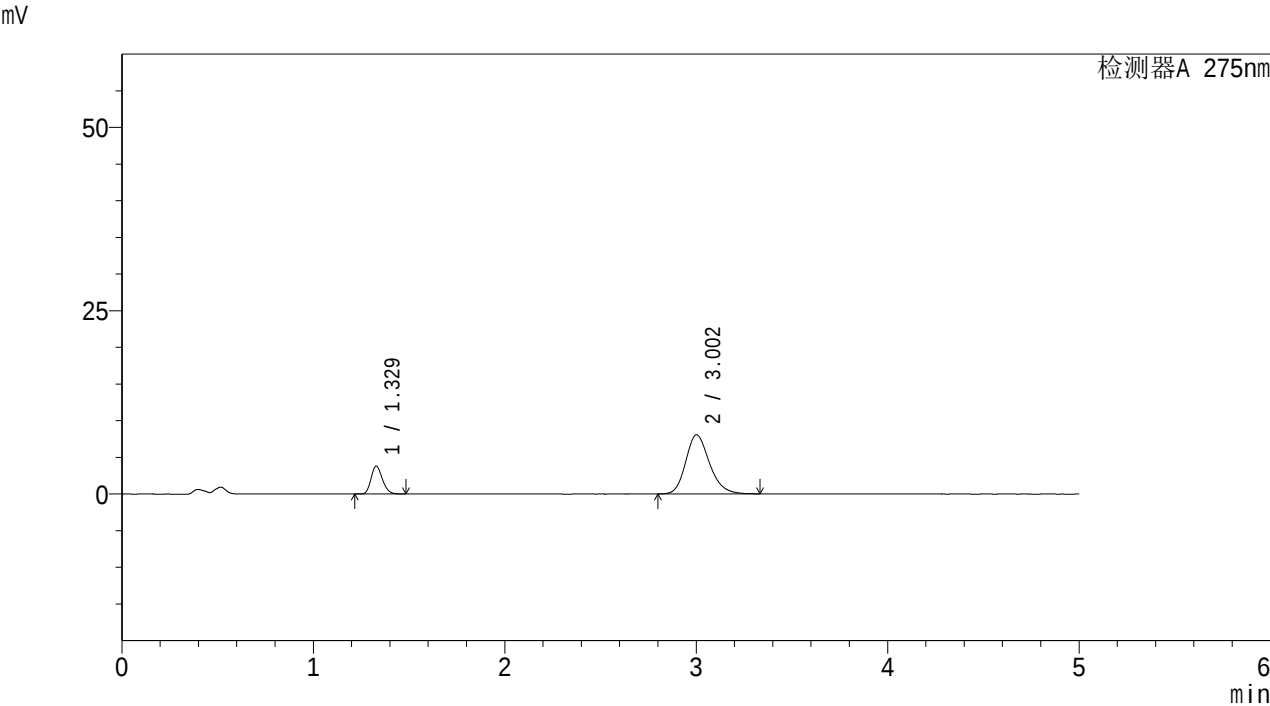

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	15649	18.212	3804	2410	1.197	--
2	3.002	70280	81.788	8077	2839	1.205	10.033
总计		85929	100.000	11881			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-90-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:17:36
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

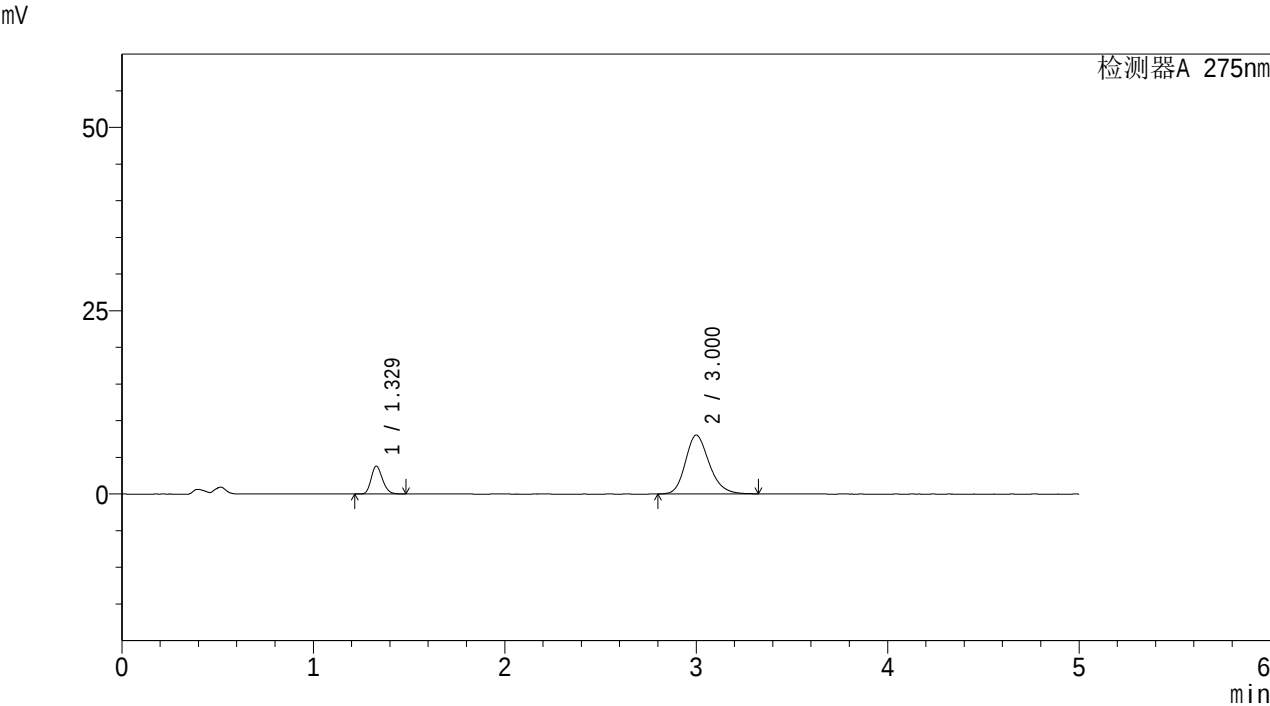

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	15675	18.326	3806	2410	1.196	--
2	3.000	69859	81.674	8027	2840	1.206	10.024
总计		85534	100.000	11833			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-91-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:23:00

处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

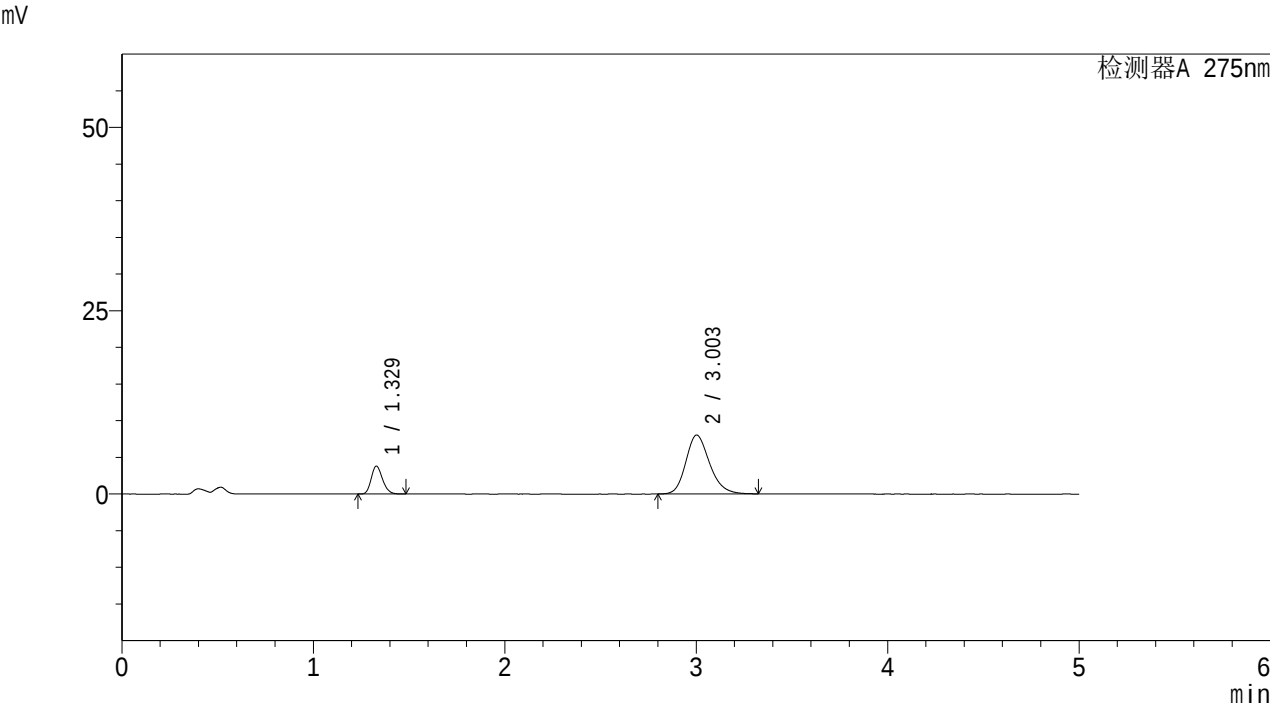

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	15664	18.313	3815	2416	1.198	--
2	3.003	69870	81.687	8039	2841	1.205	10.034
总计		85534	100.000	11854			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-92-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:28:24

处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

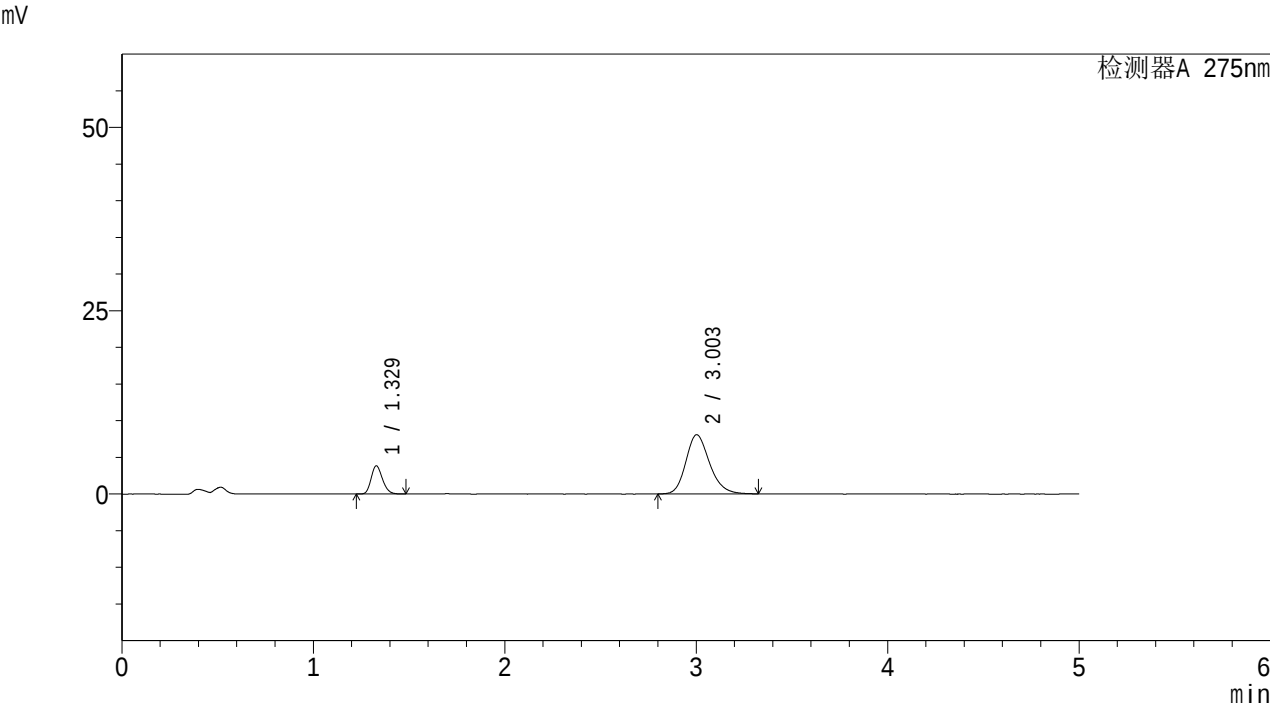

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	15832	18.422	3847	2413	1.195	--
2	3.003	70109	81.578	8083	2856	1.205	10.054
总计		85941	100.000	11930			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-93-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:33:48
处理时间(V2): 2026/05/14 19:56:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

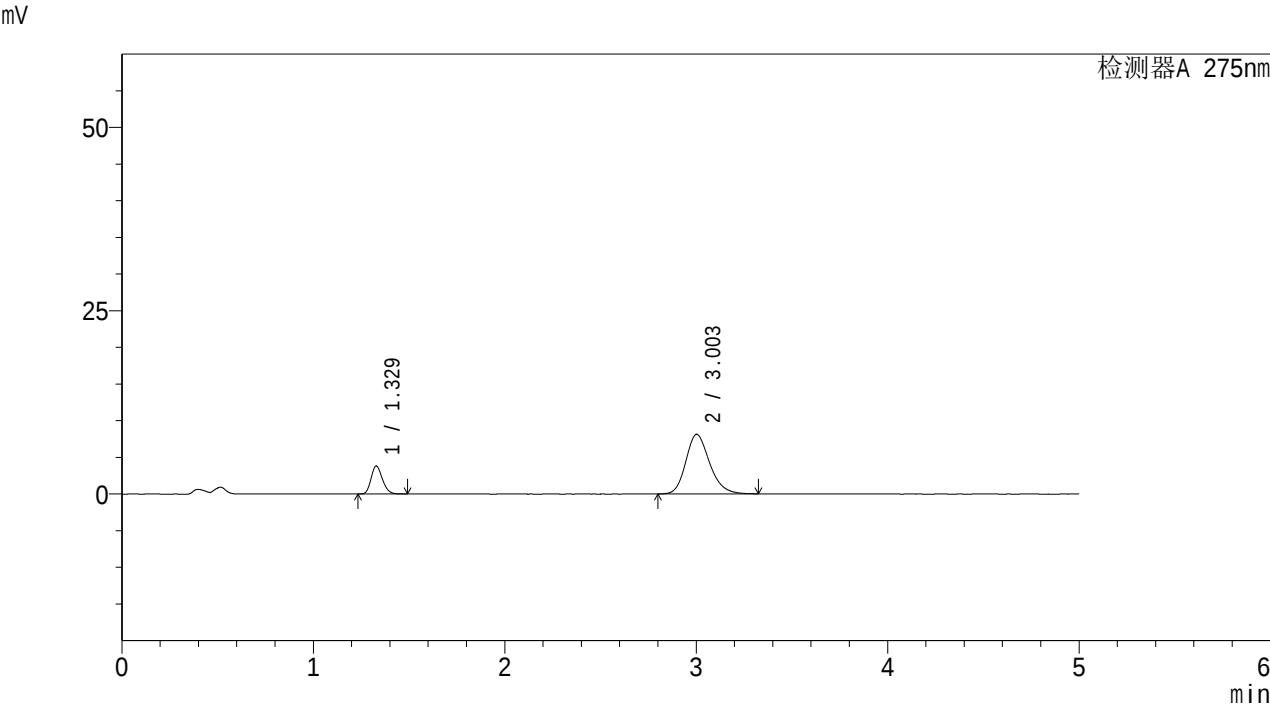

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	15790	18.239	3823	2404	1.198	--
2	3.003	70785	81.761	8132	2835	1.206	10.025
总计		86576	100.000	11955			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-94-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:39:12
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

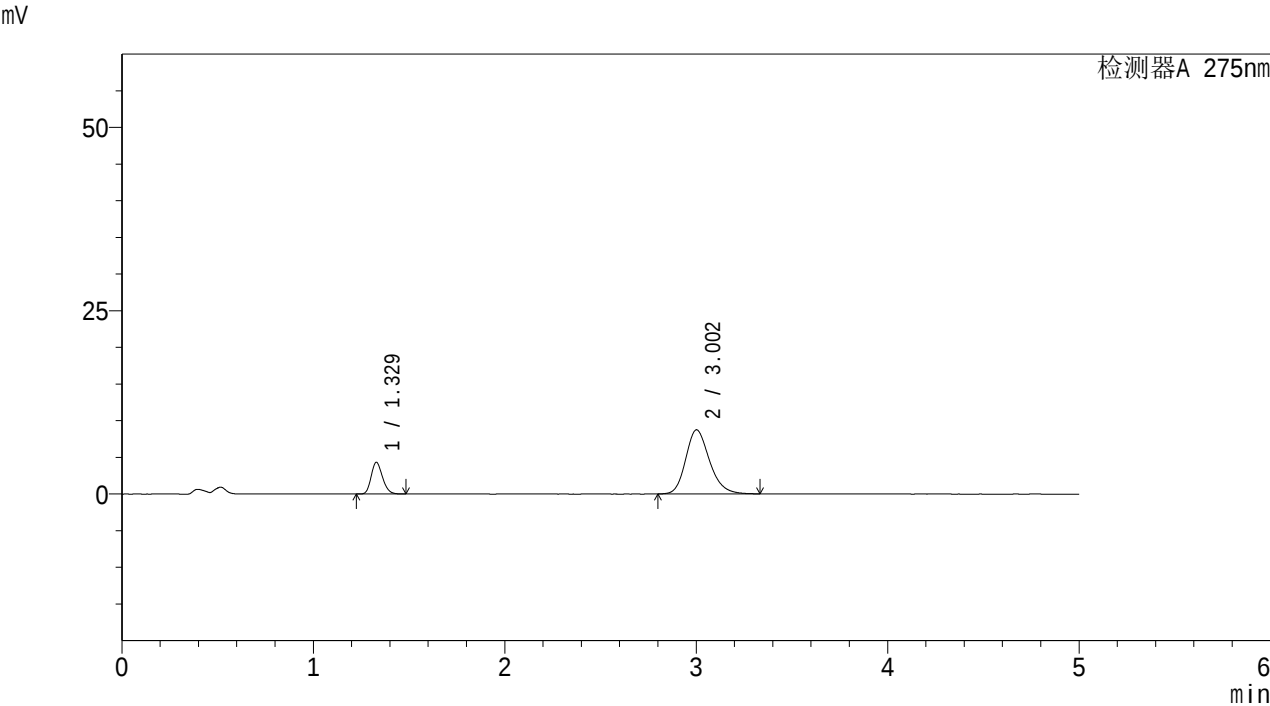

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	17783	18.943	4323	2408	1.197	--
2	3.002	76091	81.057	8747	2843	1.209	10.030
总计		93874	100.000	13070			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-95-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:44:35

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

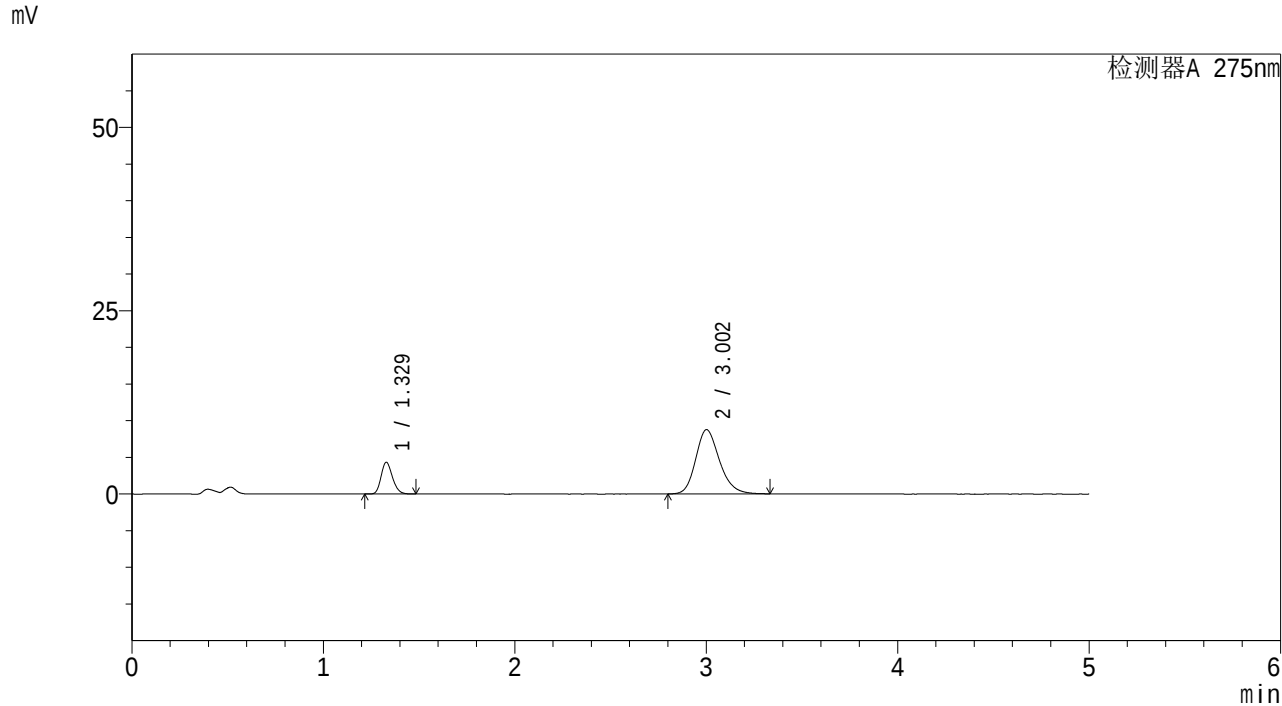

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	17844	18.962	4330	2405	1.194	--
2	3.002	76264	81.038	8768	2844	1.206	10.032
总计		94108	100.000	13098			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-96-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:49:59
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

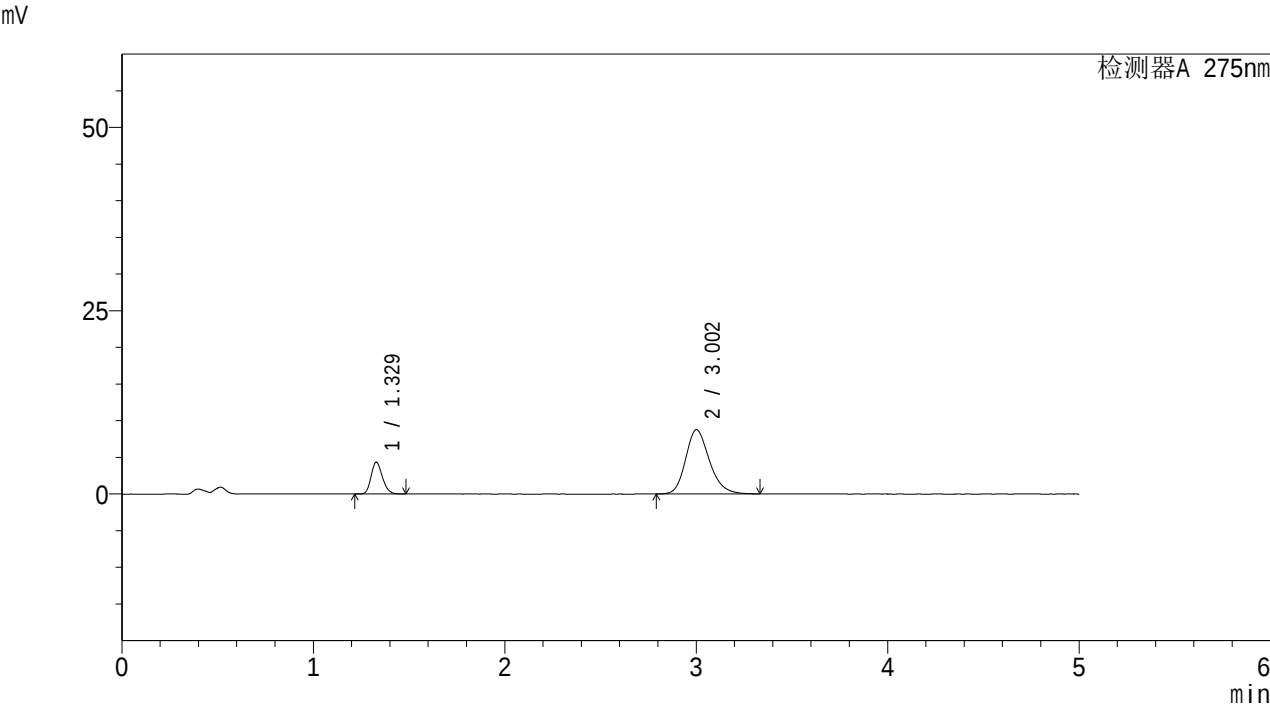

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	17869	18.967	4339	2405	1.196	--
2	3.002	76339	81.033	8759	2843	1.209	10.030
总计		94208	100.000	13098			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-97-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:55:23
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

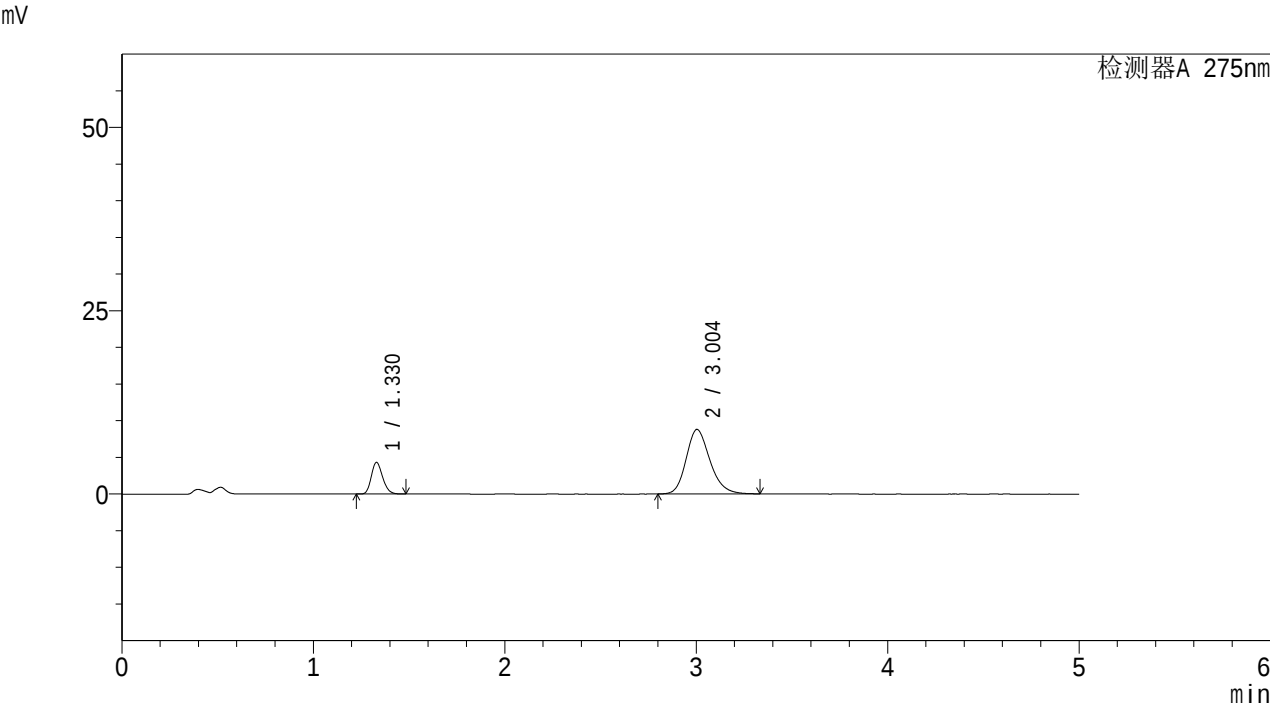

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	17765	18.840	4322	2412	1.196	--
2	3.004	76531	81.160	8806	2844	1.208	10.037
总计		94296	100.000	13128			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-98-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:00:47
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

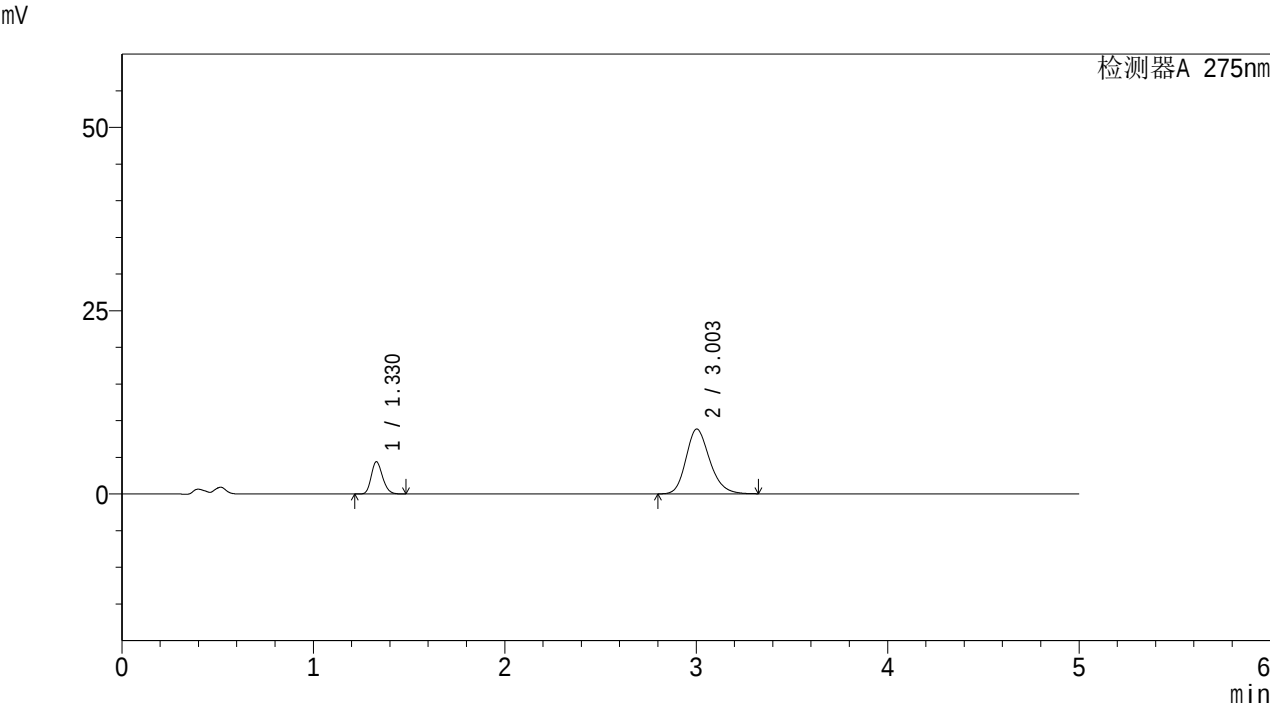

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	18067	19.027	4400	2415	1.195	--
2	3.003	76885	80.973	8854	2846	1.207	10.040
总计		94952	100.000	13254			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-99-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:06:10
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

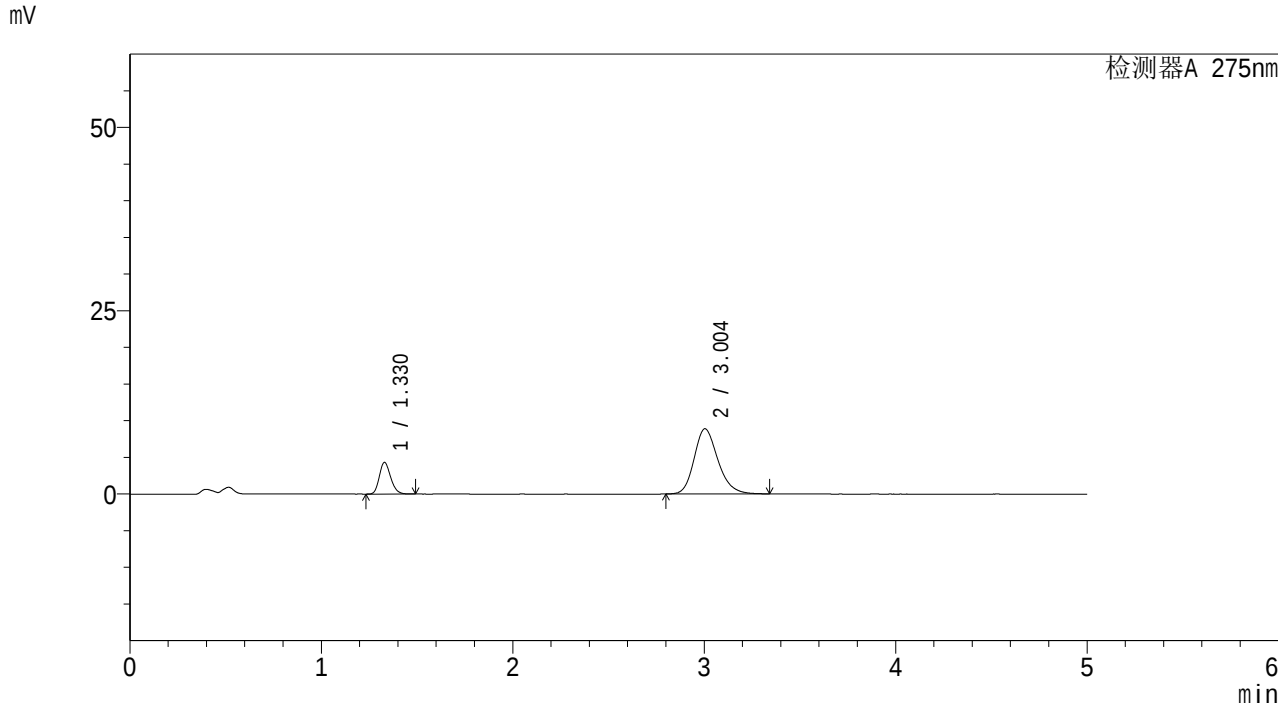

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	17769	18.659	4321	2415	1.197	--
2	3.004	77461	81.341	8907	2846	1.210	10.040
总计		95230	100.000	13229			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-100-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:11:33
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

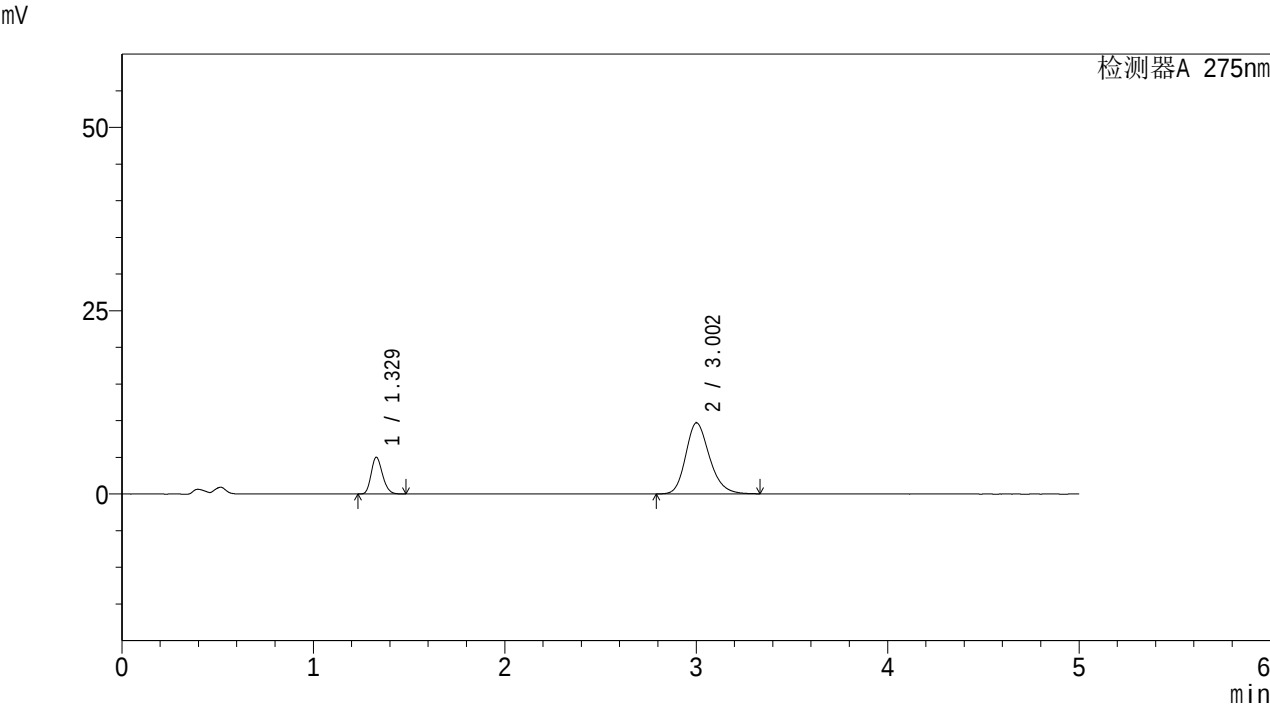

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	20600	19.620	5014	2411	1.197	--
2	3.002	84396	80.380	9695	2847	1.211	10.037
总计		104996	100.000	14709			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-101-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:16:57

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

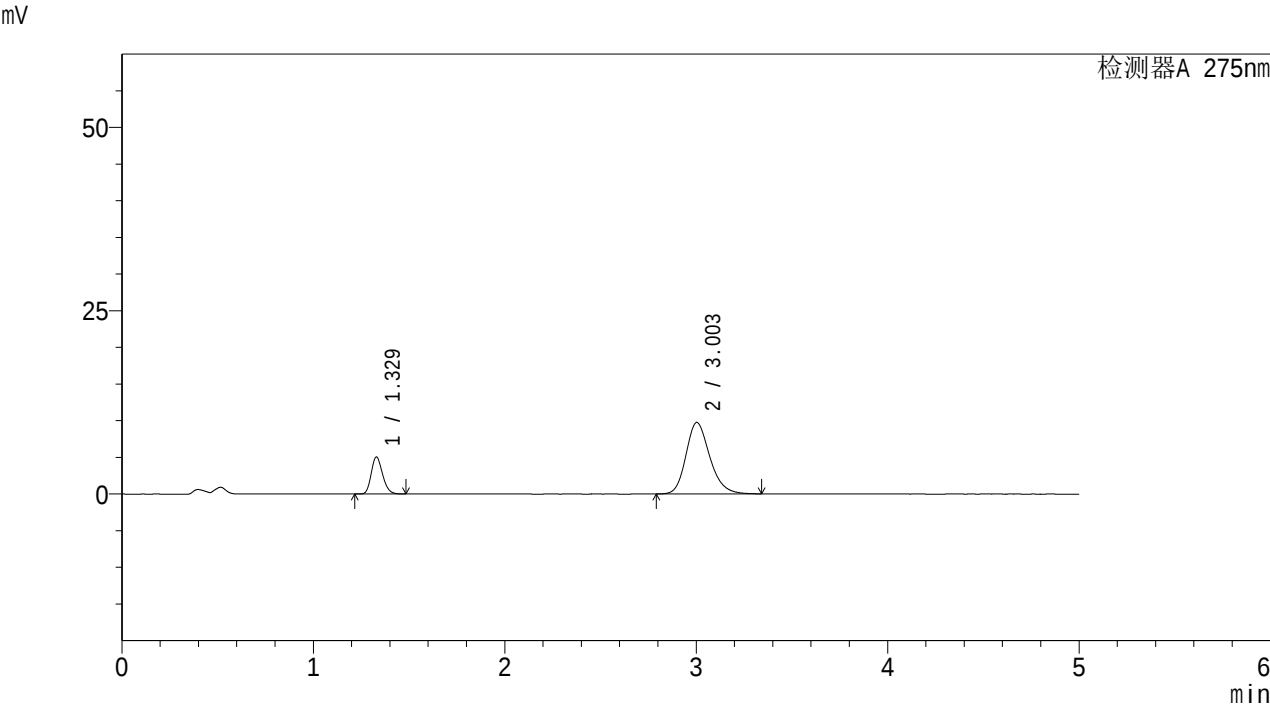

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	20782	19.648	5057	2410	1.196	--
2	3.003	84991	80.352	9767	2846	1.211	10.038
总计		105774	100.000	14823			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-102-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:22:21

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

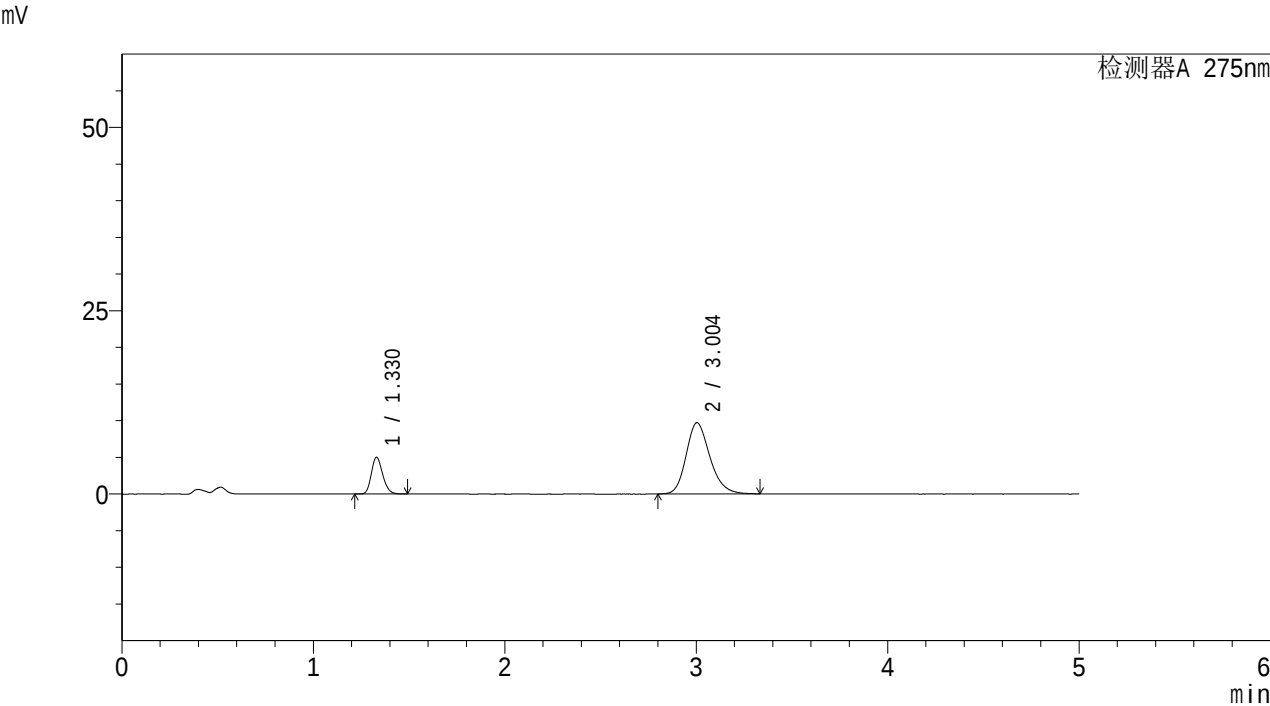

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	20644	19.633	5025	2416	1.197	--
2	3.004	84503	80.367	9729	2848	1.211	10.042
总计		105147	100.000	14753			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-103-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:27:45
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

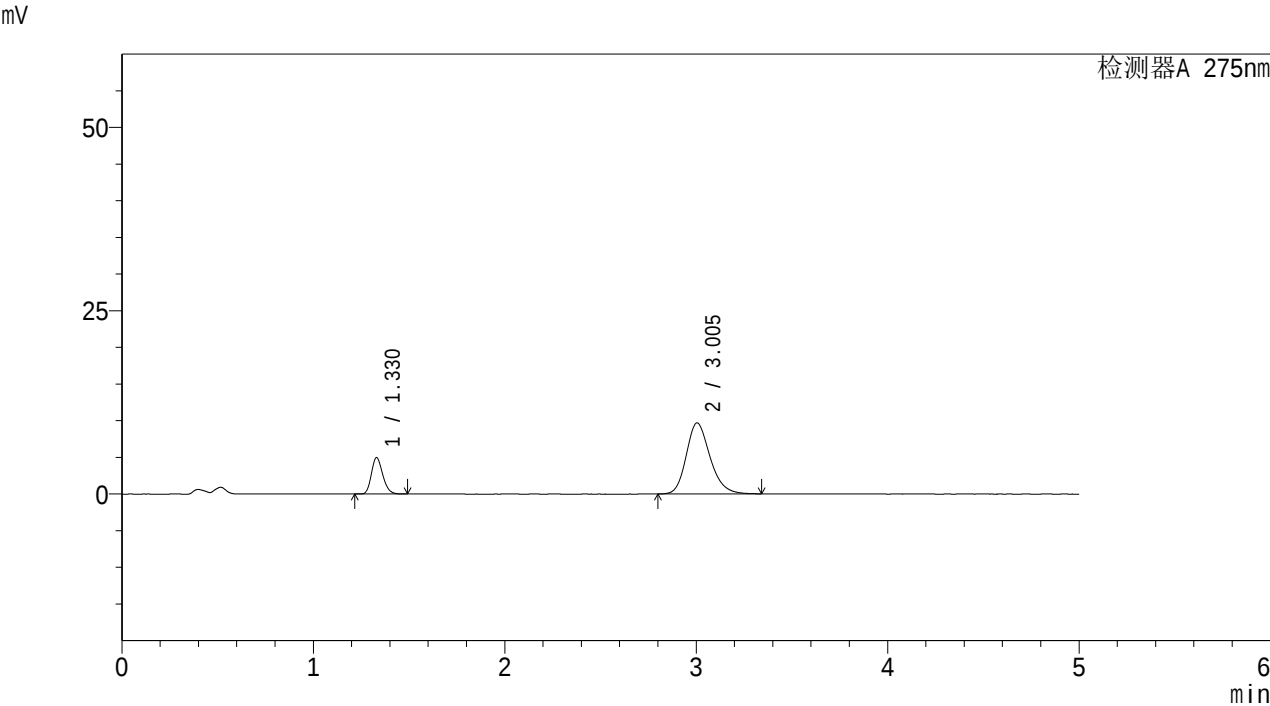

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	20418	19.486	4967	2416	1.198	--
2	3.005	84365	80.514	9707	2849	1.212	10.043
总计		104783	100.000	14674			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-104-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:33:09
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

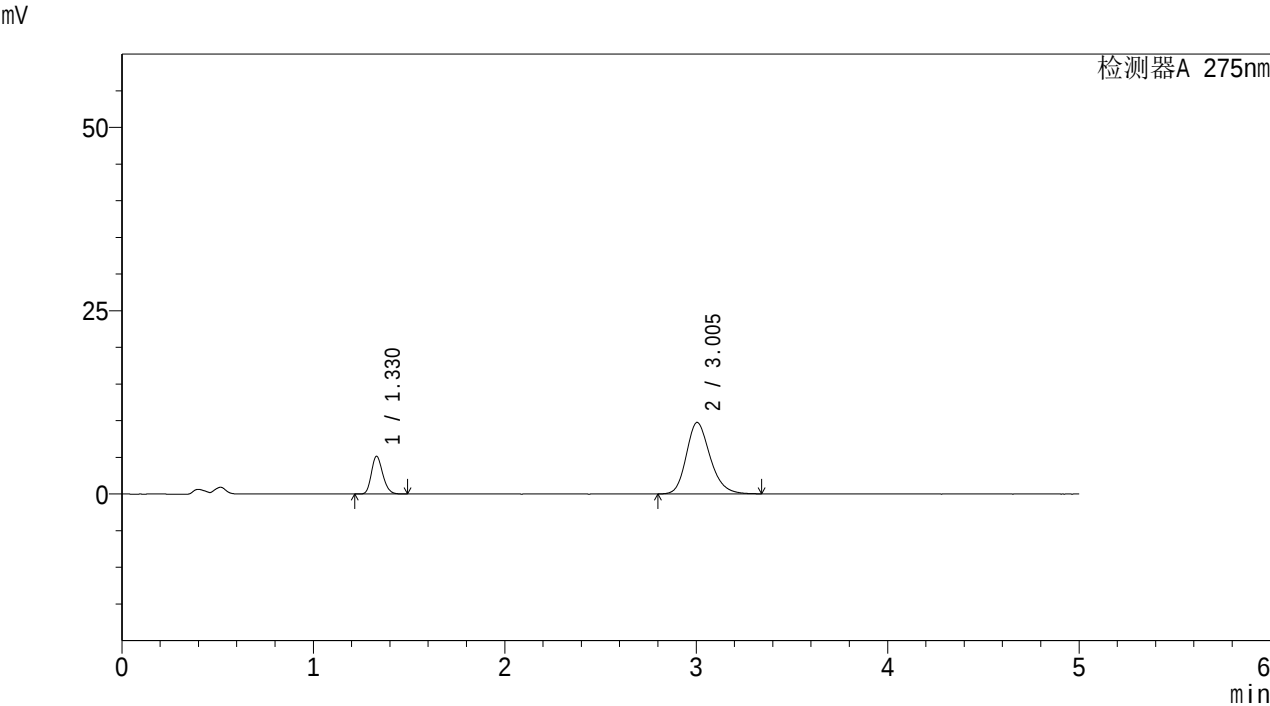

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	21196	19.985	5154	2415	1.196	--
2	3.005	84863	80.015	9759	2847	1.211	10.042
总计		106059	100.000	14913			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-105-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:38:33
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

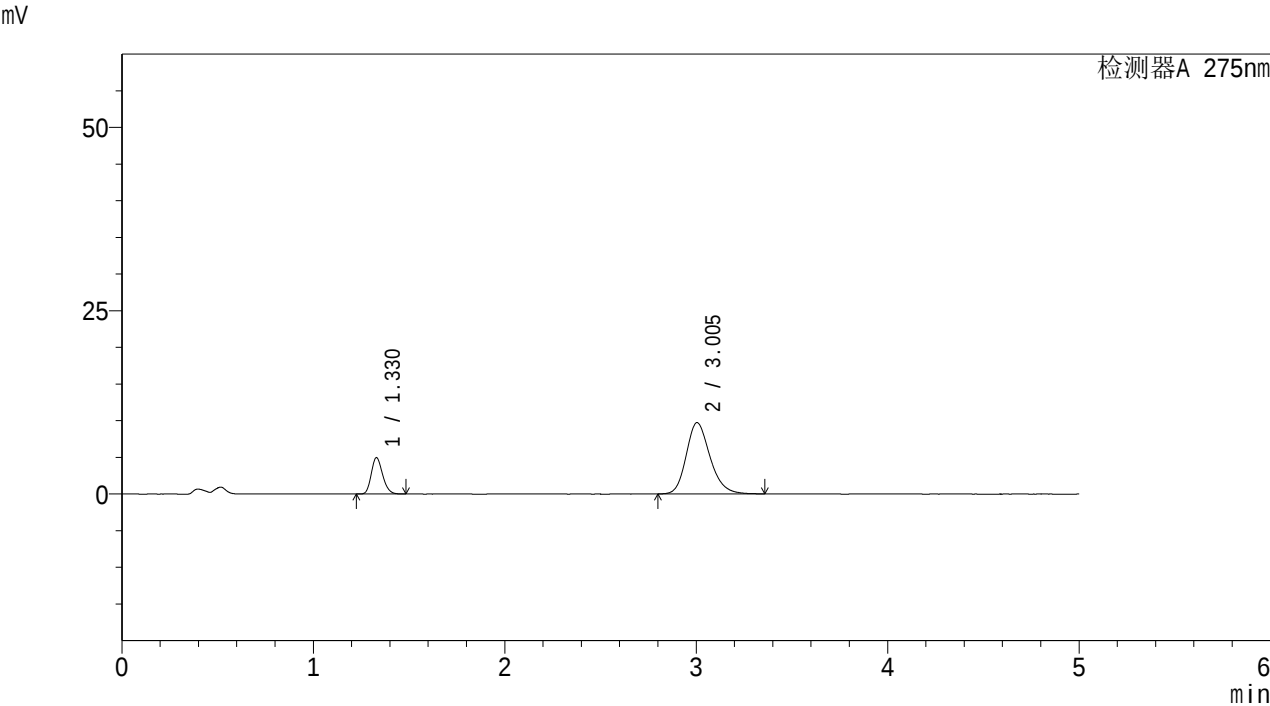

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	20382	19.369	4964	2414	1.196	--
2	3.005	84847	80.631	9749	2848	1.212	10.045
总计		105229	100.000	14713			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-106-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:43:58

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

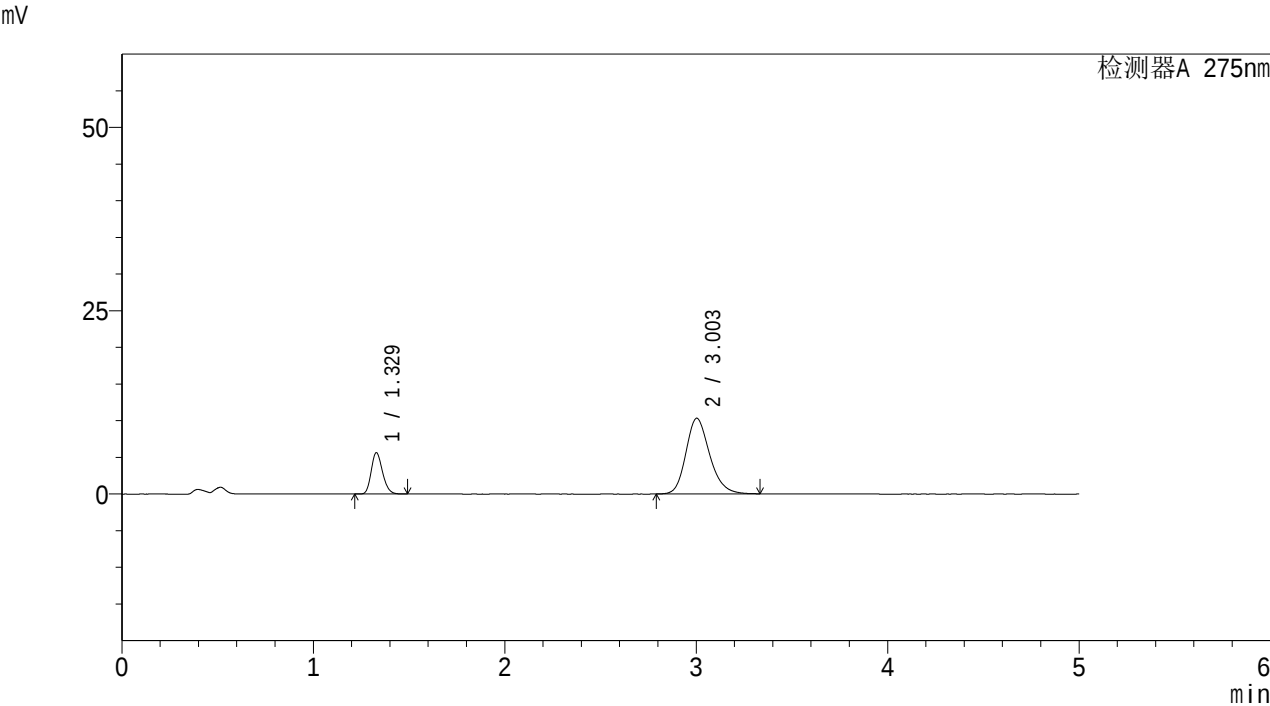

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	23209	20.546	5648	2411	1.199	--
2	3.003	89755	79.454	10327	2848	1.210	10.040
总计		112965	100.000	15975			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-107-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:49:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

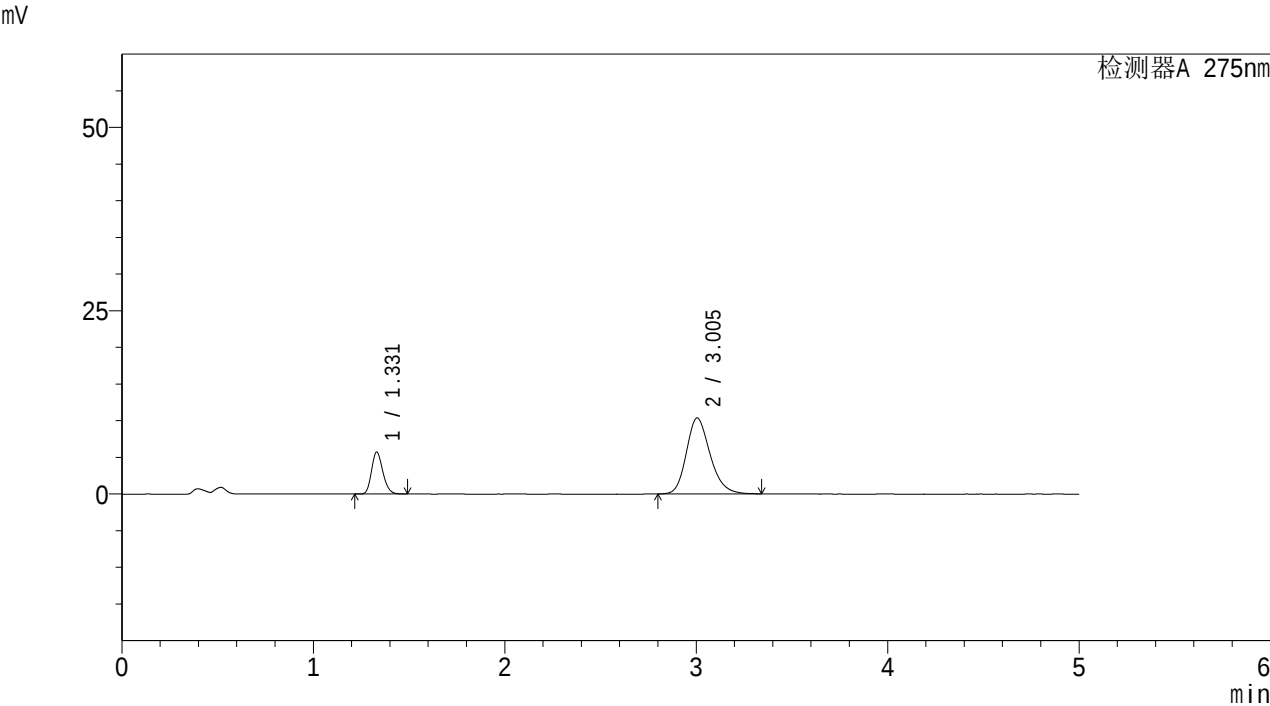

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	23496	20.715	5720	2419	1.198	--
2	3.005	89933	79.285	10370	2857	1.213	10.051
总计		113430	100.000	16090			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-108-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:54:46
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

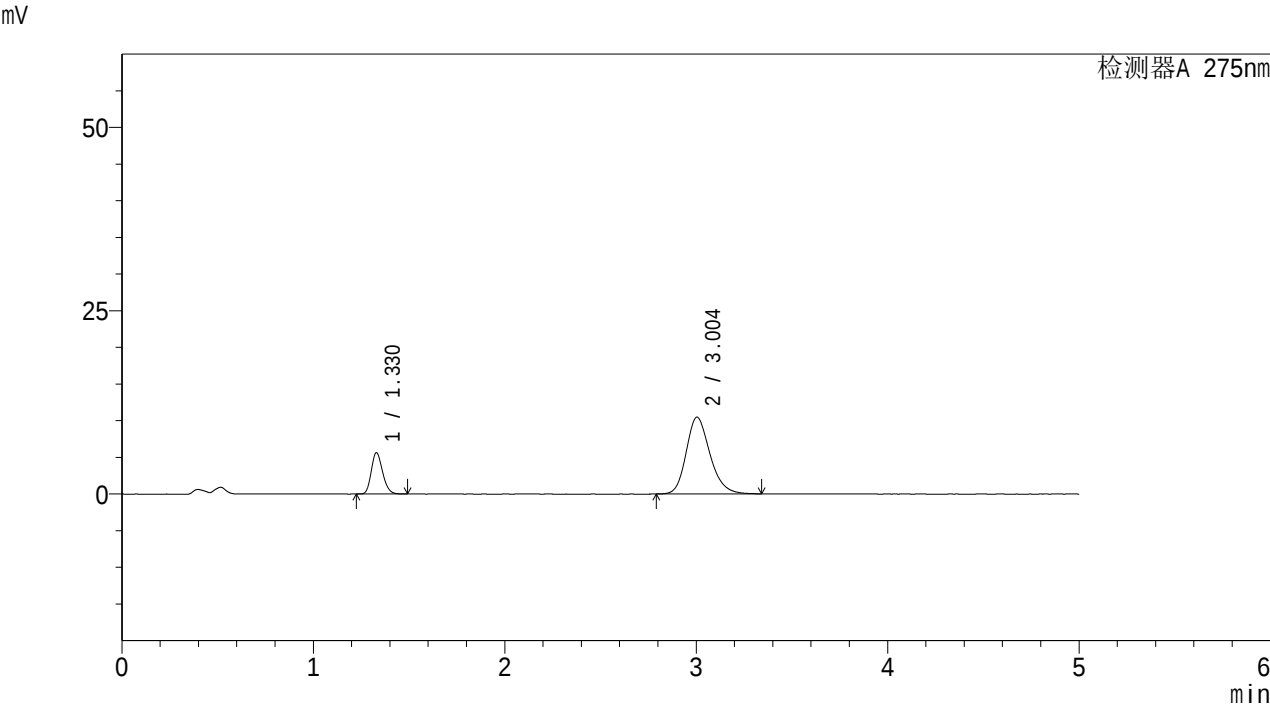

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	23198	20.286	5643	2415	1.197	--
2	3.004	91158	79.714	10491	2852	1.213	10.049
总计		114356	100.000	16134			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-109-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:00:10

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

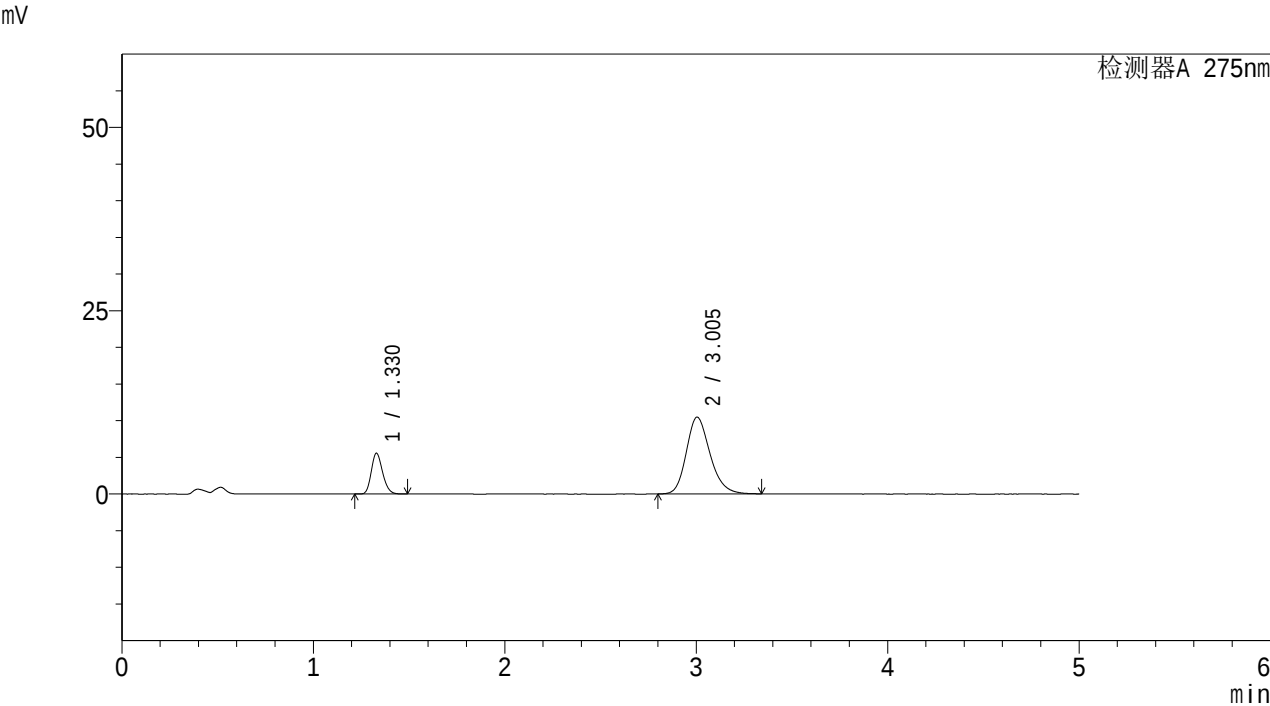

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	22875	20.079	5572	2417	1.196	--
2	3.005	91049	79.921	10494	2856	1.211	10.058
总计		113924	100.000	16066			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-110-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:05:34

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

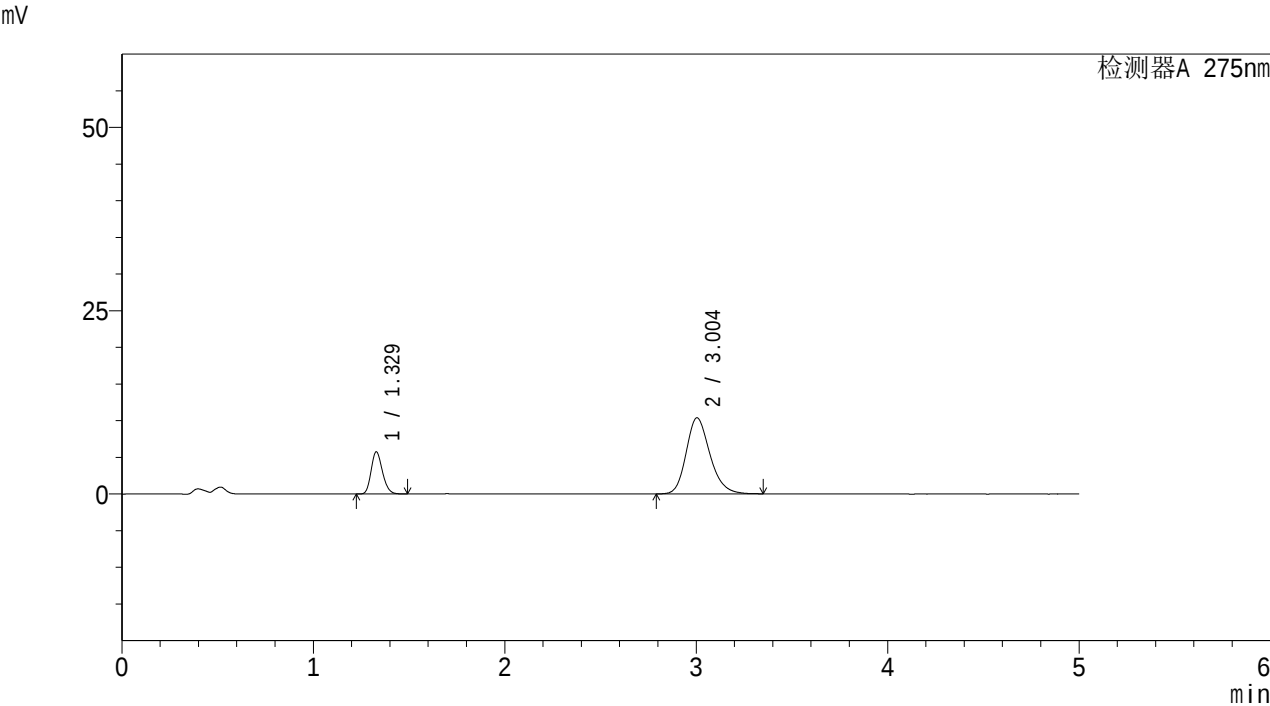

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	23690	20.761	5760	2416	1.196	--
2	3.004	90417	79.239	10399	2847	1.213	10.051
总计		114107	100.000	16159			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-111-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:10:57
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

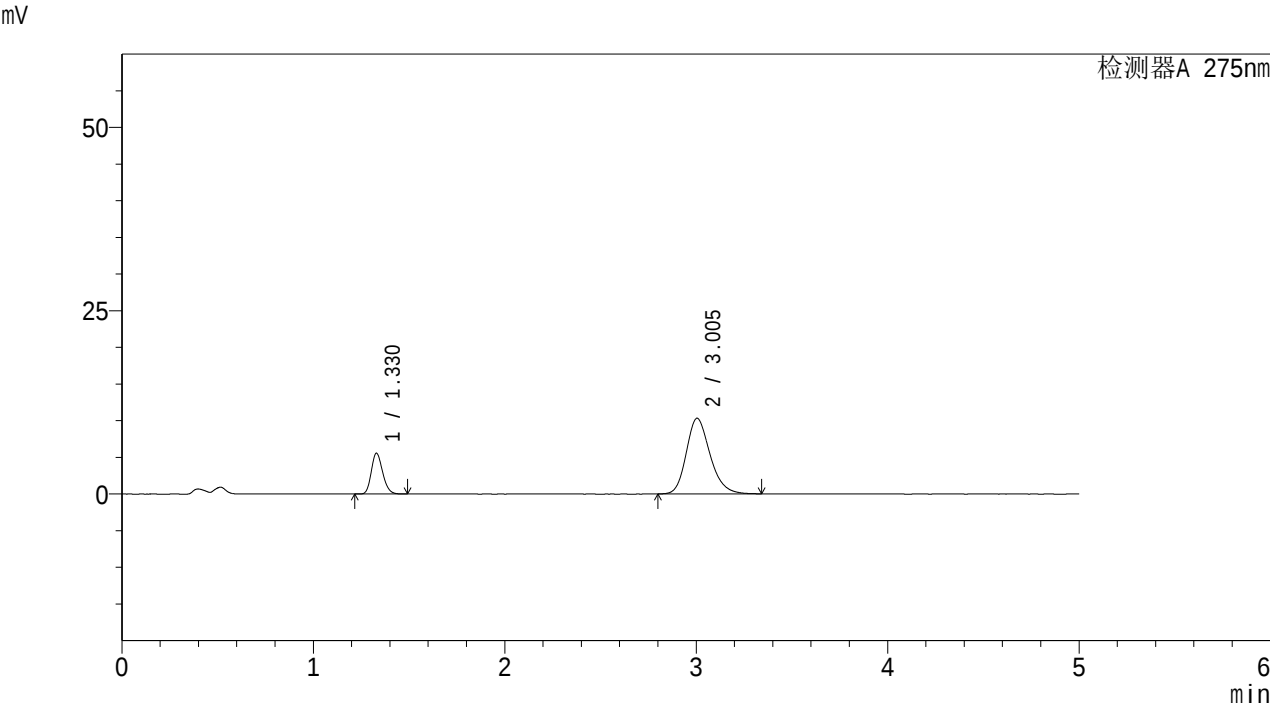

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	22855	20.288	5568	2418	1.196	--
2	3.005	89799	79.712	10335	2849	1.213	10.049
总计		112654	100.000	15904			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-112-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:16:21
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

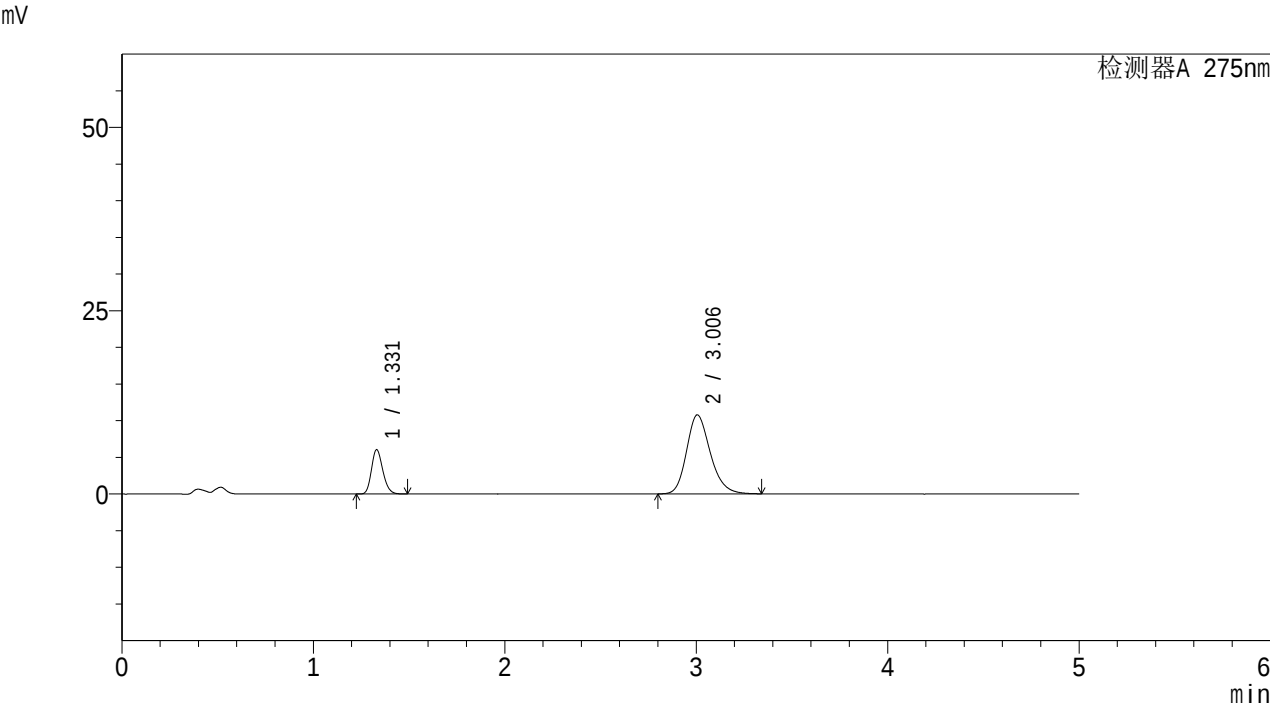

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	24852	20.968	6052	2419	1.197	--
2	3.006	93670	79.032	10787	2858	1.214	10.058
总计		118522	100.000	16839			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-113-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:21:46
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

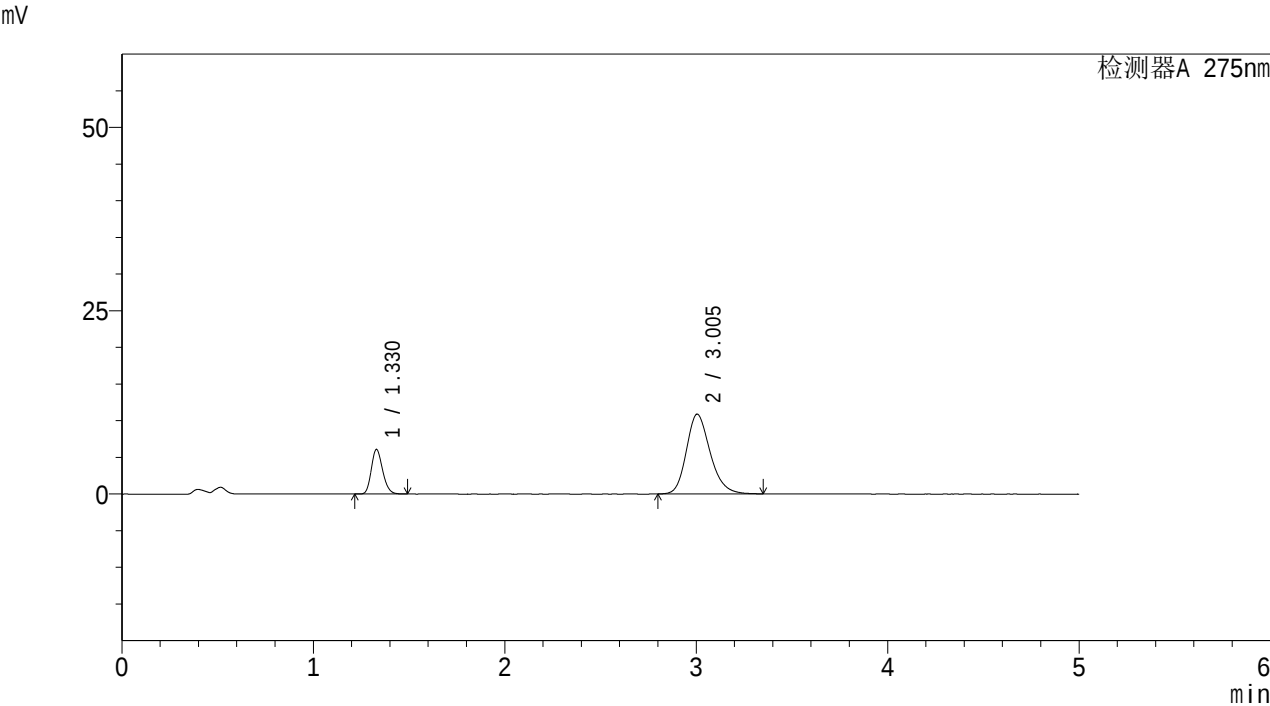

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	24998	20.883	6083	2415	1.195	--
2	3.005	94709	79.117	10892	2847	1.215	10.047
总计		119708	100.000	16975			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-114-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:27:09
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

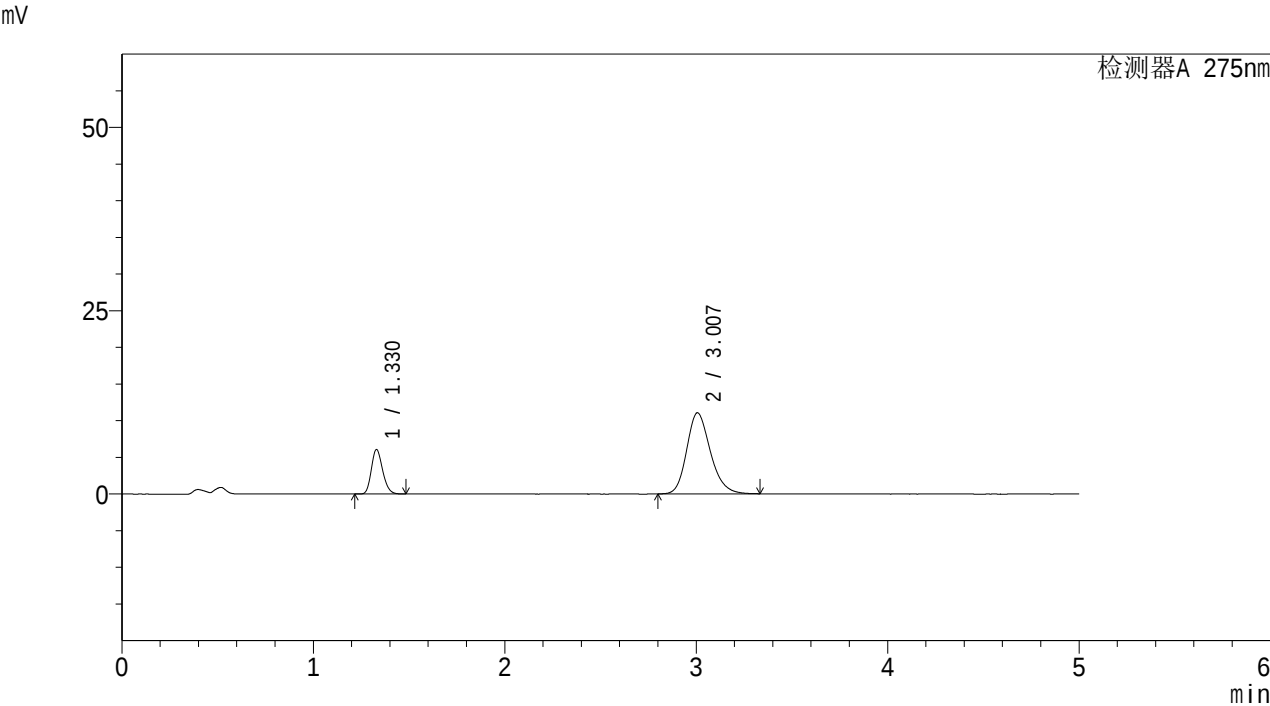

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	24945	20.655	6077	2422	1.198	--
2	3.007	95823	79.345	11067	2867	1.209	10.079
总计		120767	100.000	17144			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-115-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:32:33
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

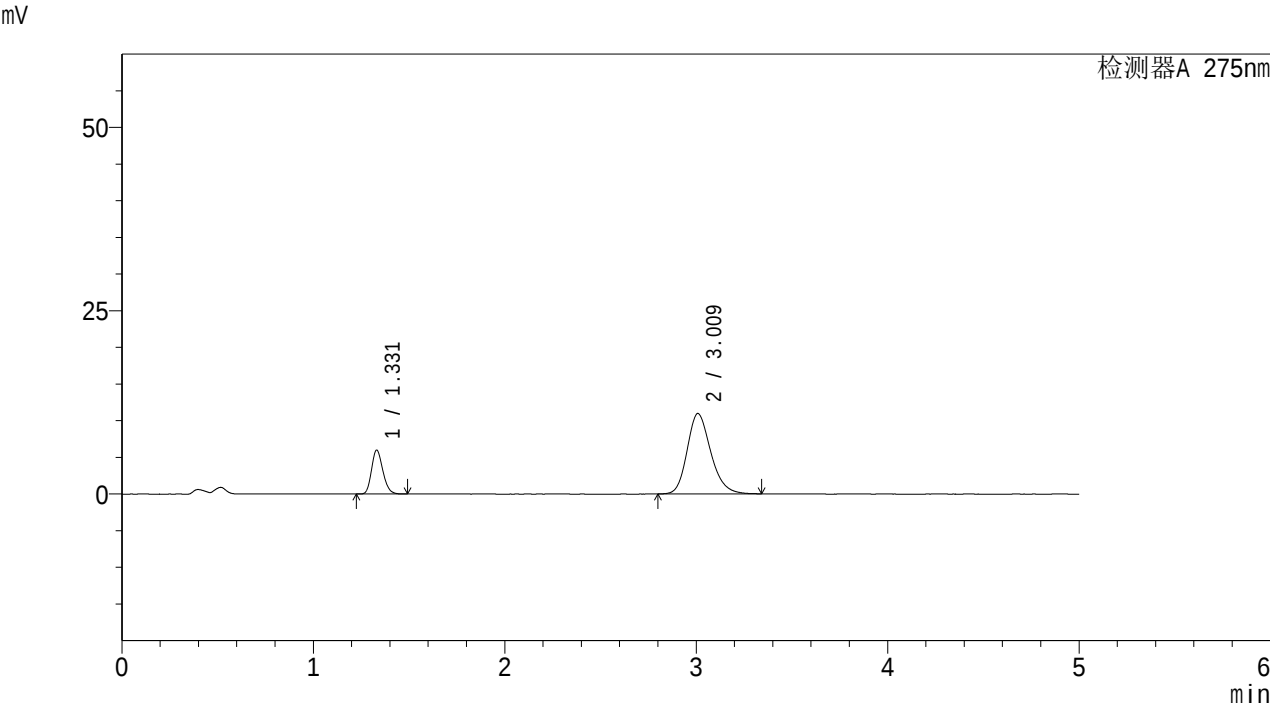

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	24534	20.527	5985	2429	1.194	--
2	3.009	94984	79.473	10953	2883	1.209	10.103
总计		119518	100.000	16937			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-116-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:37:58

处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

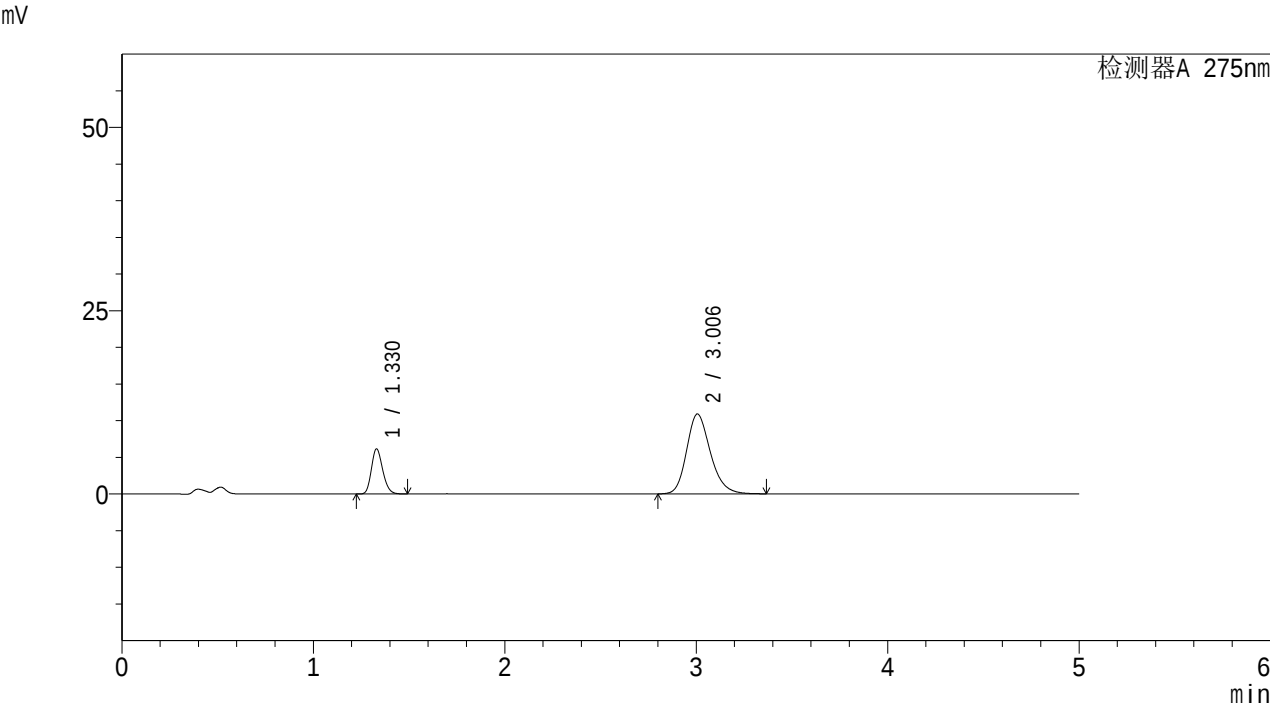

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	25245	21.012	6157	2425	1.196	--
2	3.006	94903	78.988	10910	2857	1.214	10.065
总计		120148	100.000	17066			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-117-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:43:22
处理时间(V2): 2026/05/14 19:57:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

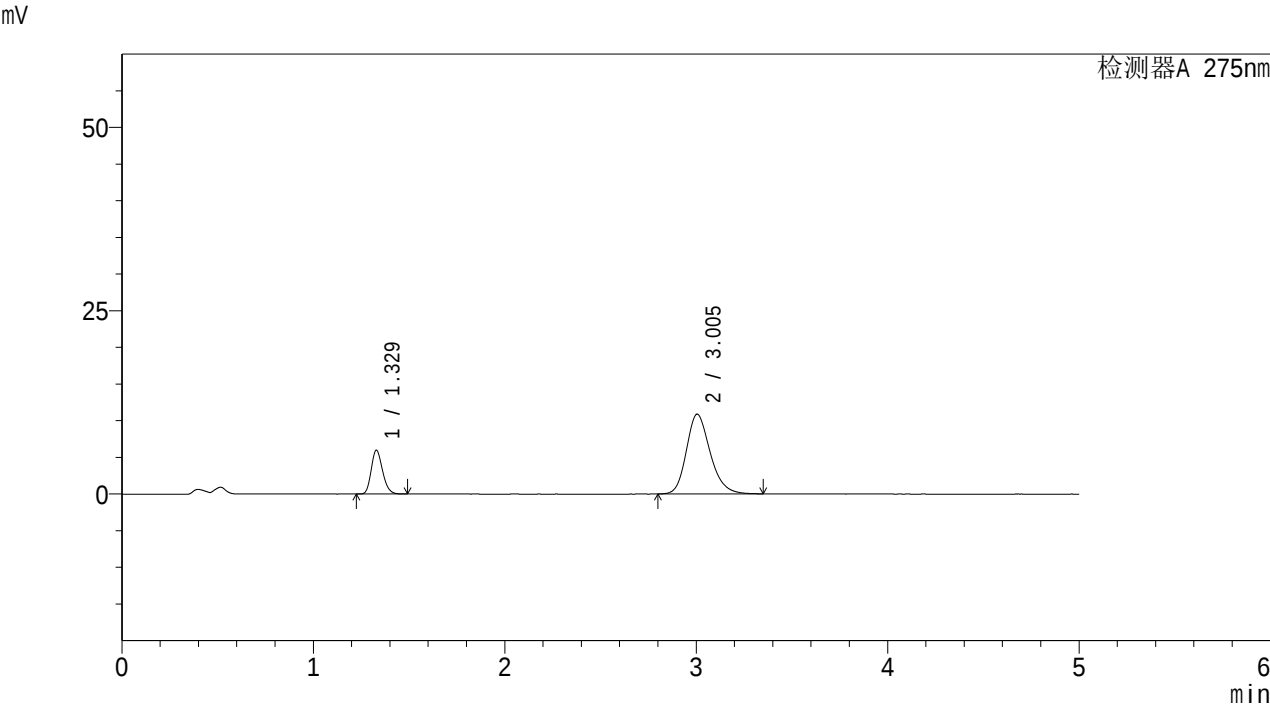

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	24587	20.606	5981	2415	1.198	--
2	3.005	94730	79.394	10892	2852	1.215	10.056
总计		119317	100.000	16874			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-118-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:48:46
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

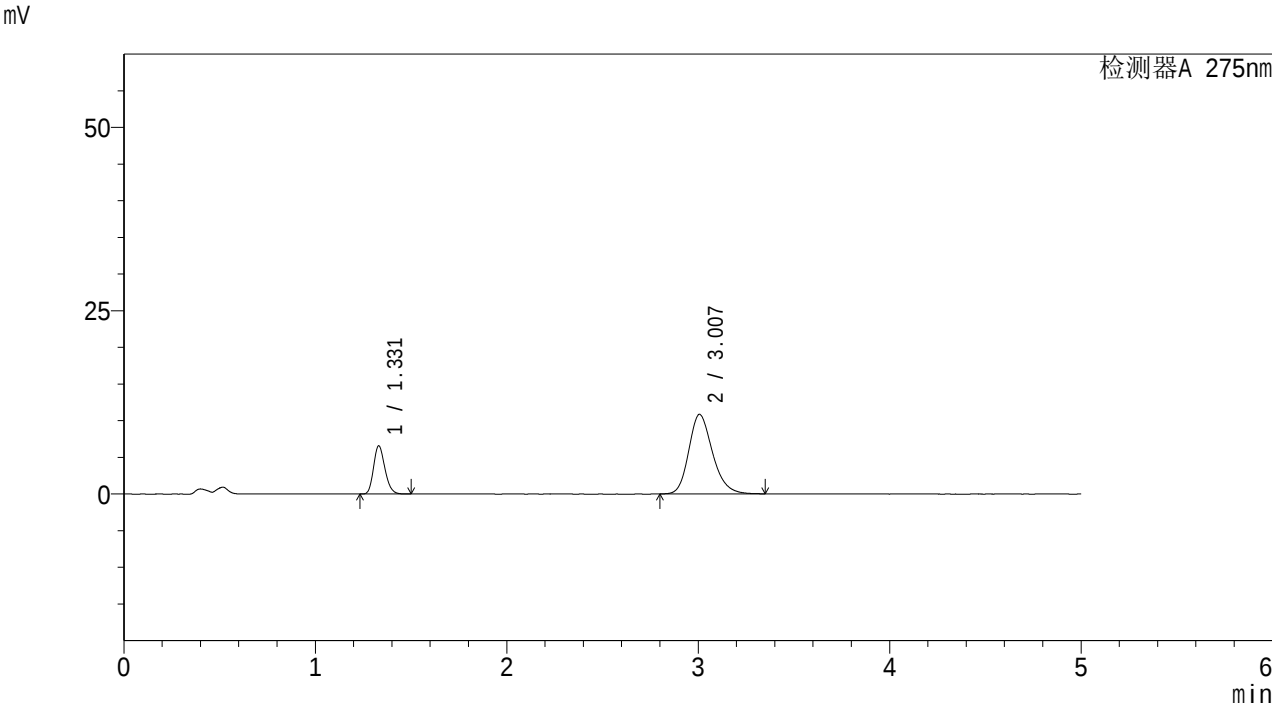

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	27048	22.299	6577	2419	1.197	--
2	3.007	94248	77.701	10856	2863	1.214	10.064
总计		121296	100.000	17433			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-119-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:54:11
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

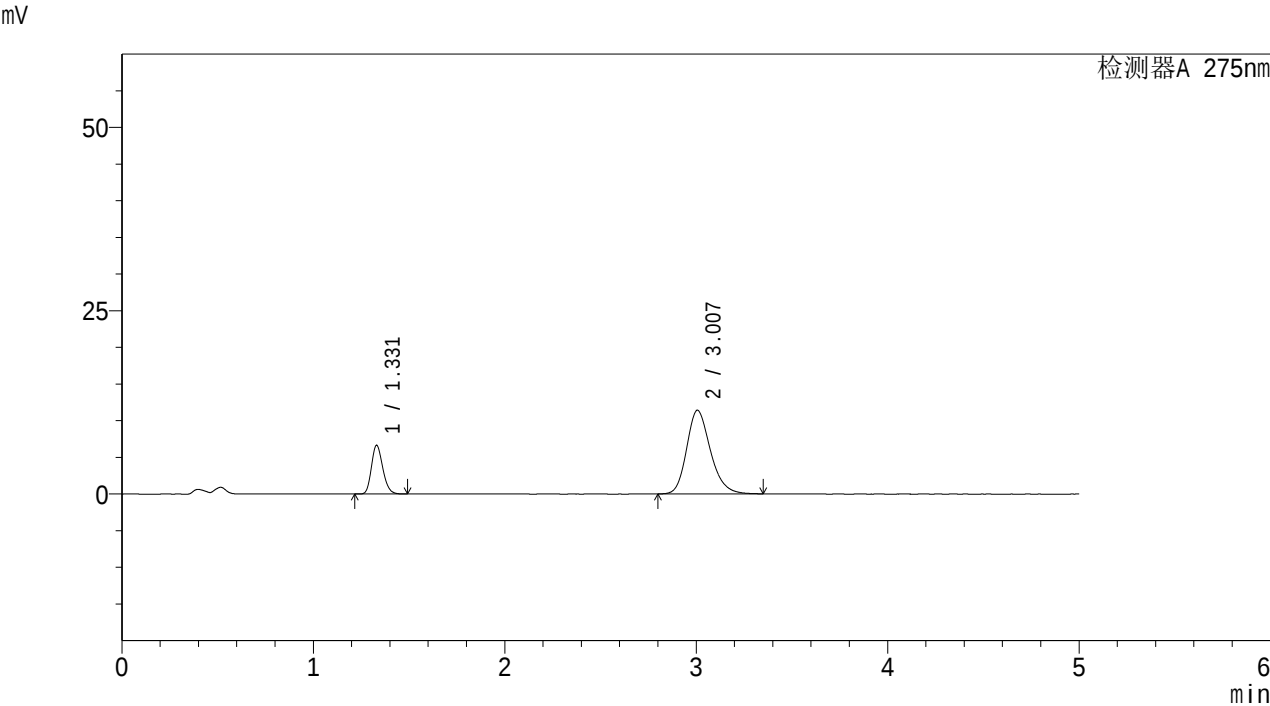

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	27339	21.602	6655	2418	1.196	--
2	3.007	99216	78.398	11416	2862	1.216	10.065
总计		126555	100.000	18071			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-120-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:59:35
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

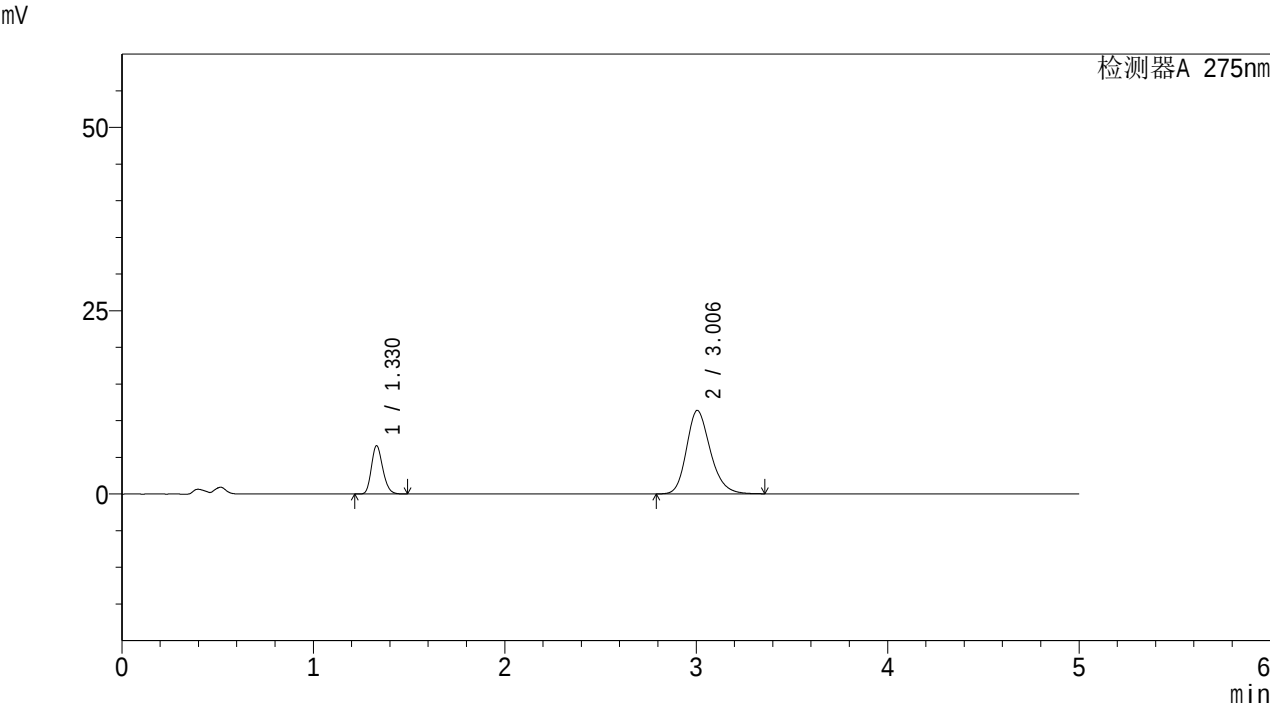

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	27093	21.454	6598	2421	1.197	--
2	3.006	99188	78.546	11398	2850	1.217	10.052
总计		126281	100.000	17996			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-121-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:05:00

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

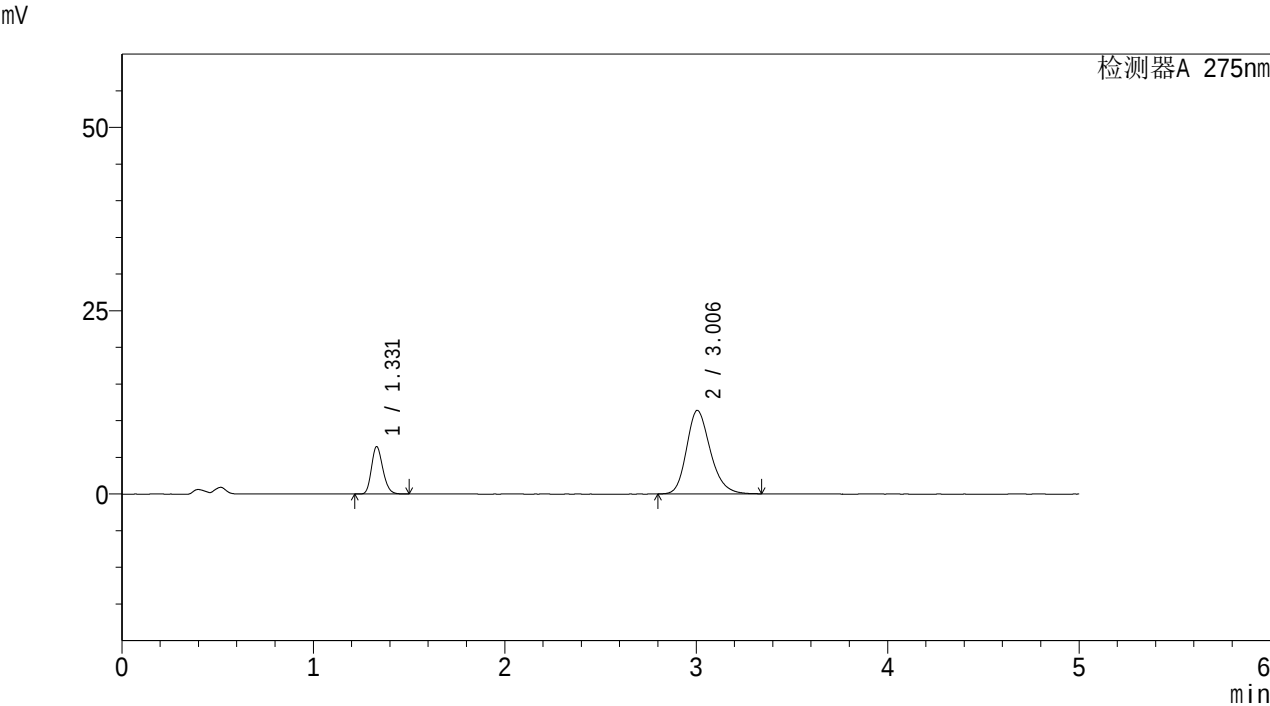

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	26608	21.194	6471	2417	1.198	--
2	3.006	98935	78.806	11403	2859	1.216	10.057
总计		125543	100.000	17875			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-122-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:10:25
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

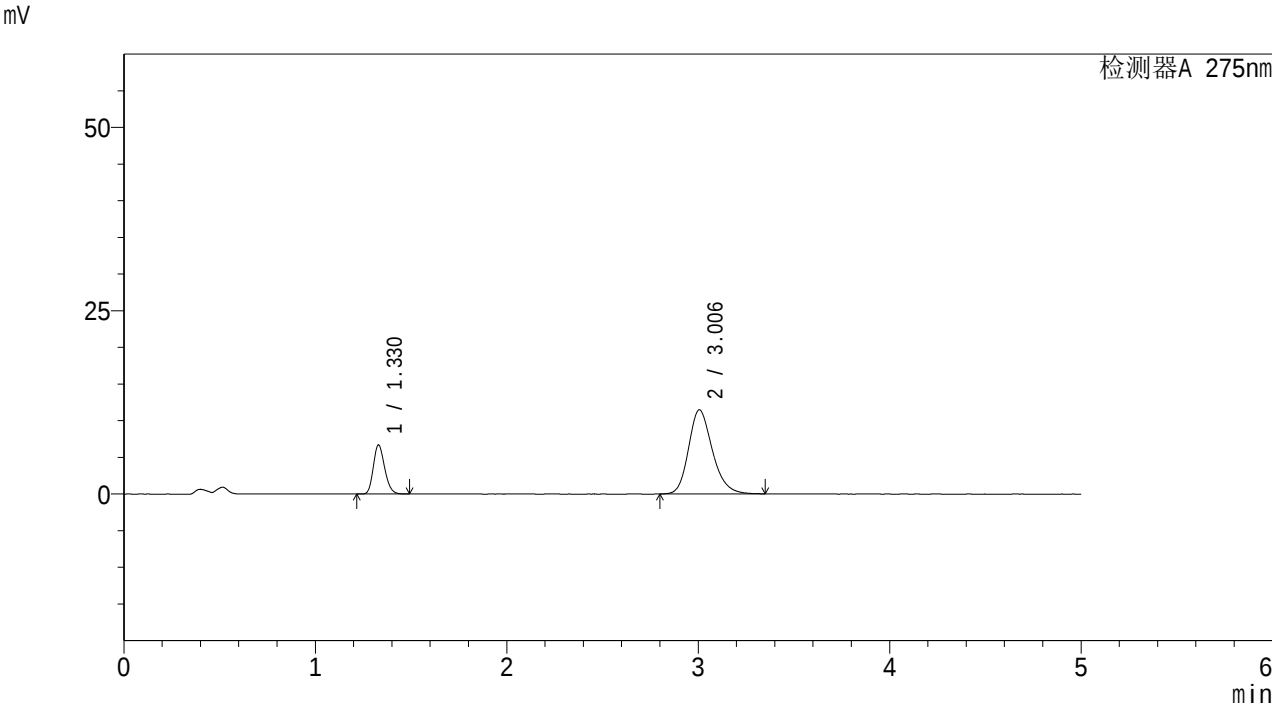

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	27500	21.581	6699	2420	1.197	--
2	3.006	99929	78.419	11489	2850	1.218	10.055
总计		127429	100.000	18188			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-123-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:15:49

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

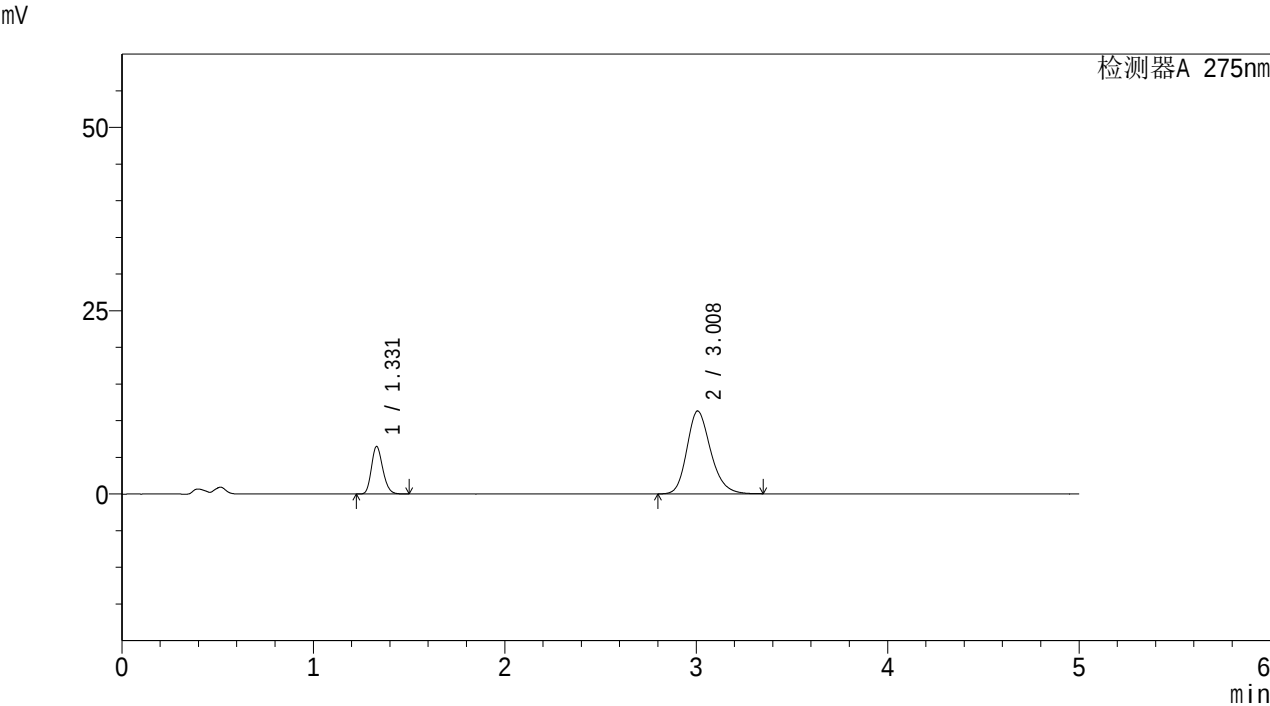

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	26648	21.323	6490	2424	1.198	--
2	3.008	98325	78.677	11302	2858	1.215	10.070
总计		124973	100.000	17792			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-124-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:21:13

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

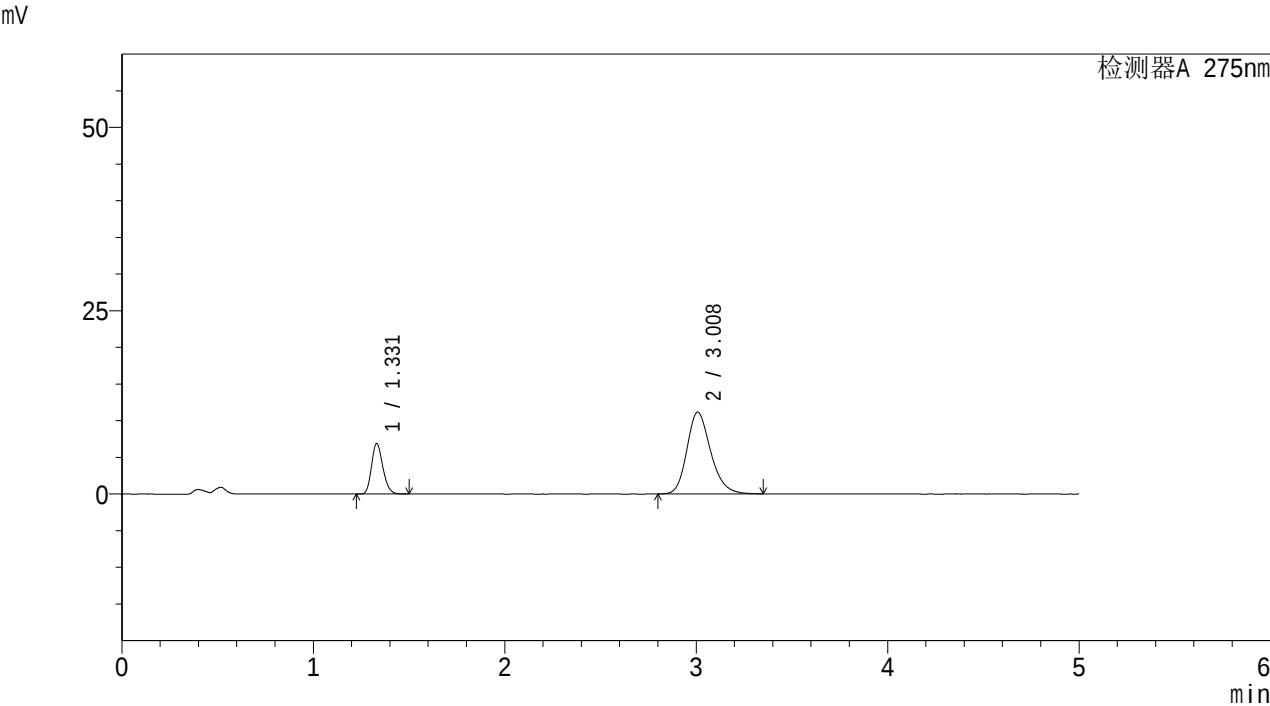

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	28351	22.600	6897	2421	1.199	--
2	3.008	97097	77.400	11155	2855	1.215	10.060
总计		125449	100.000	18053			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-125-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:26:36

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

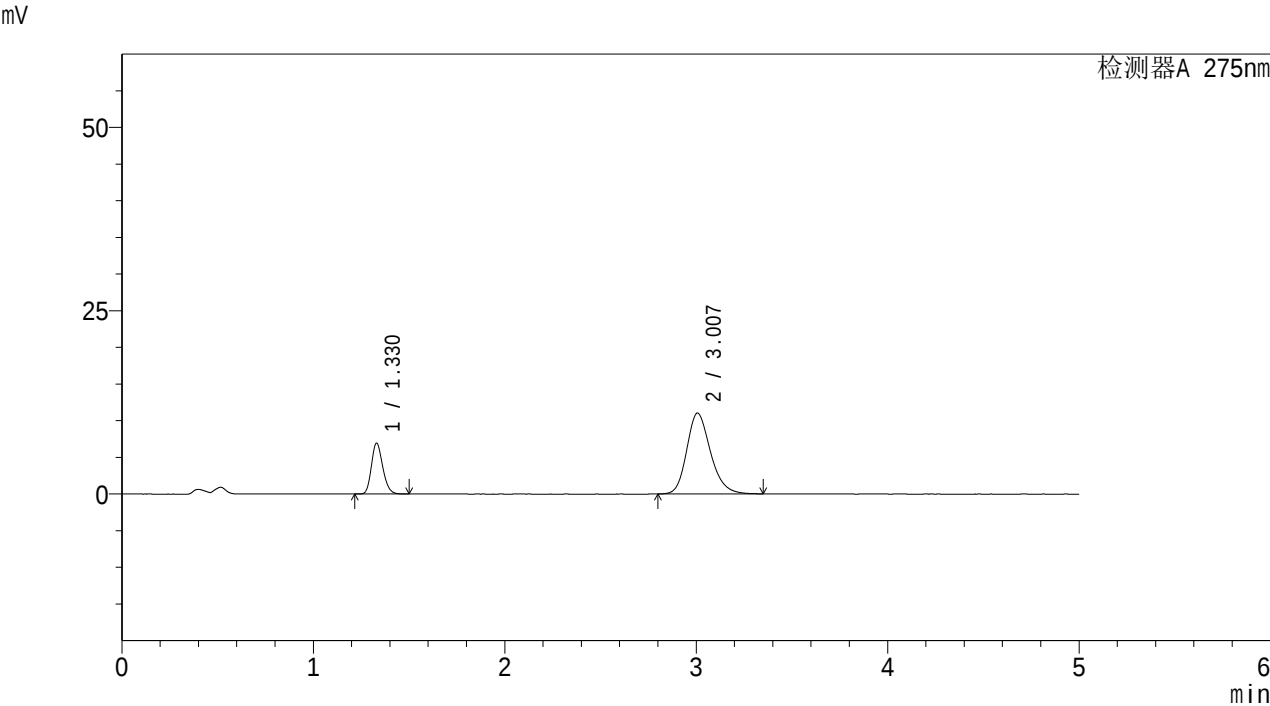

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28520	22.925	6940	2421	1.196	--
2	3.007	95886	77.075	11030	2859	1.214	10.065
总计		124406	100.000	17969			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-126-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:31:59

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

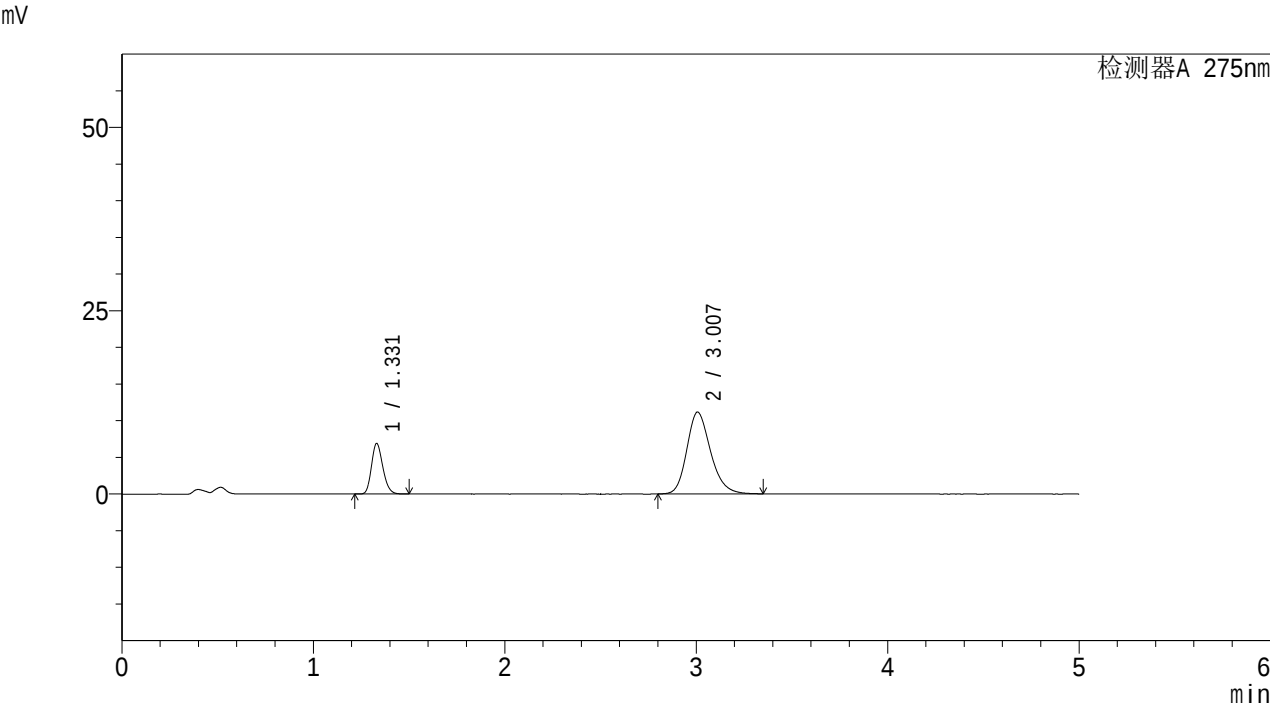

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	28429	22.656	6909	2417	1.198	--
2	3.007	97052	77.344	11167	2861	1.215	10.065
总计		125481	100.000	18076			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-127-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:37:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

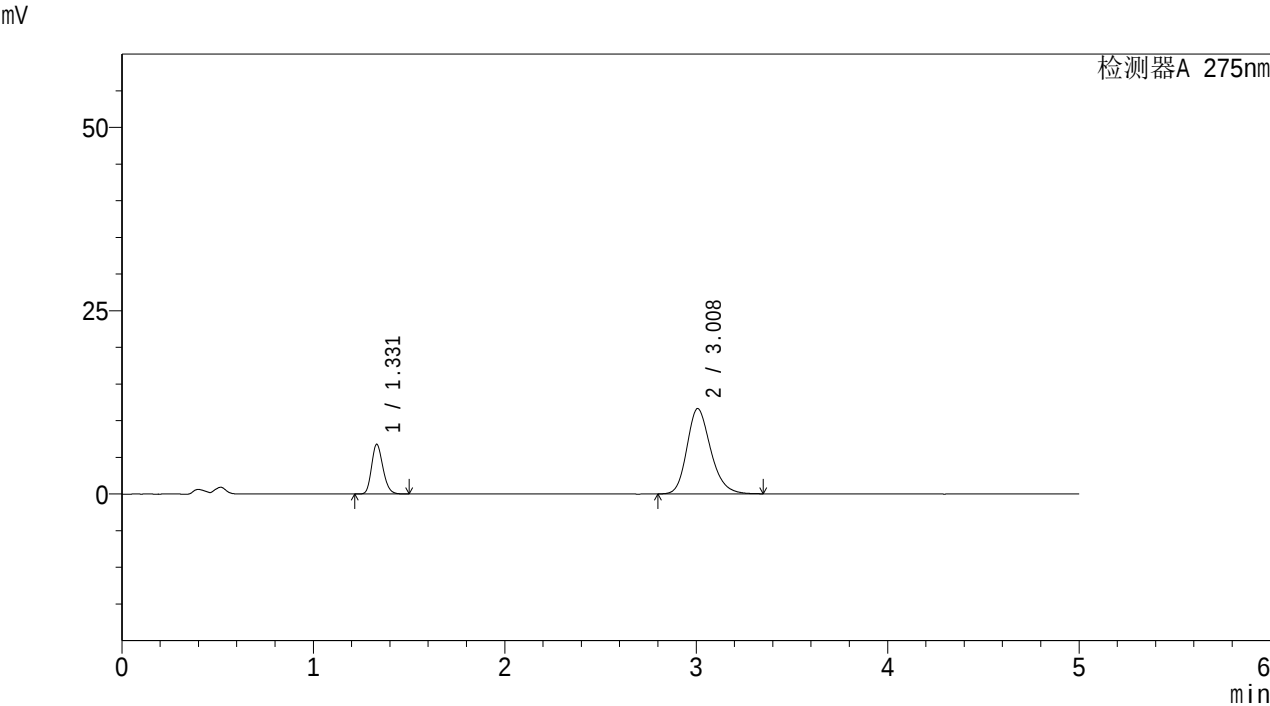

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	27885	21.609	6776	2421	1.198	--
2	3.008	101159	78.391	11636	2861	1.217	10.065
总计		129044	100.000	18412			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-128-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:42:45

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

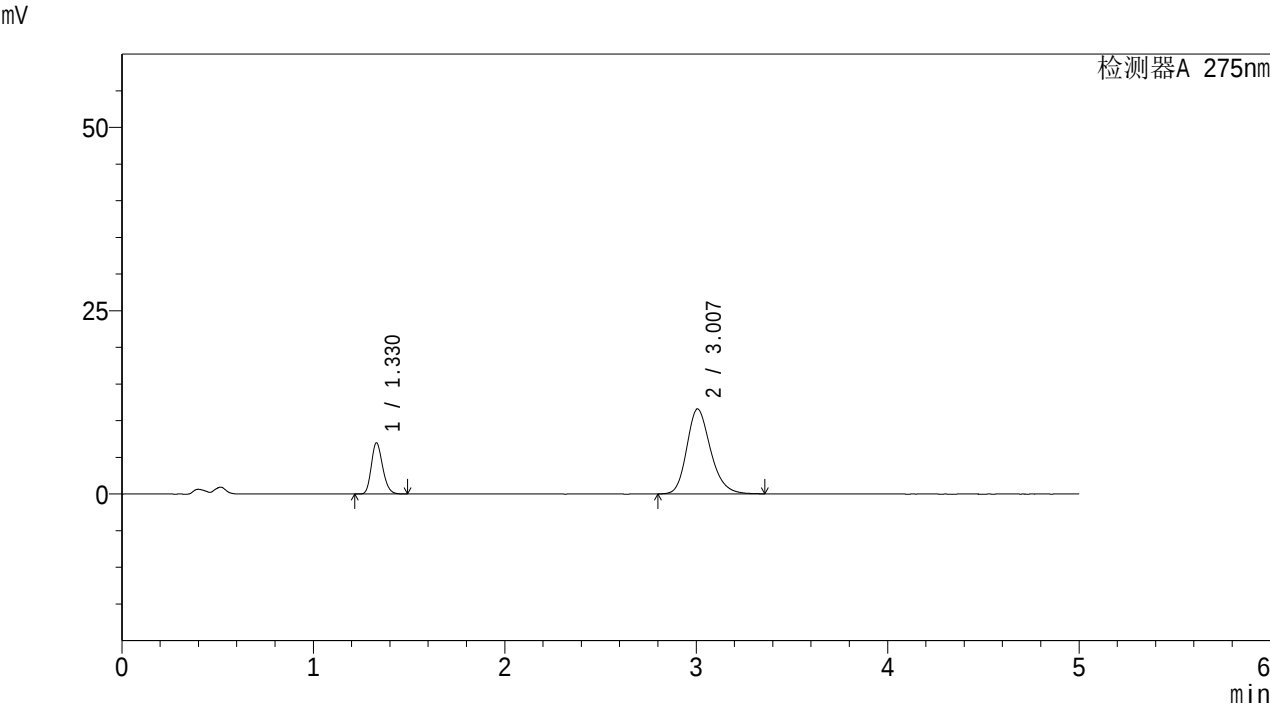

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28658	22.117	6986	2425	1.195	--
2	3.007	100915	77.883	11597	2856	1.217	10.070
总计		129573	100.000	18583			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-129-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:48:08

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

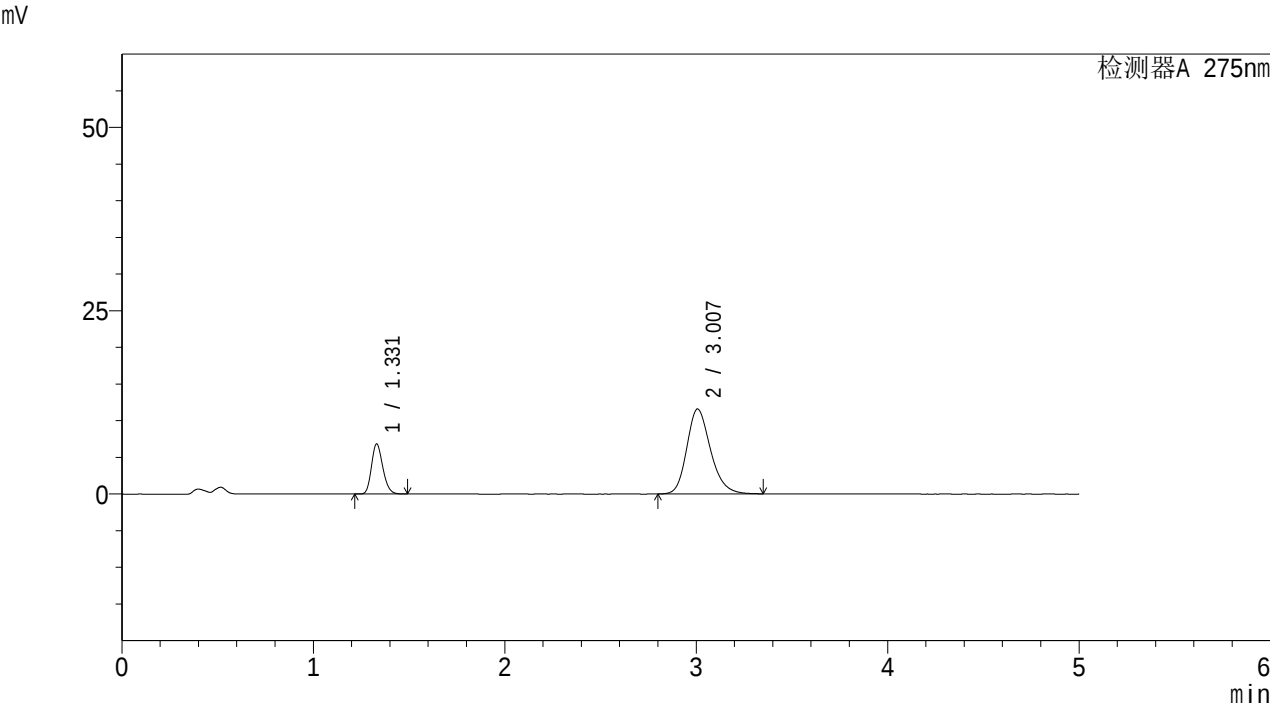

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	28057	21.795	6837	2423	1.198	--
2	3.007	100673	78.205	11590	2866	1.217	10.074
总计		128730	100.000	18427			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-130-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:53:31

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

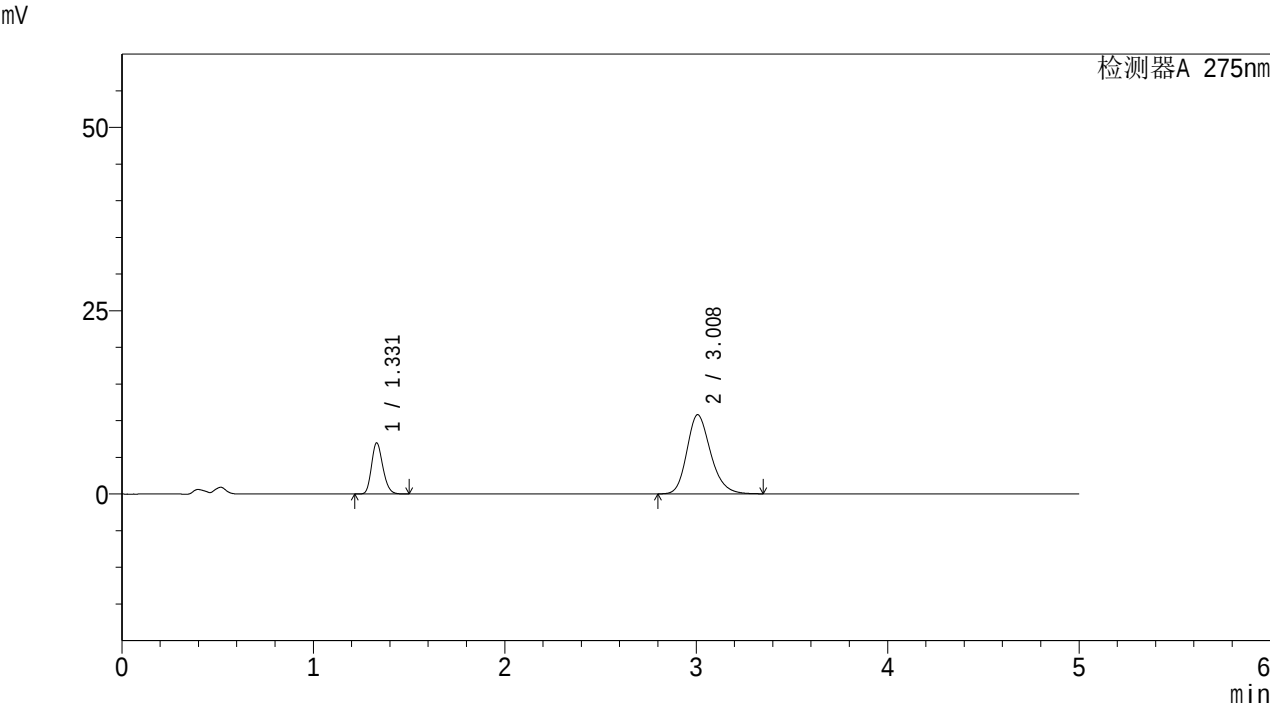

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	28678	23.410	6977	2422	1.198	--
2	3.008	93824	76.590	10796	2860	1.213	10.067
总计		122502	100.000	17773			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-131-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:58:54
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

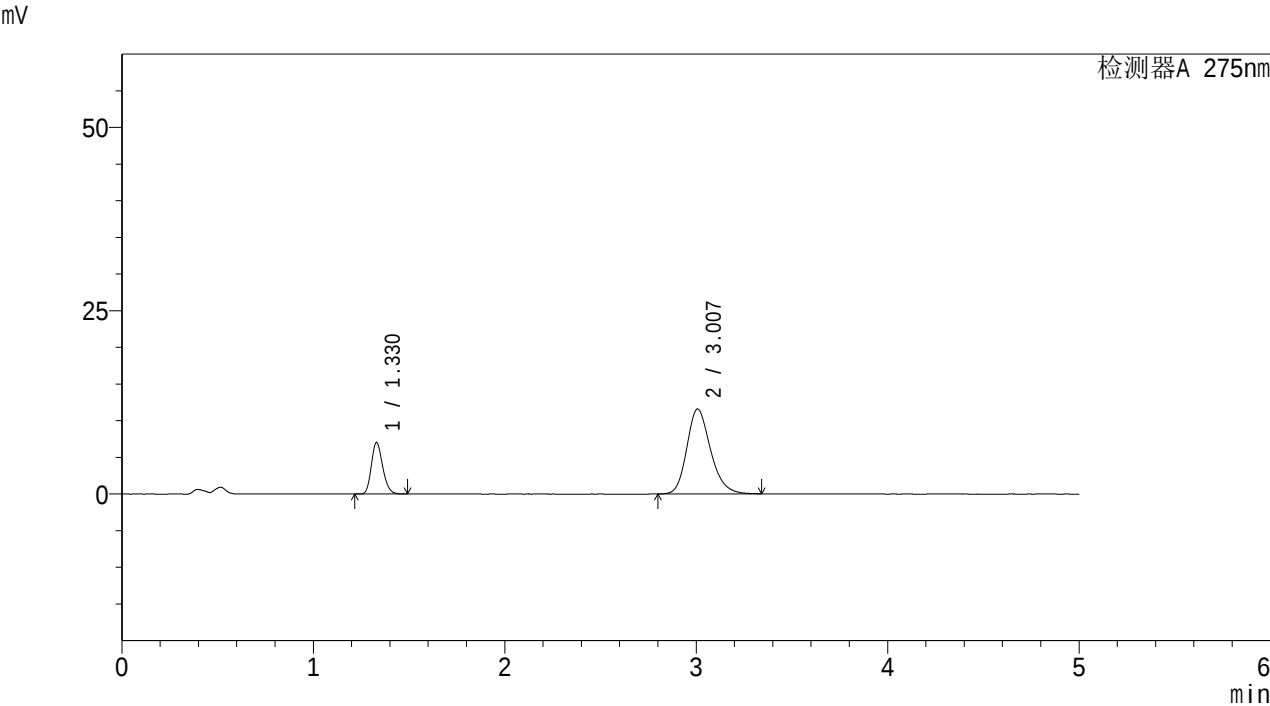

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28897	22.335	7039	2420	1.197	--
2	3.007	100484	77.665	11585	2867	1.214	10.079
总计		129380	100.000	18625			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-132-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:04:17
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

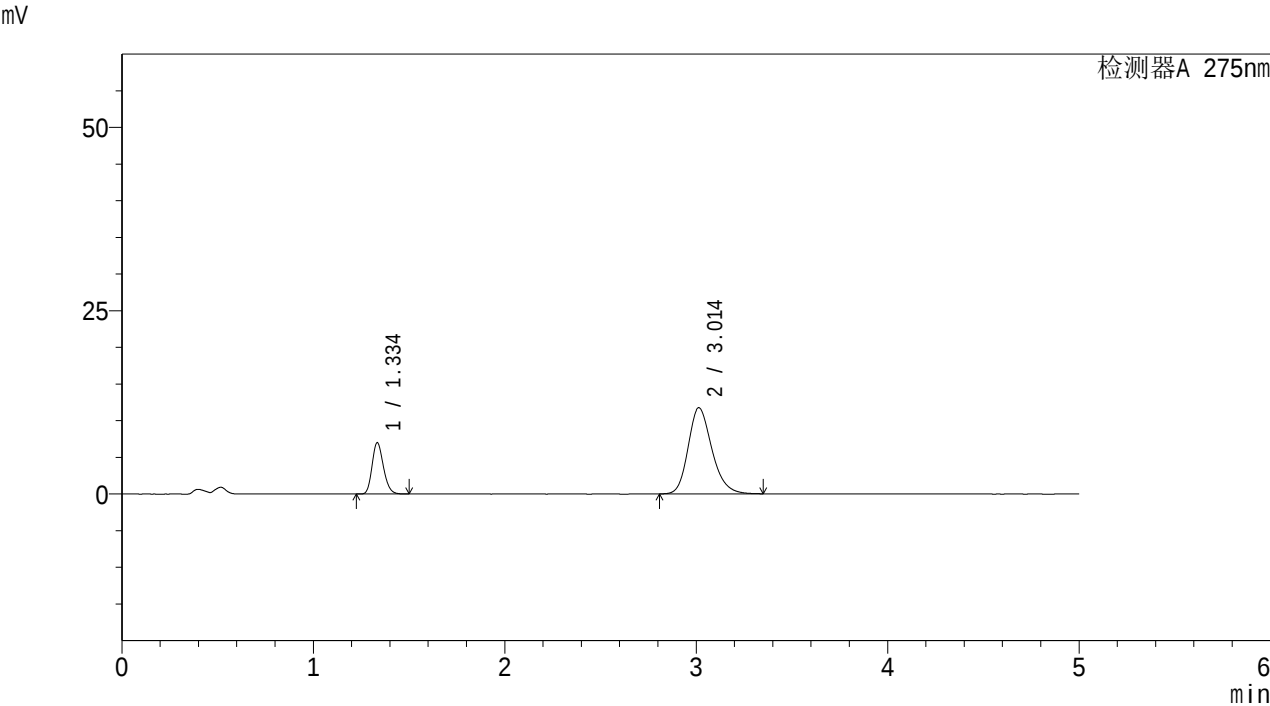

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.334	28798	22.023	6937	2428	1.200	--
2	3.014	101964	77.977	11763	2879	1.215	10.094
总计		130762	100.000	18699			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-133-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:09:40

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

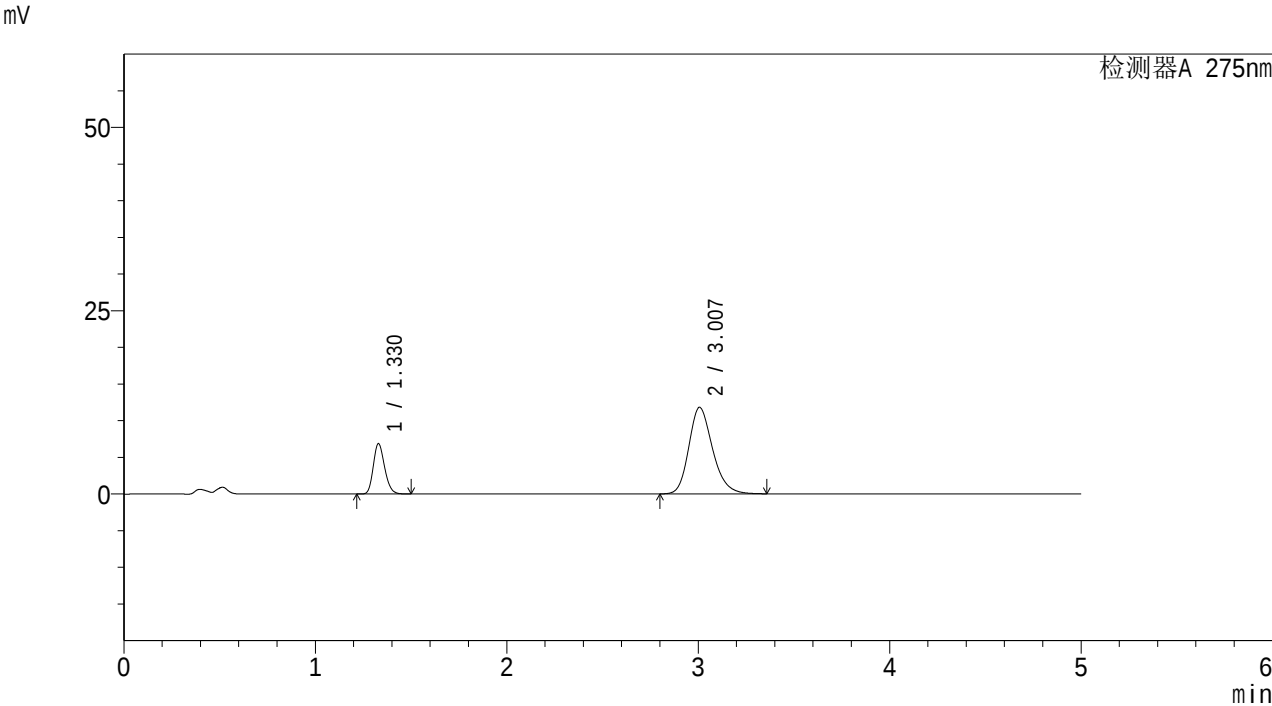

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28210	21.534	6872	2423	1.199	--
2	3.007	102794	78.466	11818	2855	1.217	10.070
总计		131004	100.000	18690			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-134-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:15:02

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

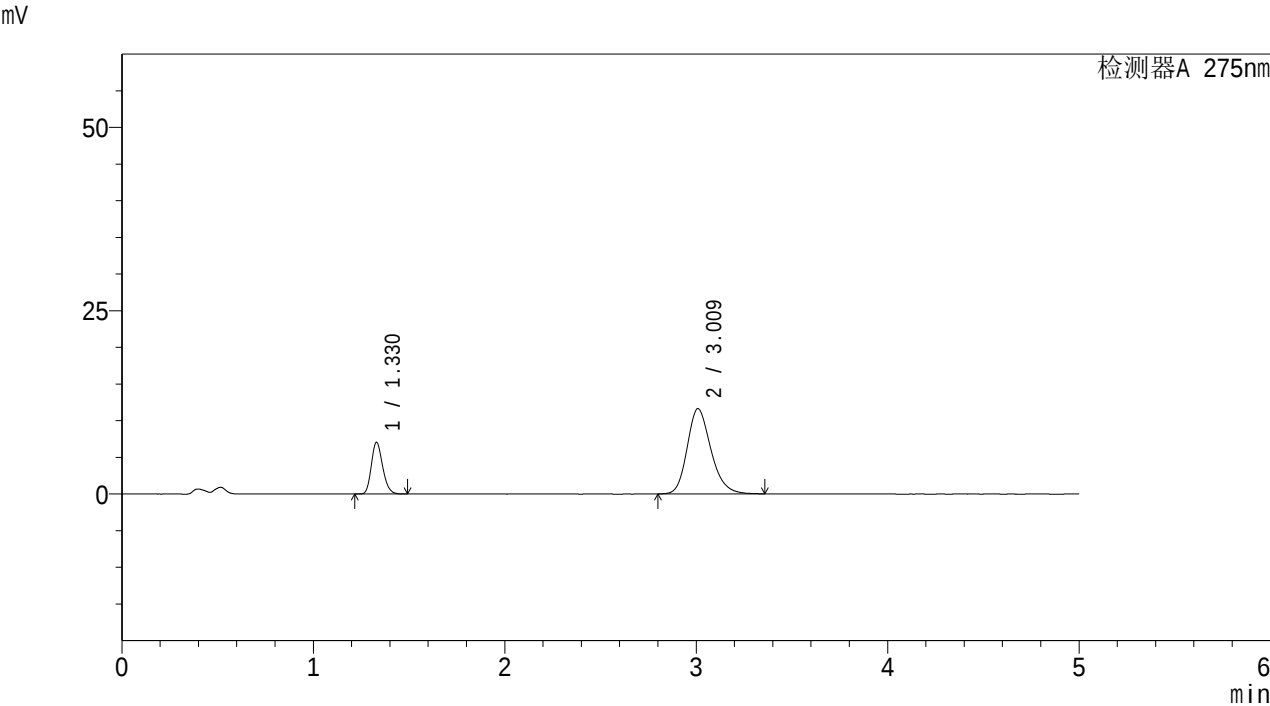

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28925	22.230	7055	2427	1.196	--
2	3.009	101191	77.770	11610	2858	1.215	10.081
总计		130116	100.000	18665			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-135-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:20:25
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

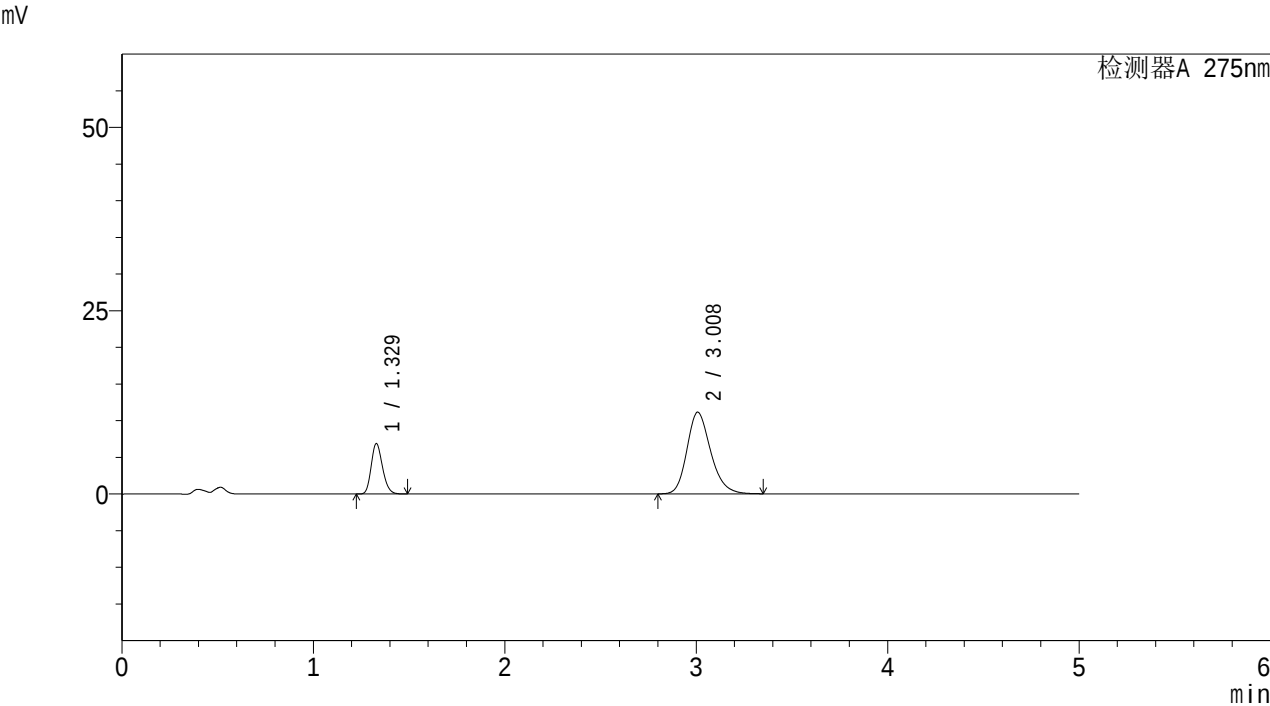

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28225	22.565	6880	2420	1.196	--
2	3.008	96857	77.435	11134	2864	1.215	10.086
总计		125081	100.000	18014			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-136-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:25:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

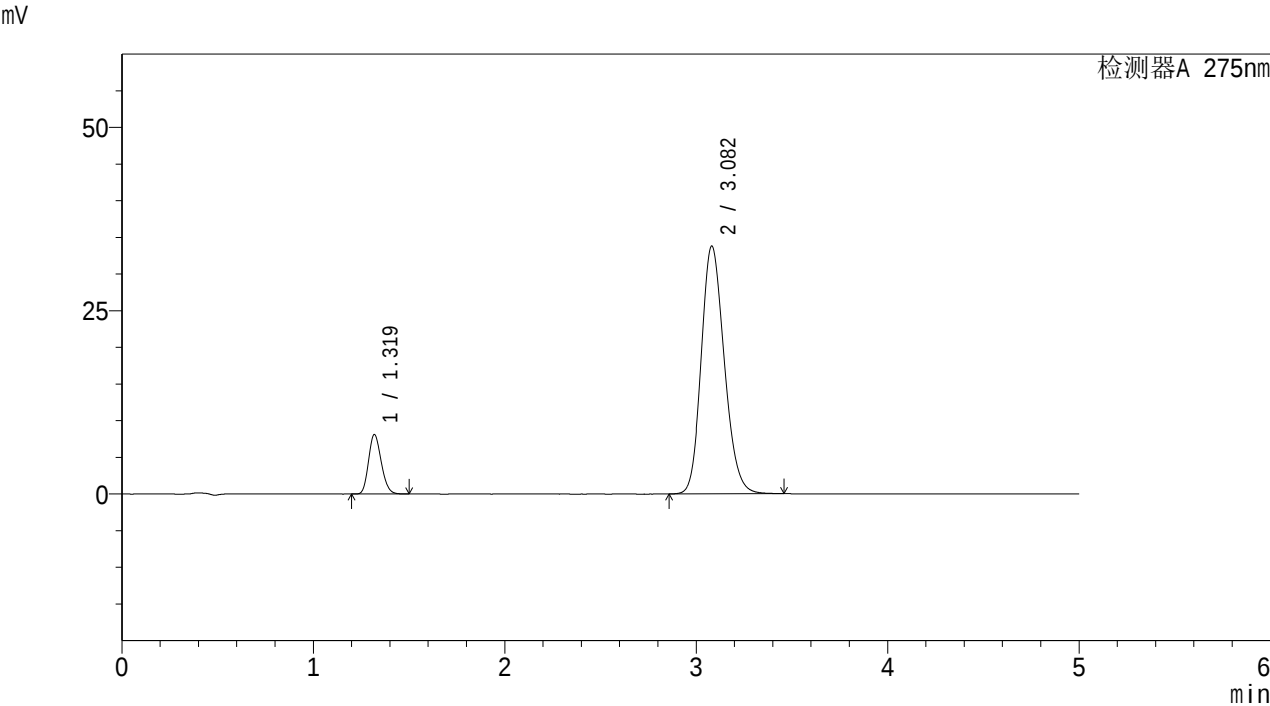

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	37334	11.650	8073	1880	1.181	--
2	3.082	283113	88.350	33790	3156	1.176	10.338
总计		320447	100.000	41863			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-137-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:31:14

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

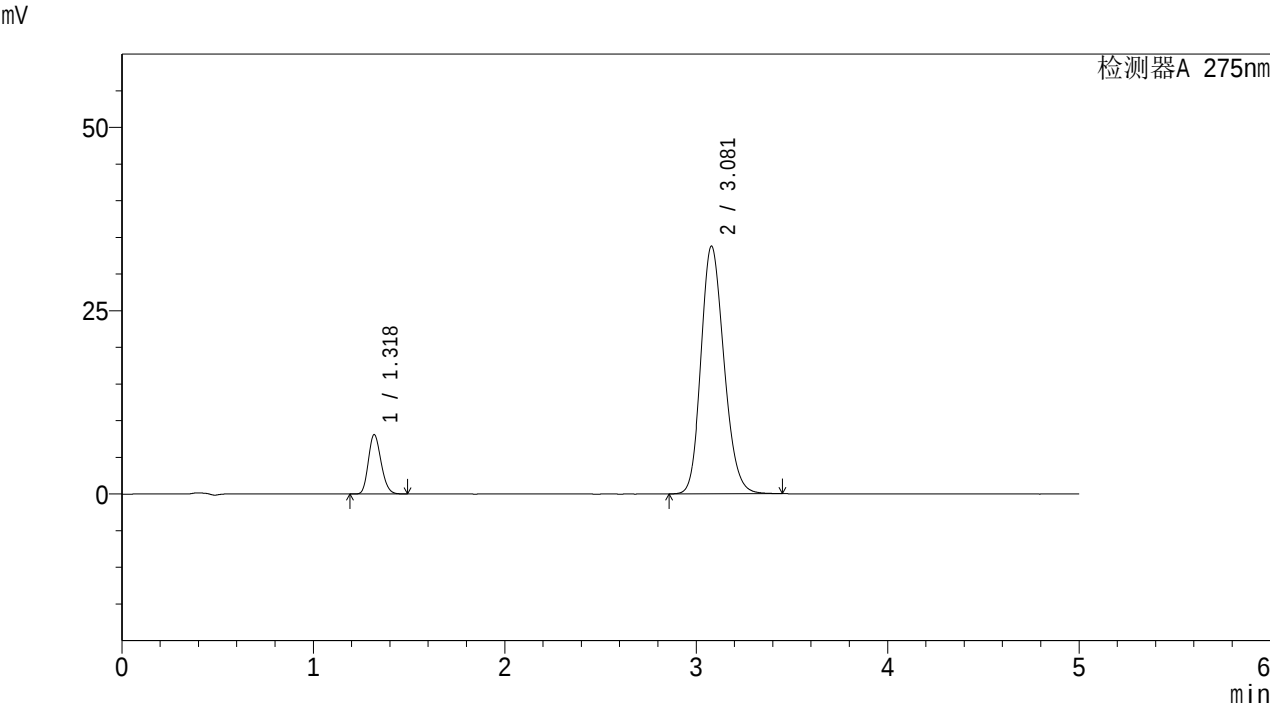

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.318	37315	11.660	8045	1877	1.182	--
2	3.081	282709	88.340	33801	3160	1.176	10.342
总计		320024	100.000	41845			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-138-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:36:36
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

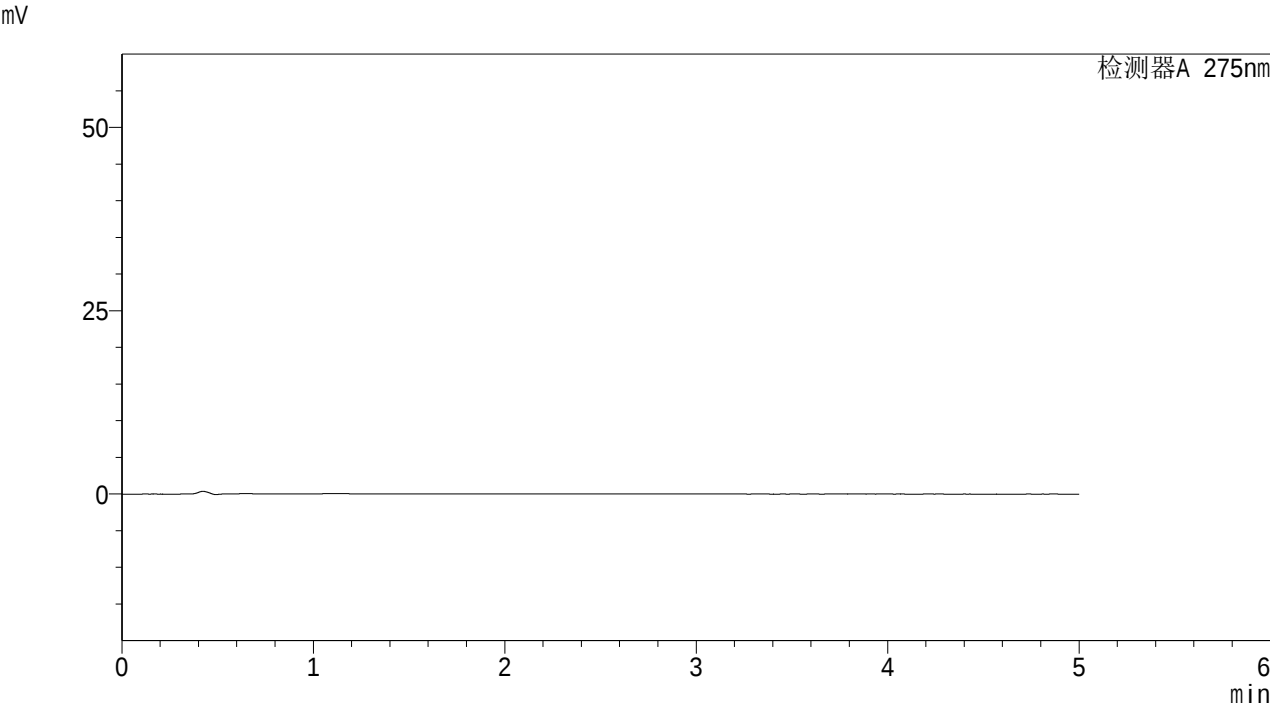

<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-139-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:41:59
处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

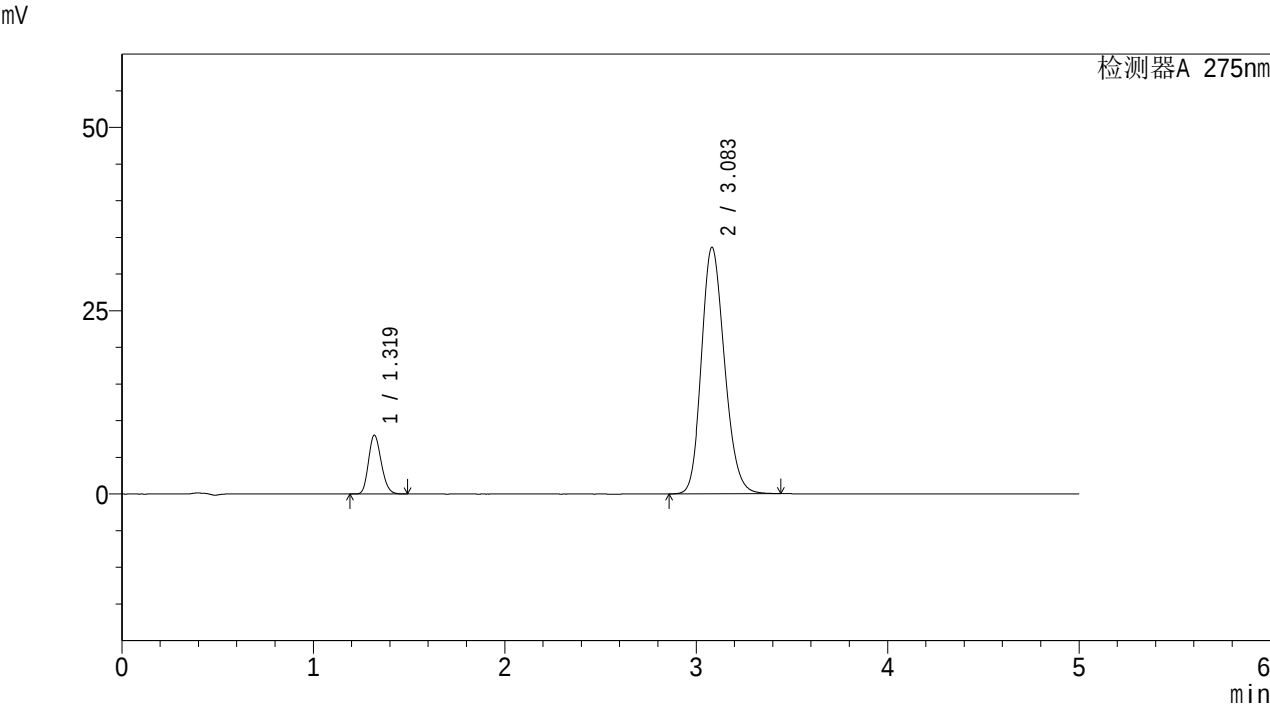

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	37011	11.622	7999	1874	1.180	--
2	3.083	281443	88.378	33591	3160	1.176	10.341
总计		318454	100.000	41590			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-140-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:47:21

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

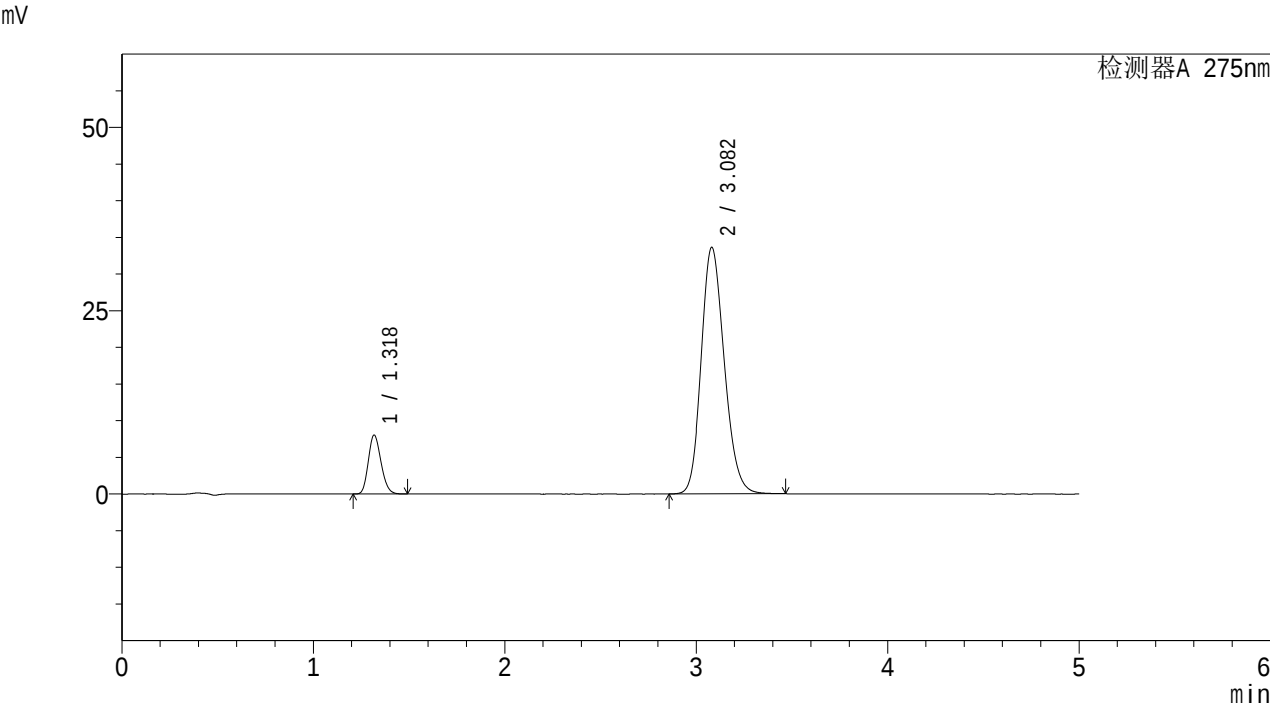

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.318	37095	11.640	7976	1869	1.181	--
2	3.082	281586	88.360	33620	3160	1.176	10.342
总计		318680	100.000	41596			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-141-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:52:44

处理时间(V2): 2026/05/14 19:58:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

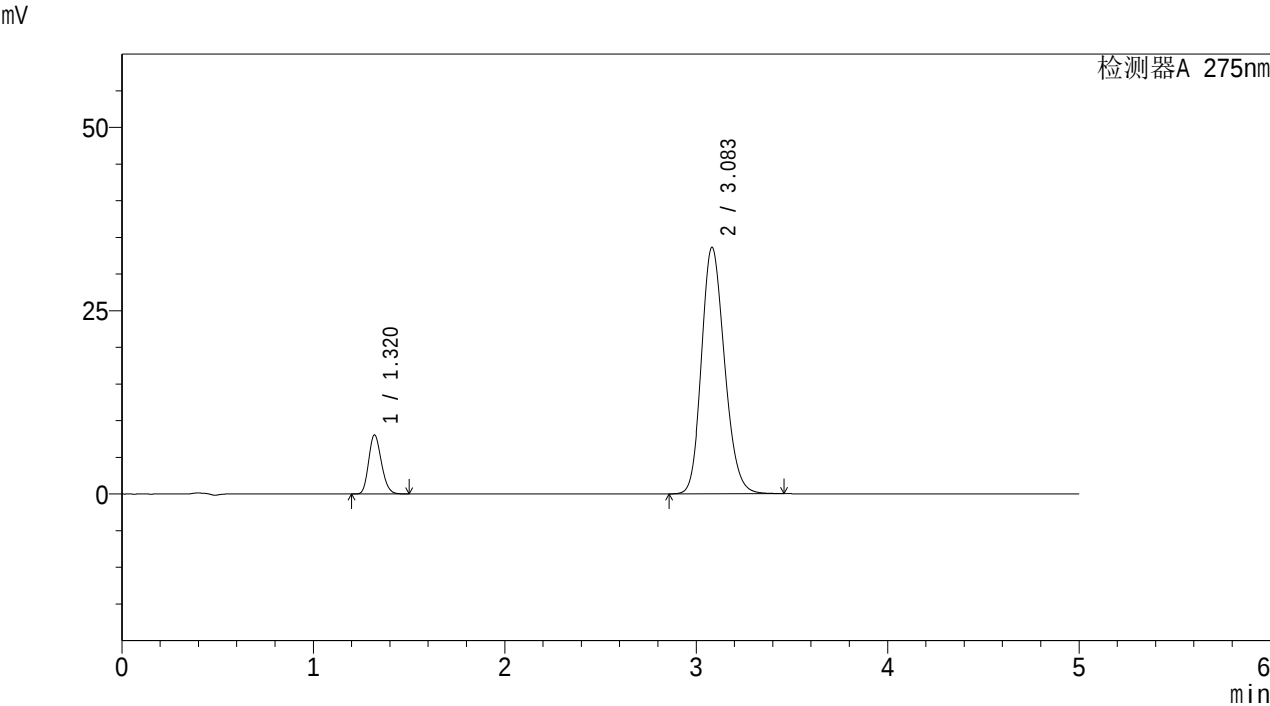

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	37164	11.661	8036	1874	1.181	--
2	3.083	281550	88.339	33584	3162	1.177	10.337
总计		318714	100.000	41620			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-142-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:58:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

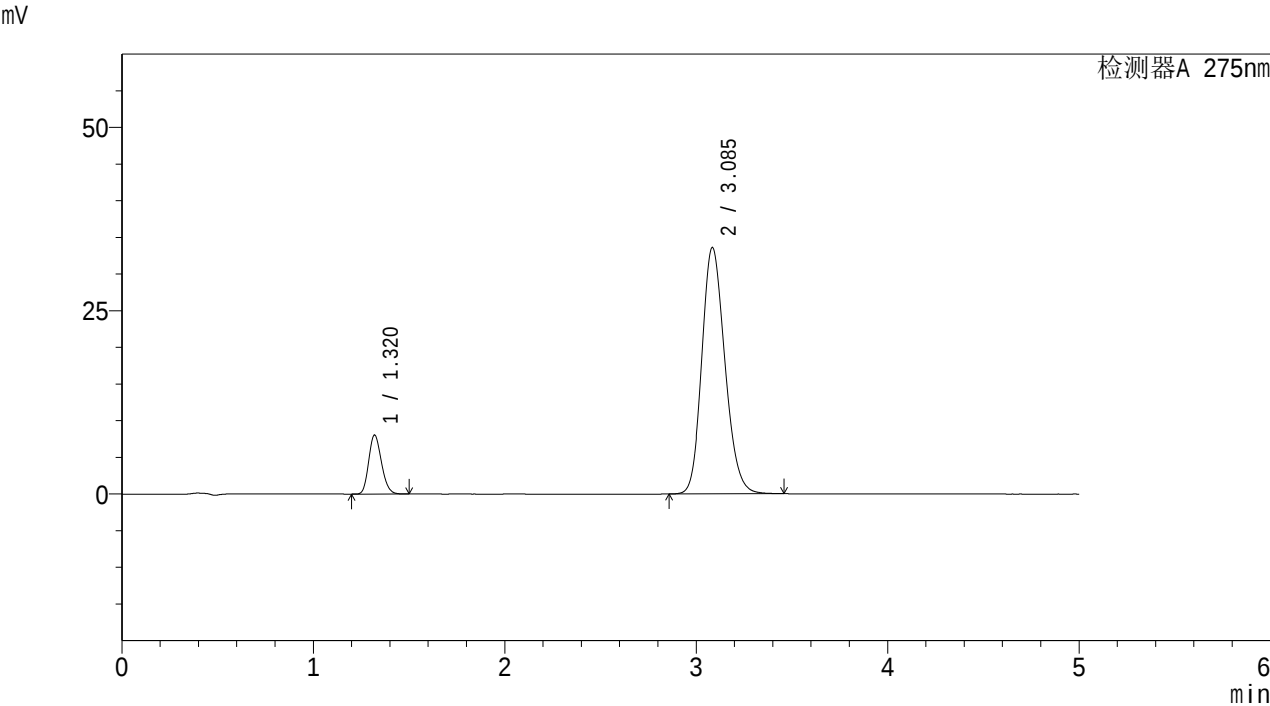

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.320	37178	11.662	8038	1873	1.181	--
2	3.085	281615	88.338	33557	3158	1.176	10.336
总计		318793	100.000	41596			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-143-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:03:30
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

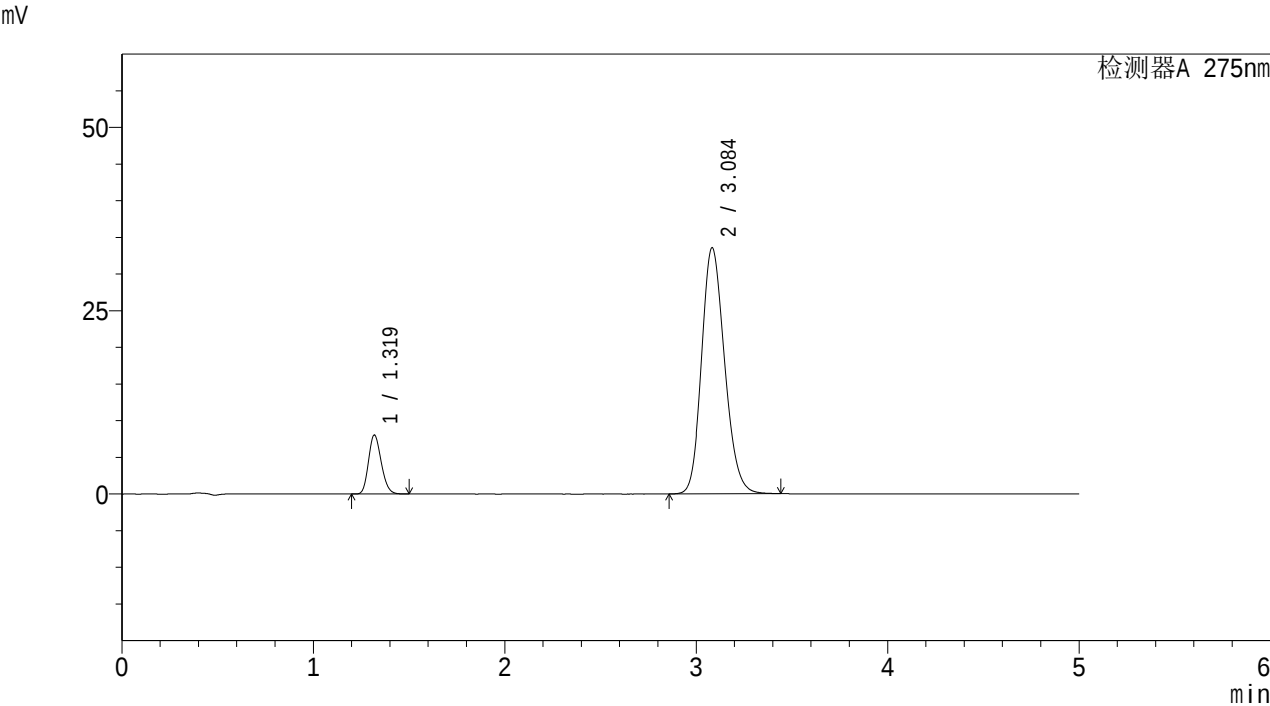

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	37129	11.685	8010	1871	1.183	--
2	3.084	280630	88.315	33493	3167	1.174	10.347
总计		317759	100.000	41503			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-144-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:08:52
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

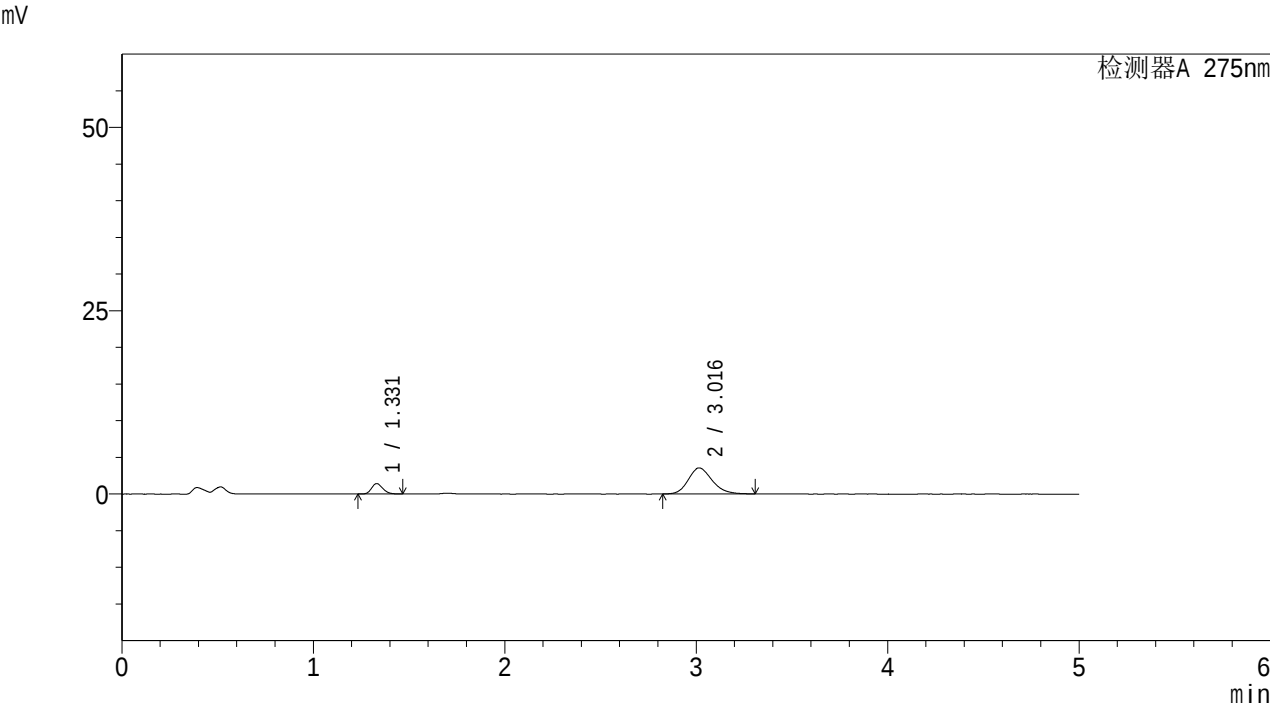

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	5814	15.763	1422	2432	1.194	--
2	3.016	31070	84.237	3552	2826	1.188	10.063
总计		36884	100.000	4974			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-145-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:14:14

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

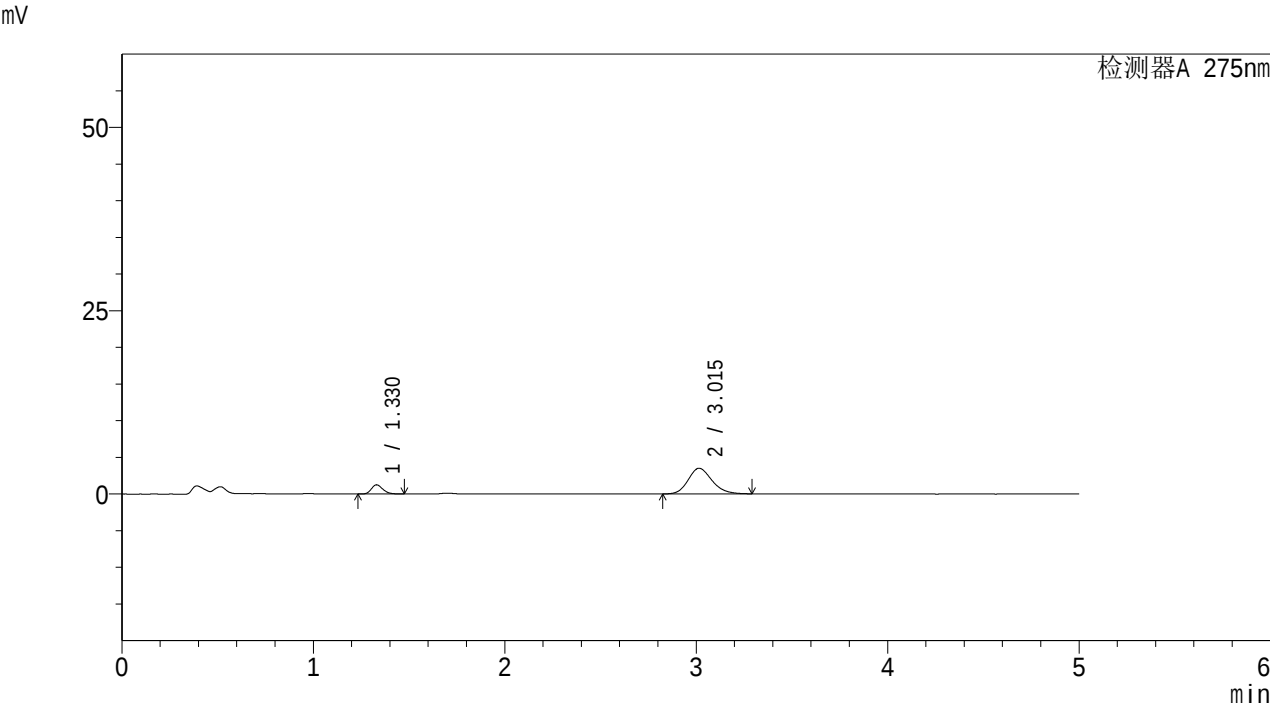

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	5189	14.549	1253	2397	1.211	--
2	3.015	30479	85.451	3496	2824	1.179	10.041
总计		35669	100.000	4749			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-146-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:19:36
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

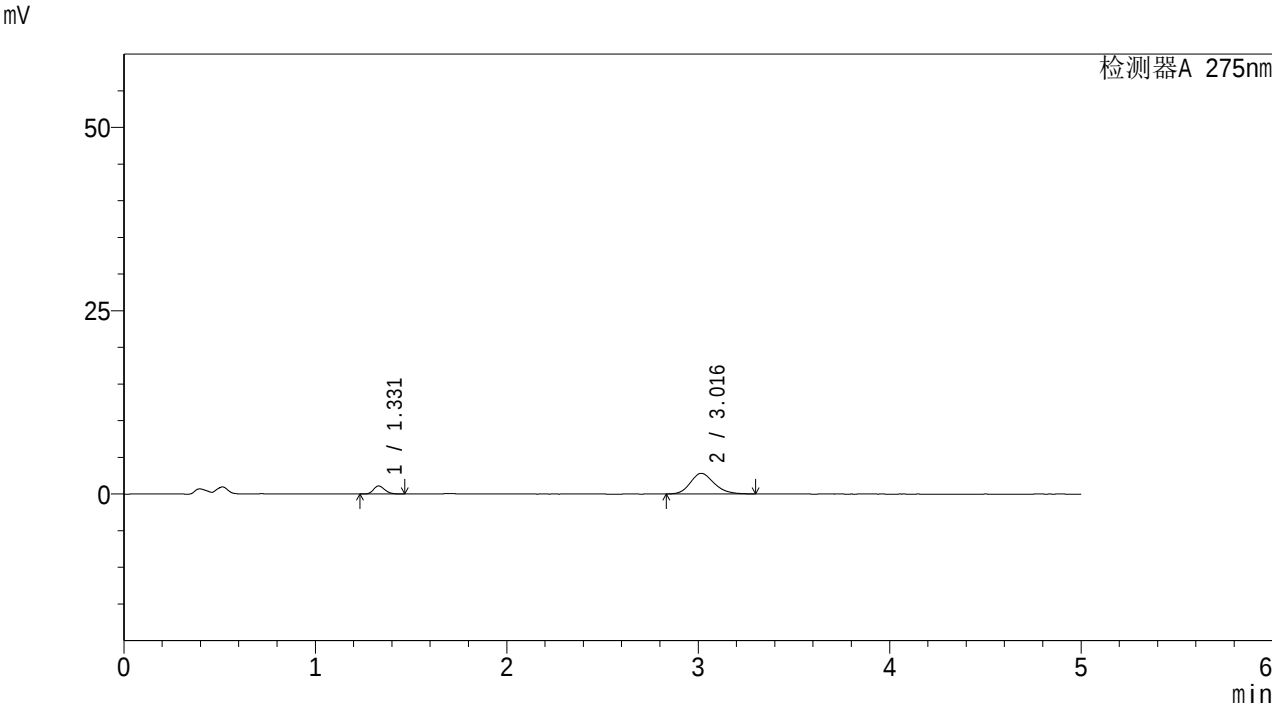

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	4506	15.492	1101	2427	1.194	--
2	3.016	24580	84.508	2813	2818	1.188	10.054
总计		29085	100.000	3914			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-147-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:24:59

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

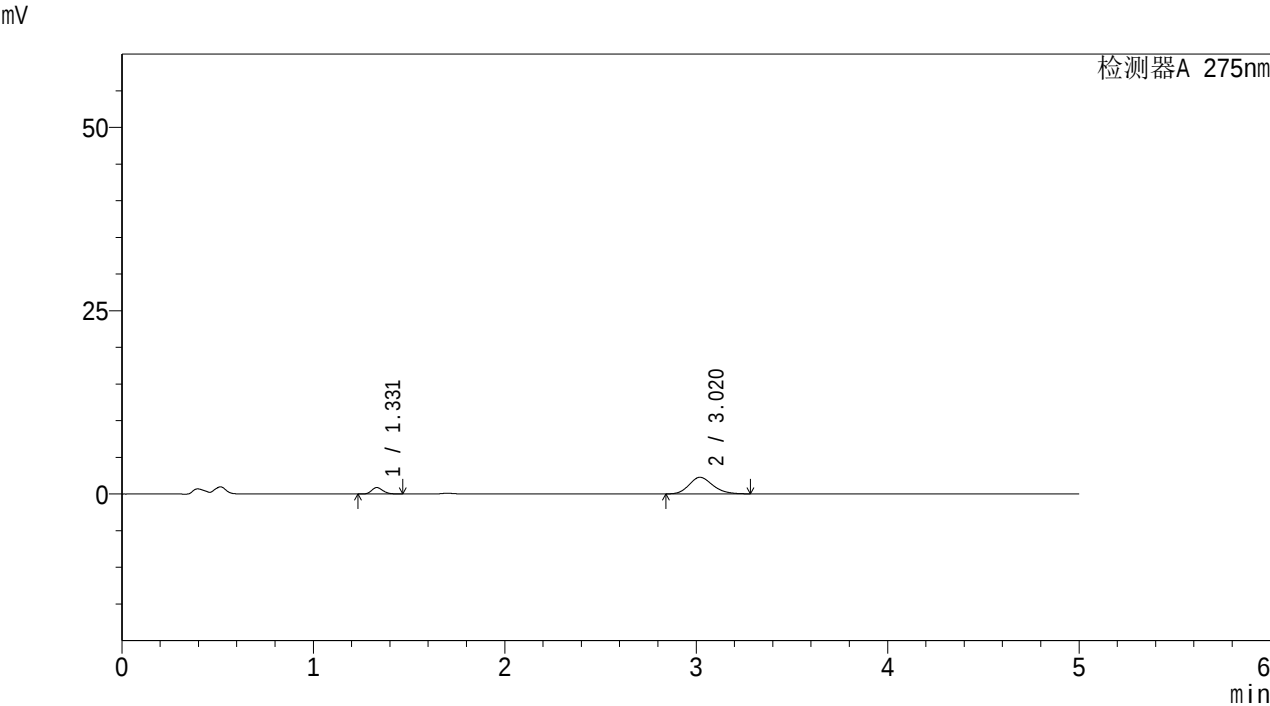

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	3605	15.475	879	2430	1.196	--
2	3.020	19692	84.525	2266	2825	1.172	10.073
总计		23298	100.000	3145			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-148-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:30:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

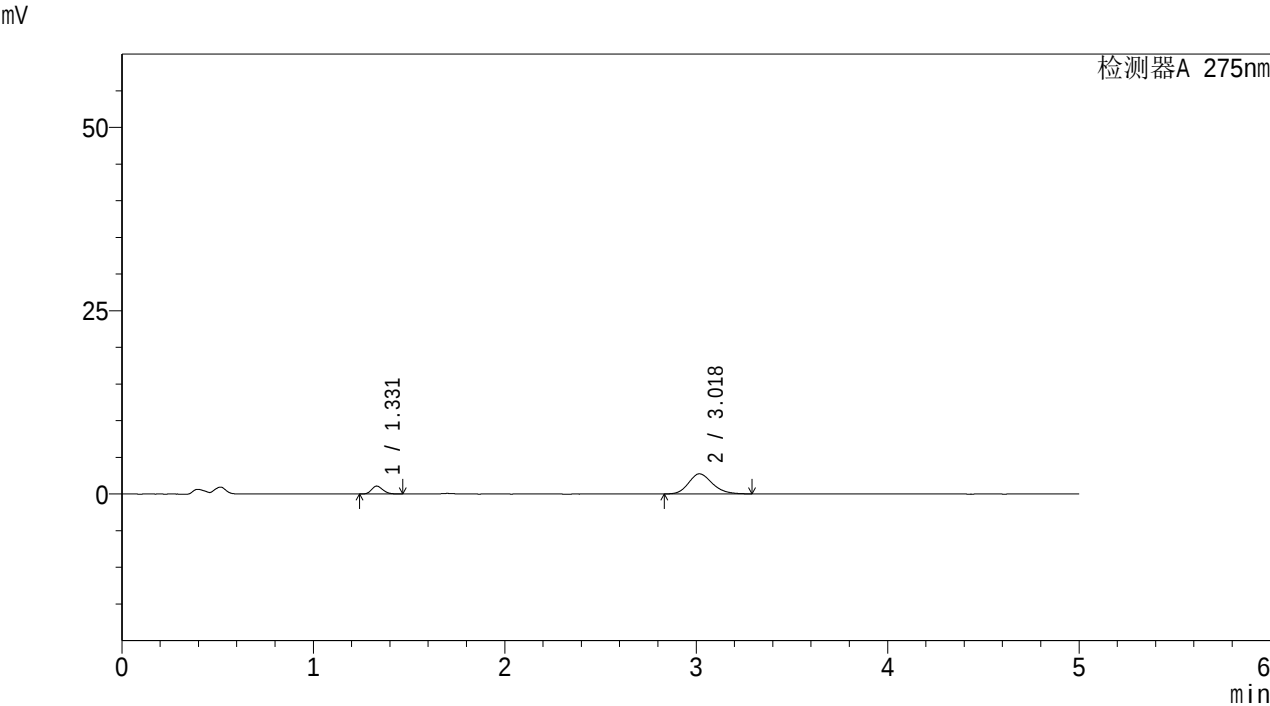

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	4439	15.673	1082	2415	1.195	--
2	3.018	23887	84.327	2736	2827	1.179	10.058
总计		28327	100.000	3818			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-149-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:35:44

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

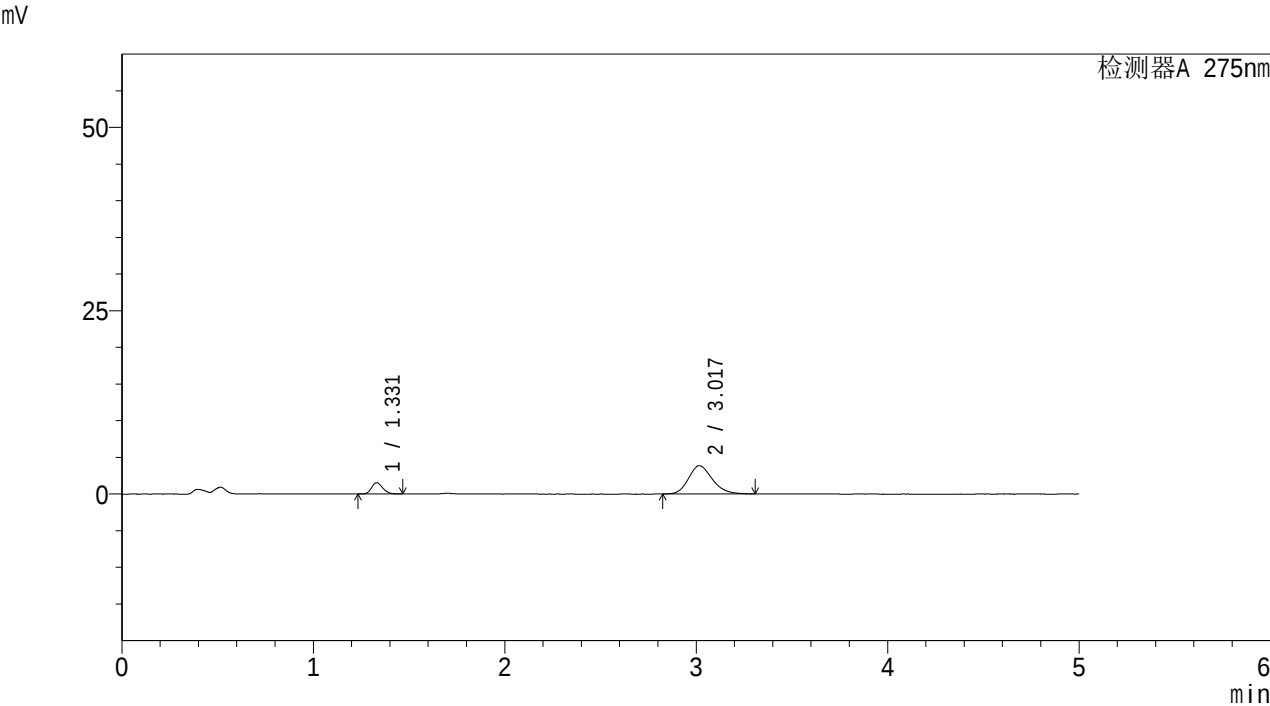

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	6341	15.850	1546	2416	1.193	--
2	3.017	33667	84.150	3846	2827	1.190	10.060
总计		40008	100.000	5392			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-150-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:41:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

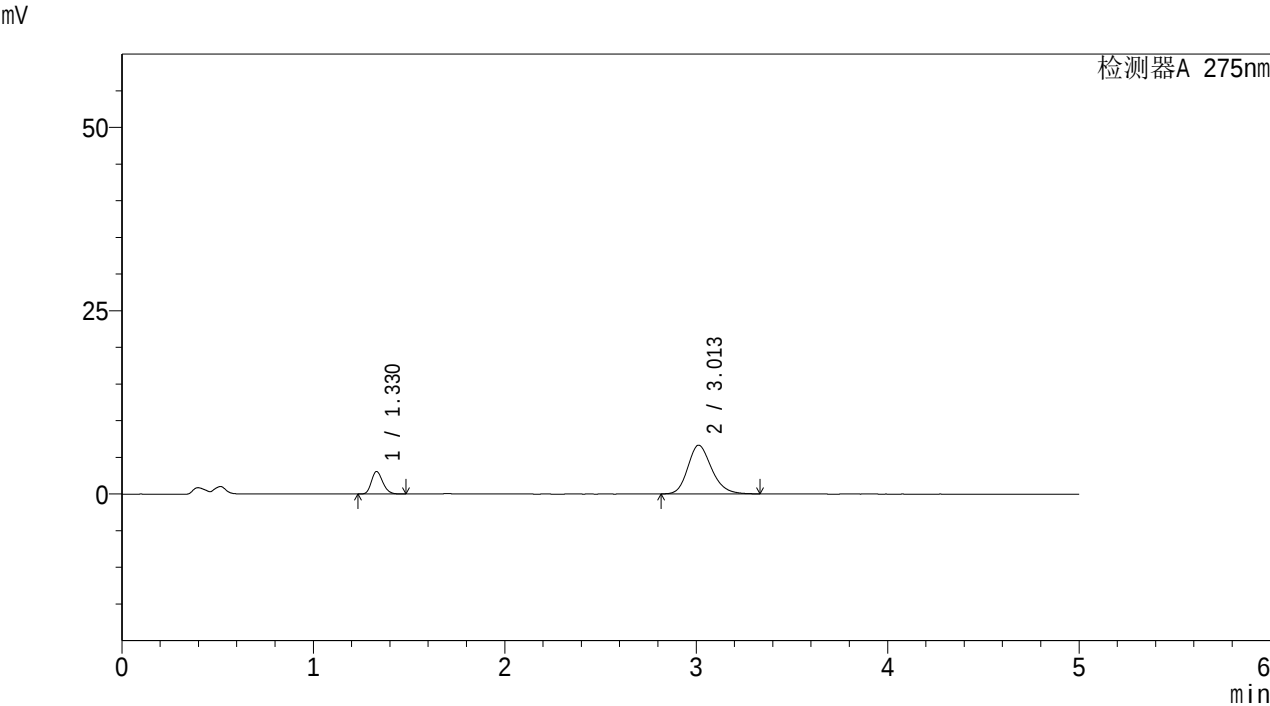

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	12634	17.904	3076	2416	1.194	--
2	3.013	57931	82.096	6653	2848	1.204	10.072
总计		70565	100.000	9729			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-151-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:46:29
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

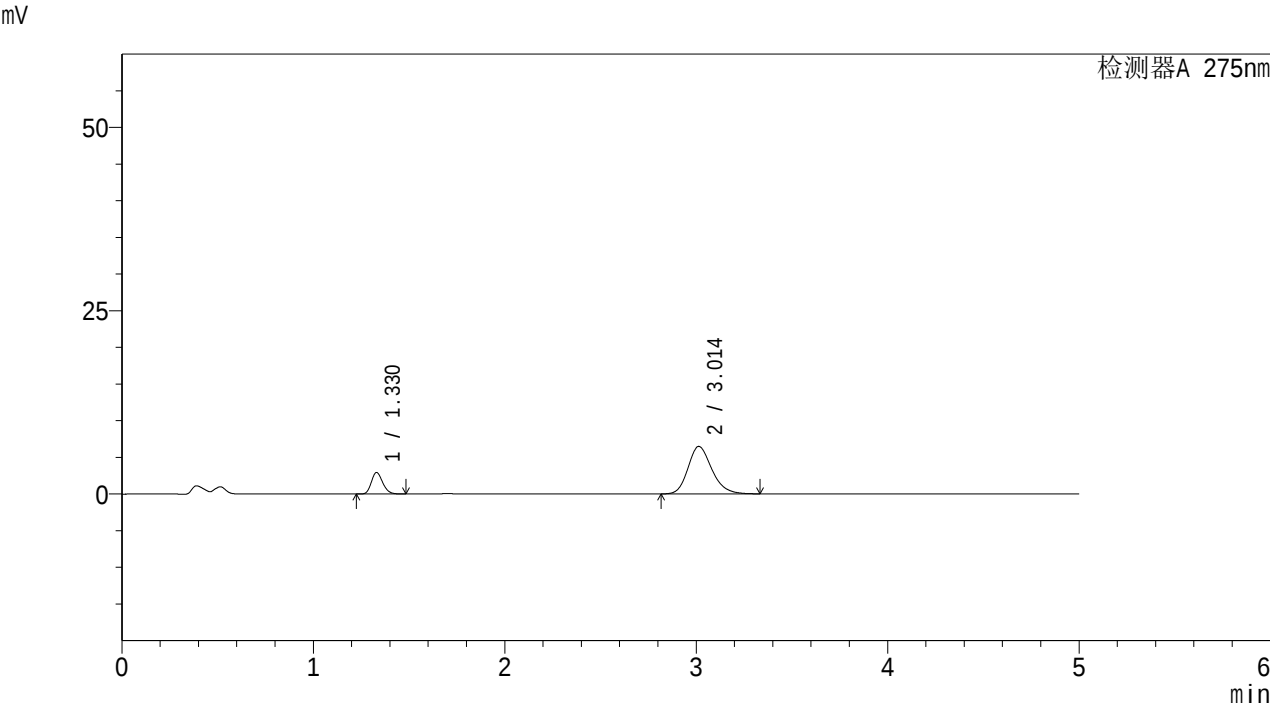

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	12045	17.554	2938	2418	1.198	--
2	3.014	56573	82.446	6485	2836	1.203	10.066
总计		68618	100.000	9423			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-152-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:51:51

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

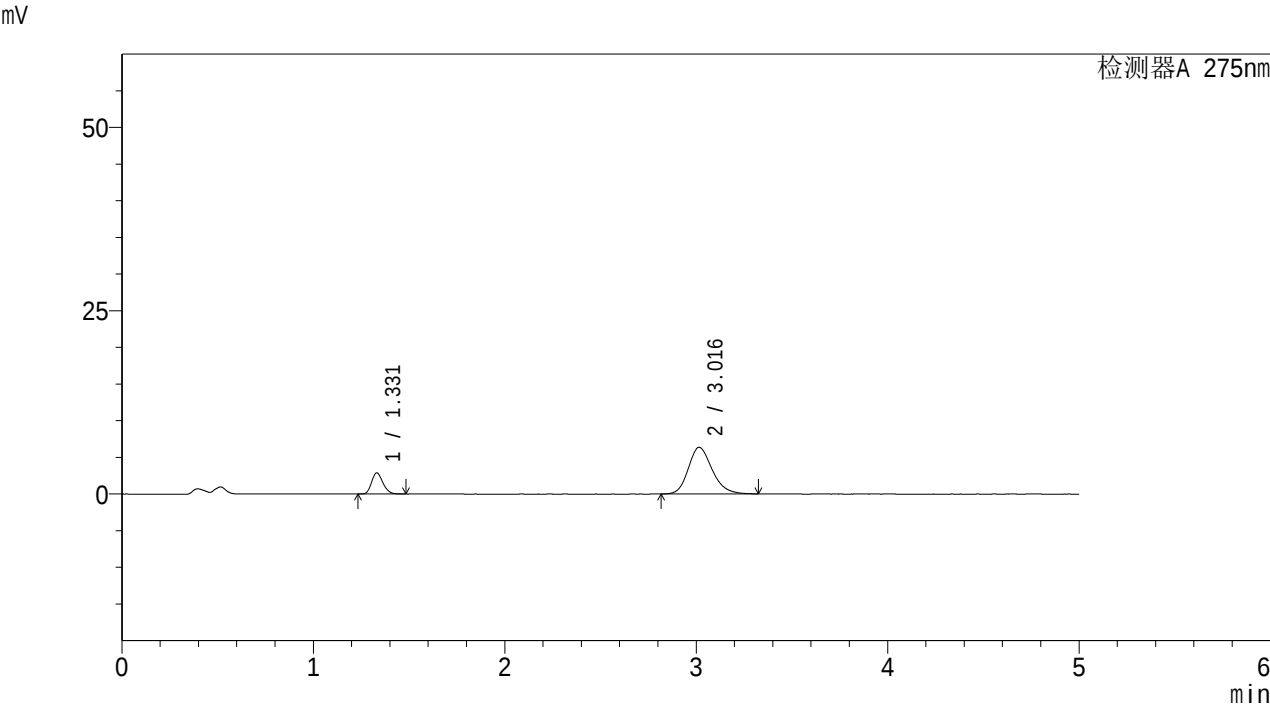

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	11930	17.695	2899	2420	1.197	--
2	3.016	55494	82.305	6359	2839	1.200	10.068
总计		67425	100.000	9258			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-153-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:57:14

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

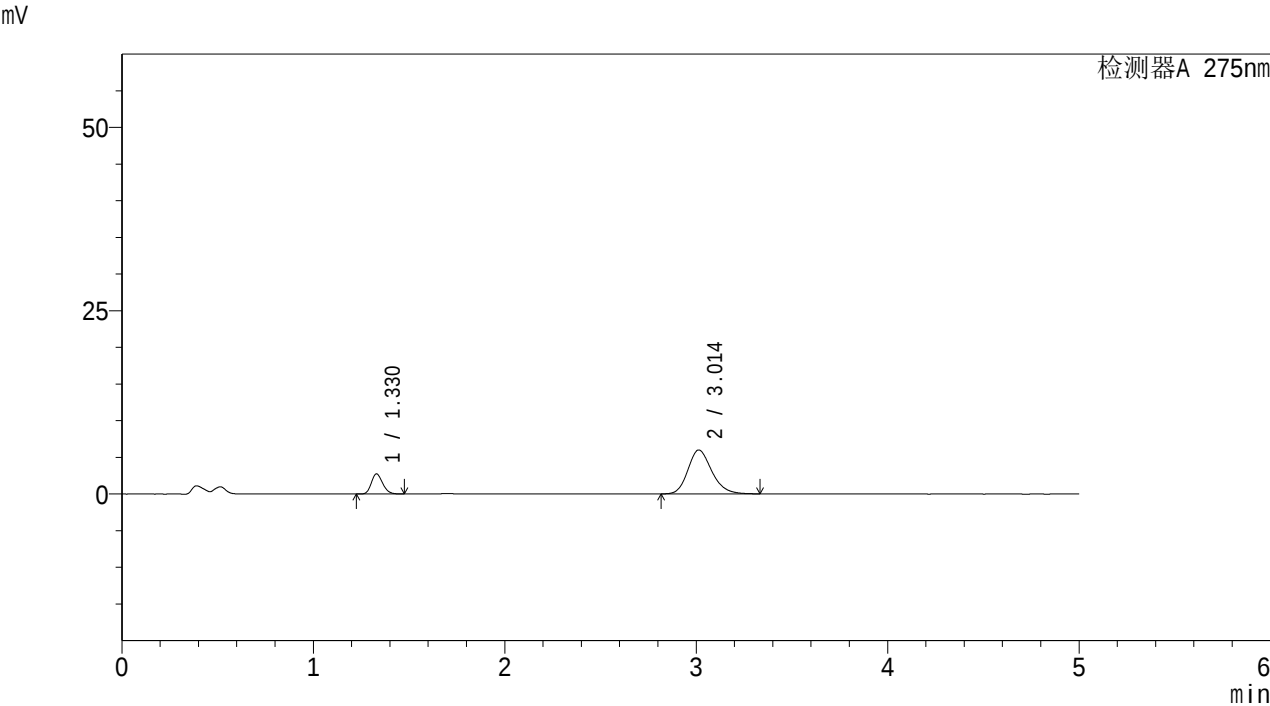

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	11238	17.648	2743	2425	1.192	--
2	3.014	52437	82.352	6000	2829	1.200	10.062
总计		63675	100.000	8743			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-154-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:02:36

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

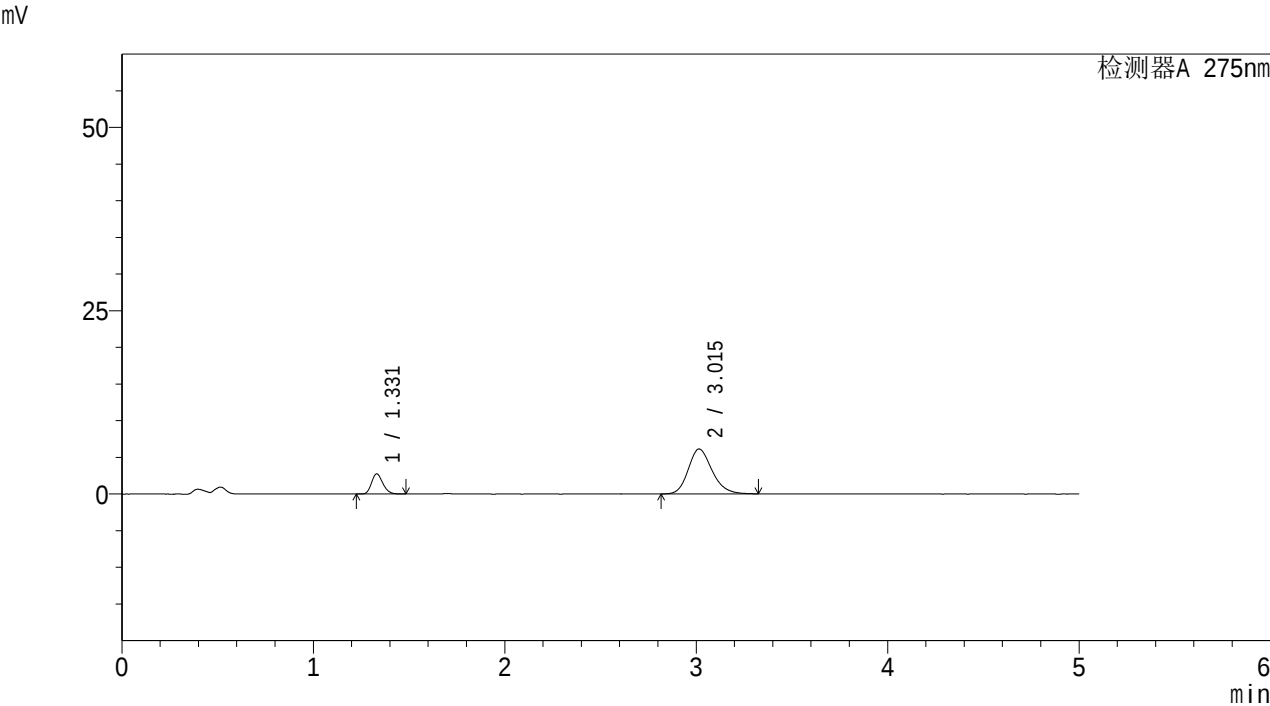

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	11308	17.454	2755	2423	1.198	--
2	3.015	53481	82.546	6129	2838	1.197	10.070
总计		64789	100.000	8884			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-155-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:07:59
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

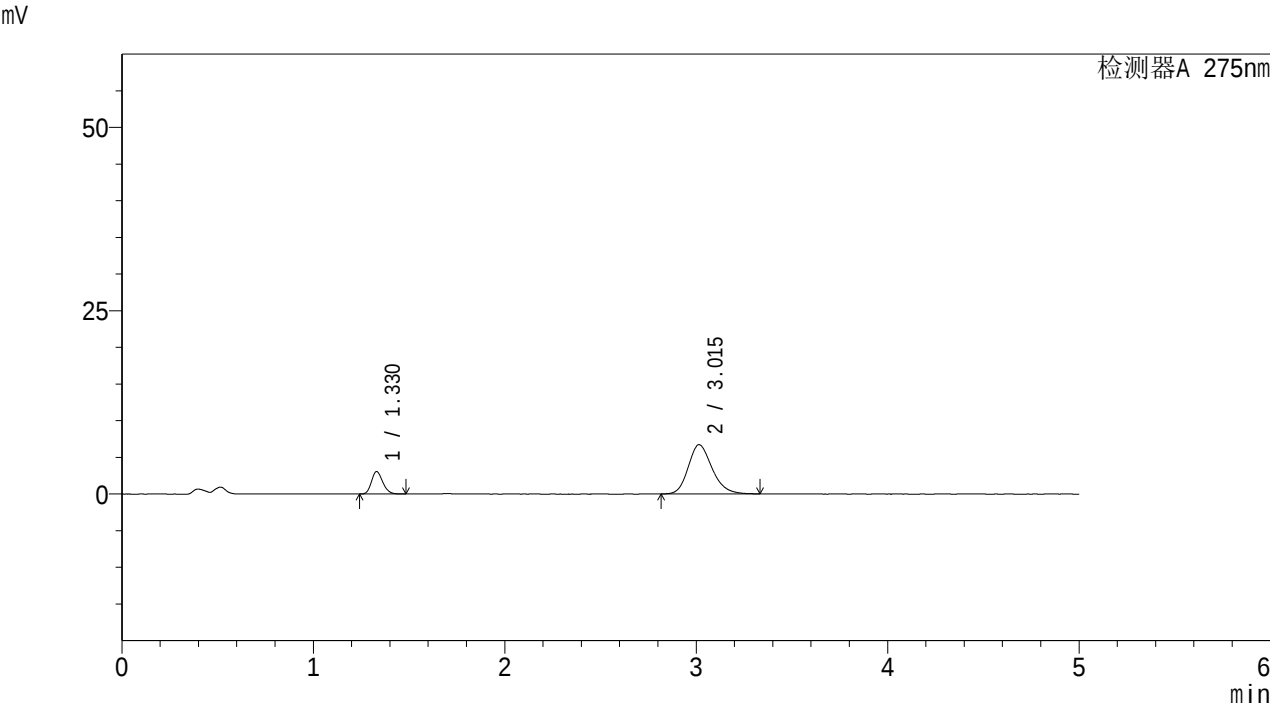

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	12599	17.686	3070	2424	1.199	--
2	3.015	58636	82.314	6713	2836	1.203	10.071
总计		71235	100.000	9783			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-156-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:13:21

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

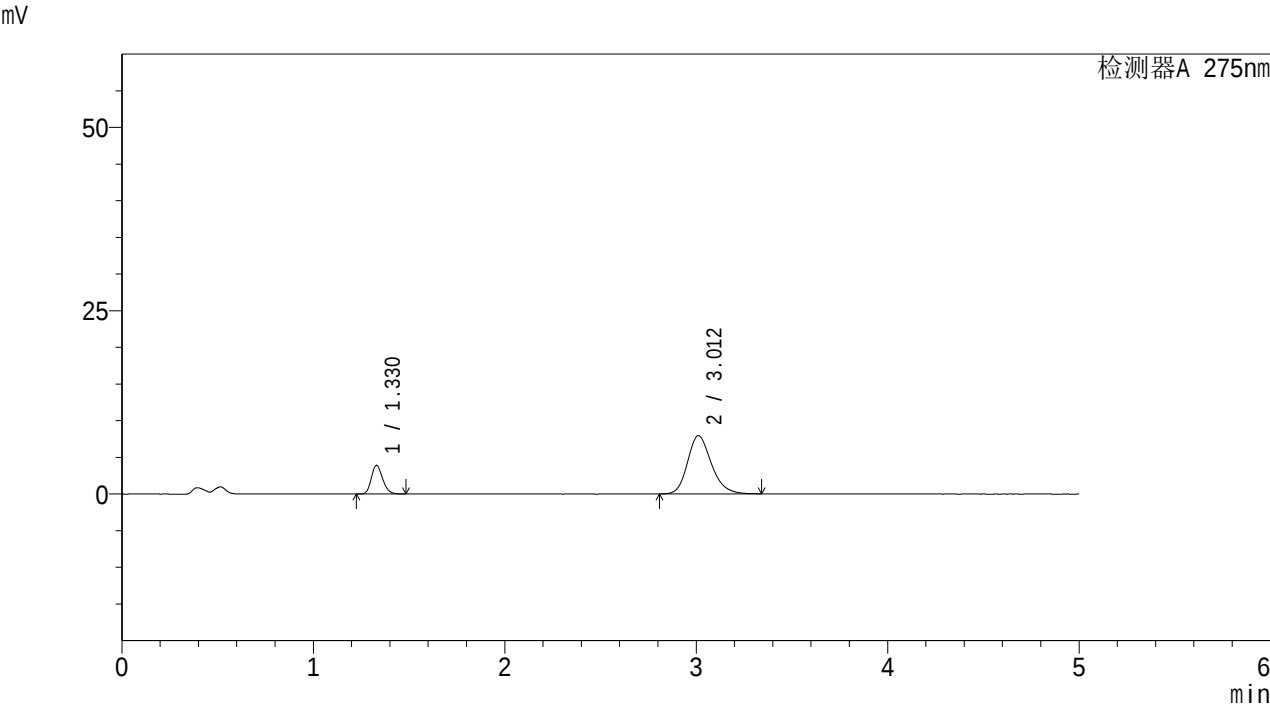

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	16050	18.796	3910	2424	1.199	--
2	3.012	69342	81.204	7952	2847	1.207	10.076
总计		85393	100.000	11862			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-157-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:18:43

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

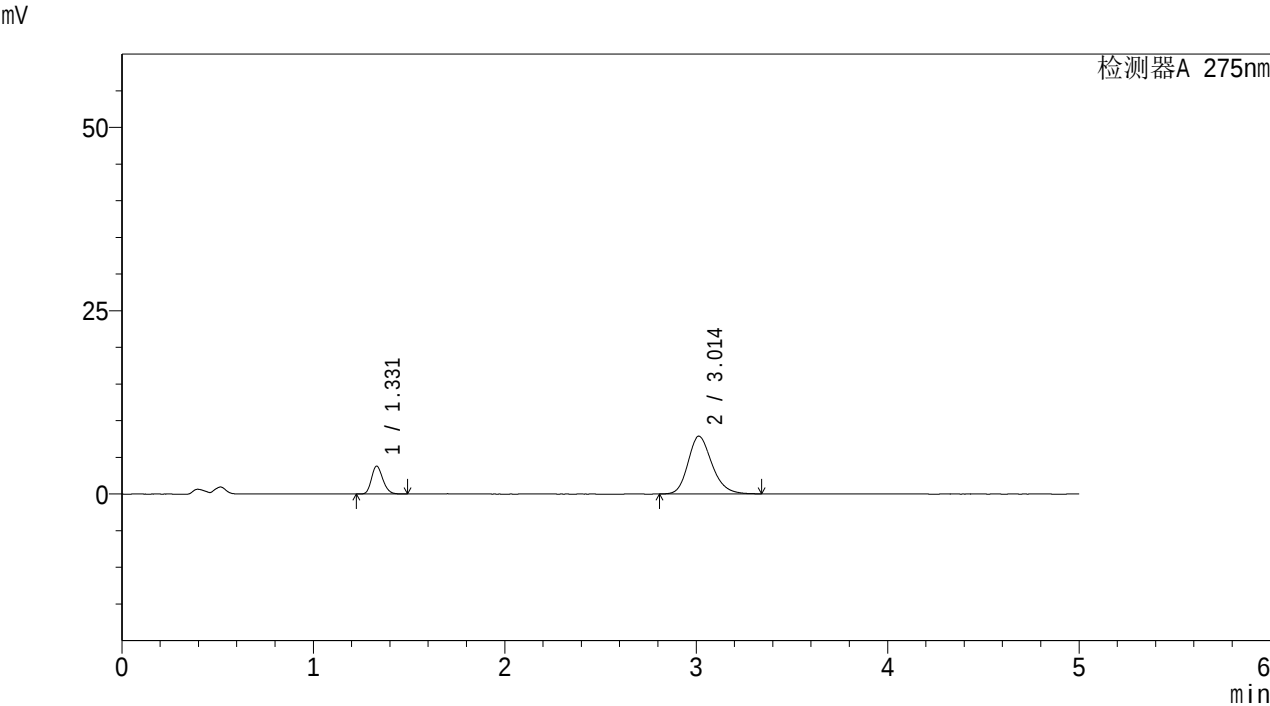

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	15687	18.552	3816	2424	1.197	--
2	3.014	68868	81.448	7886	2840	1.207	10.070
总计		84555	100.000	11702			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-158-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:24:05
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

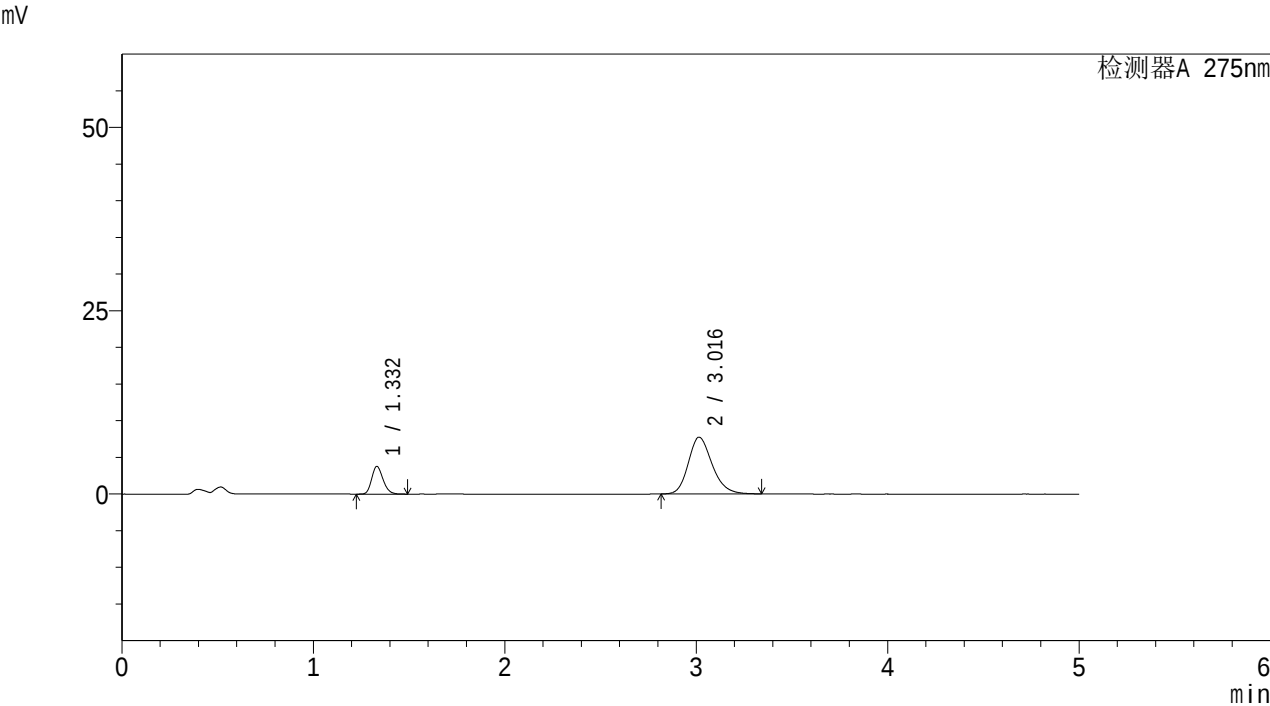

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	15530	18.688	3770	2423	1.201	--
2	3.016	67569	81.312	7741	2844	1.206	10.071
总计		83099	100.000	11511			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-159-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:29:27
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

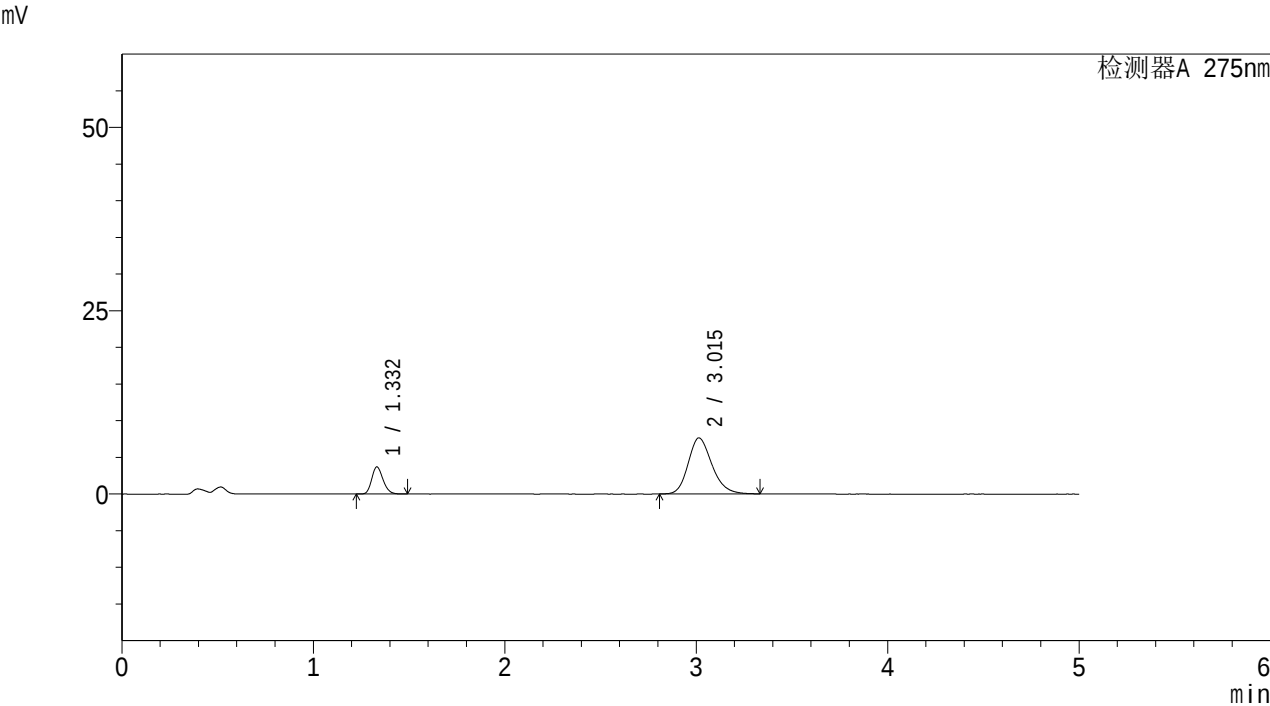

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	15210	18.575	3698	2430	1.196	--
2	3.015	66677	81.425	7647	2849	1.205	10.077
总计		81887	100.000	11345			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-160-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:34:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

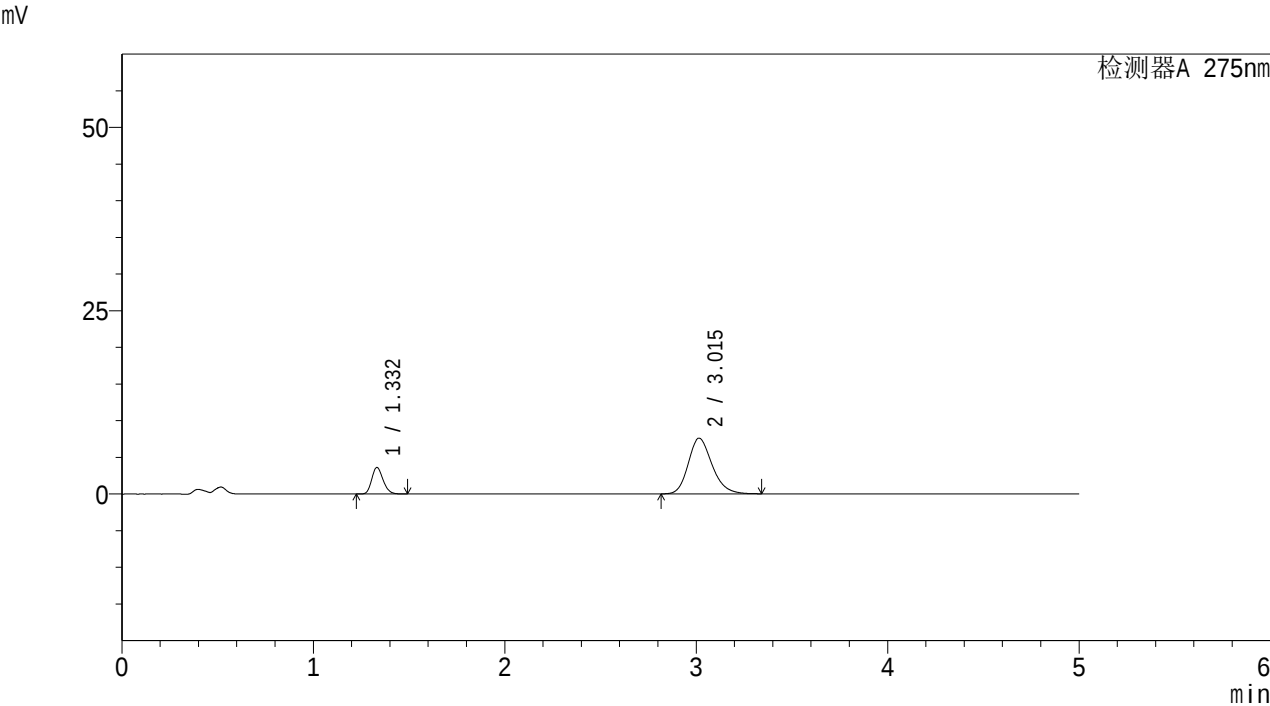

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	14888	18.344	3618	2423	1.198	--
2	3.015	66268	81.656	7602	2848	1.205	10.073
总计		81156	100.000	11220			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-161-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:40:11
处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

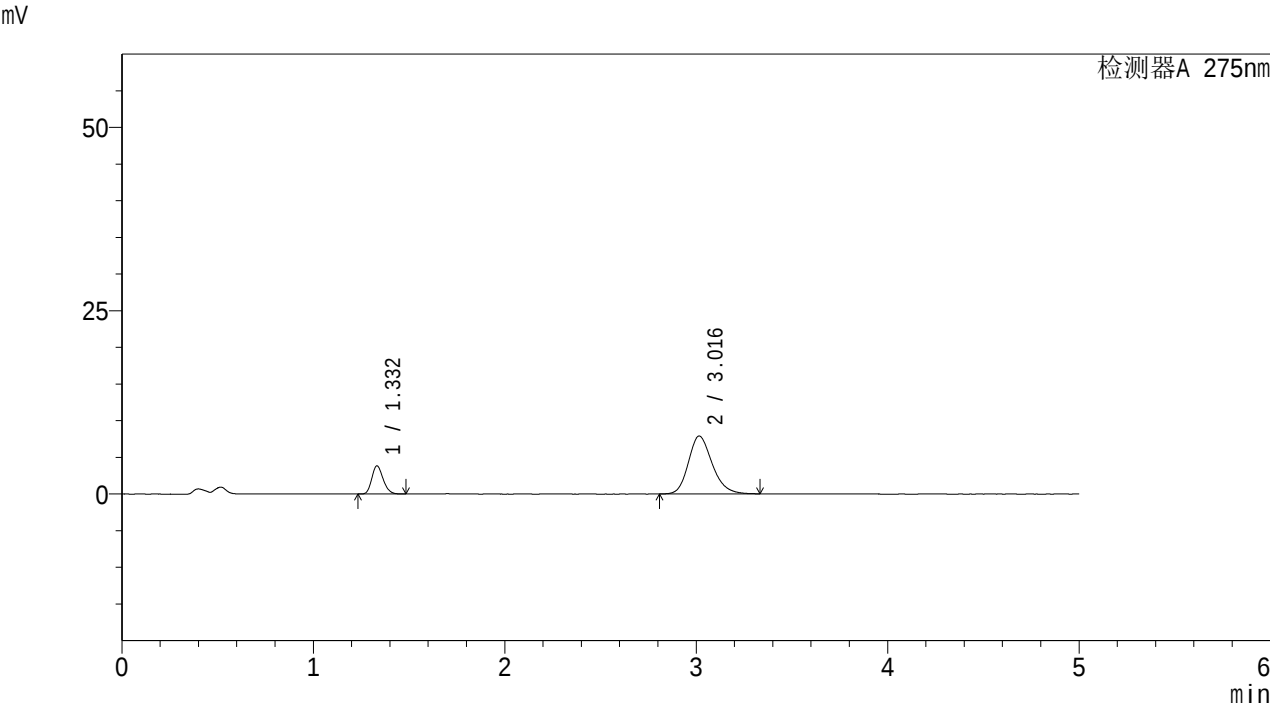

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	15742	18.618	3826	2430	1.201	--
2	3.016	68812	81.382	7891	2848	1.206	10.077
总计		84554	100.000	11717			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-162-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:45:33

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

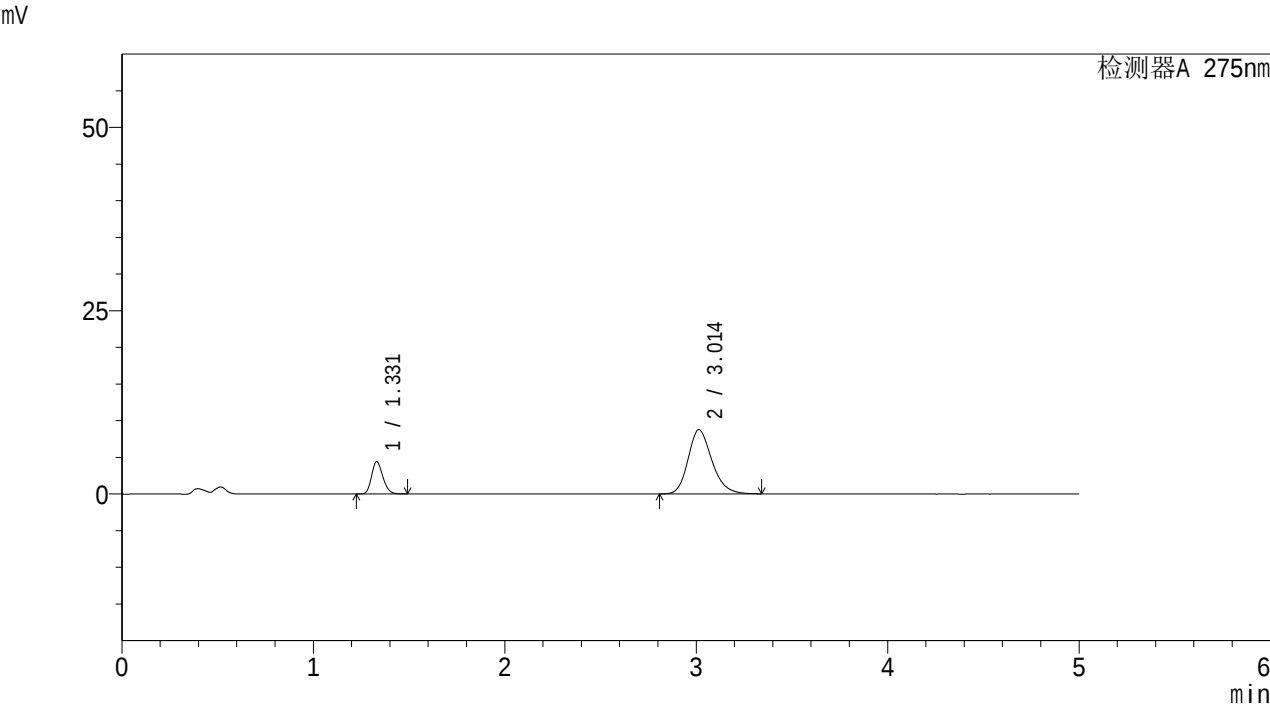

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	18102	19.185	4409	2428	1.200	--
2	3.014	76255	80.815	8769	2866	1.210	10.102
总计		94357	100.000	13178			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-163-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:50:55

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

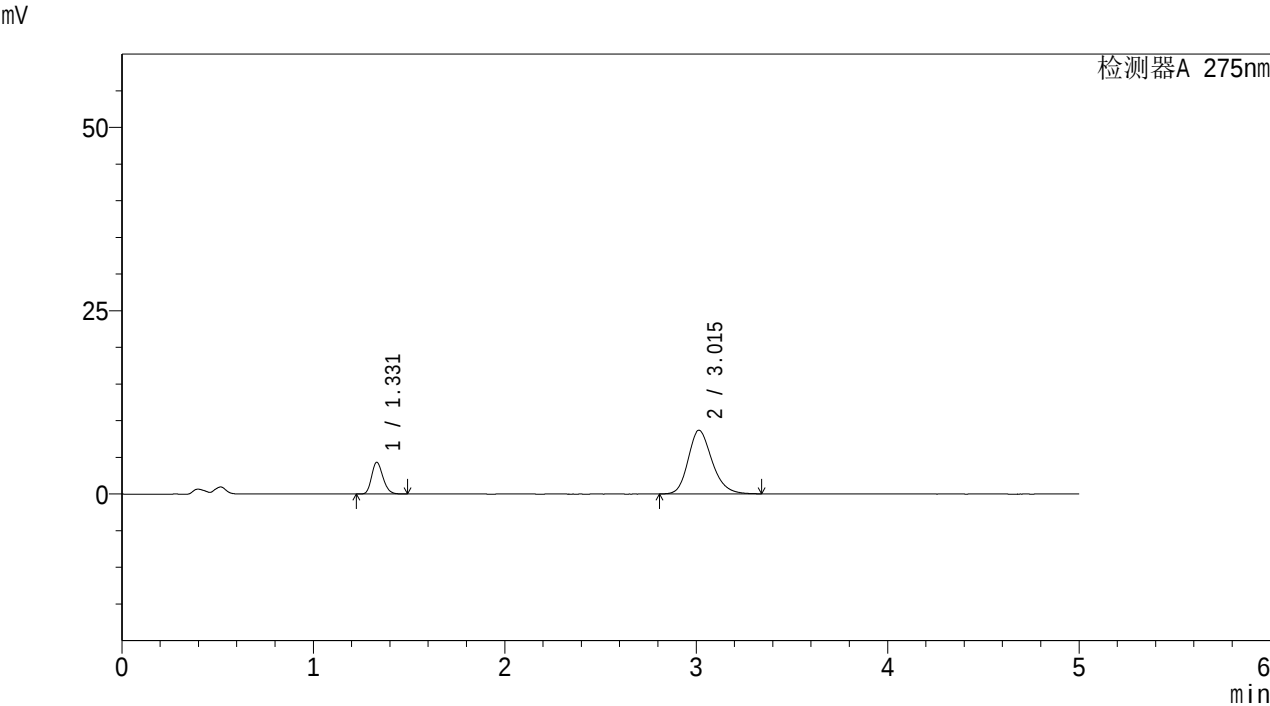

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	17764	19.014	4328	2431	1.199	--
2	3.015	75663	80.986	8687	2858	1.210	10.093
总计		93428	100.000	13015			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-164-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:56:18

处理时间(V2): 2026/05/14 19:59:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

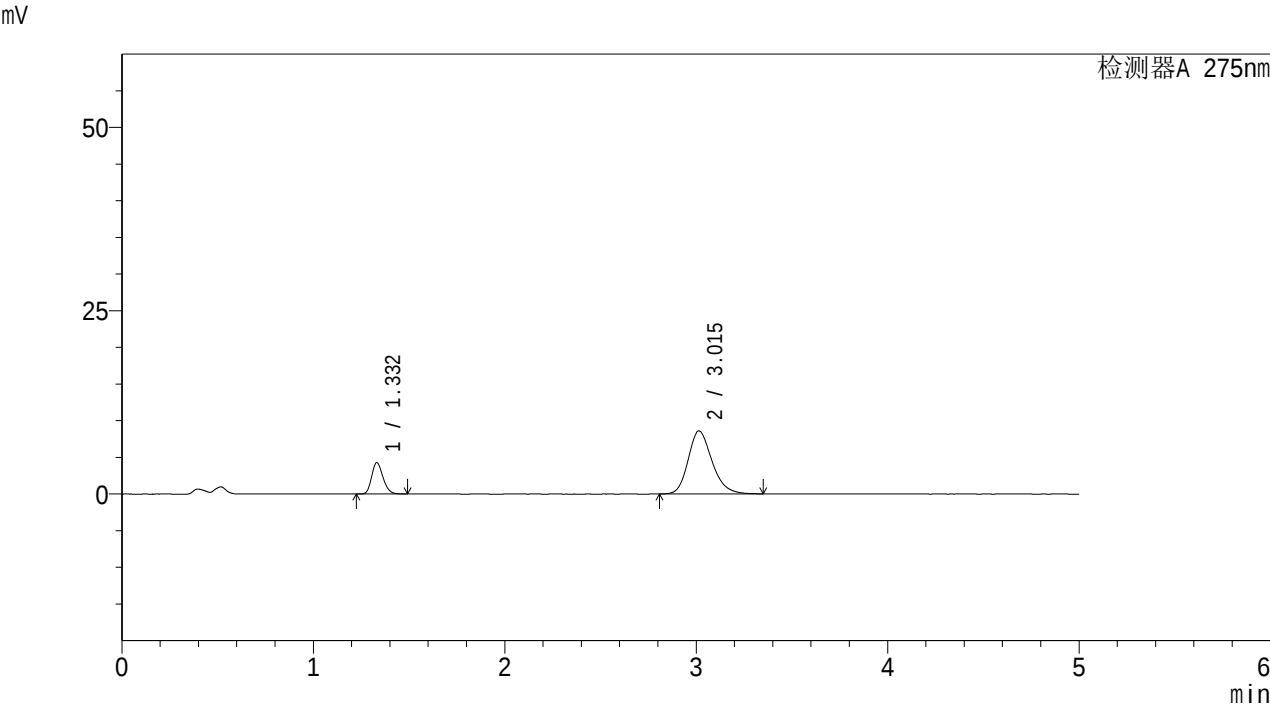

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	17635	19.033	4284	2421	1.199	--
2	3.015	75019	80.967	8597	2849	1.212	10.074
总计		92654	100.000	12881			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-165-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:01:40

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

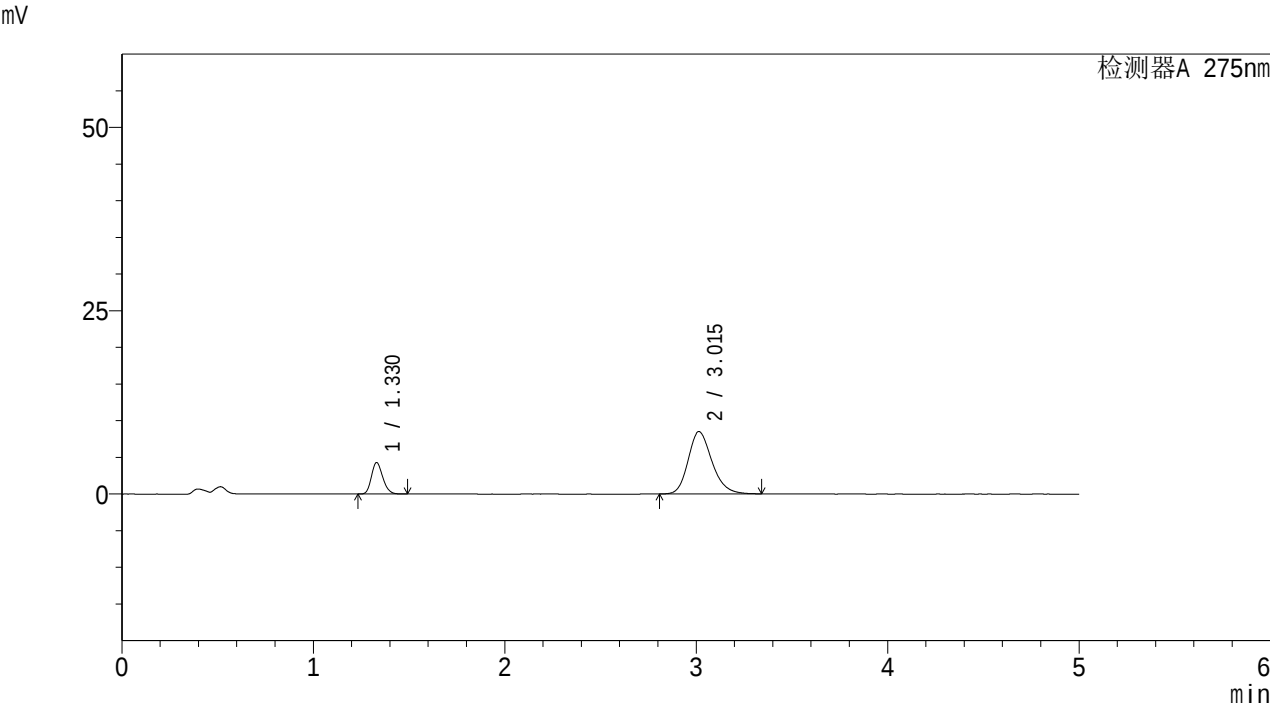

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	17638	19.220	4295	2422	1.198	--
2	3.015	74133	80.780	8506	2849	1.209	10.084
总计		91771	100.000	12801			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-166-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:07:02
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

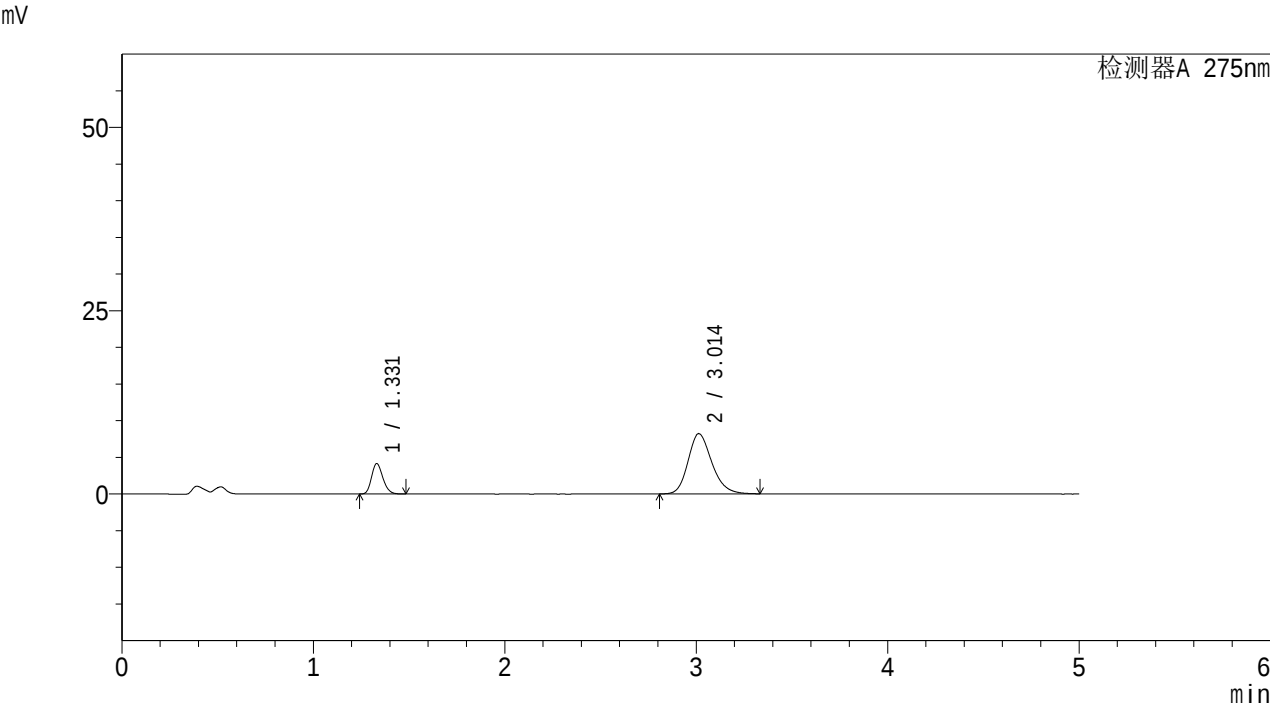

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	17054	19.229	4156	2425	1.197	--
2	3.014	71636	80.771	8225	2850	1.207	10.080
总计		88690	100.000	12380			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-167-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:12:24
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

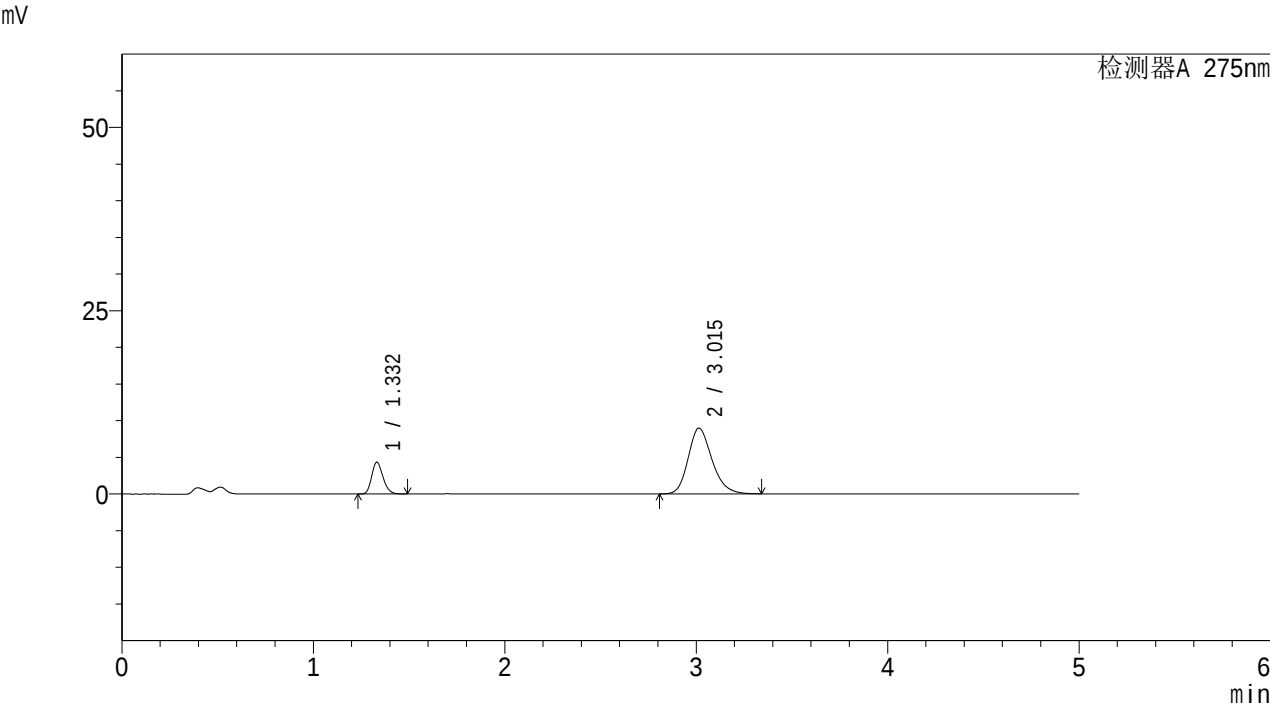

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	17833	18.575	4334	2429	1.199	--
2	3.015	78171	81.425	8974	2848	1.208	10.078
总计		96004	100.000	13308			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-168-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:17:46
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

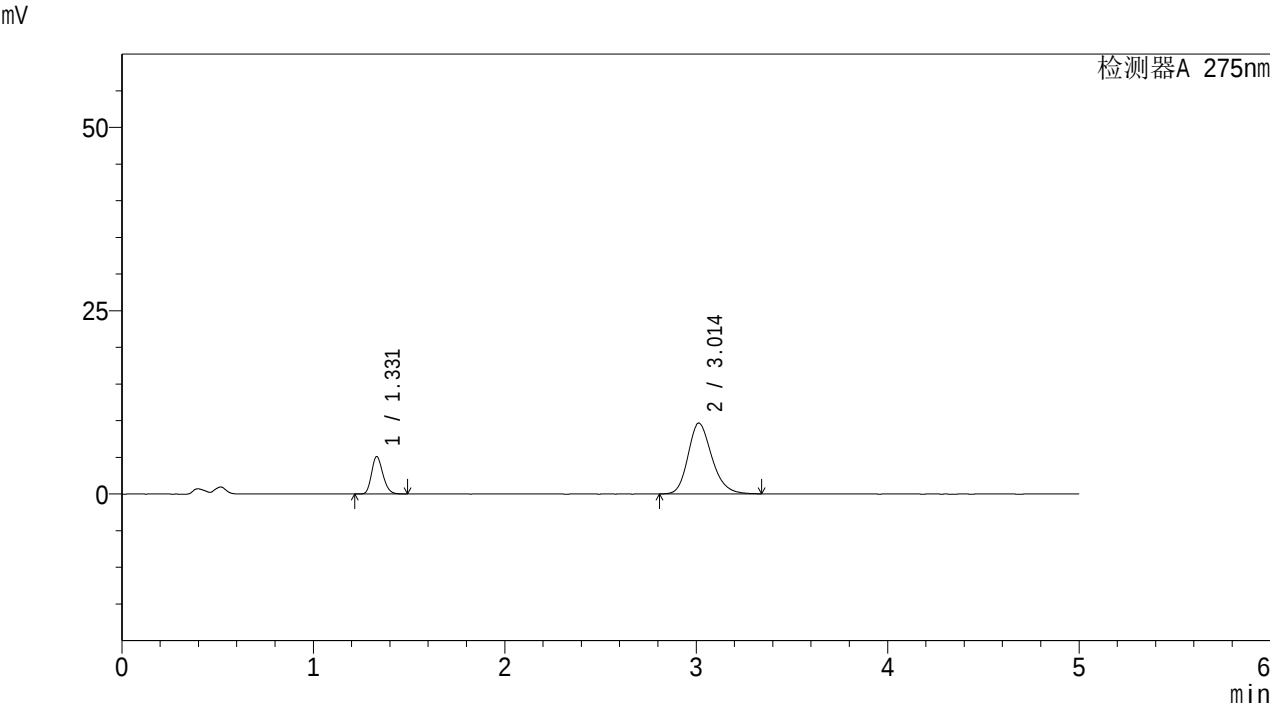

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	20968	19.939	5102	2420	1.198	--
2	3.014	84192	80.061	9668	2856	1.211	10.082
总计		105160	100.000	14771			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-169-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:23:07
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

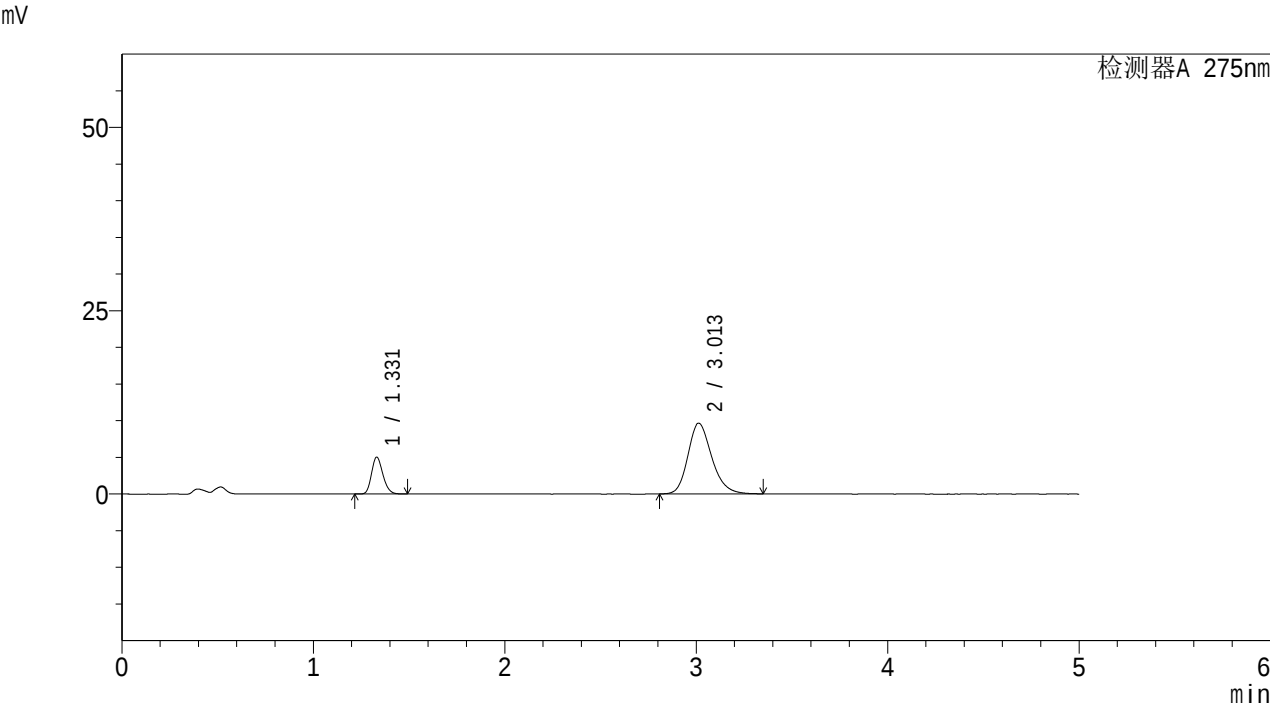

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	20700	19.727	5033	2417	1.196	--
2	3.013	84229	80.273	9659	2849	1.213	10.071
总计		104929	100.000	14692			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-170-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:28:29

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

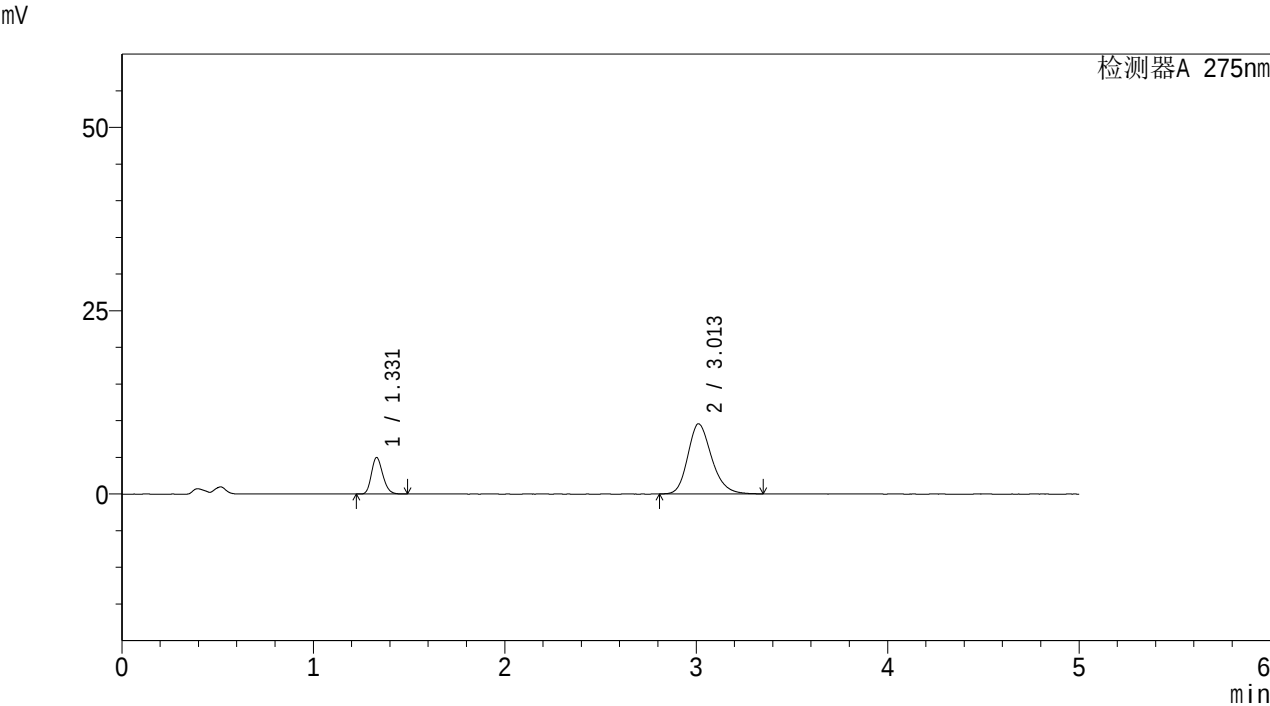

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	20516	19.760	4992	2415	1.199	--
2	3.013	83308	80.240	9569	2857	1.214	10.081
总计		103824	100.000	14561			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-171-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:33:51
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

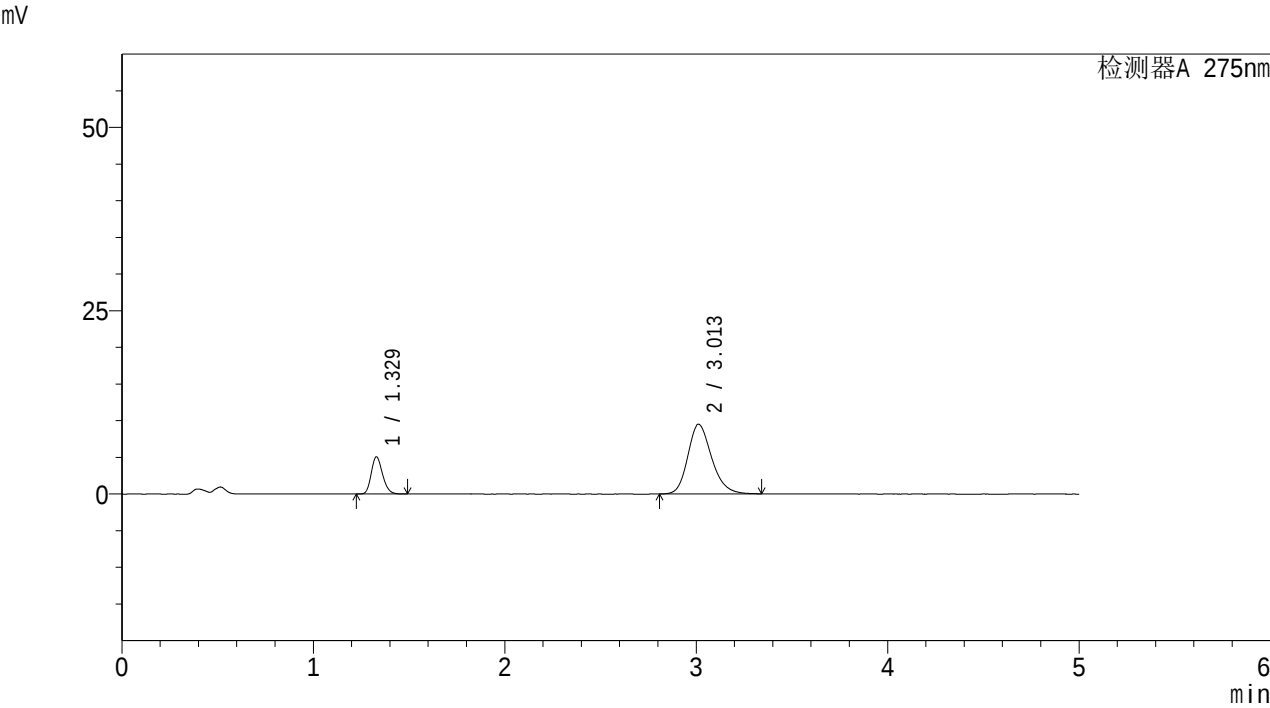

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	20847	20.113	5075	2422	1.198	--
2	3.013	82802	79.887	9509	2853	1.211	10.090
总计		103648	100.000	14583			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-172-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:39:13
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

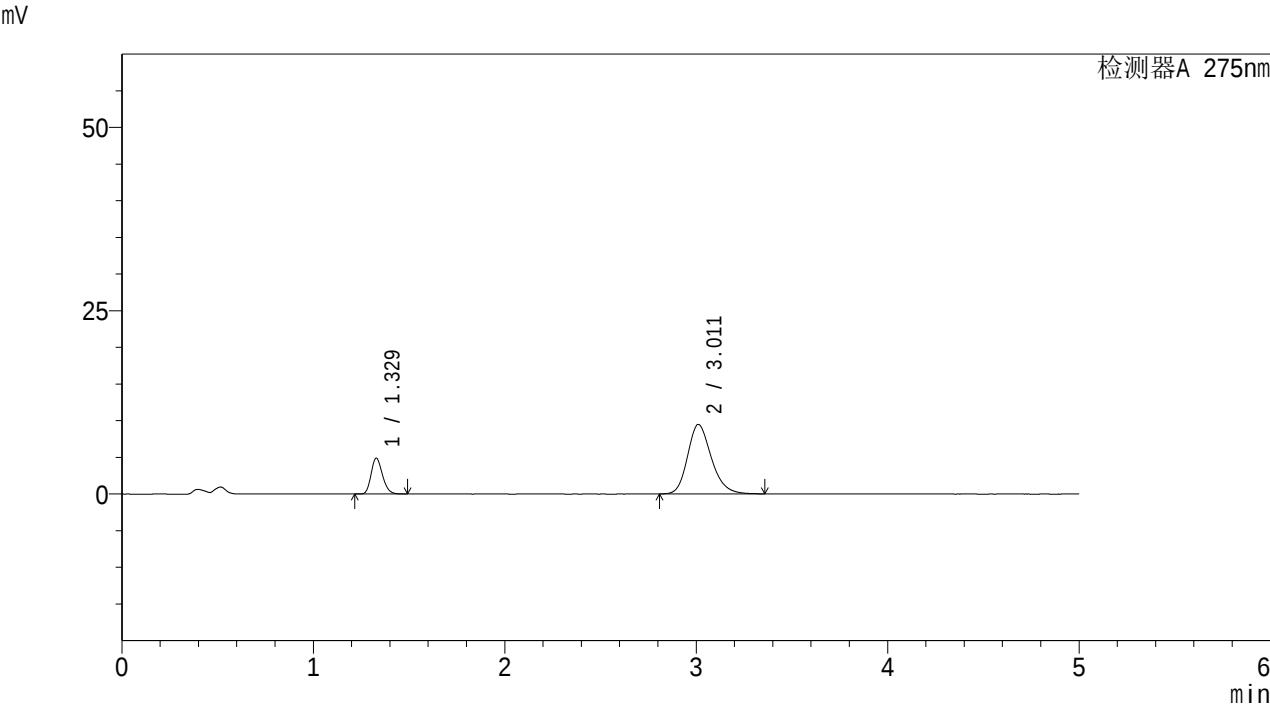

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	20176	19.614	4902	2415	1.198	--
2	3.011	82688	80.386	9485	2850	1.214	10.081
总计		102864	100.000	14388			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-173-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:44:35
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

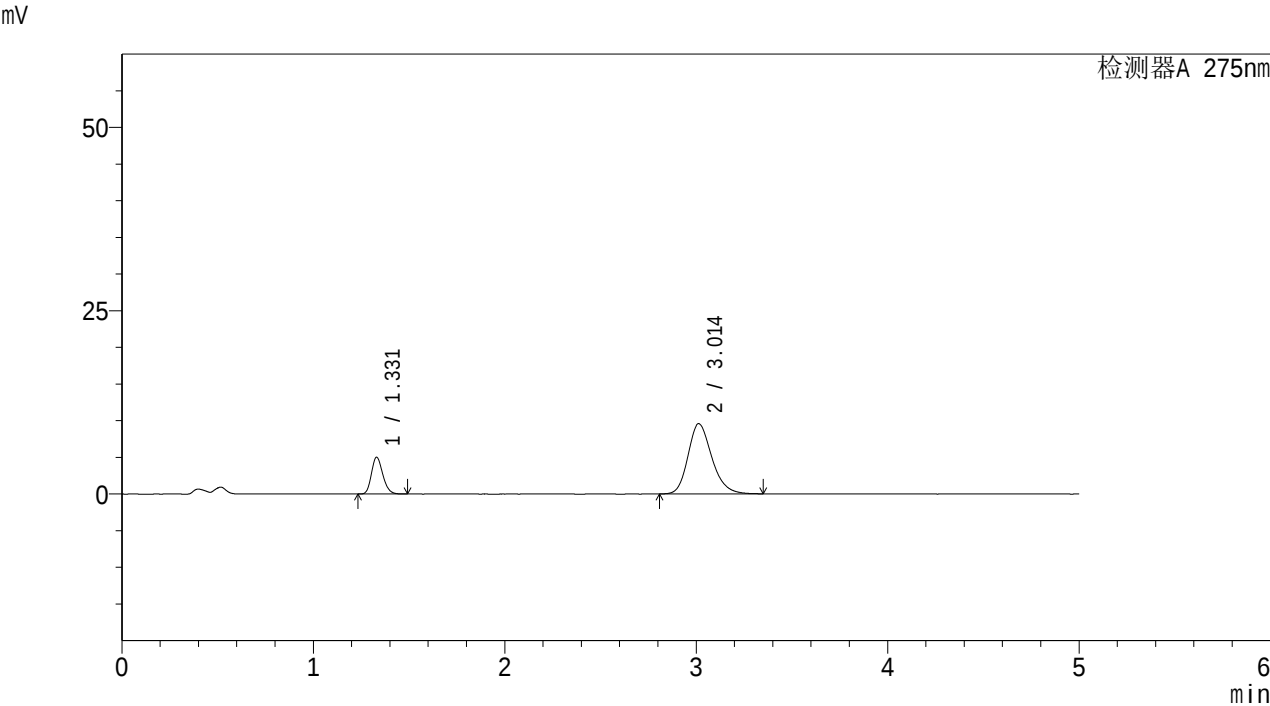

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	20658	19.825	5026	2417	1.197	--
2	3.014	83542	80.175	9587	2855	1.213	10.083
总计		104200	100.000	14613			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-174-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:49:57
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

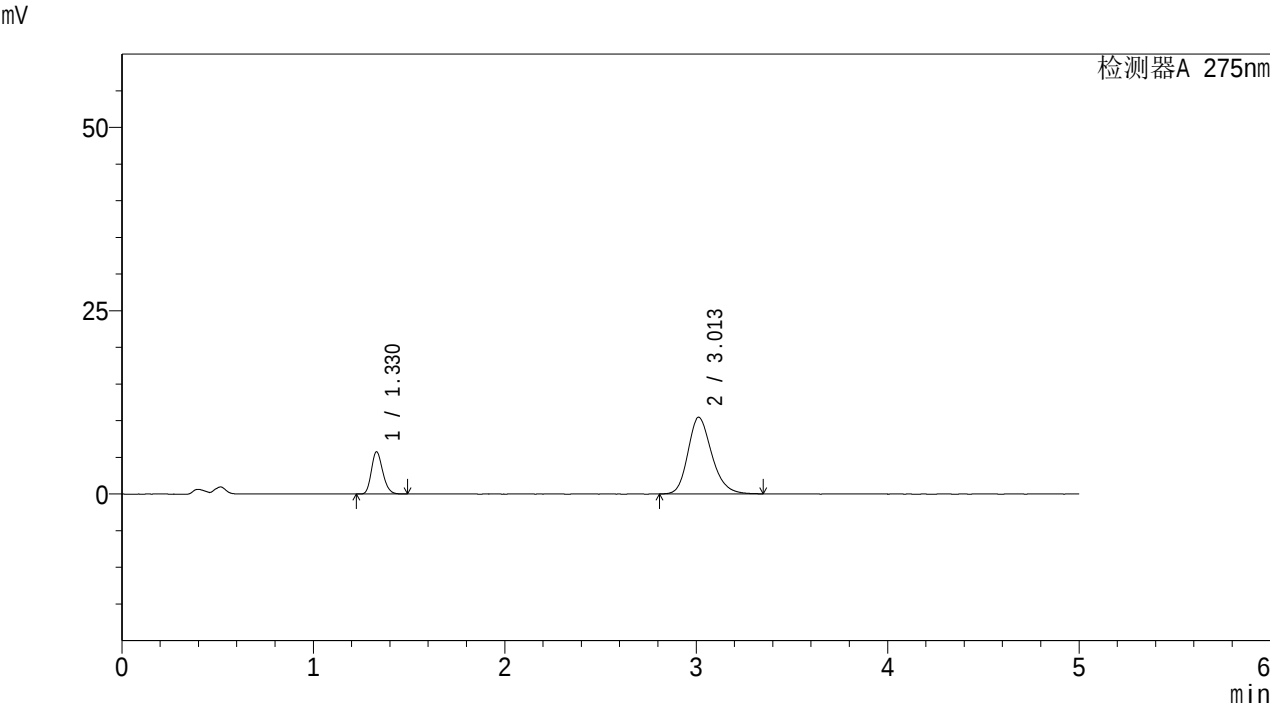

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	23710	20.678	5773	2418	1.198	--
2	3.013	90952	79.322	10458	2865	1.215	10.097
总计		114662	100.000	16231			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-175-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:55:19
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

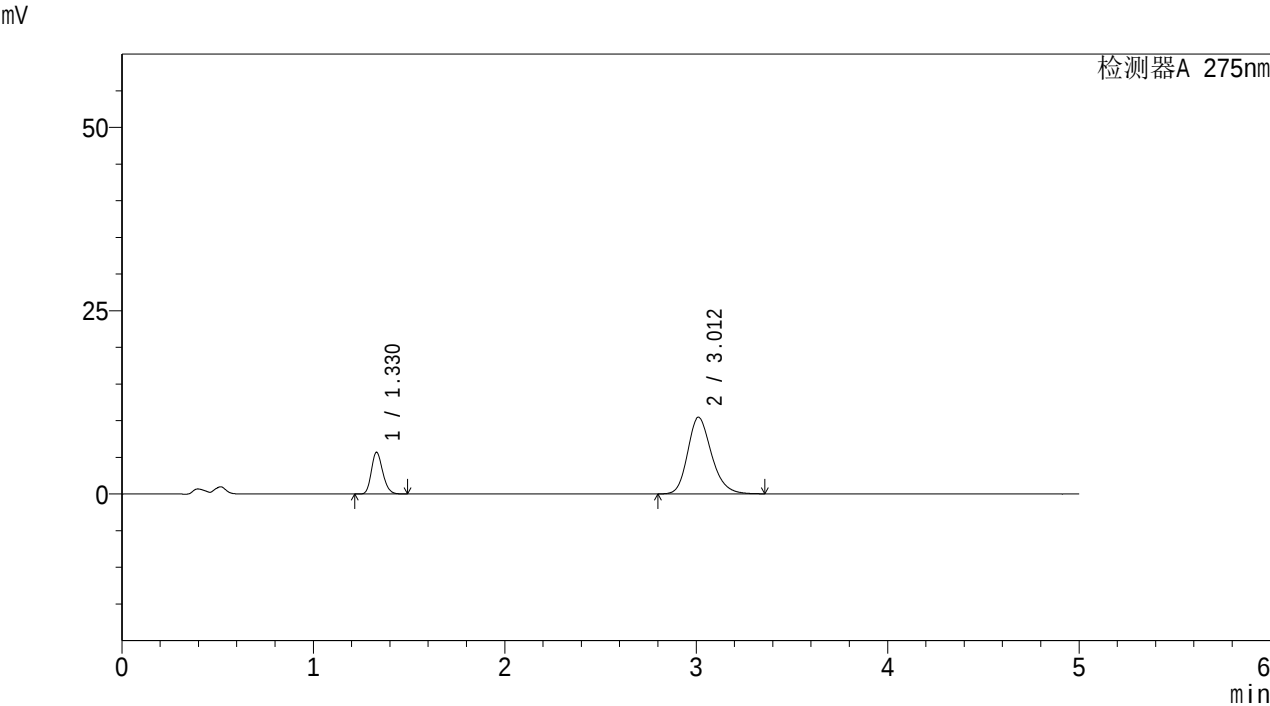

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	23358	20.394	5691	2423	1.197	--
2	3.012	91179	79.606	10465	2854	1.215	10.084
总计		114538	100.000	16156			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-176-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:00:41

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

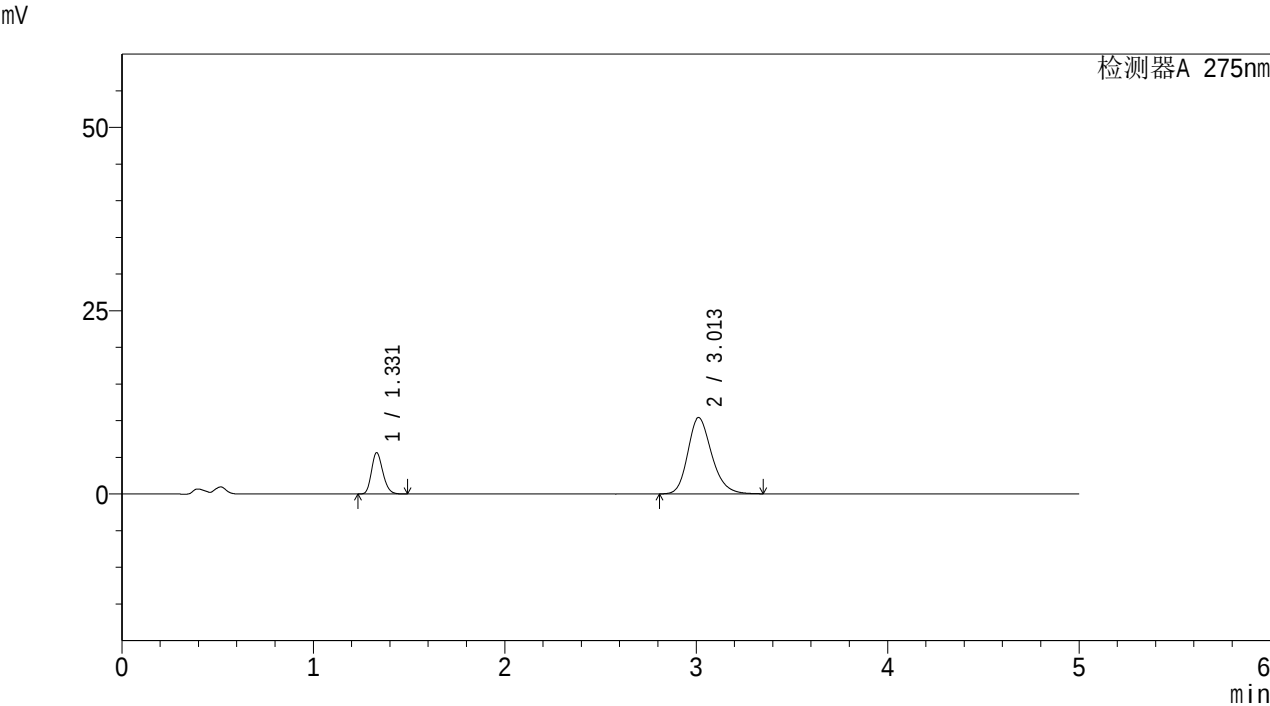

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	23187	20.351	5642	2421	1.199	--
2	3.013	90750	79.649	10423	2852	1.215	10.077
总计		113937	100.000	16066			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-177-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:06:03
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

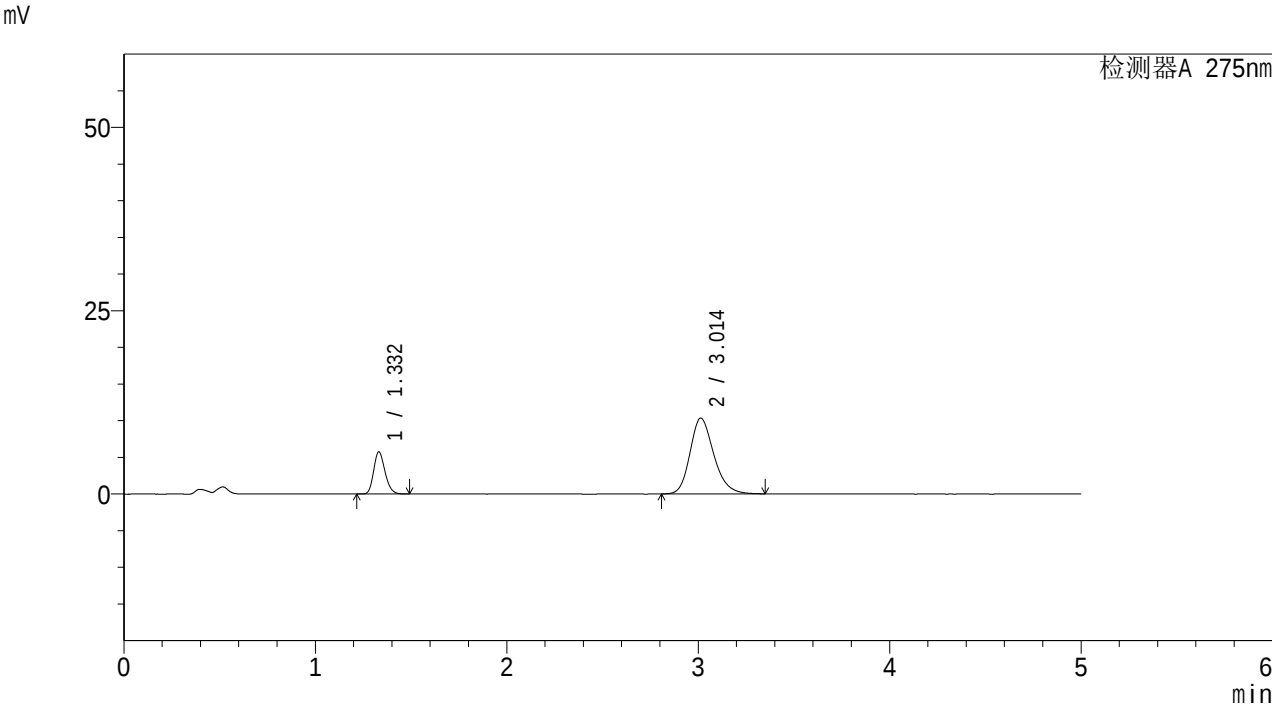

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	23639	20.799	5739	2423	1.200	--
2	3.014	90017	79.201	10355	2865	1.216	10.088
总计		113656	100.000	16094			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-178-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:11:25
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

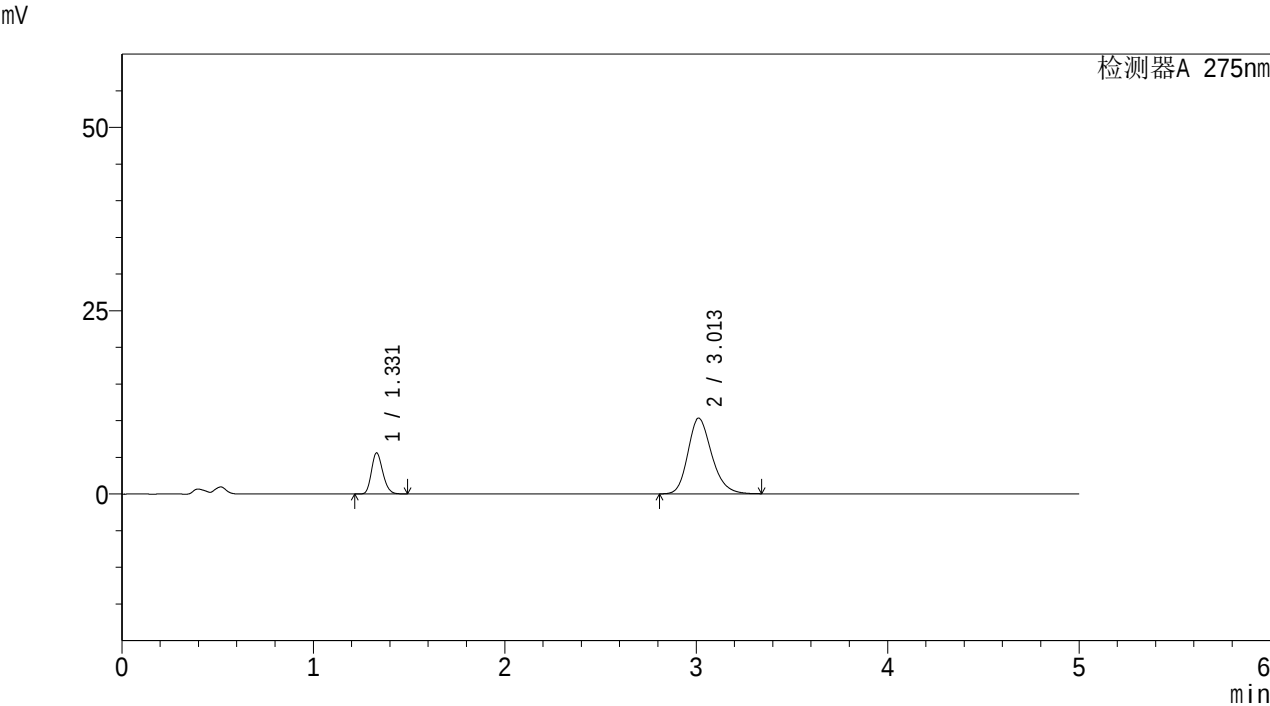

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	23026	20.387	5607	2420	1.197	--
2	3.013	89919	79.613	10343	2863	1.215	10.092
总计		112944	100.000	15950			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-179-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:16:46

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

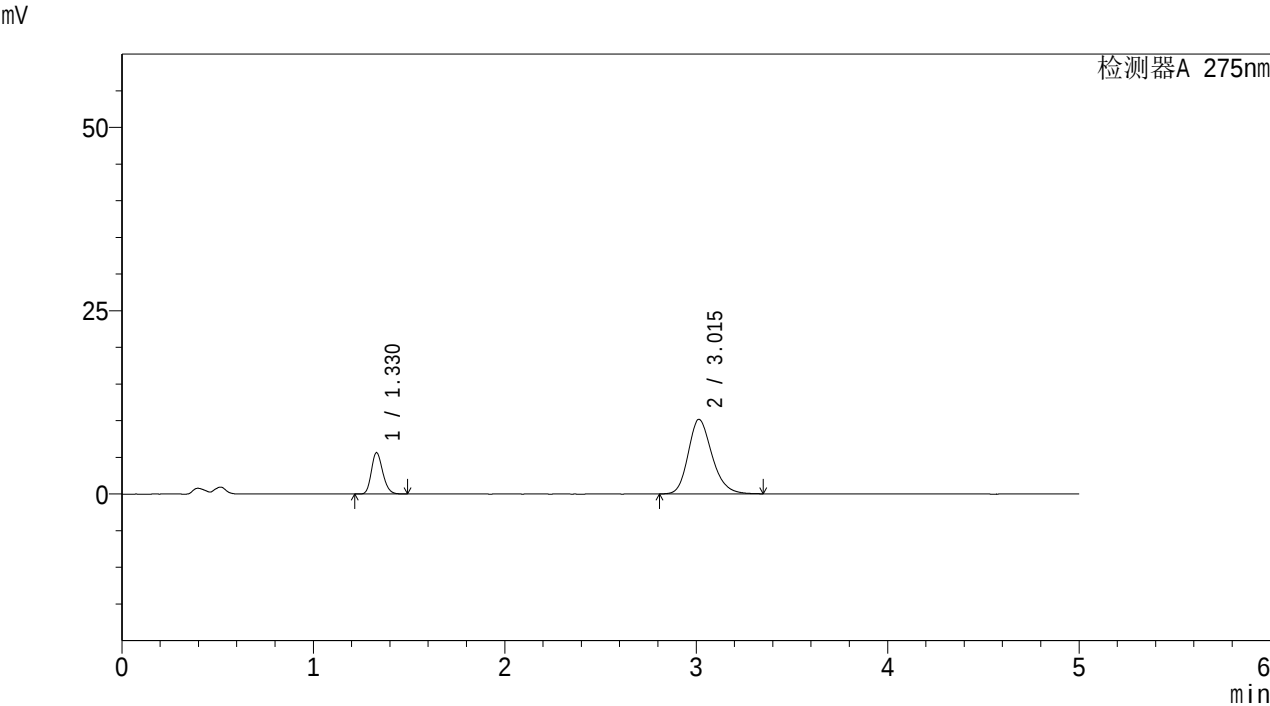

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	23191	20.770	5644	2416	1.196	--
2	3.015	88465	79.230	10170	2866	1.212	10.102
总计		111656	100.000	15814			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-180-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:22:08

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

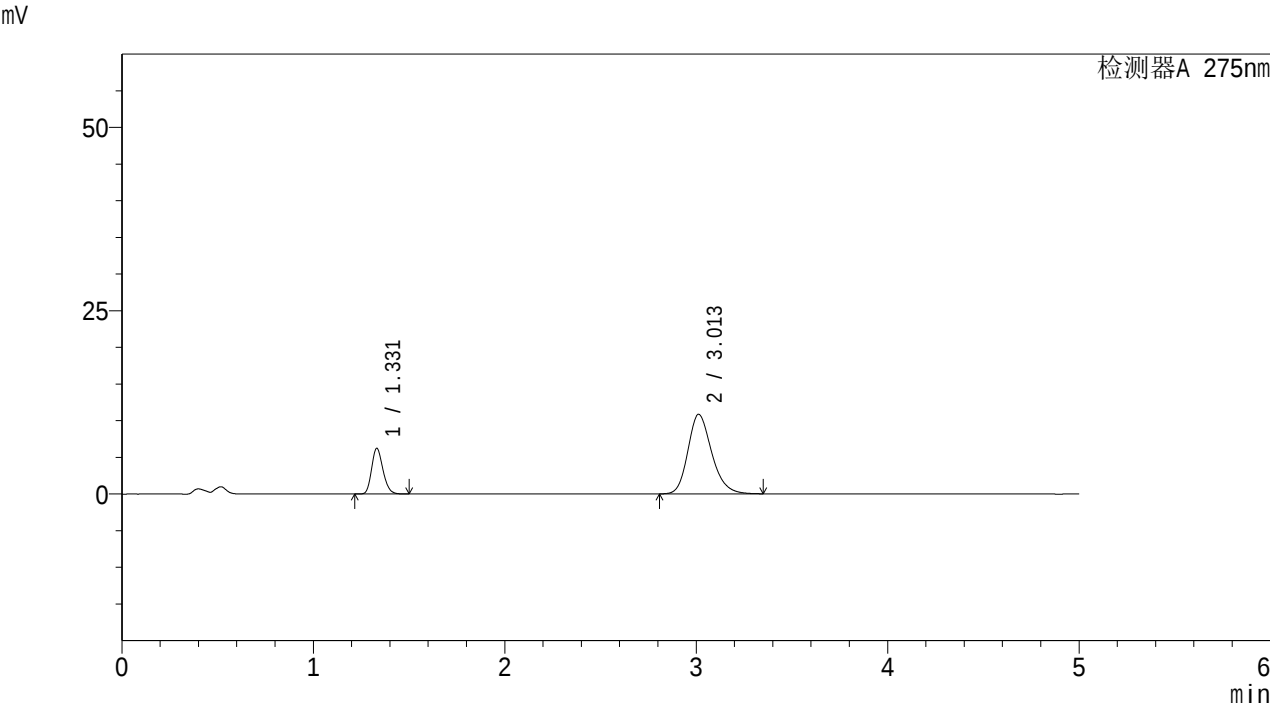

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	25603	21.318	6222	2422	1.198	--
2	3.013	94497	78.682	10861	2865	1.216	10.089
总计		120100	100.000	17083			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-181-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:27:30

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

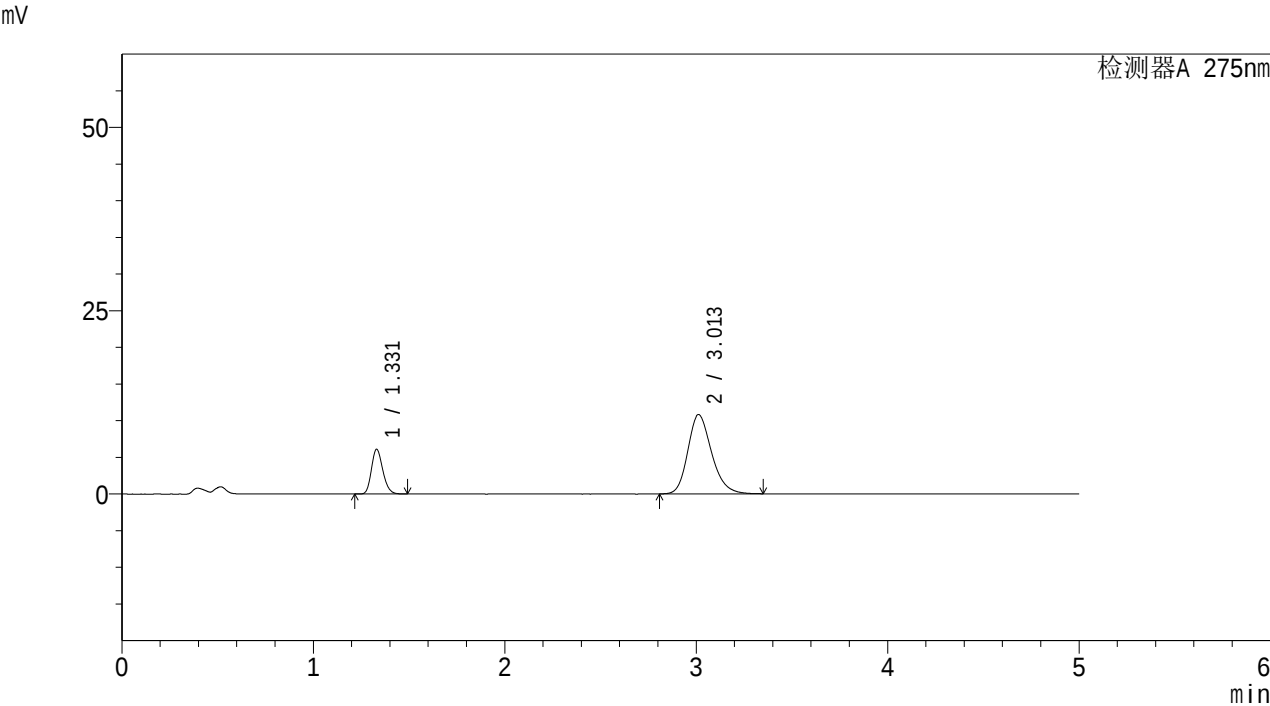

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	25160	21.095	6118	2415	1.198	--
2	3.013	94109	78.905	10825	2863	1.215	10.088
总计		119269	100.000	16942			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-182-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:32:52
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

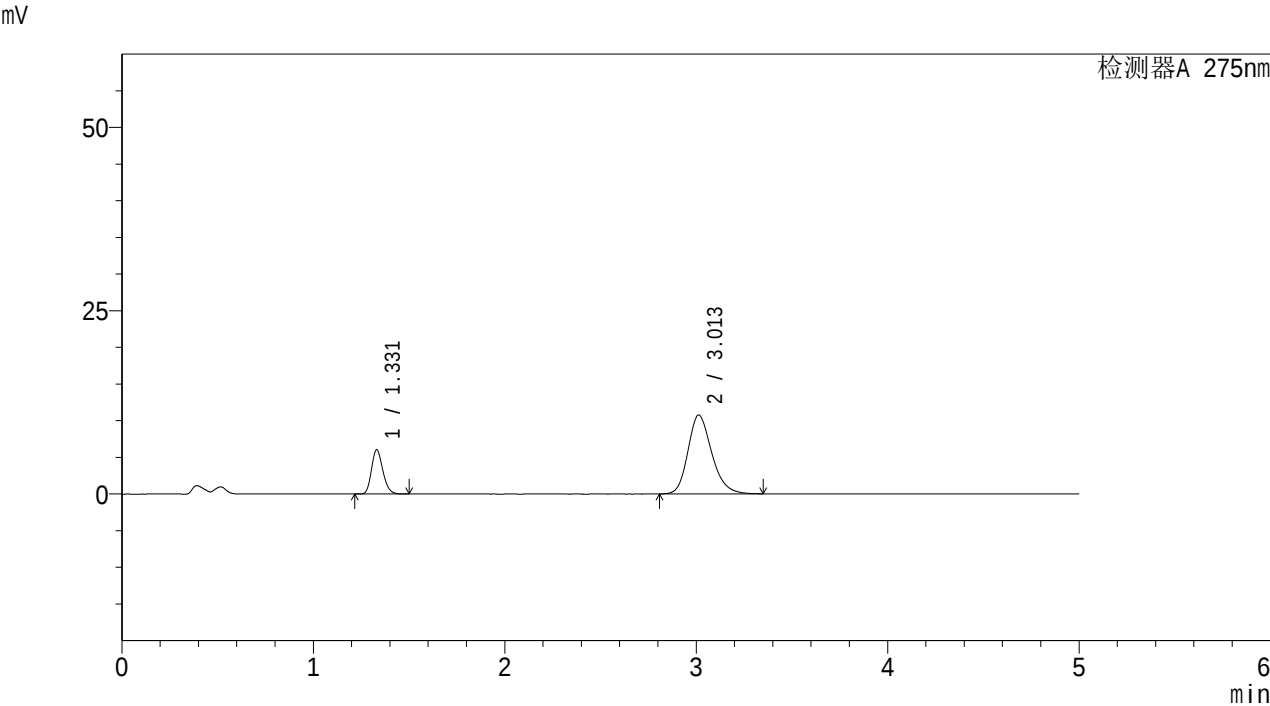

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	24852	20.998	6042	2417	1.200	--
2	3.013	93503	79.002	10759	2864	1.214	10.091
总计		118354	100.000	16801			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-183-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:38:14

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

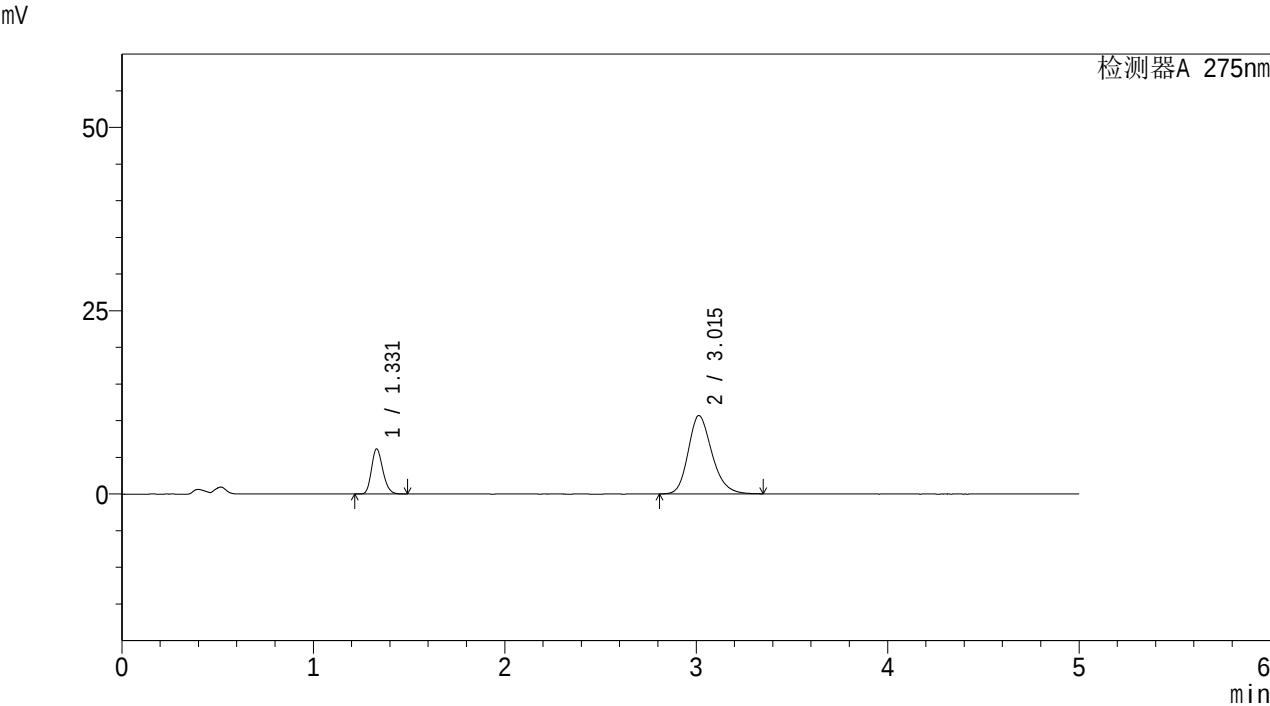

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	25235	21.378	6152	2425	1.196	--
2	3.015	92806	78.622	10691	2873	1.214	10.110
总计		118041	100.000	16843			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-184-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:43:35
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

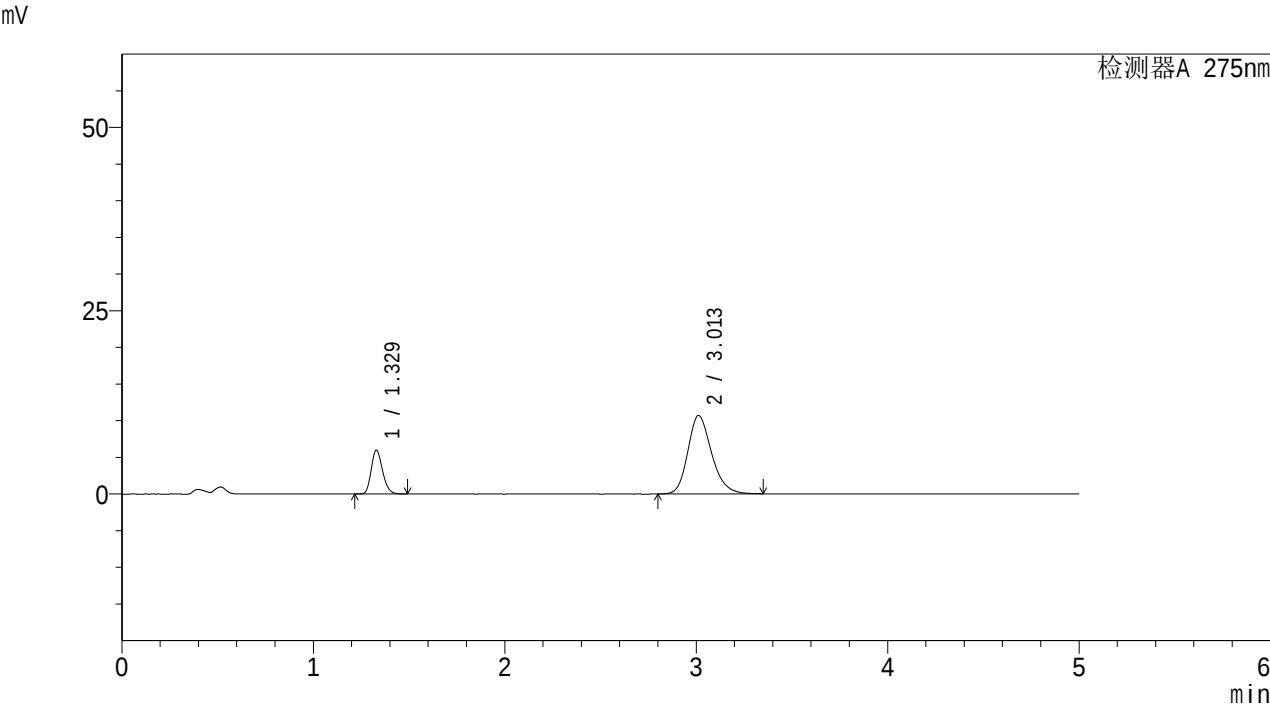

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	24593	20.916	5983	2411	1.199	--
2	3.013	92990	79.084	10701	2863	1.215	10.095
总计		117584	100.000	16684			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-185-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:48:56

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

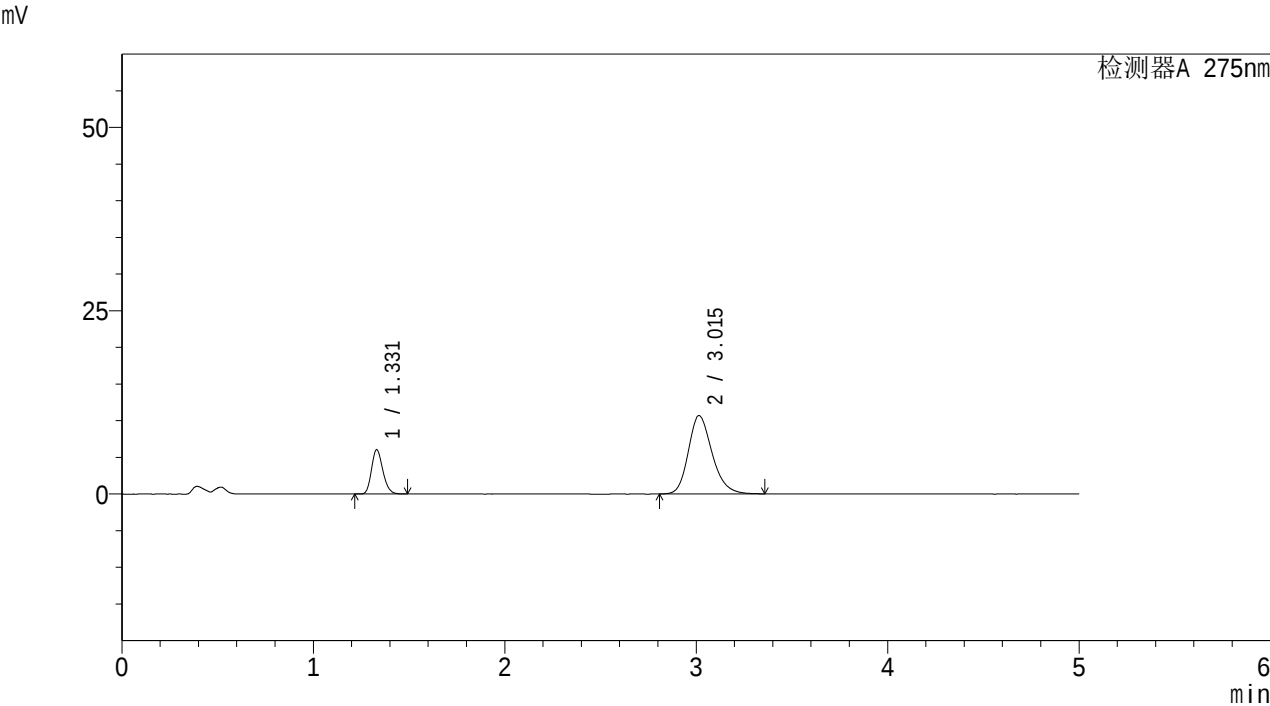

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	24865	21.099	6051	2424	1.198	--
2	3.015	92987	78.901	10685	2866	1.216	10.104
总计		117852	100.000	16736			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-186-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:54:18

处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

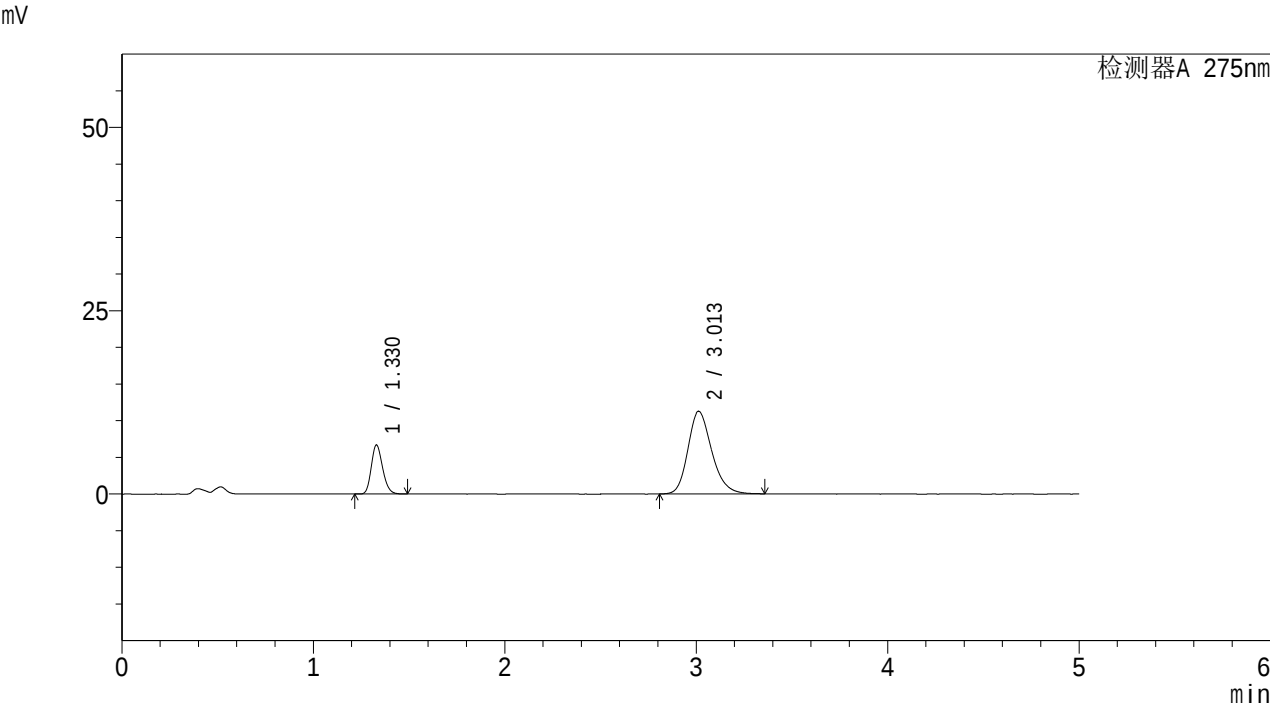

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	27503	21.890	6696	2417	1.198	--
2	3.013	98138	78.110	11281	2859	1.217	10.093
总计		125640	100.000	17977			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-187-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:59:41
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

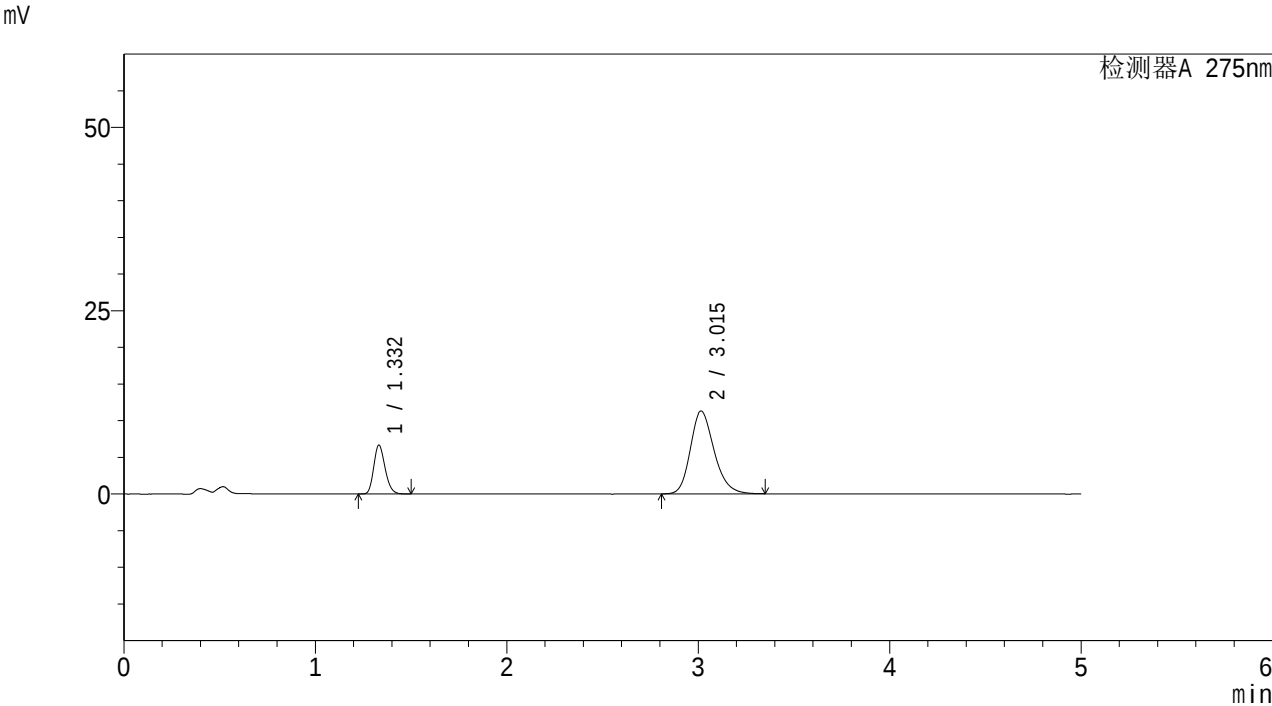

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.332	27403	21.807	6651	2424	1.199	--
2	3.015	98260	78.193	11305	2868	1.217	10.097
总计		125663	100.000	17957			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-188-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:05:04
处理时间(V2): 2026/05/14 20:00:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

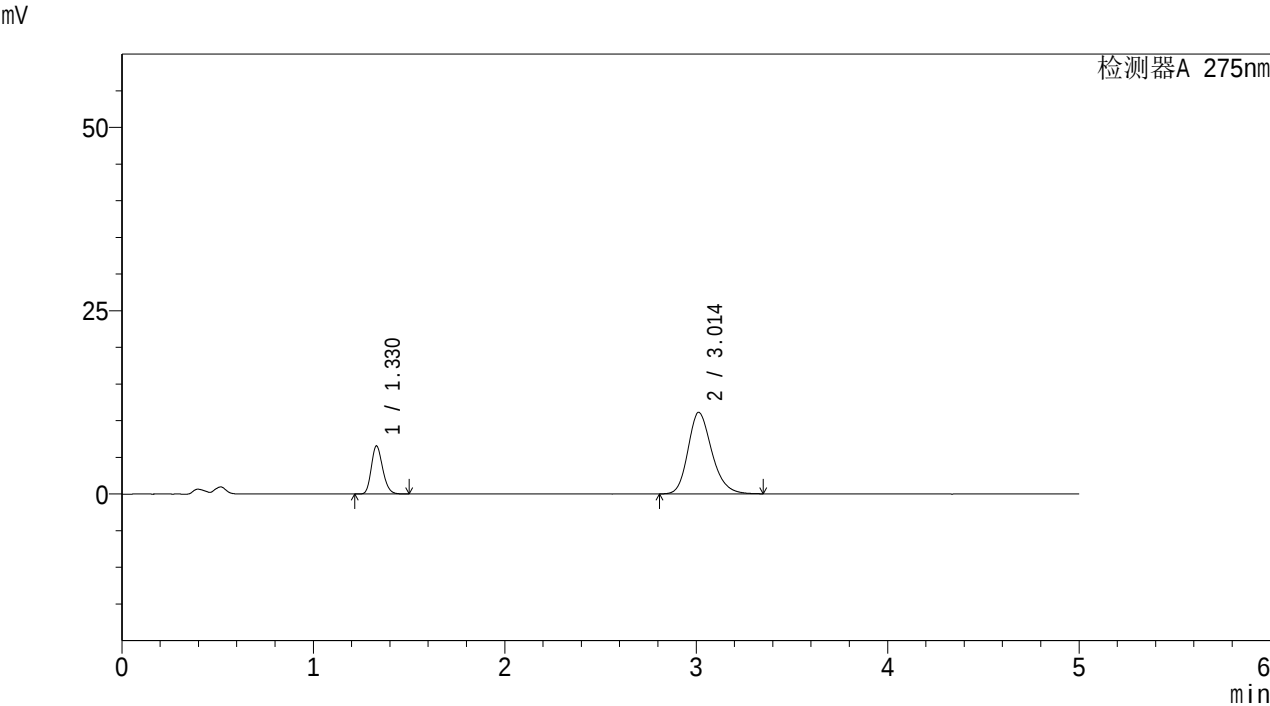

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	27021	21.818	6563	2409	1.198	--
2	3.014	96825	78.182	11129	2861	1.217	10.090
总计		123846	100.000	17691			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-189-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:10:27

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

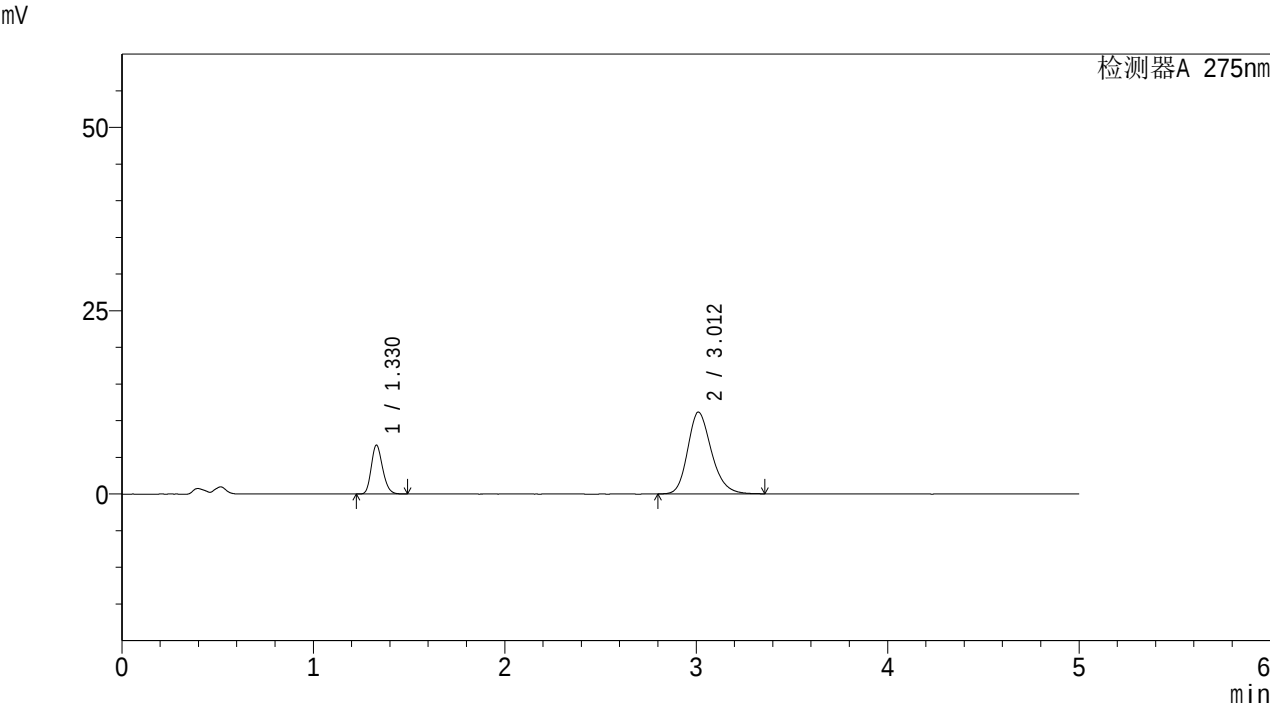

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	27372	21.996	6670	2419	1.197	--
2	3.012	97066	78.004	11156	2865	1.216	10.097
总计		124438	100.000	17827			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-190-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:15:49
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

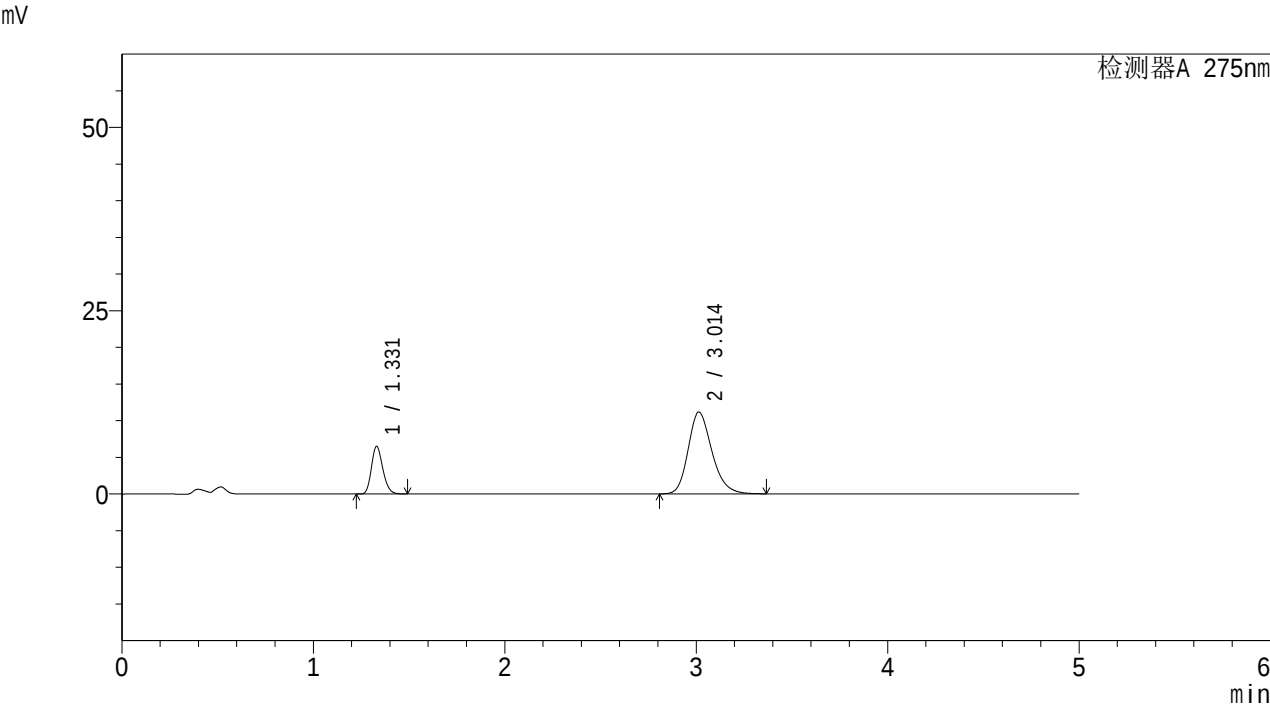

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.331	26783	21.613	6512	2418	1.198	--
2	3.014	97138	78.387	11172	2867	1.219	10.100
总计		123921	100.000	17685			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-191-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:21:12

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

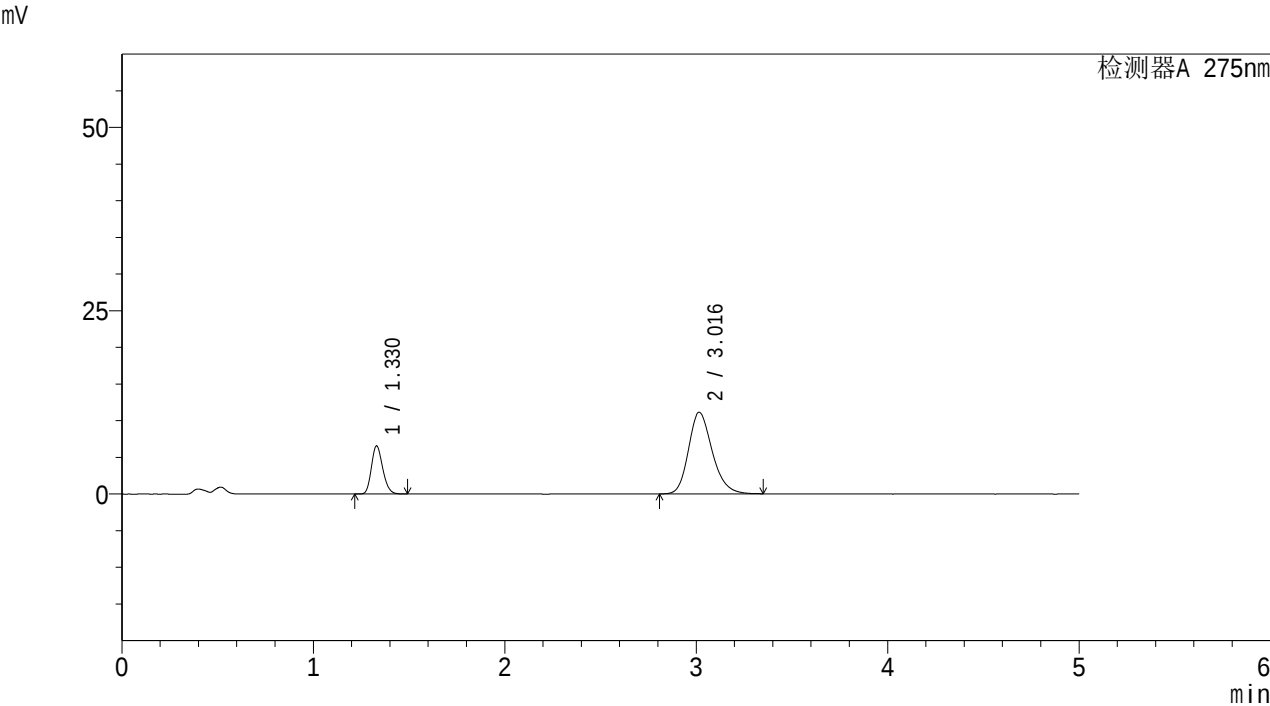

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	26969	21.799	6566	2418	1.196	--
2	3.016	96750	78.201	11128	2870	1.216	10.112
总计		123719	100.000	17694			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-192-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:26:36

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

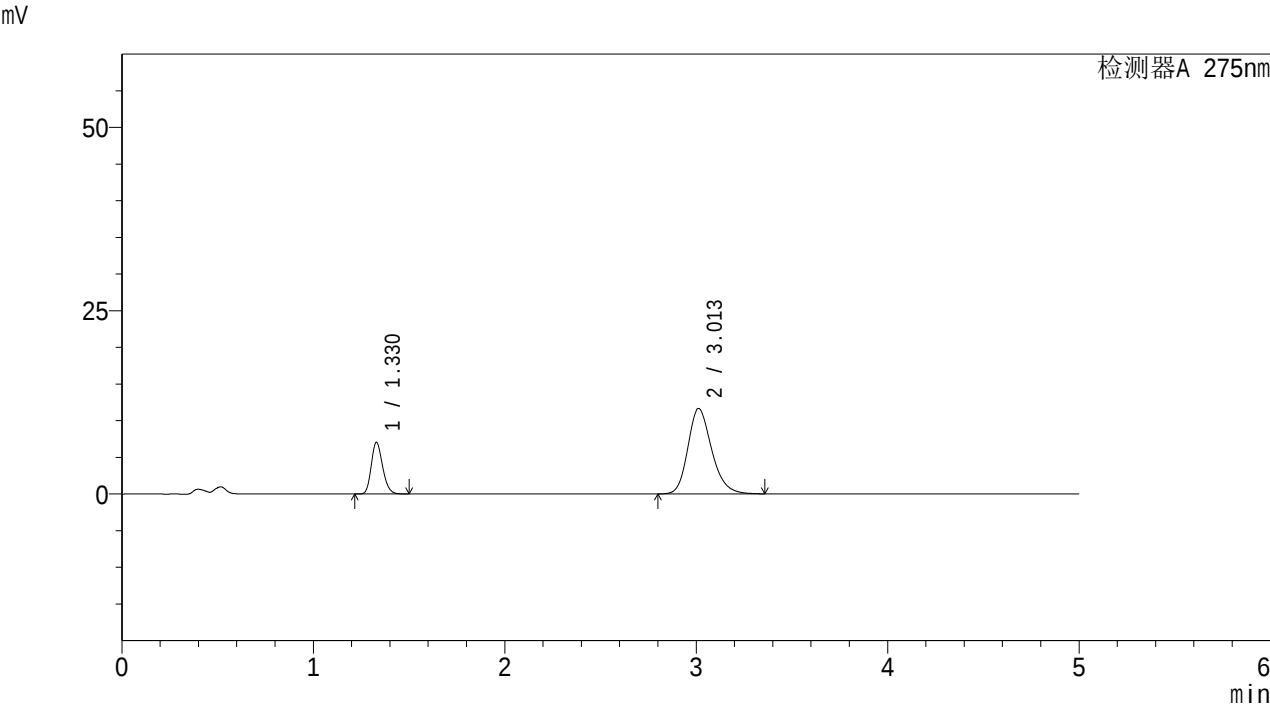

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	29070	22.285	7057	2409	1.198	--
2	3.013	101374	77.715	11660	2867	1.218	10.096
总计		130444	100.000	18717			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-193-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:31:59
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

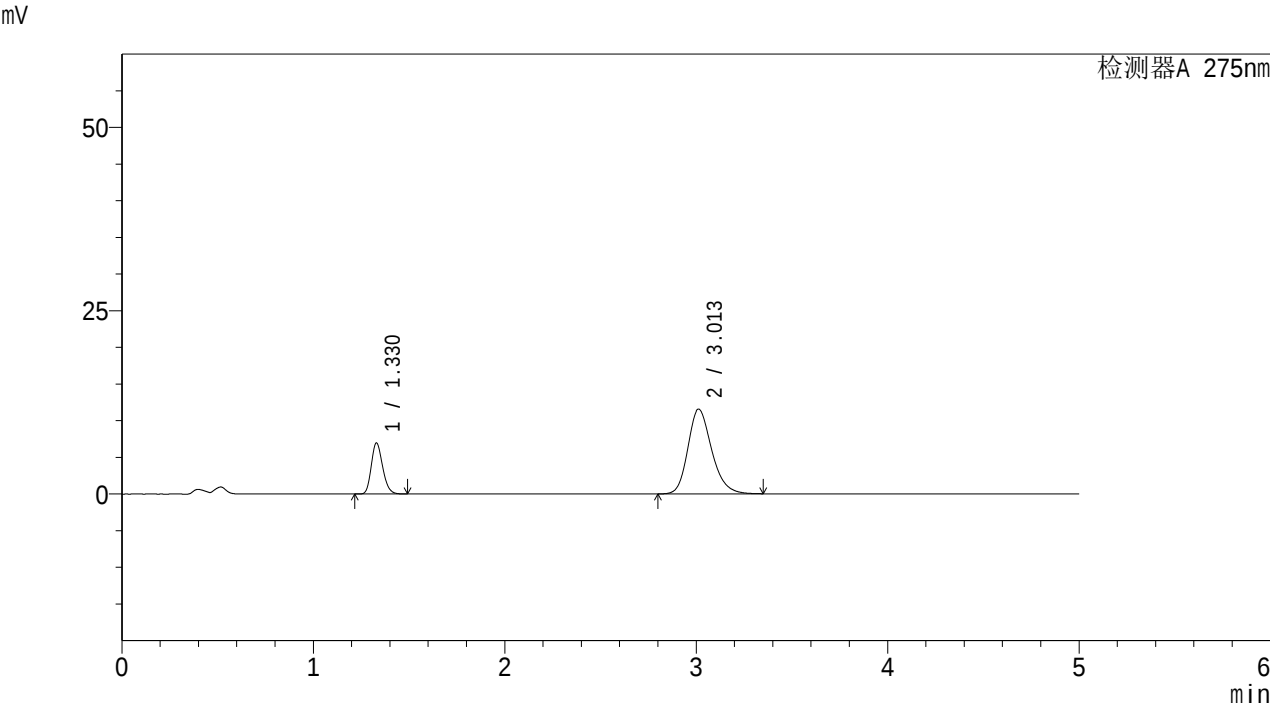

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28639	22.166	6971	2416	1.197	--
2	3.013	100563	77.834	11580	2873	1.217	10.108
总计		129202	100.000	18551			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-194-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:37:23
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

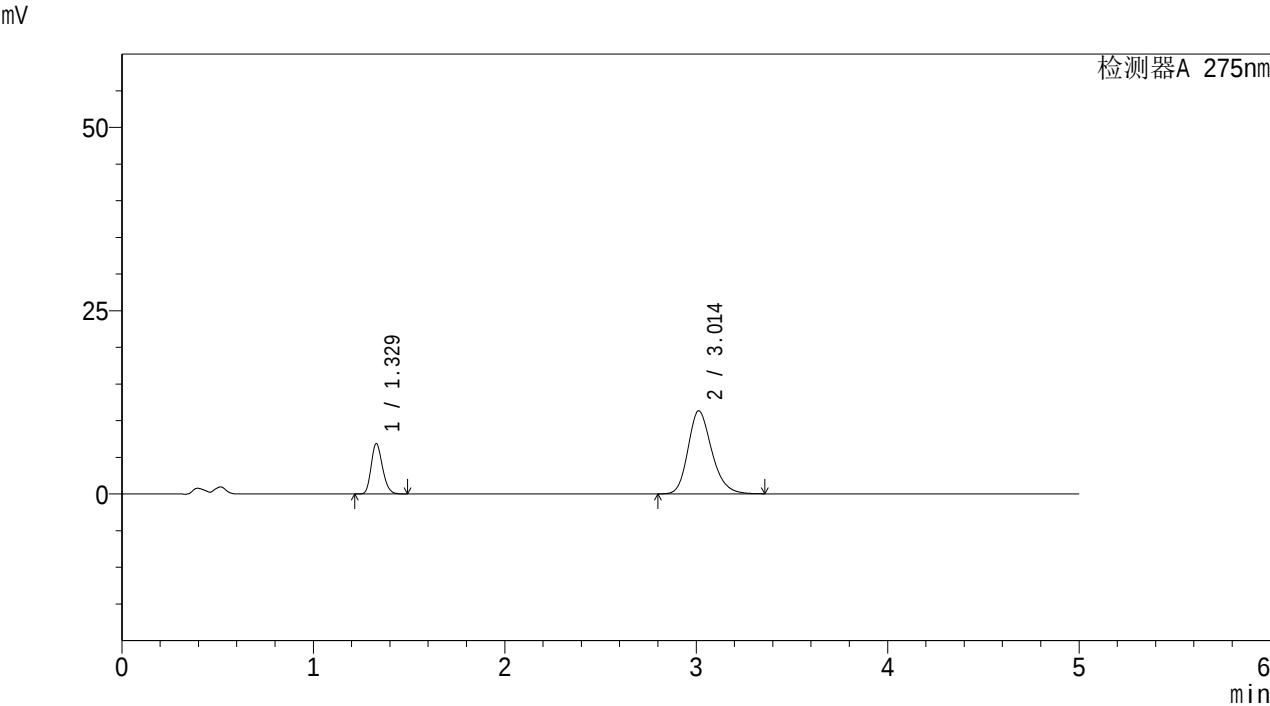

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28246	22.311	6874	2415	1.197	--
2	3.014	98354	77.689	11332	2872	1.216	10.114
总计		126600	100.000	18206			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-195-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:42:46

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

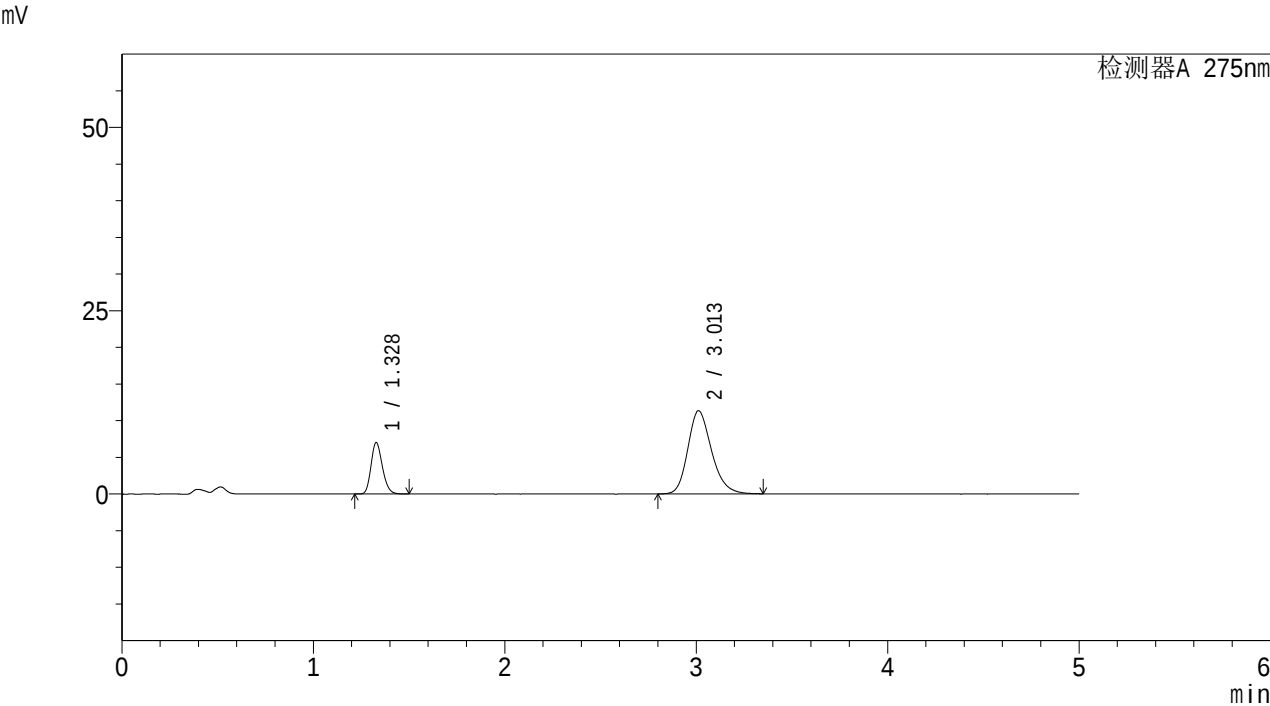

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	28915	22.693	7013	2408	1.200	--
2	3.013	98503	77.307	11346	2874	1.217	10.113
总计		127418	100.000	18359			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-196-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:48:10

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

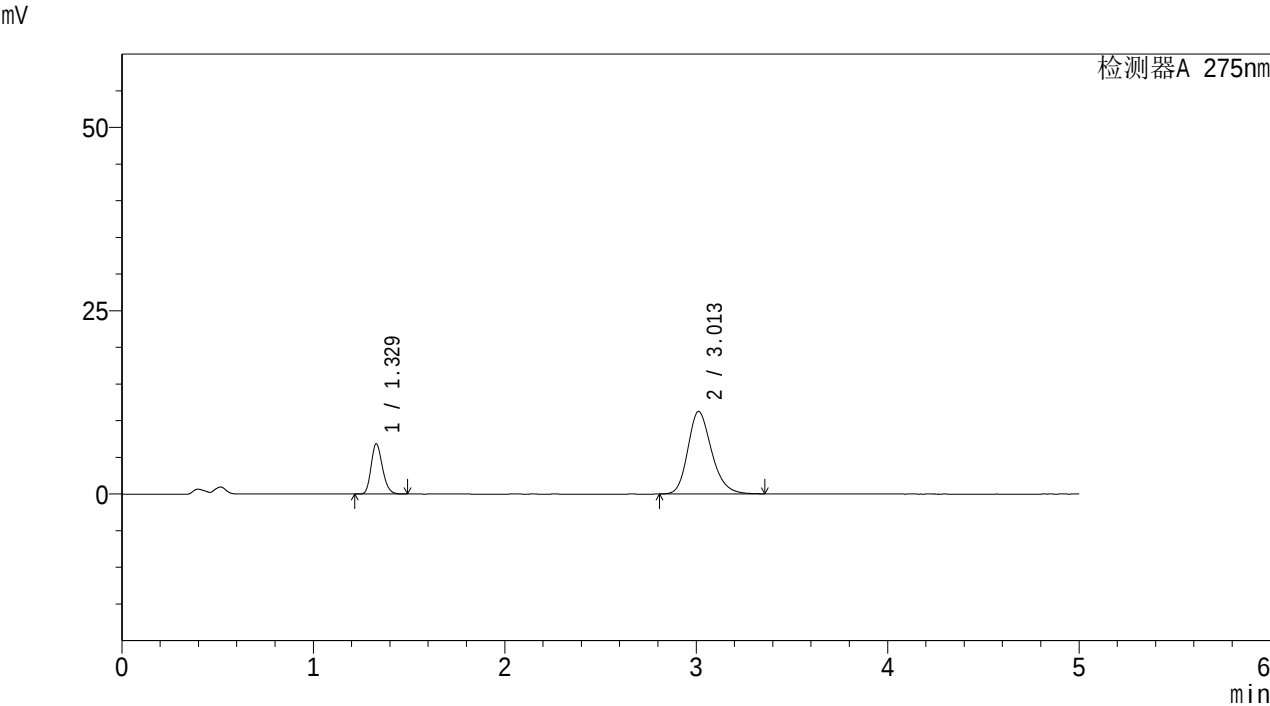

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28156	22.377	6841	2413	1.198	--
2	3.013	97671	77.623	11259	2879	1.217	10.120
总计		125827	100.000	18100			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-197-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:53:33
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

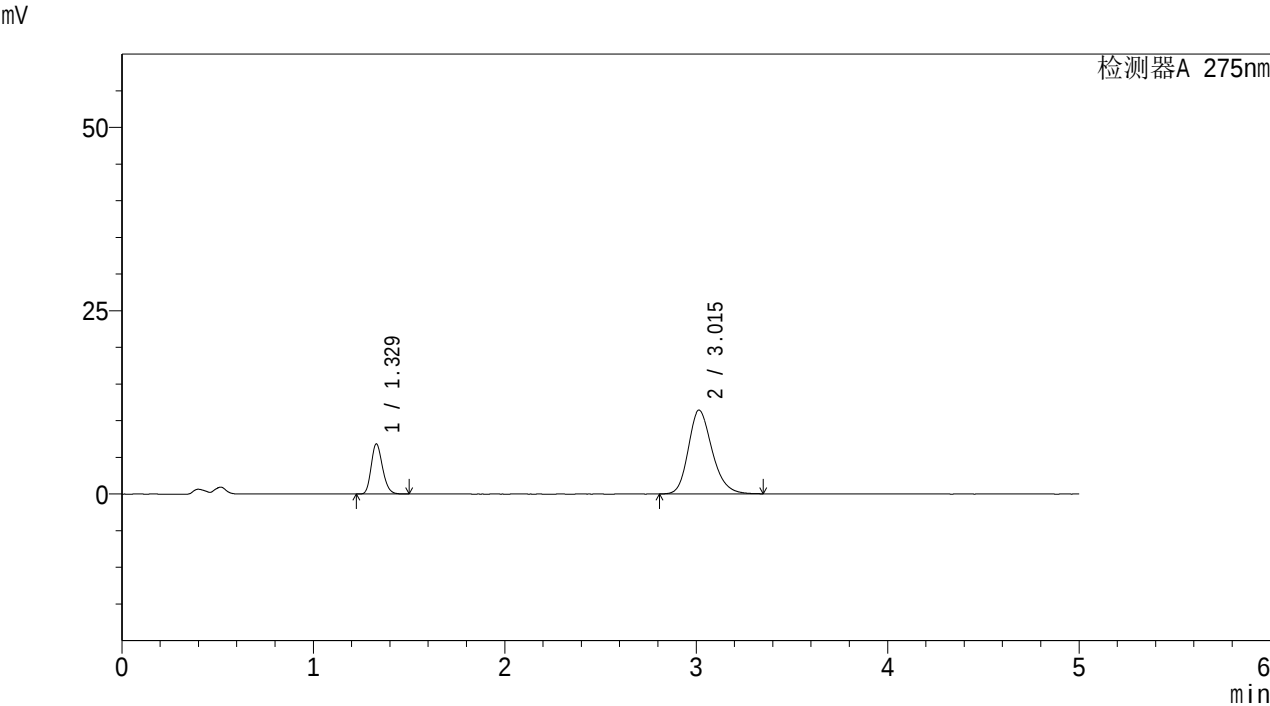

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28102	22.072	6838	2415	1.199	--
2	3.015	99220	77.928	11428	2877	1.215	10.125
总计		127322	100.000	18266			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-198-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:58:57
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

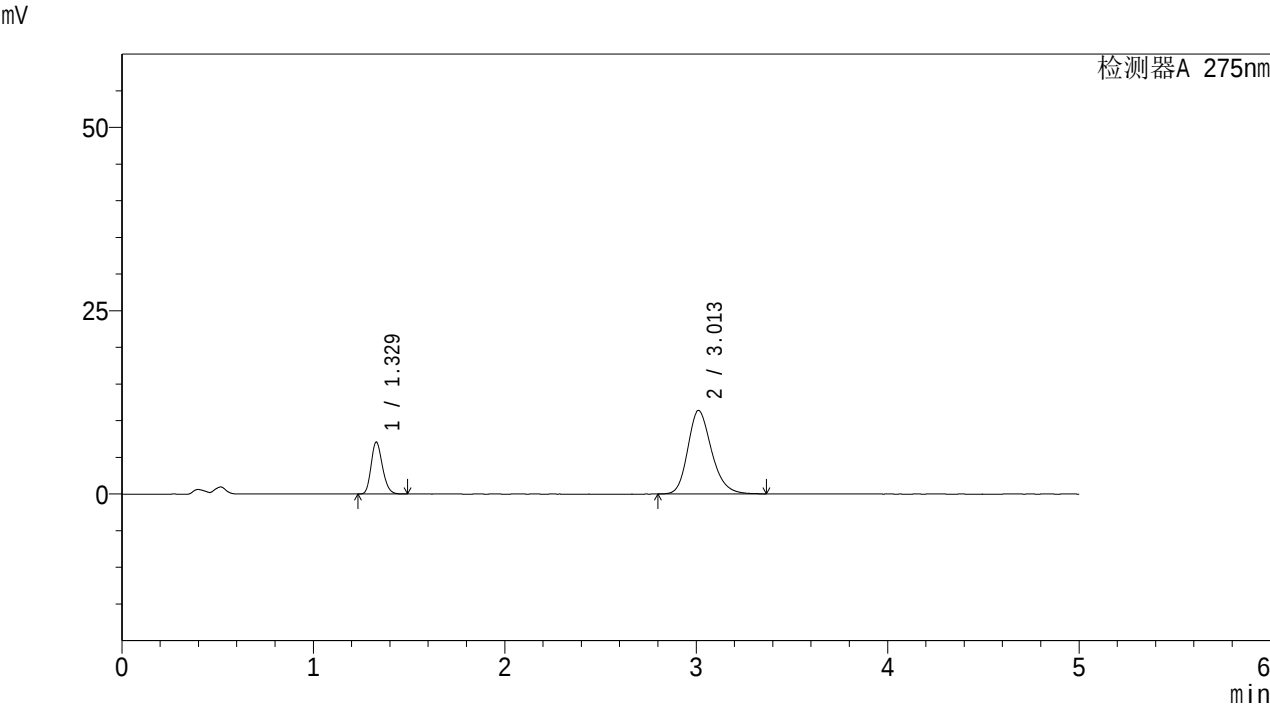

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	29119	22.742	7084	2413	1.197	--
2	3.013	98920	77.258	11394	2874	1.218	10.113
总计		128039	100.000	18478			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-199-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:04:21
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

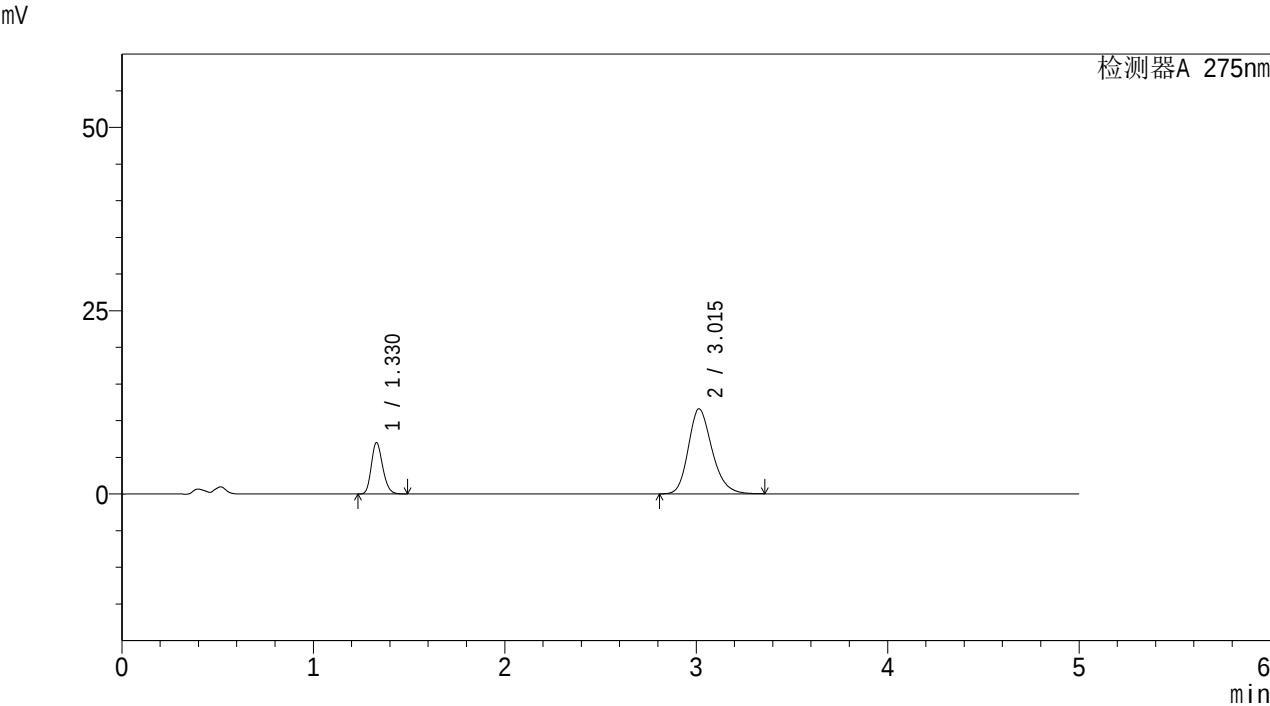

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.330	28828	22.264	7018	2414	1.197	--
2	3.015	100658	77.736	11594	2877	1.216	10.118
总计		129486	100.000	18612			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-200-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:09:45
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

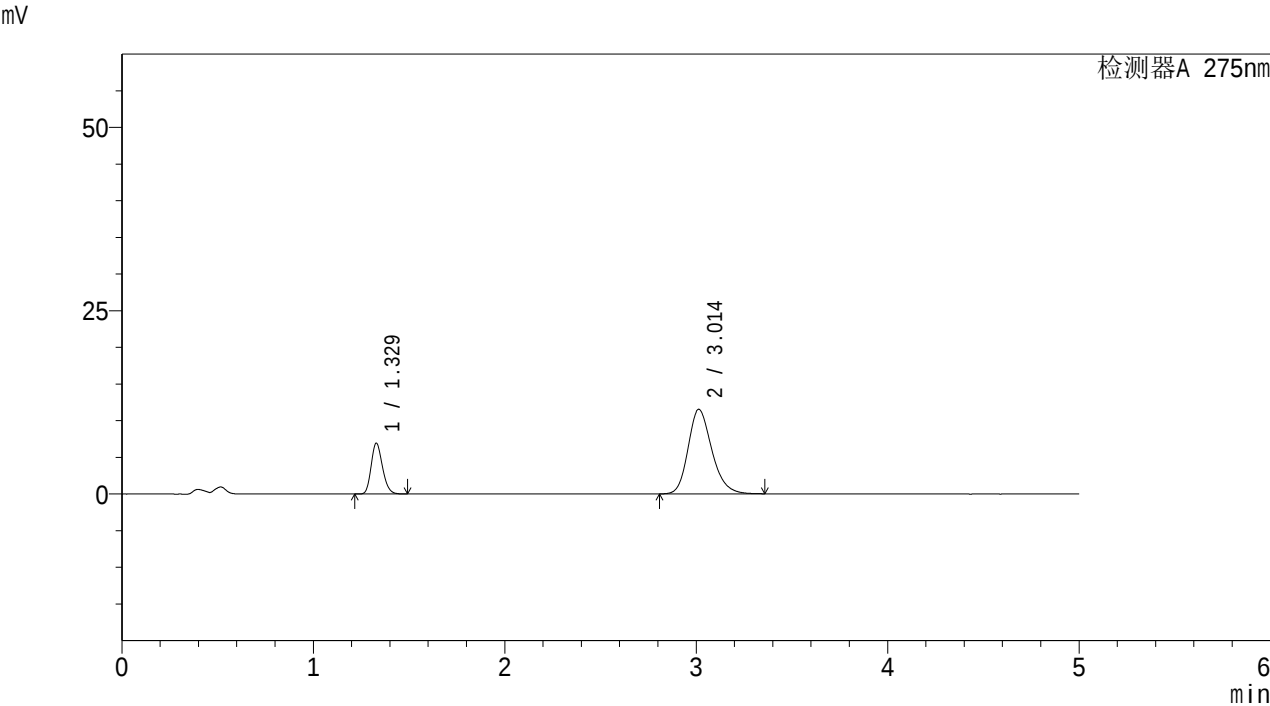

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28504	22.172	6932	2415	1.198	--
2	3.014	100056	77.828	11541	2878	1.217	10.123
总计		128560	100.000	18473			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-201-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 10:15:09

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

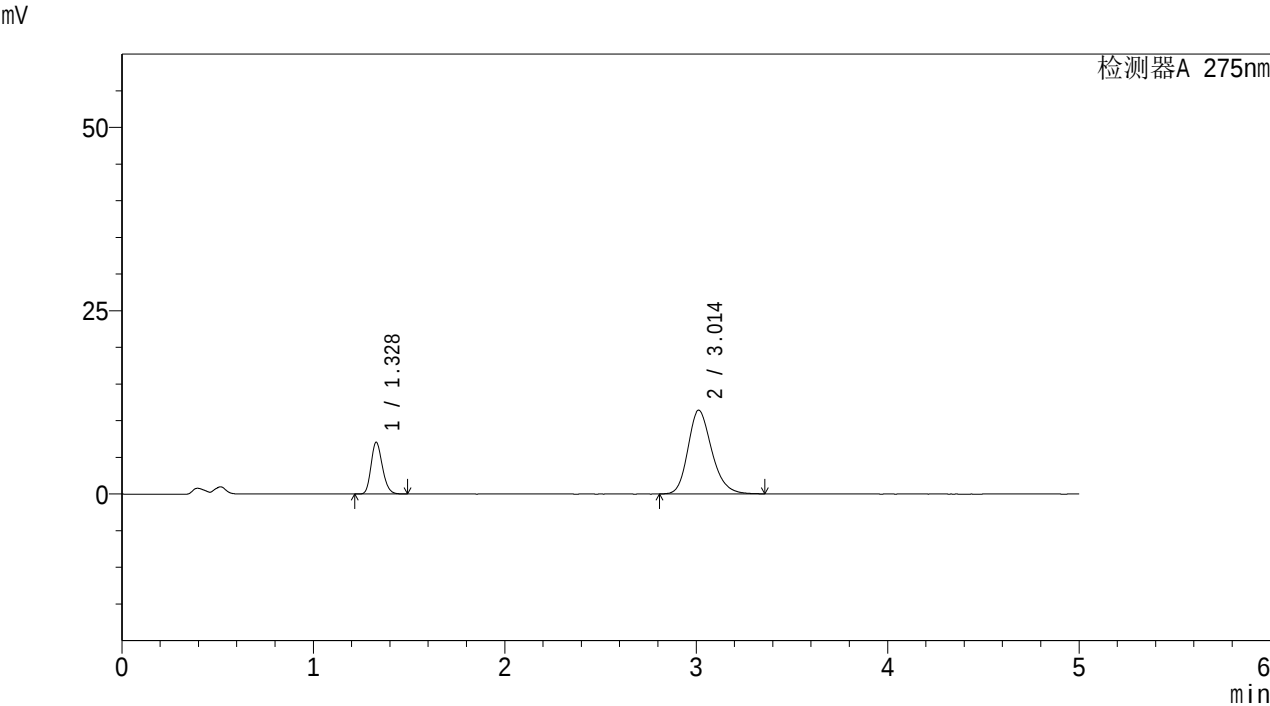

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.328	29015	22.631	7053	2418	1.196	--
2	3.014	99191	77.369	11429	2872	1.214	10.121
总计		128206	100.000	18482			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-202-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:20:32
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

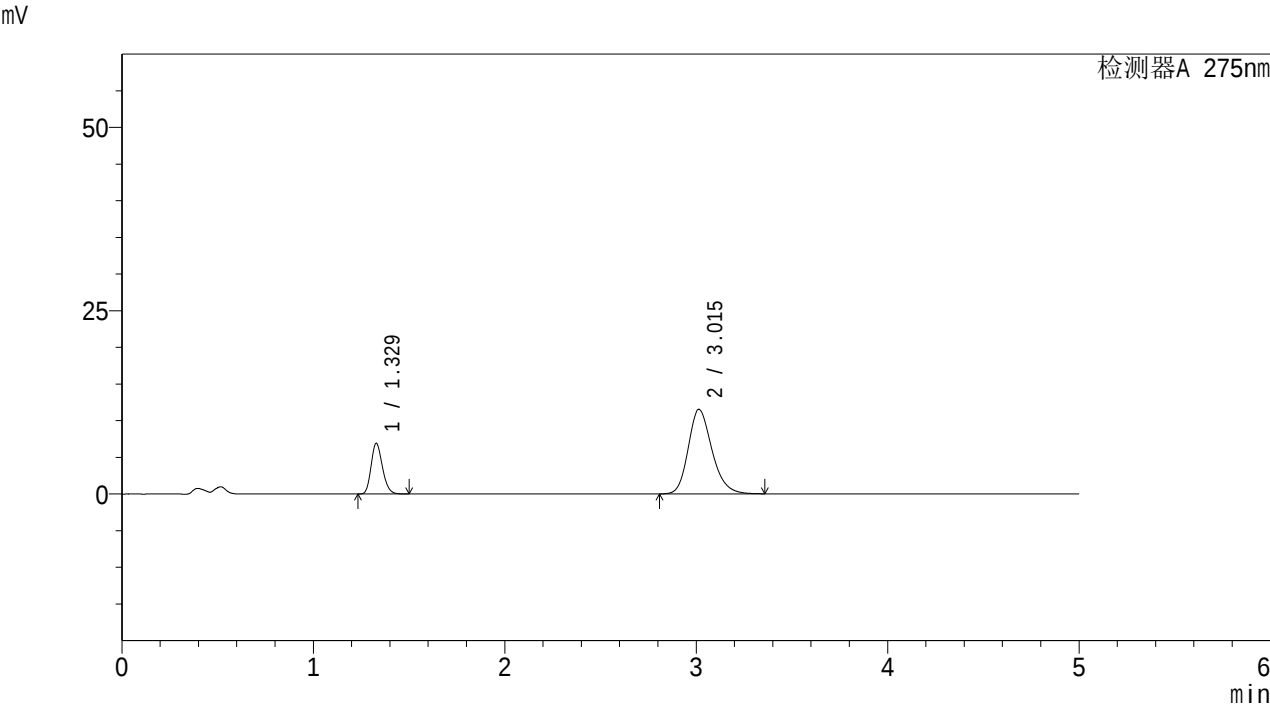

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28402	22.119	6907	2415	1.197	--
2	3.015	100003	77.881	11536	2881	1.213	10.131
总计		128405	100.000	18443			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-203-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:25:55
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

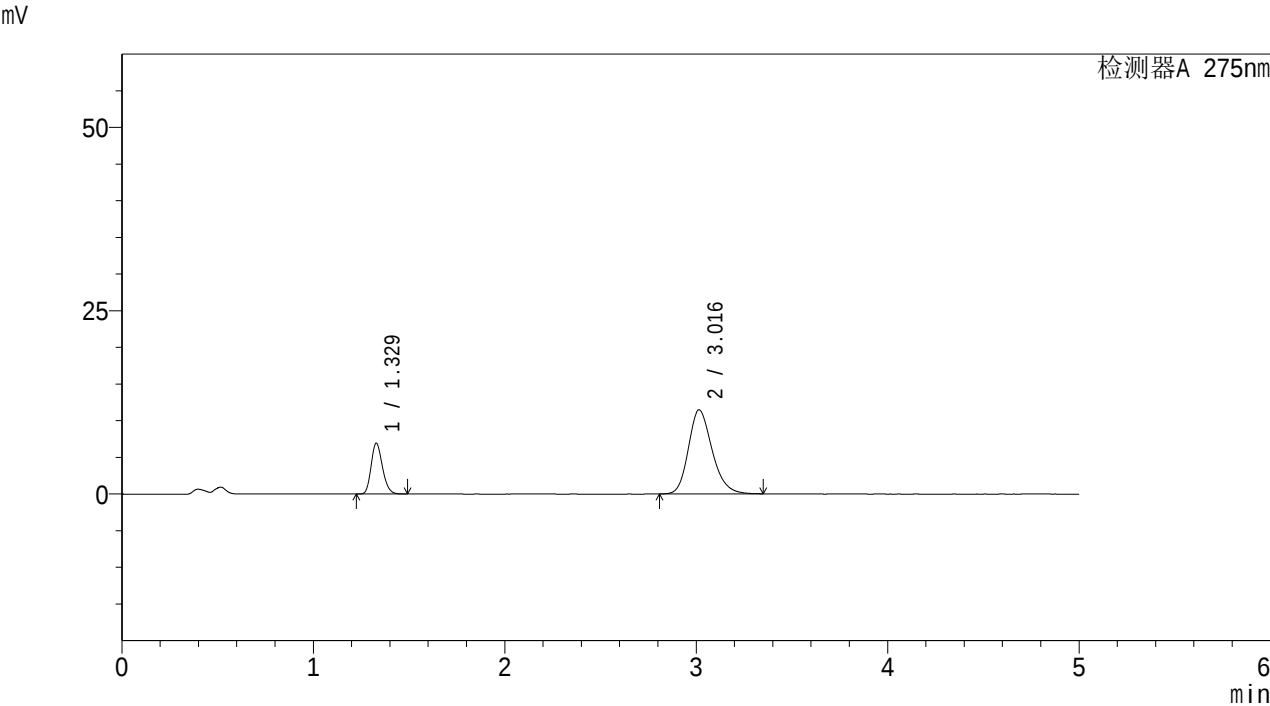

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.329	28507	22.289	6934	2415	1.197	--
2	3.016	99390	77.711	11463	2879	1.214	10.132
总计		127897	100.000	18397			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-204-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 10:31:18

处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

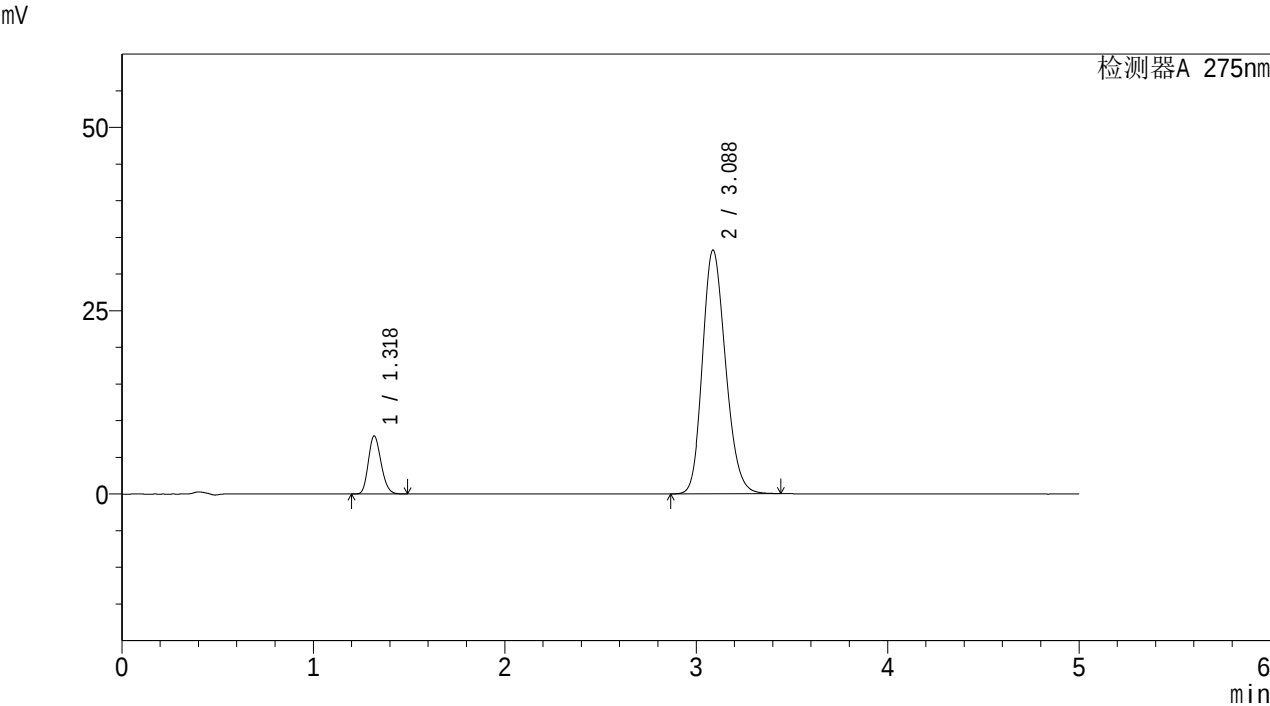

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.318	36445	11.580	7860	1877	1.183	--
2	3.088	278281	88.420	33252	3168	1.180	10.380
总计		314725	100.000	41113			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-20/21-205-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx270.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX270.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:36:41
处理时间(V2): 2026/05/14 20:01:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX270)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

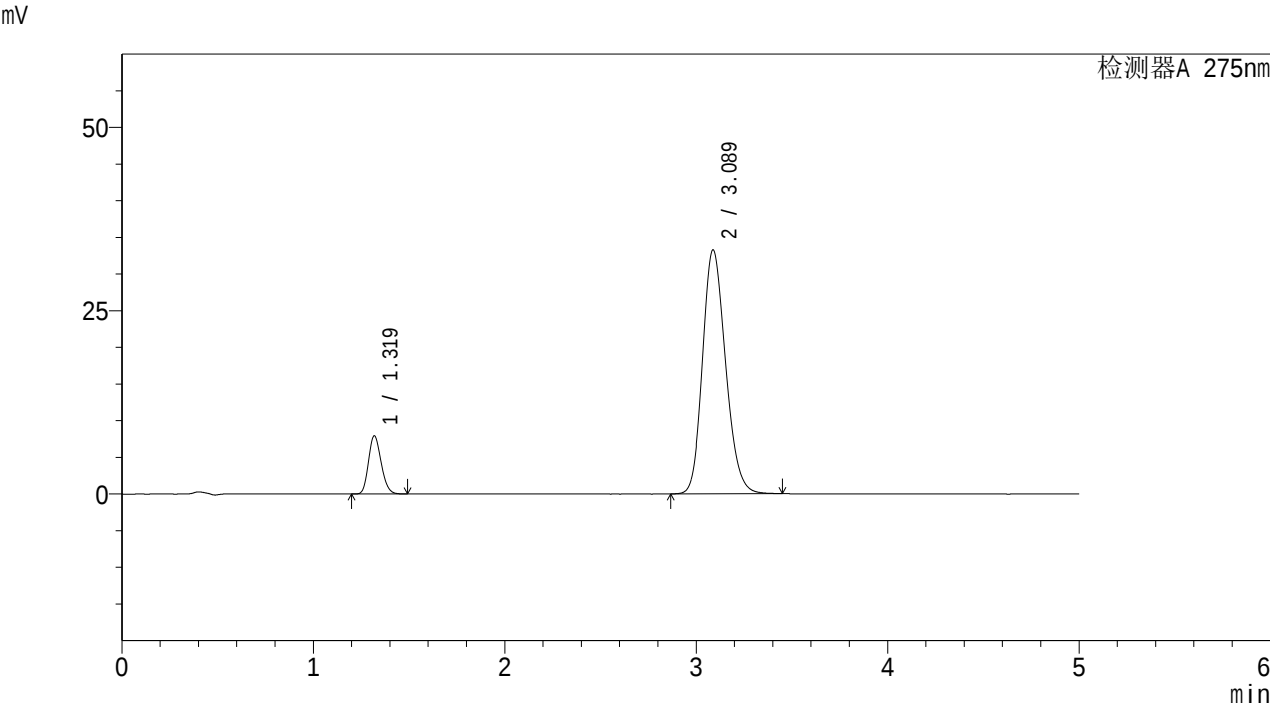

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.319	36384	11.566	7885	1890	1.181	--
2	3.089	278203	88.434	33280	3175	1.180	10.395
总计		314587	100.000	41165			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH4.5介质
对照品溶液-2-2