



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	70112	70244	70019	70326	70337	70208	0.20
2	10.99	70527	70533				70530	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
6441.10	6417.65	0.26	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	13517	-	13517	18.863	18.03	13.48	18.86	18.03	13.48
	2	14649	-	14649	20.443			20.44		
	3	12126	-	12126	16.922			16.92		
	4	9918	-	9918	13.840			13.84		
	5	14392	-	14392	20.084			20.08		
	6	12910	-	12910	18.016			18.02		
10min	1	24437	-	24437	34.102	32.97	7.07	34.13	33.00	7.07
	2	24800	-	24800	34.608			34.64		
	3	23505	-	23505	32.801			32.83		
	4	20453	-	20453	28.542			28.57		
	5	24980	-	24980	34.859			34.89		
	6	23594	-	23594	32.925			32.96		
15min	1	30196	-	30196	42.138	41.15	3.98	42.23	41.23	3.99
	2	30304	-	30304	42.289			42.38		
	3	29710	-	29710	41.460			41.54		
	4	27263	-	27263	38.045			38.12		
	5	30269	-	30269	42.240			42.33		
	6	29165	-	29165	40.699			40.78		
20min	1	33821	-	33821	47.197	46.30	2.88	47.36	46.45	2.89
	2	33949	-	33949	47.375			47.54		
	3	33517	-	33517	46.773			46.92		
	4	31472	-	31472	43.919			44.05		
	5	33659	-	33659	46.971			47.13		
	6	32651	-	32651	45.564			45.72		
30min	1	38483	-	38483	53.703	53.17	1.35	53.94	53.40	1.36
	2	38427	-	38427	53.624			53.87		
	3	38354	-	38354	53.523			53.75		
	4	37407	-	37407	52.201			52.41		
	5	38460	-	38460	53.671			53.91		
	6	37480	-	37480	52.303			52.53		
45min	1	43233	-	43233	60.331	59.79	1.13	60.66	60.11	1.13
	2	43111	-	43111	60.161			60.49		
	3	42987	-	42987	59.988			60.31		
	4	42780	-	42780	59.699			59.99		
	5	43052	-	43052	60.079			60.41		
	6	41916	-	41916	58.493			58.81		
60min	1	46229	-	46229	64.512	64.05	1.20	64.94	64.46	1.20
	2	46115	-	46115	64.353			64.78		
	3	46144	-	46144	64.393			64.81		
	4	45984	-	45984	64.170			64.56		
	5	46116	-	46116	64.354			64.78		
	6	44788	-	44788	62.501			62.91		
90min	1	50015	-	50015	69.795	69.29	1.21	70.33	69.81	1.21
	2	49270	-	49270	68.756			69.29		
	3	50072	-	50072	69.875			70.40		
	4	49884	-	49884	69.613			70.11		
	5	50072	-	50072	69.875			70.41		
	6	48594	-	48594	67.812			68.33		
120min	1	52833	-	52833	73.728	73.06	1.32	74.38	73.70	1.31
	2	52412	-	52412	73.140			73.79		
	3	52721	-	52721	73.572			74.21		
	4	52589	-	52589	73.387			74.00		
	5	52583	-	52583	73.379			74.03		
	6	50975	-	50975	71.135			71.77		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	53406	-	53406	74.528	73.80	1.33	75.30	74.56	1.32
	2	53196	-	53196	74.234			75.01		
	3	53324	-	53324	74.413			75.18		
	4	53328	-	53328	74.419			75.16		
	5	52310	-	52310	72.998			73.77		
	6	51724	-	51724	72.180			72.93		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	530826	530783	530047	532051	530974	530936	0.14
2	11.10	536422	535366				535894	0.14

单位质量响应值		RSD%	判断
48889.13	48278.74	0.89	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	61864	-	61864	11.449	11.07	9.69	11.45	11.07	9.70
	2	65006	-	65006	12.031			12.03		
	3	58005	-	58005	10.735			10.73		
	4	49336	-	49336	9.131			9.13		
	5	64682	-	64682	11.971			11.97		
	6	60059	-	60059	11.115			11.12		
10min	1	86934	-	86934	16.089	15.77	3.84	16.11	15.78	3.85
	2	87339	-	87339	16.164			16.18		
	3	85347	-	85347	15.795			15.81		
	4	78878	-	78878	14.598			14.61		
	5	87604	-	87604	16.213			16.23		
	6	85100	-	85100	15.749			15.77		
15min	1	94205	-	94205	17.434	17.33	1.73	17.48	17.38	1.75
	2	94802	-	94802	17.545			17.59		
	3	93844	-	93844	17.368			17.41		
	4	90630	-	90630	16.773			16.81		
	5	95150	-	95150	17.609			17.66		
	6	93371	-	93371	17.280			17.32		
20min	1	98297	-	98297	18.192	17.96	1.60	18.27	18.04	1.61
	2	98395	-	98395	18.210			18.29		
	3	95775	-	95775	17.725			17.80		
	4	95315	-	95315	17.640			17.71		
	5	98618	-	98618	18.251			18.33		
	6	95848	-	95848	17.738			17.81		
30min	1	101778	-	101778	18.836	18.61	0.99	18.94	18.72	1.00
	2	101691	-	101691	18.820			18.93		
	3	99663	-	99663	18.444			18.55		
	4	100171	-	100171	18.538			18.64		
	5	100569	-	100569	18.612			18.72		
	6	99465	-	99465	18.408			18.51		
45min	1	104610	-	104610	19.360	19.23	0.83	19.50	19.37	0.84
	2	105033	-	105033	19.438			19.58		
	3	103926	-	103926	19.233			19.37		
	4	102826	-	102826	19.030			19.16		
	5	104010	-	104010	19.249			19.39		
	6	103051	-	103051	19.071			19.21		
60min	1	106998	-	106998	19.802	19.73	5.92	19.97	19.89	5.87
	2	107117	-	107117	19.824			19.99		
	3	116724	-	116724	21.602			21.77		
	4	104514	-	104514	19.342			19.50		
	5	107079	-	107079	19.817			19.99		
	6	97066	-	97066	17.964			18.13		
90min	1	108783	-	108783	20.132	19.78	1.19	20.33	19.98	1.19
	2	107596	-	107596	19.913			20.12		
	3	106198	-	106198	19.654			19.86		
	4	106313	-	106313	19.675			19.87		
	5	107347	-	107347	19.867			20.07		
	6	105162	-	105162	19.462			19.66		
120min	1	110205	-	110205	20.395	19.67	4.13	20.63	19.90	4.10
	2	110000	-	110000	20.358			20.59		
	3	103705	-	103705	19.193			19.43		
	4	98807	-	98807	18.286			18.51		
	5	108392	-	108392	20.060			20.30		
	6	106525	-	106525	19.714			19.94		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	108997	-	108997	20.172	19.66	2.93	20.44	19.93	2.91
	2	109601	-	109601	20.284			20.55		
	3	104153	-	104153	19.275			19.54		
	4	101373	-	101373	18.761			19.02		
	5	107358	-	107358	19.869			20.14		
	6	105958	-	105958	19.609			19.87		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	71162	71310	71296	71437	71540	71349	0.21
2	10.99	71787	72019				71903	0.23
单位质量响应值				RSD%	判断			
6545.78		6542.58		0.04	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	13752	-	13752	18.854	18.10	8.12	18.85	18.10	8.11
	2	14254	-	14254	19.542			19.54		
	3	11143	-	11143	15.277			15.28		
	4	13300	-	13300	18.234			18.23		
	5	13464	-	13464	18.459			18.46		
	6	13290	-	13290	18.221			18.22		
10min	1	24447	-	24447	33.517	33.21	2.77	33.55	33.24	2.78
	2	24904	-	24904	34.143			34.18		
	3	22968	-	22968	31.489			31.51		
	4	24577	-	24577	33.695			33.73		
	5	24115	-	24115	33.062			33.09		
	6	24329	-	24329	33.355			33.39		
15min	1	29974	-	29974	41.094	41.18	0.90	41.18	41.26	0.91
	2	30285	-	30285	41.521			41.61		
	3	29666	-	29666	40.672			40.75		
	4	30400	-	30400	41.679			41.77		
	5	29885	-	29885	40.972			41.06		
	6	29991	-	29991	41.118			41.20		
20min	1	33461	-	33461	45.875	46.17	0.82	46.03	46.32	0.82
	2	33894	-	33894	46.469			46.63		
	3	33622	-	33622	46.096			46.24		
	4	34105	-	34105	46.758			46.91		
	5	33377	-	33377	45.760			45.91		
	6	33590	-	33590	46.052			46.21		
30min	1	38376	-	38376	52.614	52.78	0.92	52.85	53.02	0.92
	2	38332	-	38332	52.553			52.79		
	3	38624	-	38624	52.954			53.18		
	4	39144	-	39144	53.667			53.90		
	5	38404	-	38404	52.652			52.88		
	6	38121	-	38121	52.264			52.50		
45min	1	42745	-	42745	58.604	59.07	0.67	58.92	59.39	0.67
	2	43258	-	43258	59.307			59.63		
	3	43257	-	43257	59.306			59.62		
	4	43490	-	43490	59.625			59.95		
	5	42900	-	42900	58.816			59.13		
	6	42879	-	42879	58.787			59.11		
60min	1	45751	-	45751	62.725	63.16	0.58	63.14	63.58	0.58
	2	46077	-	46077	63.172			63.59		
	3	46103	-	46103	63.207			63.62		
	4	46524	-	46524	63.785			64.21		
	5	45875	-	45875	62.895			63.31		
	6	46077	-	46077	63.172			63.59		
90min	1	49446	-	49446	67.791	68.23	0.39	68.31	68.75	0.39
	2	49688	-	49688	68.122			68.65		
	3	49803	-	49803	68.280			68.80		
	4	50033	-	50033	68.595			69.12		
	5	49845	-	49845	68.338			68.86		
	6	49779	-	49779	68.247			68.77		
120min	1	52073	-	52073	71.392	71.66	0.28	72.03	72.30	0.27
	2	52098	-	52098	71.427			72.07		
	3	52384	-	52384	71.819			72.45		
	4	52363	-	52363	71.790			72.43		
	5	52347	-	52347	71.768			72.40		
	6	52343	-	52343	71.762			72.40		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	52690	-	52690	72.238	72.61	0.49	72.99	73.37	0.49
	2	52834	-	52834	72.436			73.20		
	3	52923	-	52923	72.558			73.31		
	4	53438	-	53438	73.264			74.03		
	5	52859	-	52859	72.470			73.22		
	6	53027	-	53027	72.700			73.46		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	543540	543475	541749	543583	543201	543110	0.15
2	11.10	552681	552630				552656	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
50010.13		49788.83		0.32	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	63352	-	63352	11.415	11.08	5.43	11.41	11.08	5.43
	2	65302	-	65302	11.766			11.77		
	3	55385	-	55385	9.979			9.98		
	4	61561	-	61561	11.092			11.09		
	5	61993	-	61993	11.170			11.17		
	6	61315	-	61315	11.048			11.05		
10min	1	85815	-	85815	15.462	15.28	2.00	15.48	15.29	2.00
	2	87601	-	87601	15.784			15.80		
	3	82981	-	82981	14.952			14.97		
	4	84760	-	84760	15.272			15.29		
	5	83813	-	83813	15.102			15.12		
	6	83722	-	83722	15.085			15.10		
15min	1	90337	-	90337	16.277	16.58	1.59	16.32	16.62	1.58
	2	94548	-	94548	17.036			17.08		
	3	92167	-	92167	16.607			16.65		
	4	91679	-	91679	16.519			16.56		
	5	92301	-	92301	16.631			16.67		
	6	90947	-	90947	16.387			16.43		
20min	1	97023	-	97023	17.482	17.18	1.47	17.55	17.25	1.47
	2	92959	-	92959	16.750			16.82		
	3	95278	-	95278	17.167			17.24		
	4	95892	-	95892	17.278			17.35		
	5	96176	-	96176	17.329			17.40		
	6	94770	-	94770	17.076			17.15		
30min	1	100747	-	100747	18.153	18.14	2.75	18.25	18.24	2.74
	2	105842	-	105842	19.071			19.17		
	3	99463	-	99463	17.922			18.02		
	4	100083	-	100083	18.033			18.13		
	5	100462	-	100462	18.102			18.20		
	6	97549	-	97549	17.577			17.68		
45min	1	104164	-	104164	18.769	22.11	37.70	18.90	22.24	37.47
	2	105328	-	105328	18.978			19.11		
	3	217089	-	217089	39.116			39.24		
	4	104719	-	104719	18.869			19.00		
	5	103971	-	103971	18.734			18.86		
	6	101027	-	101027	18.203			18.33		
60min	1	105862	-	105862	19.075	18.92	1.24	19.24	19.08	1.24
	2	107028	-	107028	19.285			19.45		
	3	105192	-	105192	18.954			19.15		
	4	103857	-	103857	18.713			18.88		
	5	104043	-	104043	18.747			18.91		
	6	103885	-	103885	18.718			18.88		
90min	1	106347	-	106347	19.162	19.07	2.41	19.36	19.27	2.45
	2	106803	-	106803	19.244			19.44		
	3	110199	-	110199	19.856			20.08		
	4	103066	-	103066	18.571			18.76		
	5	104194	-	104194	18.774			18.97		
	6	104447	-	104447	18.820			19.01		
120min	1	109769	-	109769	19.779	19.44	2.07	20.00	19.66	2.06
	2	109957	-	109957	19.812			20.04		
	3	108474	-	108474	19.545			19.80		
	4	104046	-	104046	18.747			18.97		
	5	108330	-	108330	19.519			19.74		
	6	106608	-	106608	19.209			19.43		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	107596	-	107596	19.387	19.32	0.74	19.65	19.58	0.77
	2	108020	-	108020	19.463			19.73		
	3	107843	-	107843	19.431			19.72		
	4	105843	-	105843	19.071			19.33		
	5	107008	-	107008	19.281			19.54		
	6	107031	-	107031	19.285			19.54		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	69951	70116	70064	70134	70108	70075	0.11
2	10.99	71064	70956				71010	0.11
单位质量响应值				RSD%	判断			
6428.90		6461.33		0.36	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12447	-	12447	17.327	18.04	21.05	17.33	18.04	21.06
	2	11202	-	11202	15.594			15.59		
	3	8586	-	8586	11.952			11.95		
	4	15100	-	15100	21.021			21.02		
	5	15211	-	15211	21.175			21.18		
	6	15207	-	15207	21.169			21.17		
10min	1	24005	-	24005	33.417	33.29	8.89	33.45	33.32	8.90
	2	22561	-	22561	31.407			31.43		
	3	20352	-	20352	28.332			28.35		
	4	25327	-	25327	35.257			35.29		
	5	25922	-	25922	36.086			36.12		
	6	25332	-	25332	35.264			35.30		
15min	1	30184	-	30184	42.019	41.27	5.70	42.10	41.36	5.71
	2	28372	-	28372	39.496			39.57		
	3	26876	-	26876	37.414			37.48		
	4	30472	-	30472	42.420			42.51		
	5	31411	-	31411	43.727			43.82		
	6	30567	-	30567	42.552			42.65		
20min	1	34097	-	34097	47.466	46.65	3.86	47.62	46.80	3.88
	2	32639	-	32639	45.436			45.58		
	3	31338	-	31338	43.625			43.75		
	4	34043	-	34043	47.391			47.56		
	5	34909	-	34909	48.596			48.76		
	6	34046	-	34046	47.395			47.56		
30min	1	39206	-	39206	54.578	53.65	2.41	54.81	53.88	2.43
	2	37855	-	37855	52.697			52.92		
	3	37159	-	37159	51.729			51.93		
	4	38569	-	38569	53.691			53.93		
	5	39749	-	39749	55.334			55.58		
	6	38704	-	38704	53.879			54.12		
45min	1	43430	-	43430	60.458	59.99	1.70	60.78	60.31	1.71
	2	42679	-	42679	59.413			59.72		
	3	42065	-	42065	58.558			58.85		
	4	42932	-	42932	59.765			60.10		
	5	44222	-	44222	61.561			61.90		
	6	43224	-	43224	60.172			60.51		
60min	1	45945	-	45945	63.959	64.06	1.33	64.38	64.48	1.35
	2	45652	-	45652	63.552			63.96		
	3	45280	-	45280	63.034			63.42		
	4	45958	-	45958	63.978			64.41		
	5	47093	-	47093	65.558			66.00		
	6	46157	-	46157	64.255			64.69		
90min	1	50015	-	50015	69.625	69.49	1.24	70.16	70.02	1.25
	2	49577	-	49577	69.015			69.53		
	3	49203	-	49203	68.495			68.99		
	4	49921	-	49921	69.494			70.03		
	5	51027	-	51027	71.034			71.59		
	6	49779	-	49779	69.297			69.84		
120min	1	52155	-	52155	72.604	72.77	1.09	73.25	73.41	1.11
	2	52102	-	52102	72.530			73.16		
	3	51690	-	51690	71.957			72.56		
	4	52341	-	52341	72.863			73.52		
	5	53345	-	53345	74.261			74.93		
	6	51996	-	51996	72.383			73.04		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	52723	-	52723	73.395	73.50	1.35	74.16	74.27	1.36
	2	52772	-	52772	73.463			74.21		
	3	51826	-	51826	72.146			72.87		
	4	52637	-	52637	73.275			74.05		
	5	54035	-	54035	75.221			76.02		
	6	52811	-	52811	73.517			74.29		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	528022	527974	527333	528068	528655	528010	0.09
2	11.10	535501	534837				535169	0.09
单位质量响应值				RSD%	判断			
48619.71				0.60	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	57106	-	57106	10.605	10.77	14.85	10.60	10.77	14.88
	2	52467	-	52467	9.743			9.74		
	3	43902	-	43902	8.153			8.15		
	4	65302	-	65302	12.127			12.13		
	5	64726	-	64726	12.020			12.02		
	6	64491	-	64491	11.976			11.98		
10min	1	81282	-	81282	15.094	15.22	5.54	15.11	15.24	5.55
	2	78751	-	78751	14.624			14.64		
	3	74934	-	74934	13.916			13.93		
	4	86486	-	86486	16.061			16.08		
	5	84318	-	84318	15.658			15.68		
	6	86046	-	86046	15.979			16.00		
15min	1	89621	-	89621	16.643	16.66	4.35	16.69	16.70	4.35
	2	83311	-	83311	15.471			15.51		
	3	87122	-	87122	16.179			16.22		
	4	92741	-	92741	17.222			17.27		
	5	93360	-	93360	17.337			17.38		
	6	92110	-	92110	17.105			17.15		
20min	1	98666	-	98666	18.323	17.54	3.71	18.39	17.61	3.69
	2	93149	-	93149	17.298			17.36		
	3	92021	-	92021	17.089			17.15		
	4	89389	-	89389	16.600			16.68		
	5	96928	-	96928	18.000			18.07		
	6	96467	-	96467	17.914			17.99		
30min	1	103536	-	103536	19.227	18.24	3.76	19.33	18.34	3.74
	2	99008	-	99008	18.386			18.48		
	3	97413	-	97413	18.090			18.18		
	4	96980	-	96980	18.010			18.11		
	5	92378	-	92378	17.155			17.26		
	6	99940	-	99940	18.559			18.66		
45min	1	102359	-	102359	19.008	18.67	2.40	19.14	18.80	2.39
	2	97180	-	97180	18.047			18.17		
	3	102118	-	102118	18.964			19.09		
	4	99275	-	99275	18.436			18.57		
	5	98866	-	98866	18.360			18.49		
	6	103260	-	103260	19.176			19.31		
60min	1	100420	-	100420	18.648	18.37	4.67	18.81	18.53	4.61
	2	102673	-	102673	19.067			19.22		
	3	100861	-	100861	18.730			18.88		
	4	91451	-	91451	16.983			17.15		
	5	102941	-	102941	19.117			19.28		
	6	95127	-	95127	17.665			17.83		
90min	1	257104	-	257104	47.745	24.04	48.36	47.94	24.23	47.98
	2	104302	-	104302	19.369			19.56		
	3	100507	-	100507	18.665			18.85		
	4	102332	-	102332	19.003			19.20		
	5	105312	-	105312	19.557			19.75		
	6	107026	-	107026	19.875			20.07		
120min	1	102988	-	102988	19.125	20.29	14.99	19.40	20.52	14.81
	2	103034	-	103034	19.134			19.35		
	3	106019	-	106019	19.688			19.90		
	4	102857	-	102857	19.101			19.33		
	5	142280	-	142280	26.422			26.65		
	6	98319	-	98319	18.258			18.49		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	90364	-	90364	16.781	18.49	6.58	17.09	18.75	6.44
	2	104596	-	104596	19.424			19.68		
	3	95496	-	95496	17.734			17.98		
	4	95642	-	95642	17.761			18.02		
	5	105887	-	105887	19.664			19.94		
	6	105265	-	105265	19.548			19.81		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-857-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 19:51:39
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

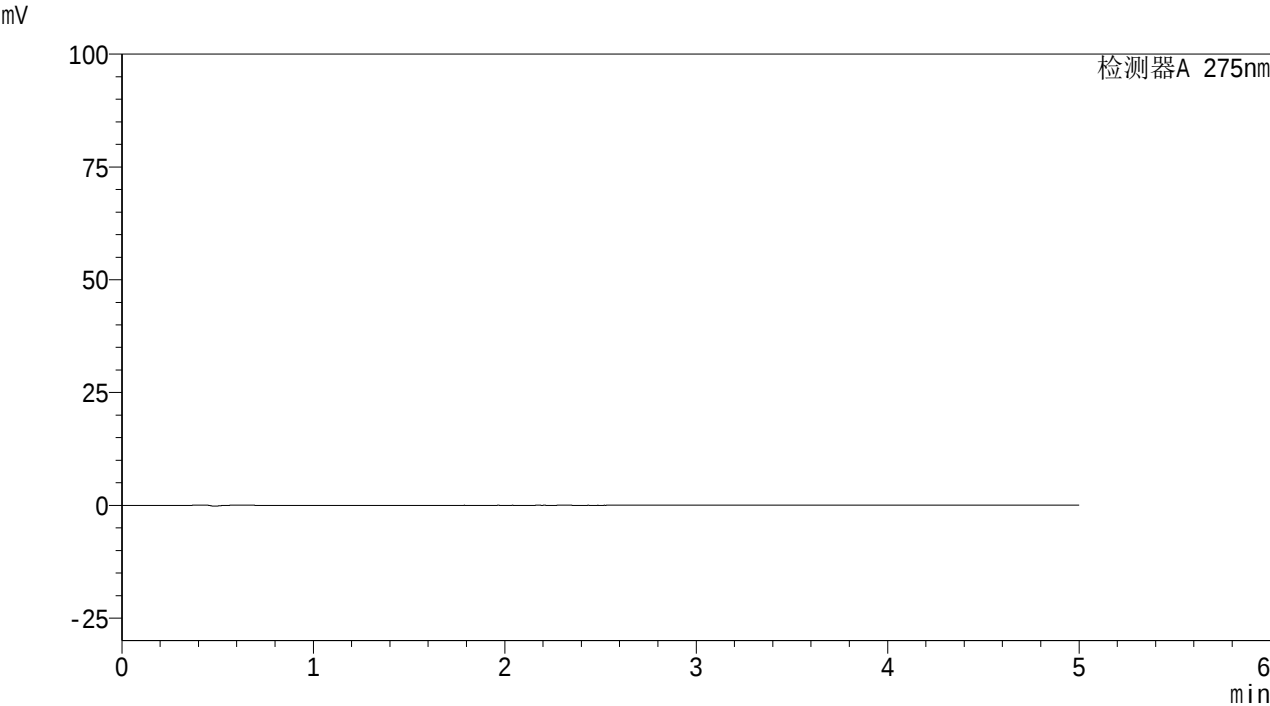

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-858-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 19:57:03

处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

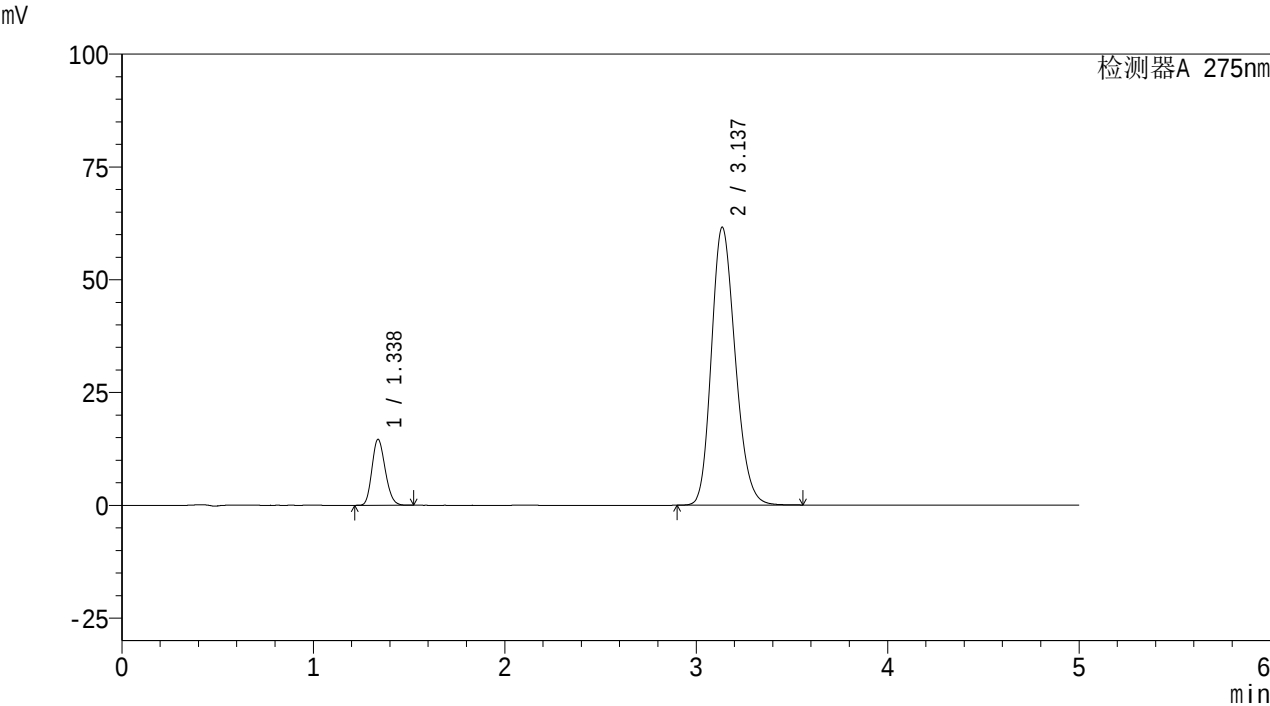

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	70112	11.667	14631	1781	1.178	--
2	3.137	530826	88.333	61595	3086	1.194	10.200
总计		600937	100.000	76226			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-859-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:02:27
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

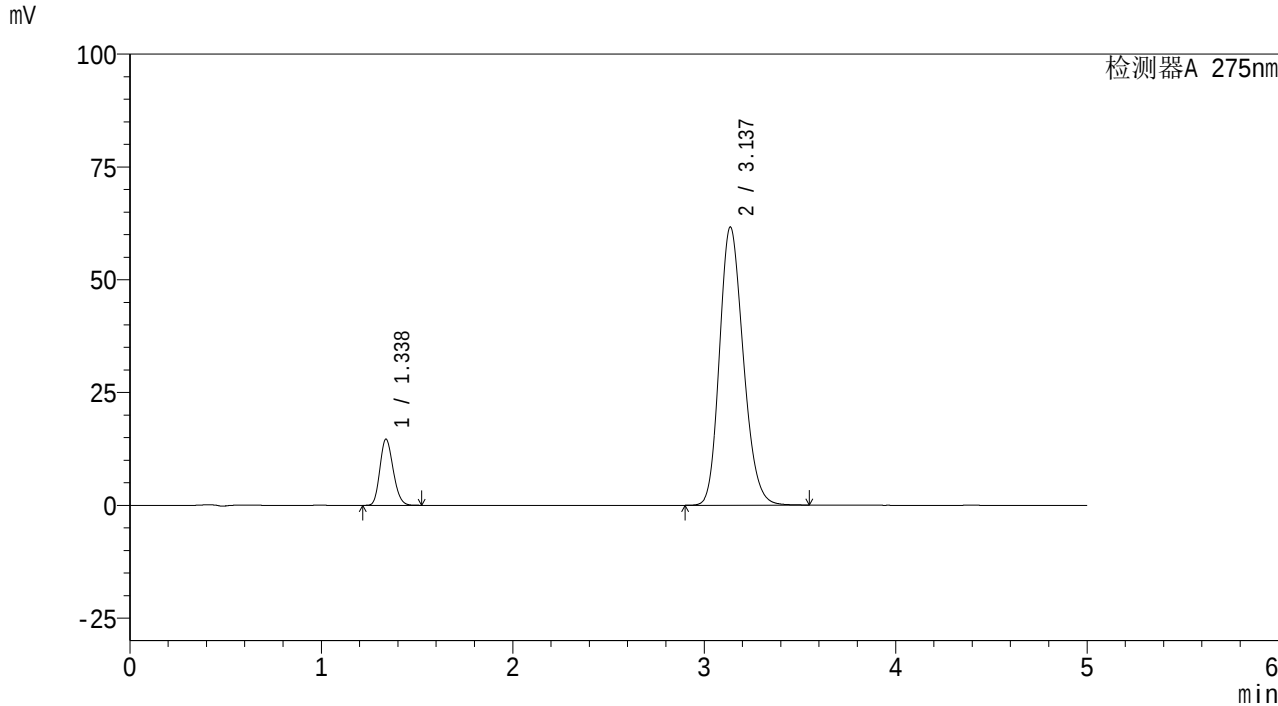

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	70244	11.687	14667	1781	1.178	--
2	3.137	530783	88.313	61660	3094	1.193	10.212
总计		601027	100.000	76327			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-860-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 20:07:51

处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

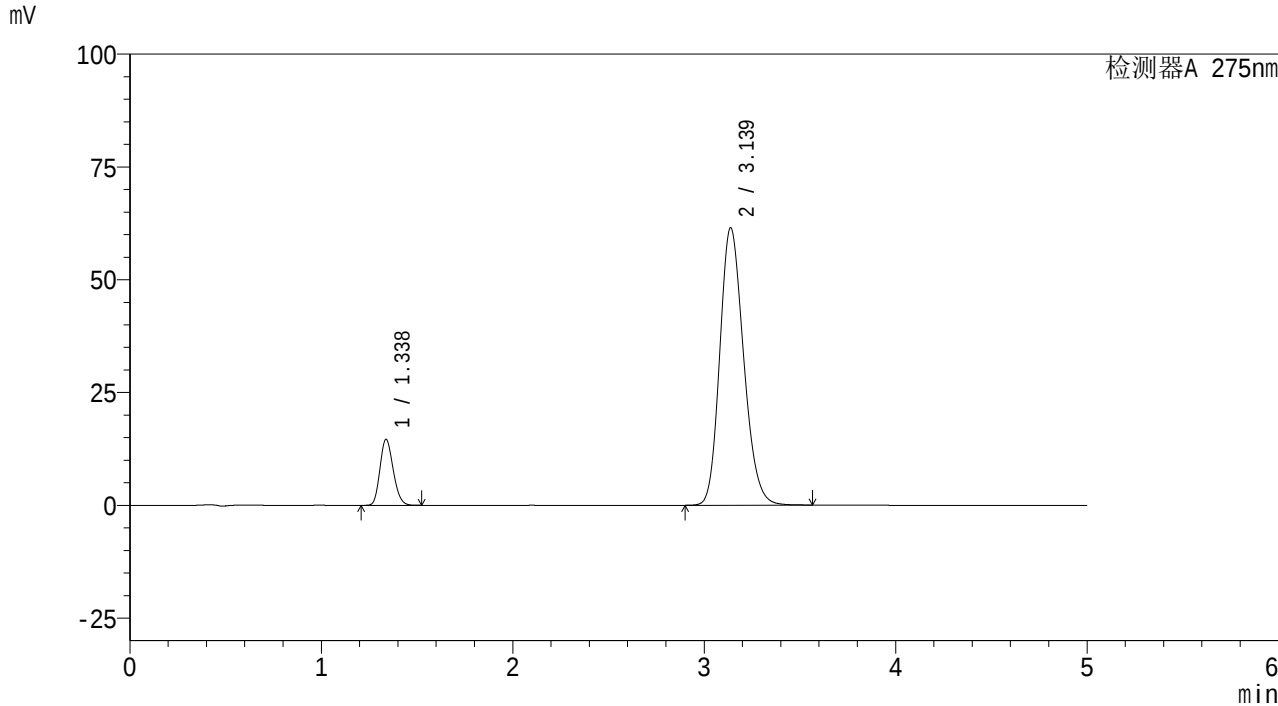

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	70019	11.669	14626	1785	1.178	--
2	3.139	530047	88.331	61513	3089	1.192	10.215
总计		600066	100.000	76139			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-861-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:13:15
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

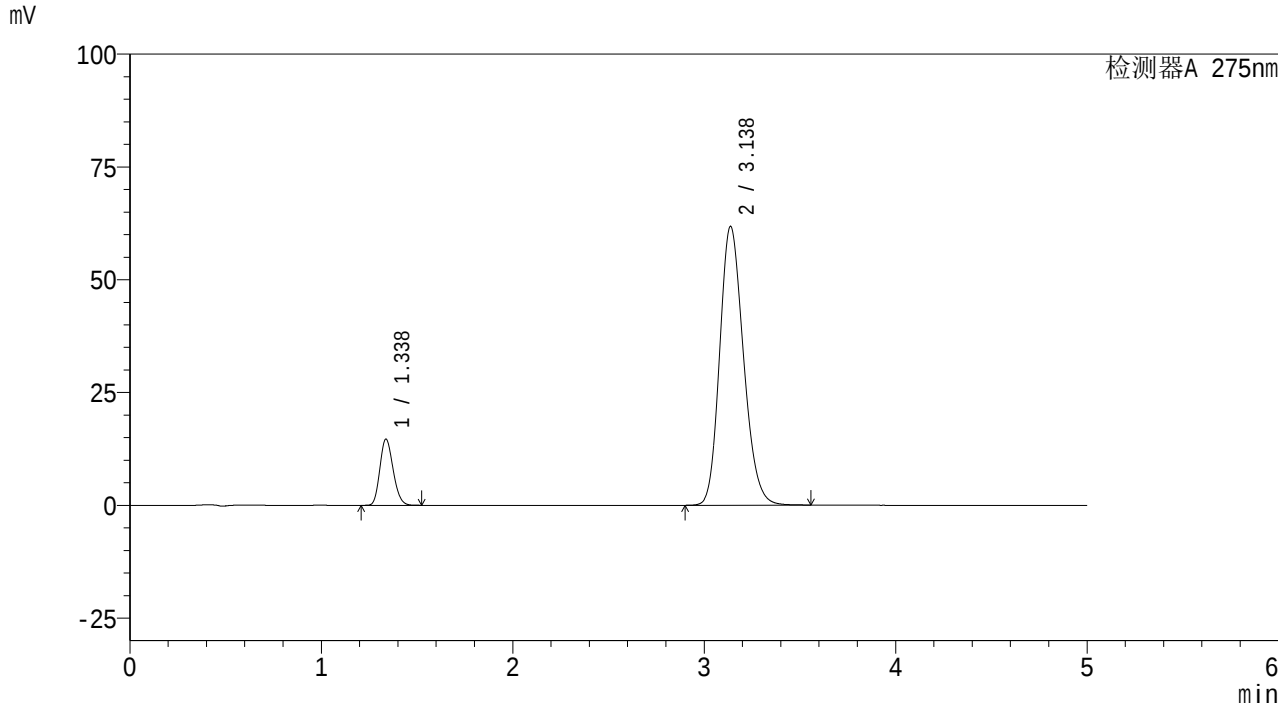

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	70326	11.675	14687	1783	1.178	--
2	3.138	532051	88.325	61817	3095	1.191	10.220
总计		602377	100.000	76504			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-862-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:18:39
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

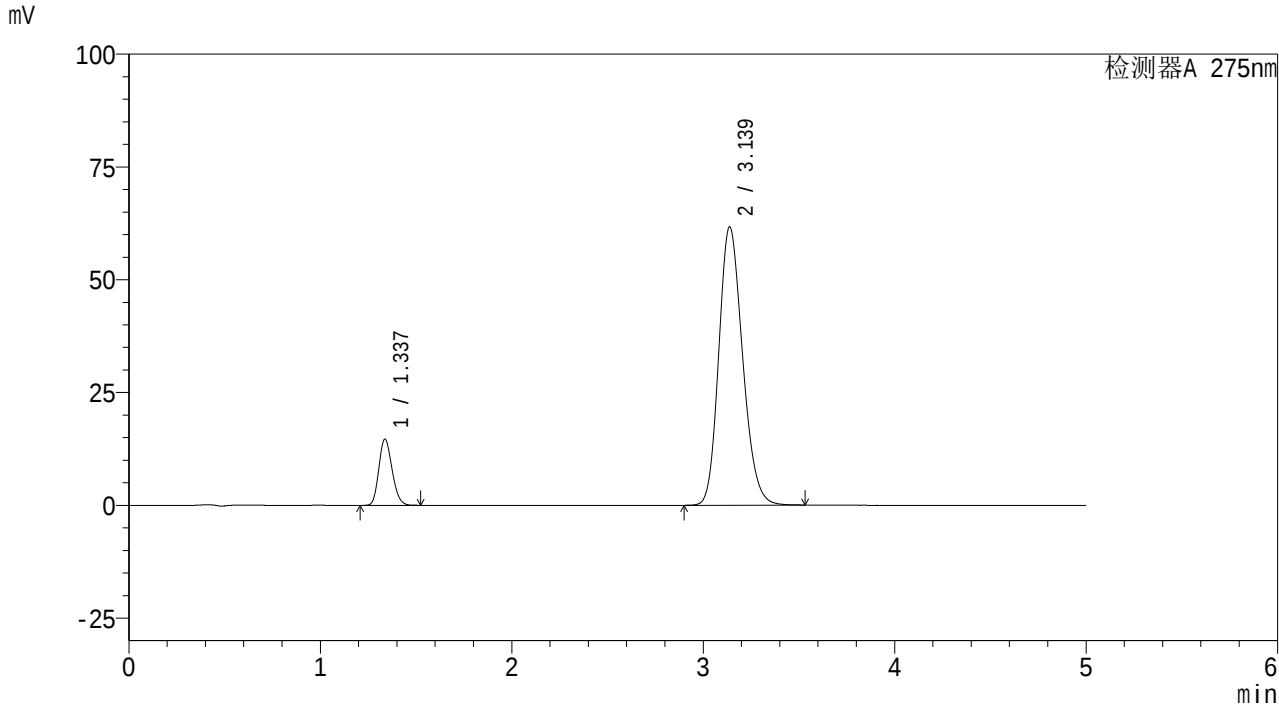

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	70337	11.697	14676	1779	1.178	--
2	3.139	530974	88.303	61721	3096	1.189	10.220
总计		601311	100.000	76397			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-863-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:24:02
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

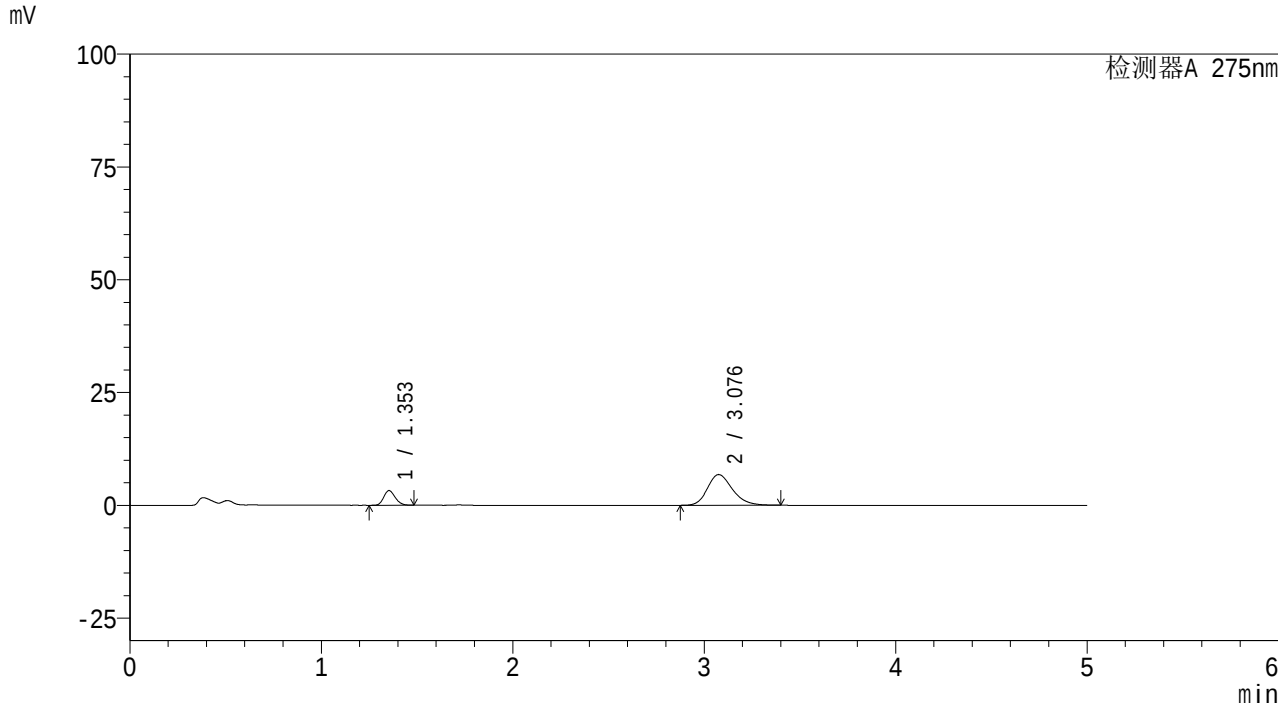

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	13517	17.932	3253	2442	1.183	--
2	3.076	61864	82.068	6794	2728	1.217	9.984
总计		75381	100.000	10048			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-864-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:29:26
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

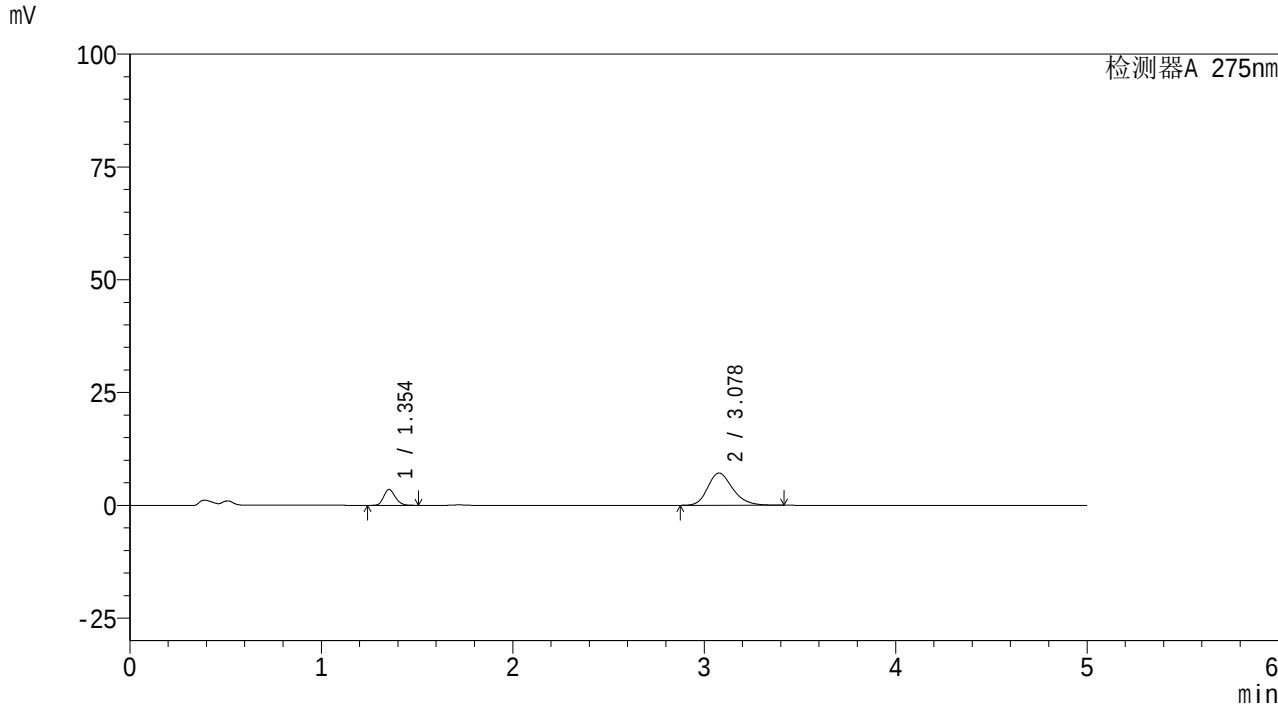

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	14649	18.390	3517	2437	1.181	--
2	3.078	65006	81.610	7147	2735	1.216	9.994
总计		79655	100.000	10664			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-865-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:34:49
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

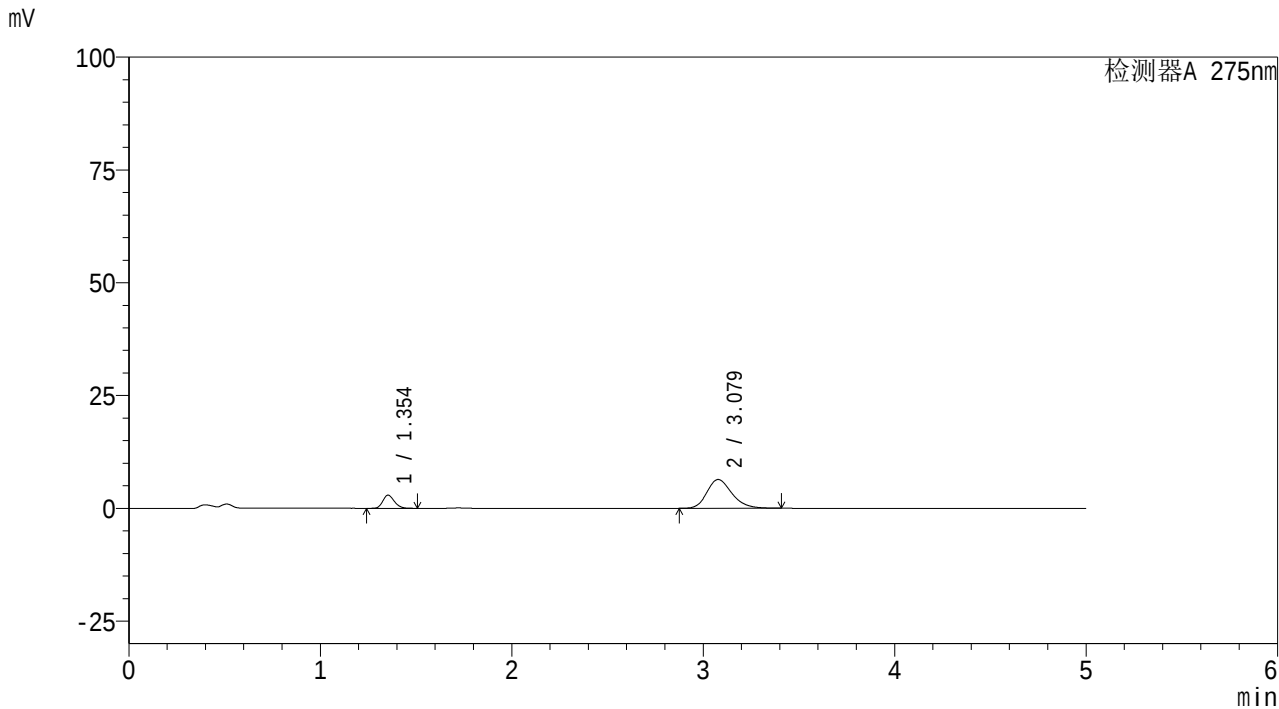

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	12126	17.291	2915	2439	1.183	--
2	3.079	58005	82.709	6382	2728	1.215	9.987
总计		70131	100.000	9297			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-866-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 20:40:11

处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

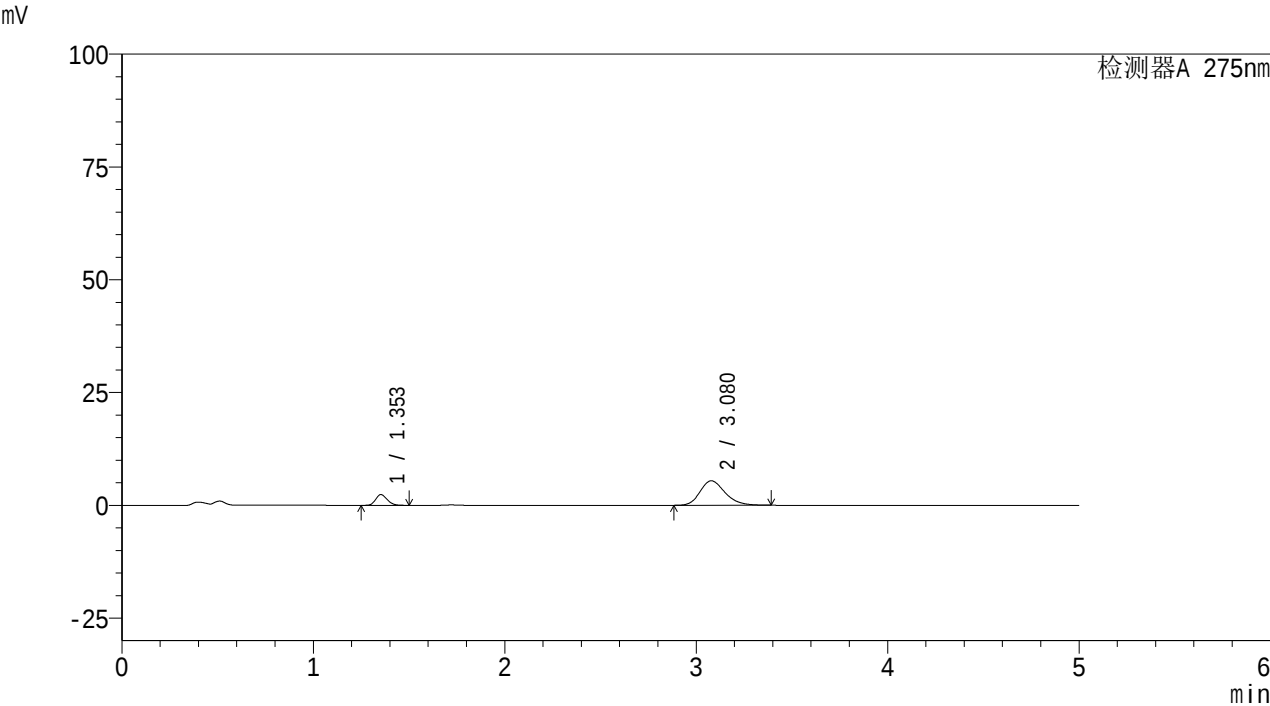

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	9918	16.738	2378	2435	1.181	--
2	3.080	49336	83.262	5427	2713	1.209	9.974
总计		59254	100.000	7805			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-867-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:45:35
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

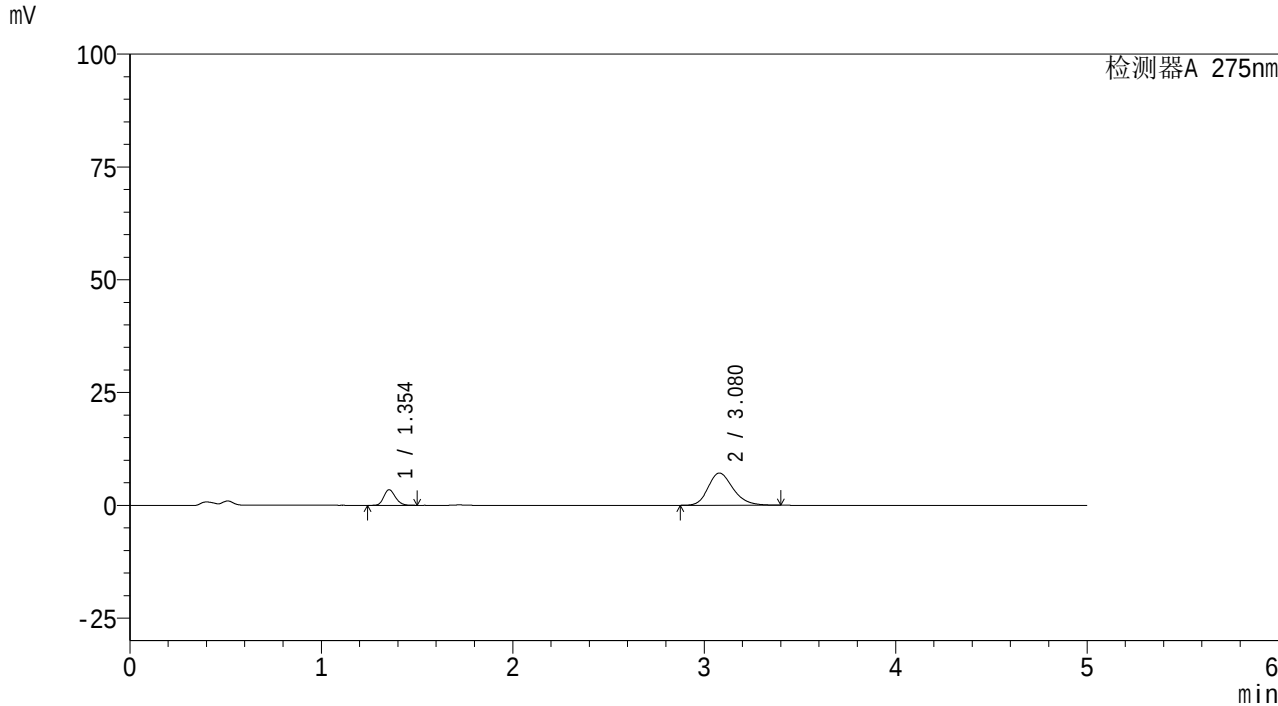

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	14392	18.200	3464	2443	1.182	--
2	3.080	64682	81.800	7151	2753	1.214	10.023
总计		79074	100.000	10615			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-868-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:50:57
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

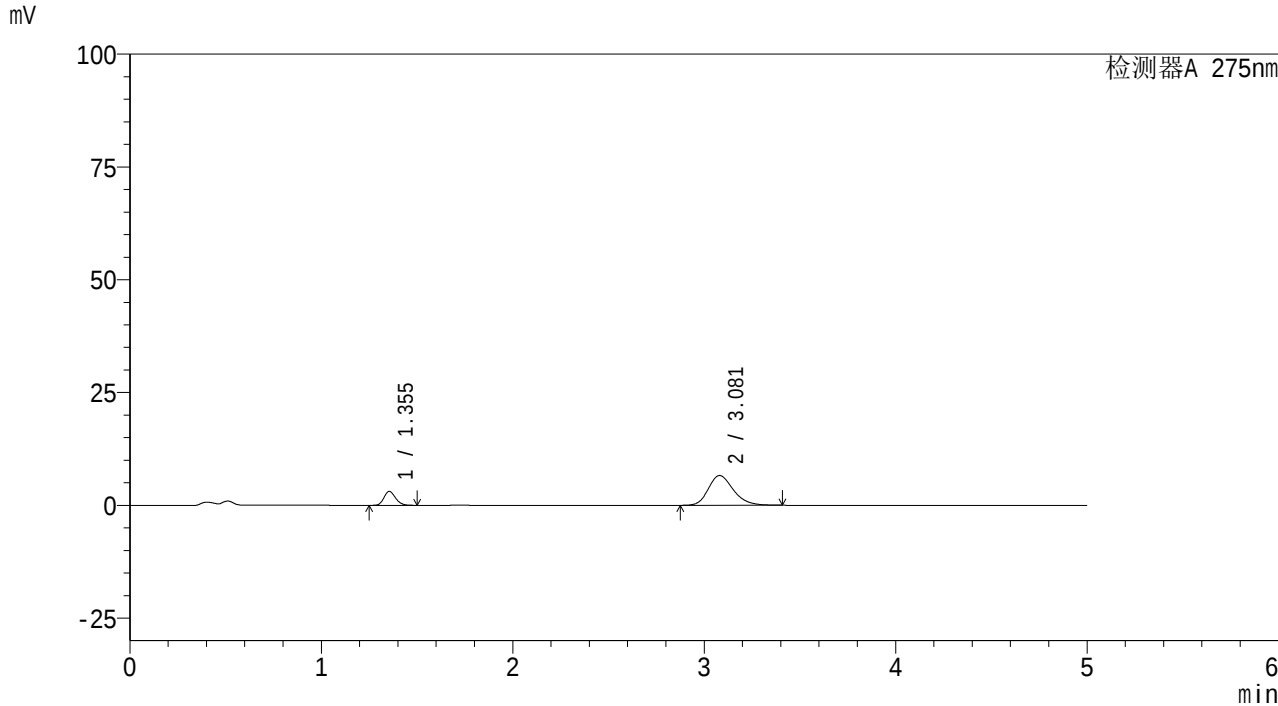

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	12910	17.693	3108	2440	1.178	--
2	3.081	60059	82.307	6602	2733	1.213	9.995
总计		72969	100.000	9710			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-869-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 20:56:21
处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

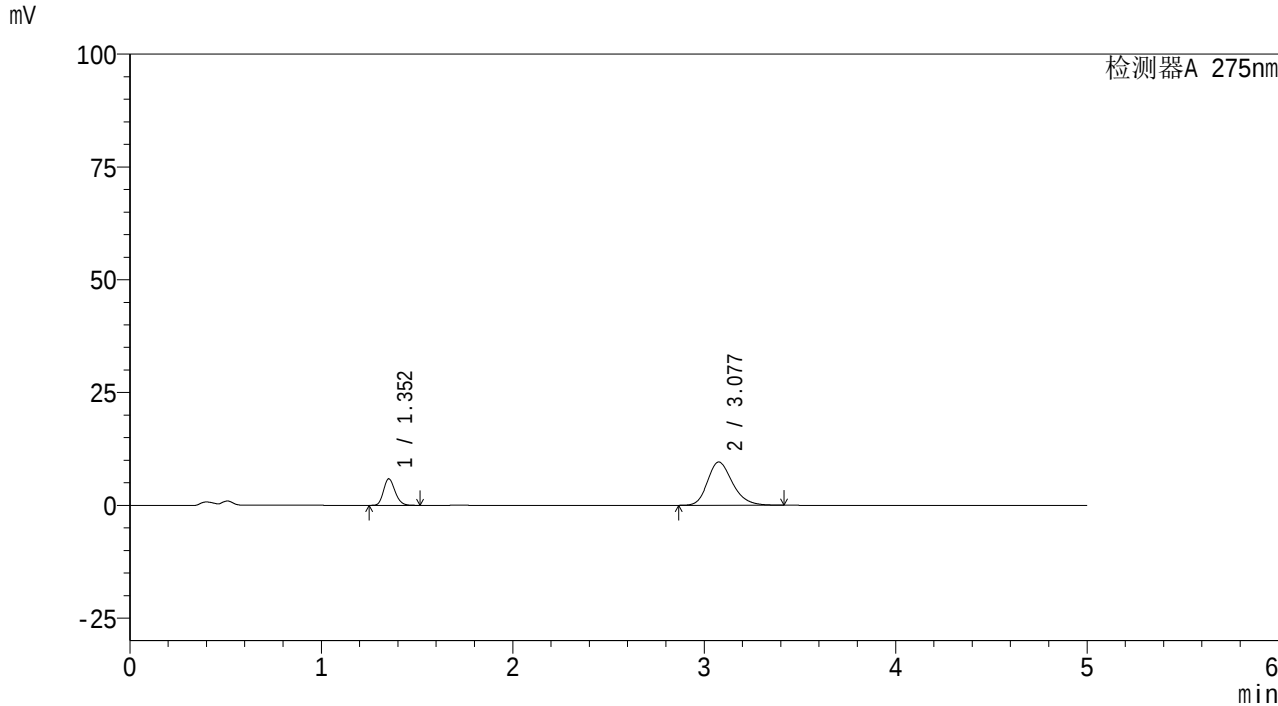

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	24437	21.942	5846	2435	1.185	--
2	3.077	86934	78.058	9583	2749	1.220	10.016
总计		111371	100.000	15429			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-870-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:01:44

处理时间(V2): 2026/05/15 17:13:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

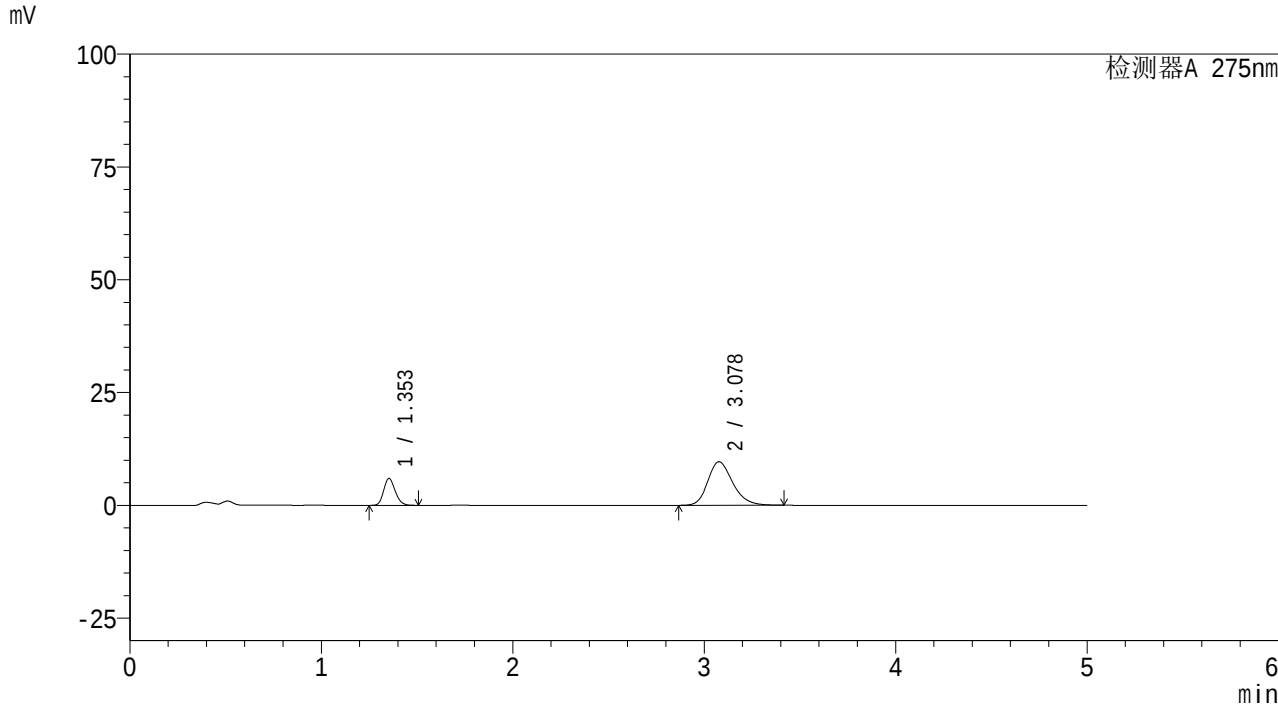

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	24800	22.116	5948	2439	1.181	--
2	3.078	87339	77.884	9642	2755	1.220	10.022
总计		112139	100.000	15590			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-871-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:07:07
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

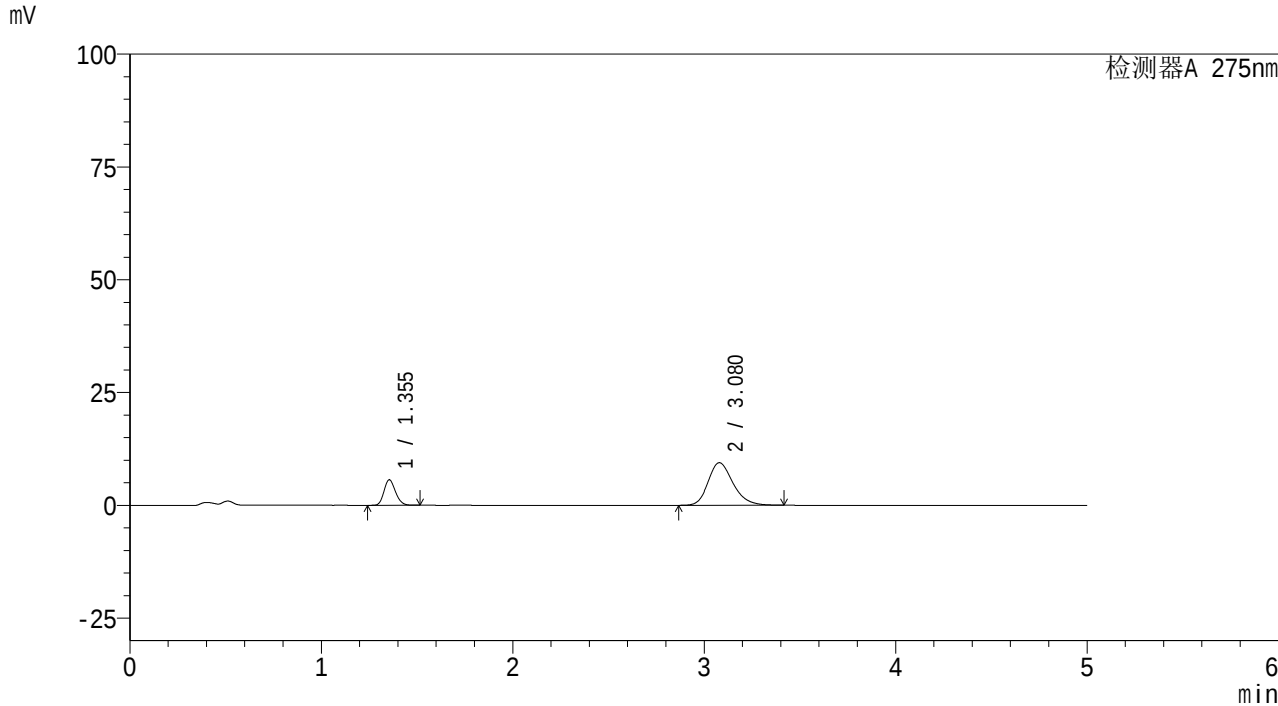

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	23505	21.593	5662	2451	1.181	--
2	3.080	85347	78.407	9440	2763	1.219	10.035
总计		108852	100.000	15102			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-872-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:12:30
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

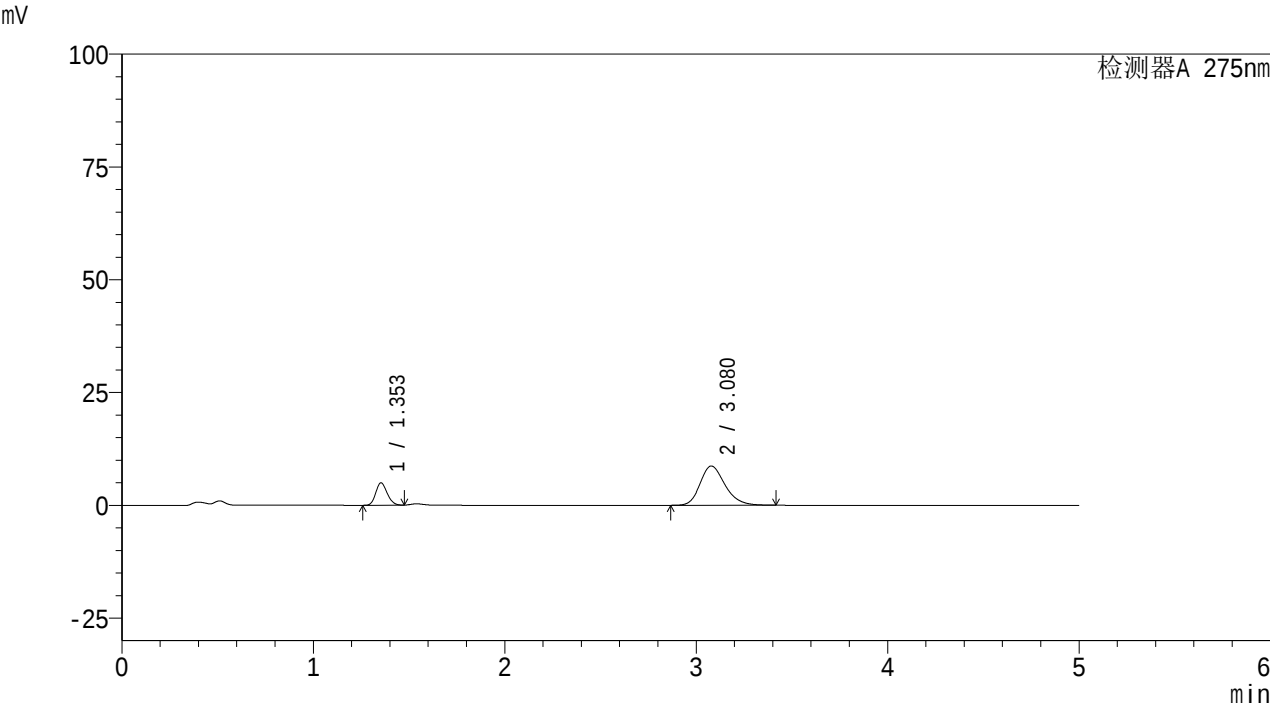

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	20453	20.590	4954	2458	1.168	--
2	3.080	78878	79.410	8705	2751	1.217	10.035
总计		99331	100.000	13659			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-873-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:17:52

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

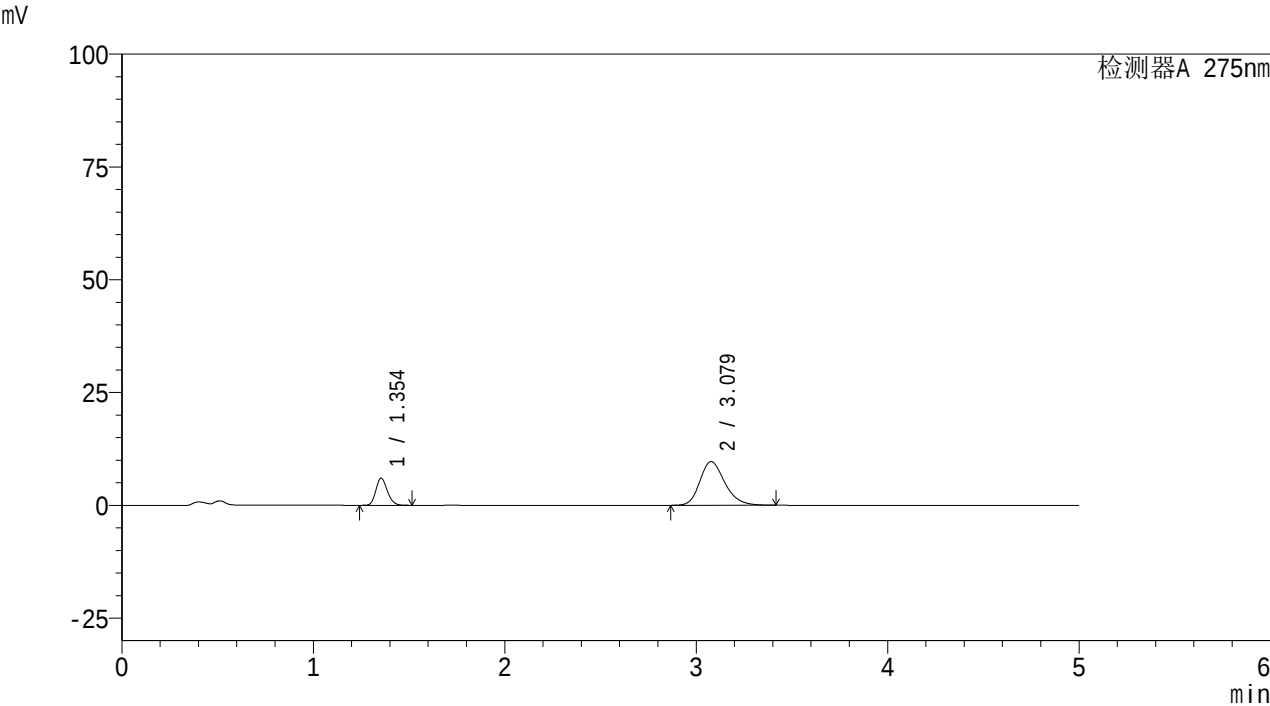

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	24980	22.188	6013	2448	1.183	--
2	3.079	87604	77.812	9678	2760	1.220	10.031
总计		112584	100.000	15692			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-874-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:23:16
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

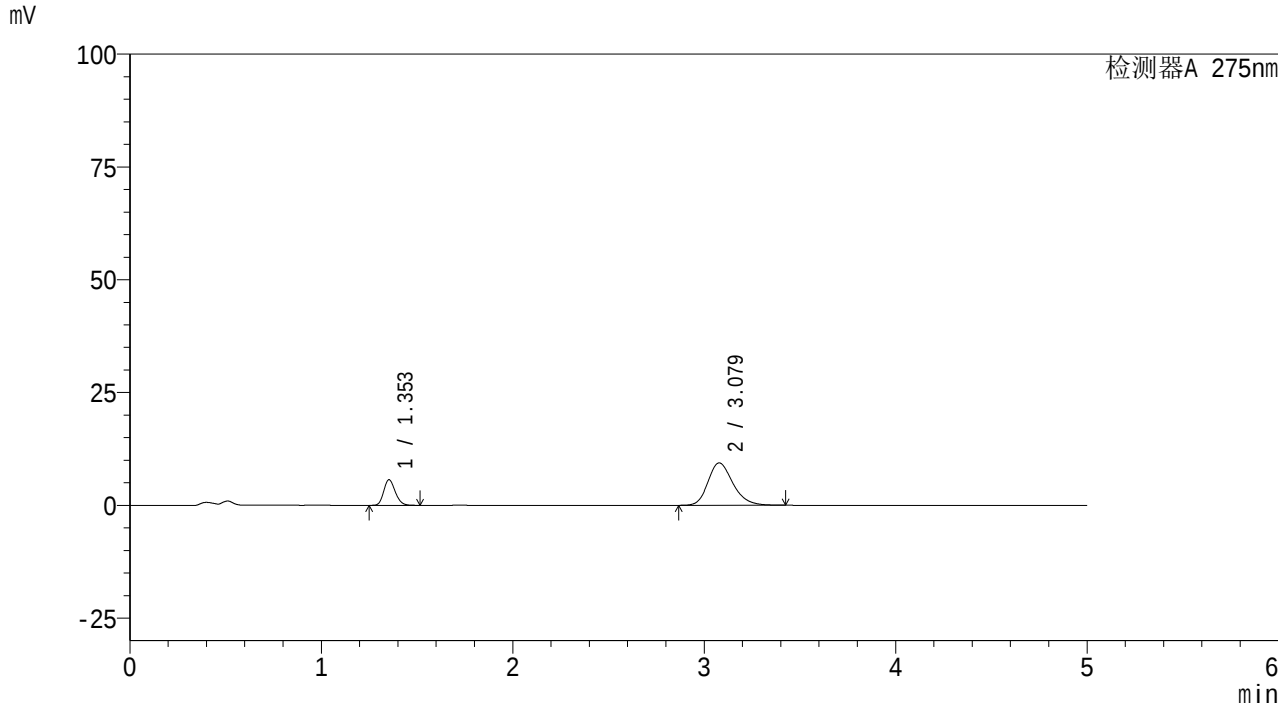

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	23594	21.706	5671	2444	1.183	--
2	3.079	85100	78.294	9404	2757	1.220	10.031
总计		108694	100.000	15075			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-875-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:28:38
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

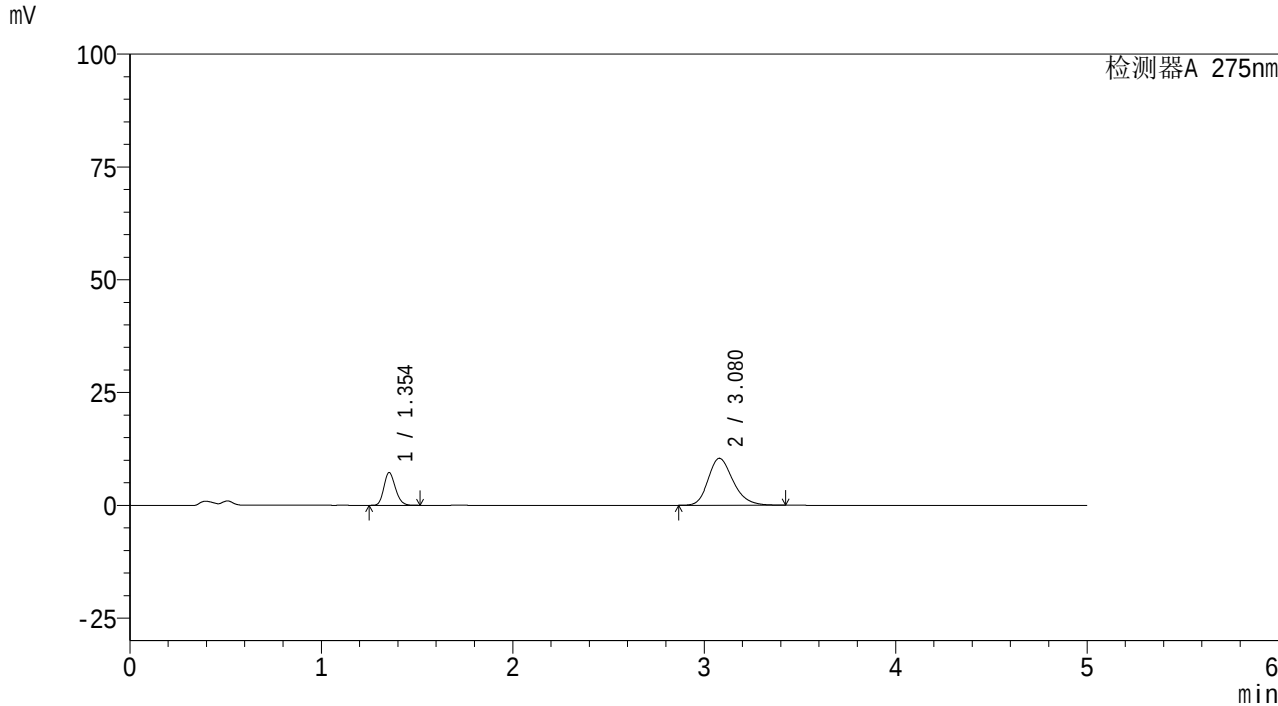

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	30196	24.273	7254	2437	1.184	--
2	3.080	94205	75.727	10417	2765	1.221	10.033
总计		124401	100.000	17672			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-876-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:34:01

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

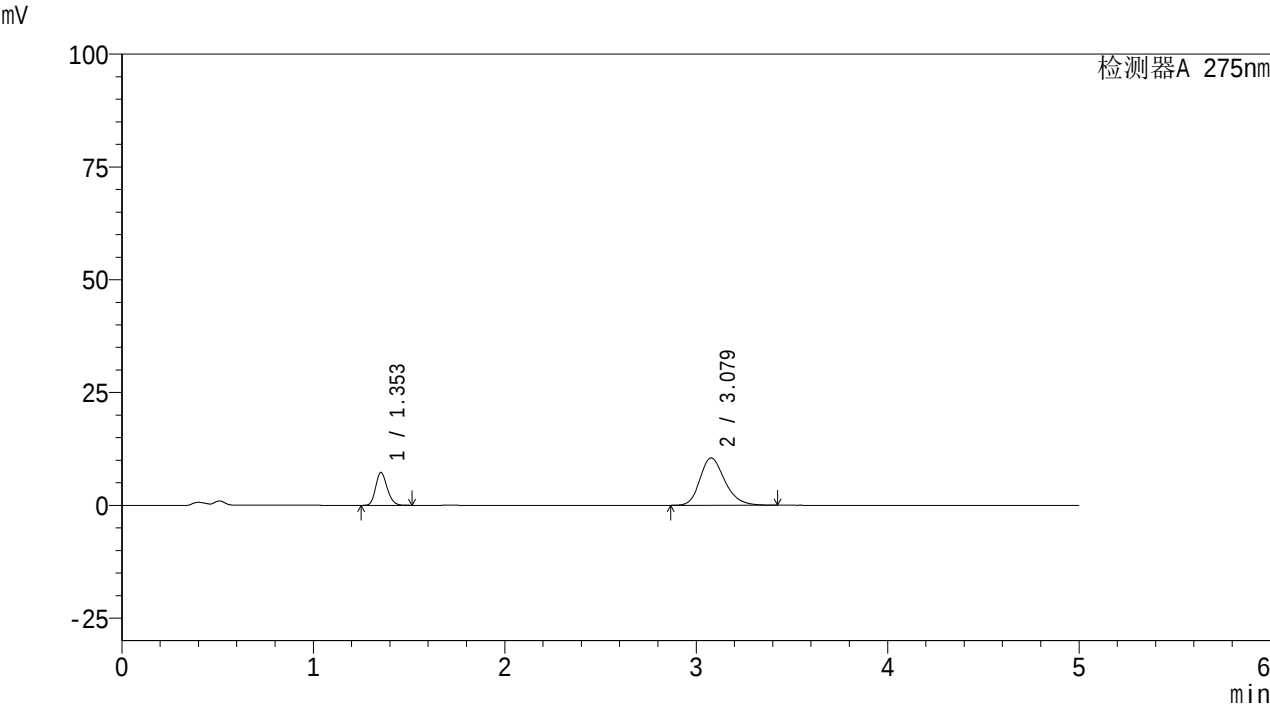

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	30304	24.222	7267	2438	1.182	--
2	3.079	94802	75.778	10492	2769	1.220	10.043
总计		125106	100.000	17758			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-877-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:39:24

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

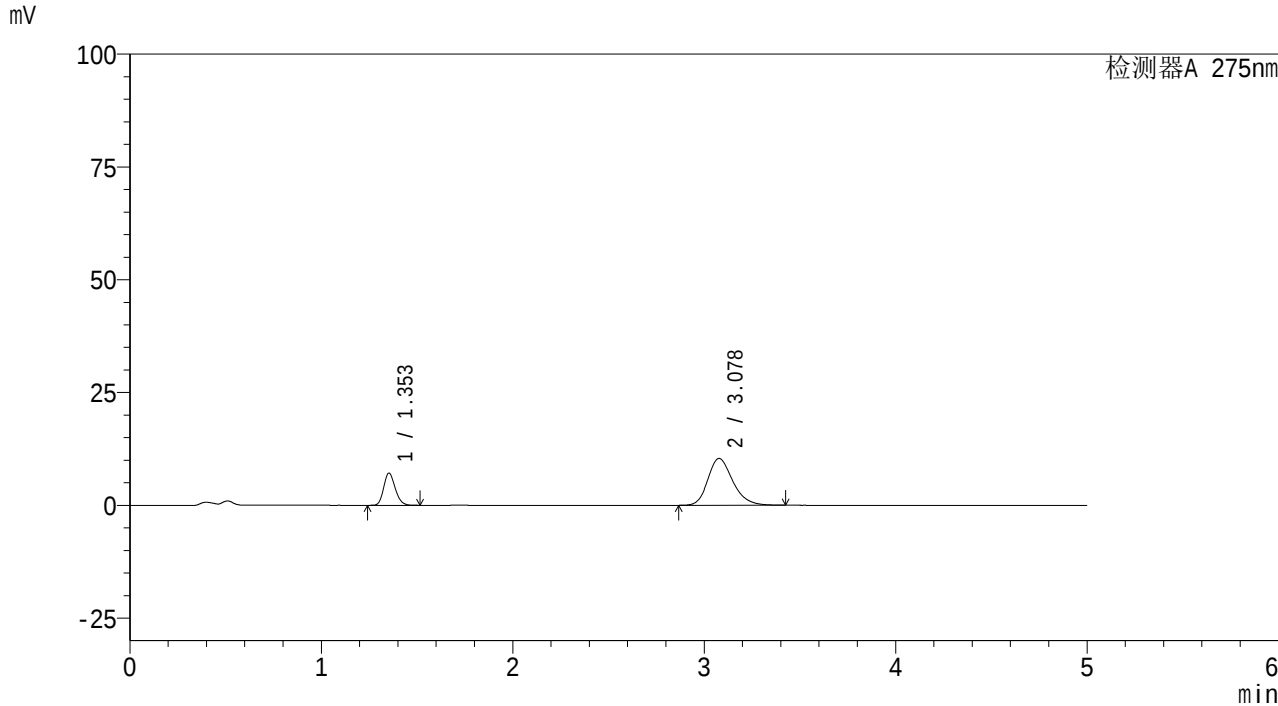

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29710	24.046	7125	2439	1.183	--
2	3.078	93844	75.954	10371	2762	1.221	10.033
总计		123554	100.000	17496			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-878-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:44:46
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

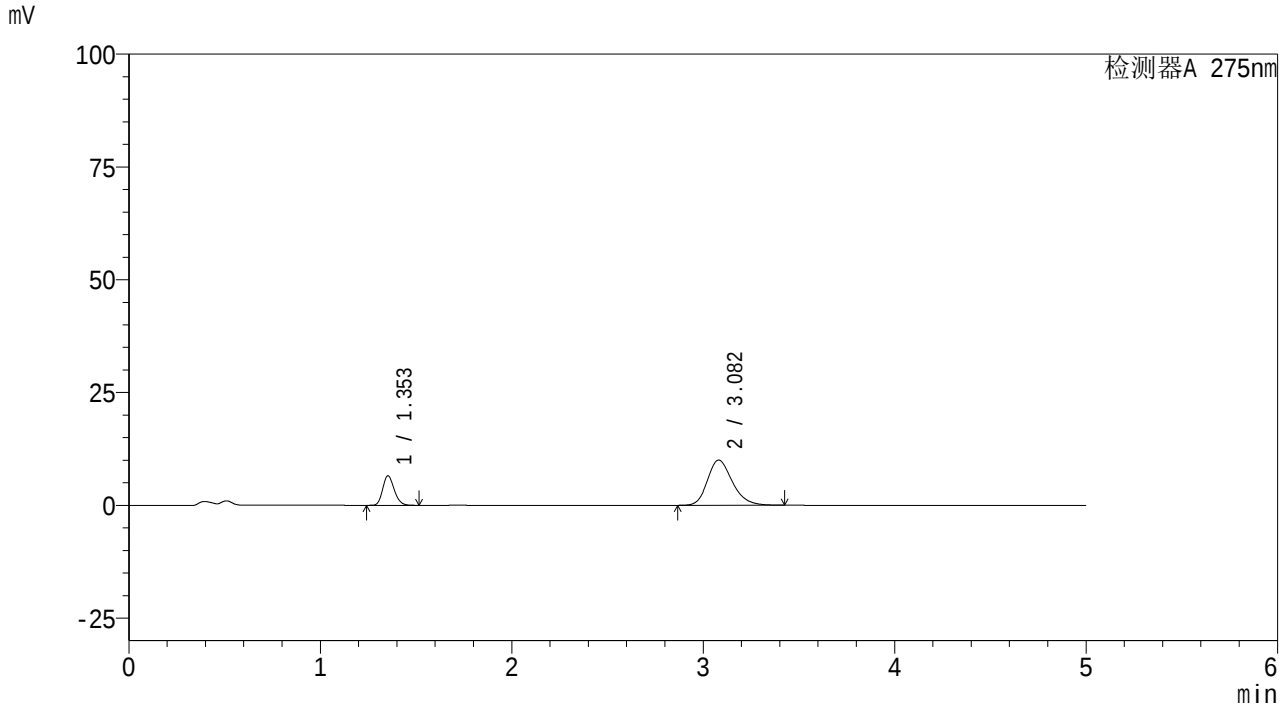

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	27263	23.125	6531	2436	1.184	--
2	3.082	90630	76.875	10018	2766	1.220	10.046
总计		117894	100.000	16549			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-879-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 21:50:09
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

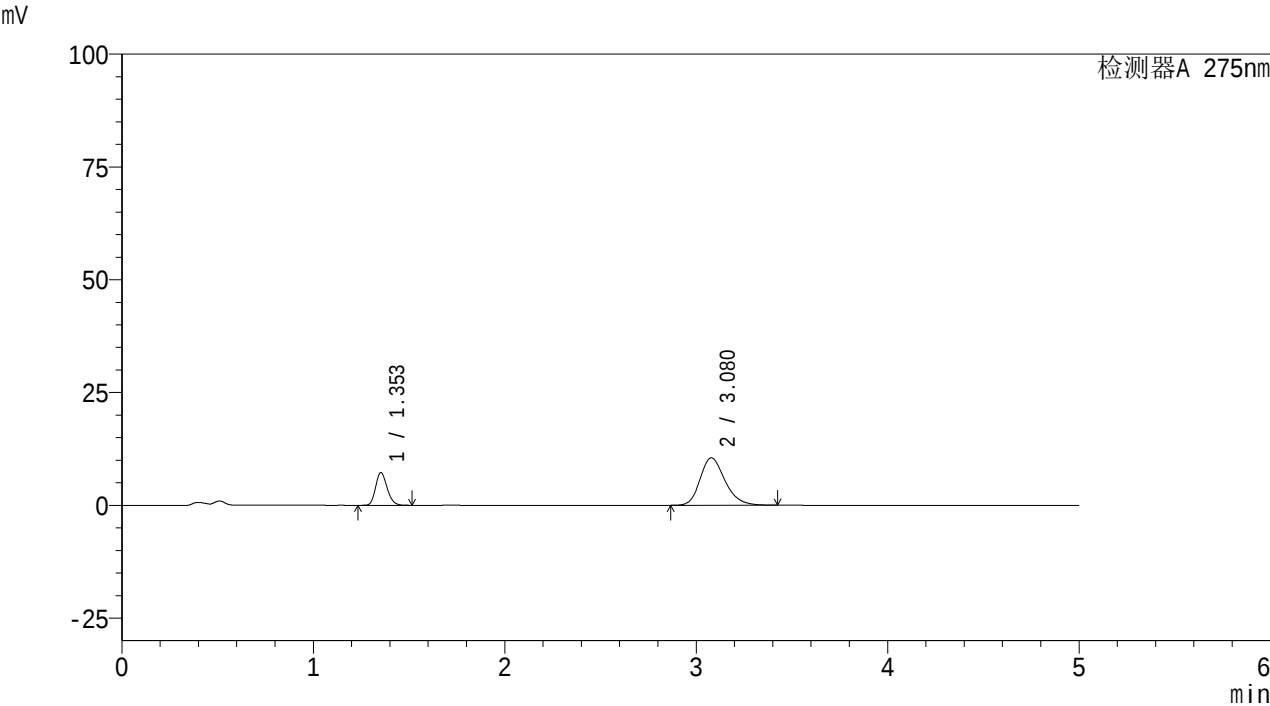

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	30269	24.134	7251	2435	1.183	--
2	3.080	95150	75.866	10513	2762	1.221	10.038
总计		125419	100.000	17764			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-880-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 21:55:32

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

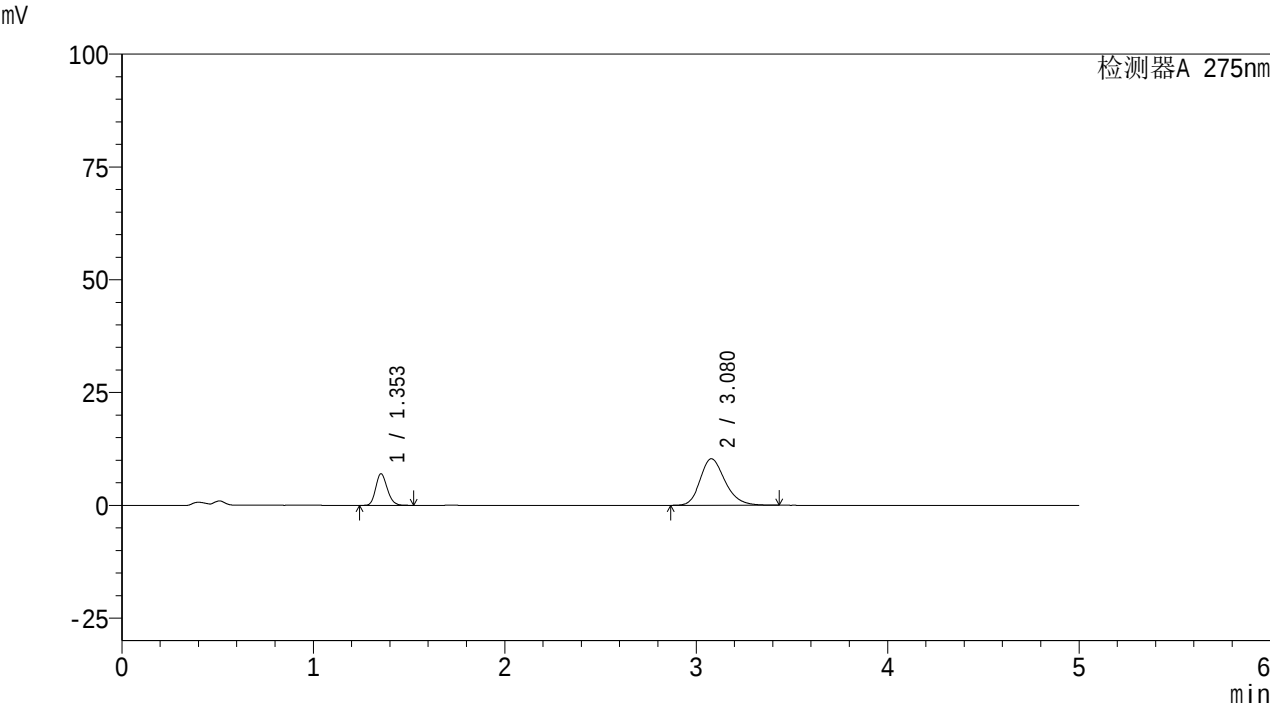

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29165	23.801	6990	2435	1.184	--
2	3.080	93371	76.199	10319	2759	1.220	10.031
总计		122536	100.000	17309			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-881-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:00:55

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

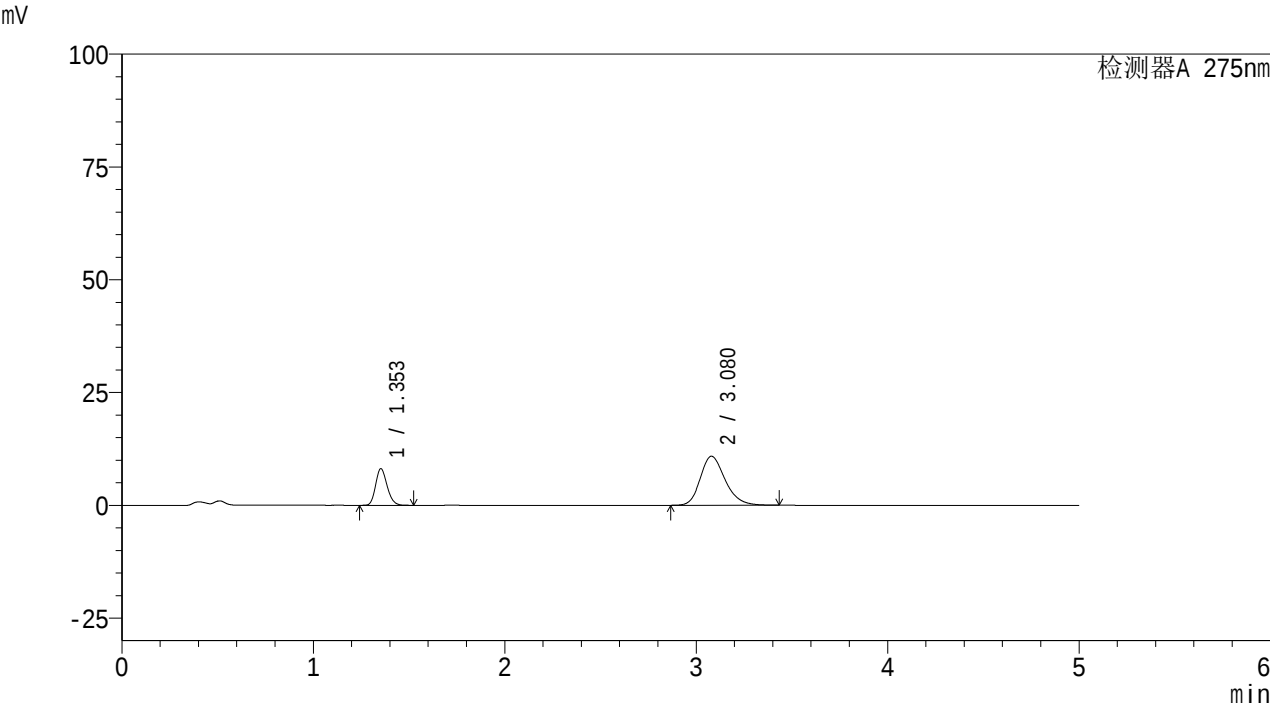

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	33821	25.599	8106	2440	1.184	--
2	3.080	98297	74.401	10874	2772	1.220	10.057
总计		132118	100.000	18980			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-882-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:06:19
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

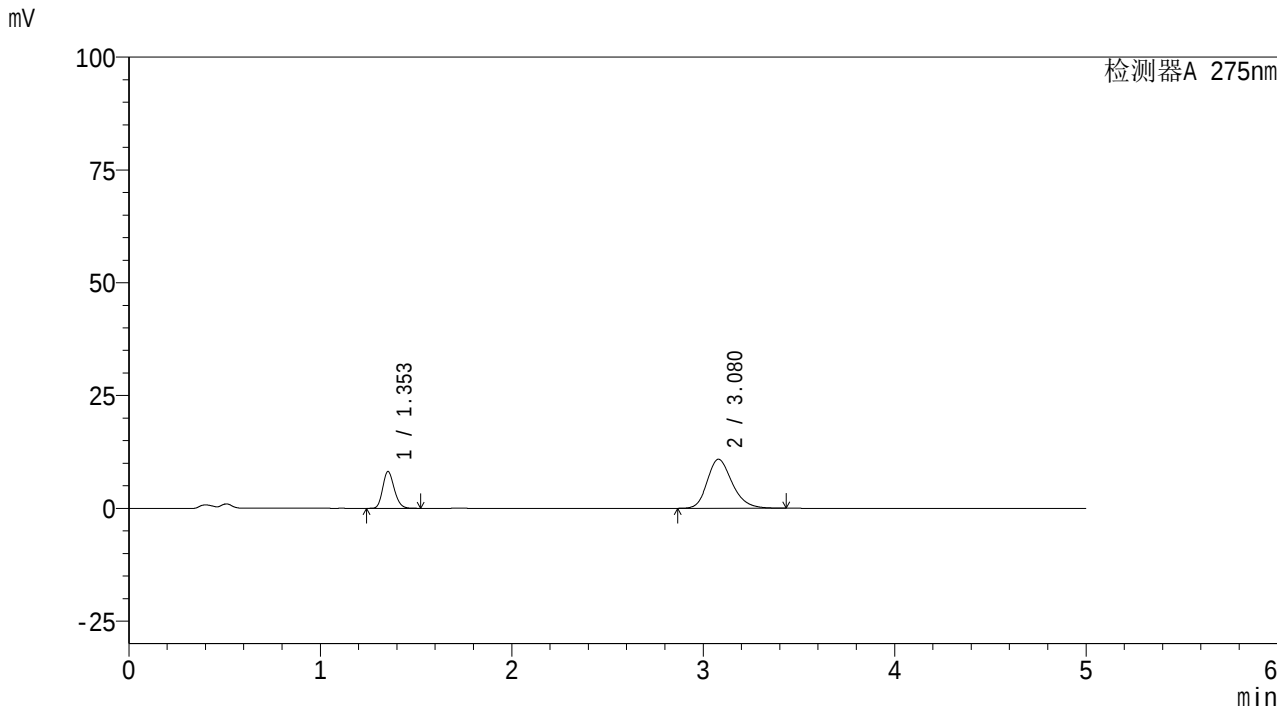

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	33949	25.652	8142	2437	1.182	--
2	3.080	98395	74.348	10869	2762	1.222	10.038
总计		132344	100.000	19012			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-883-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:11:43
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

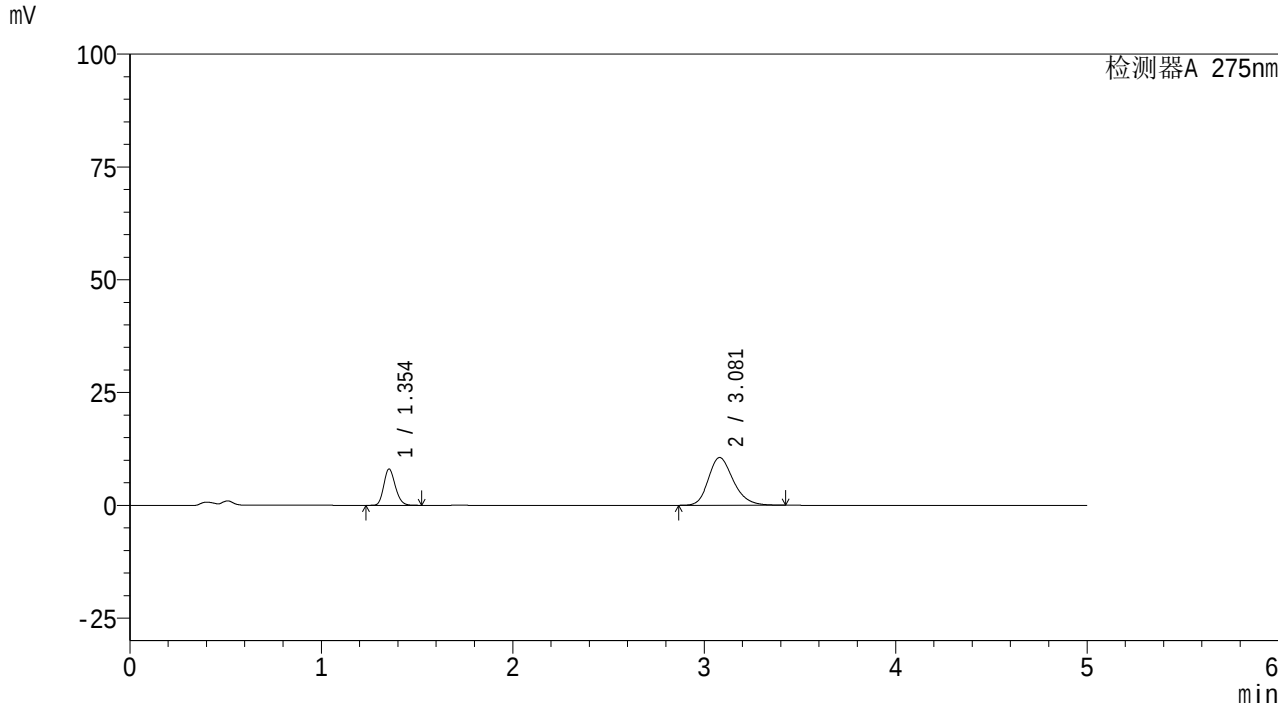

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	33517	25.923	8051	2446	1.183	--
2	3.081	95775	74.077	10586	2762	1.221	10.042
总计		129292	100.000	18637			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-884-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:17:05

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

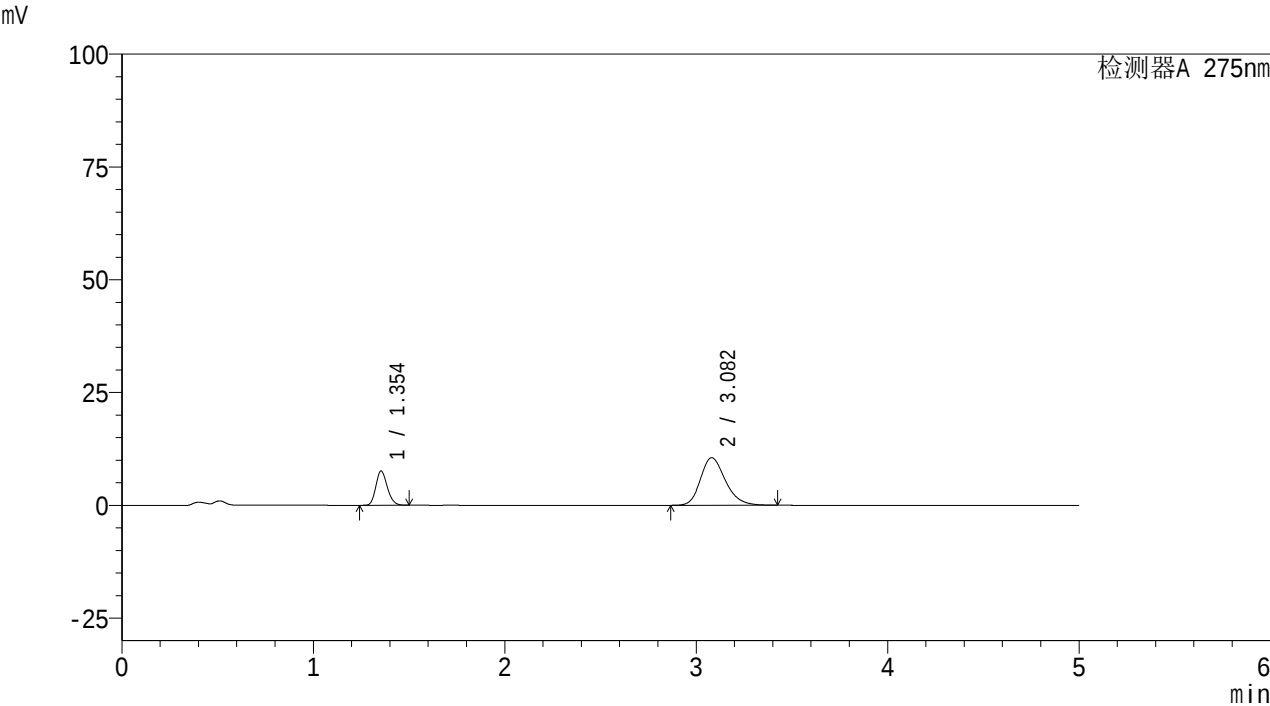

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	31472	24.822	7582	2446	1.180	--
2	3.082	95315	75.178	10548	2775	1.219	10.059
总计		126787	100.000	18131			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-885-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:22:28
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

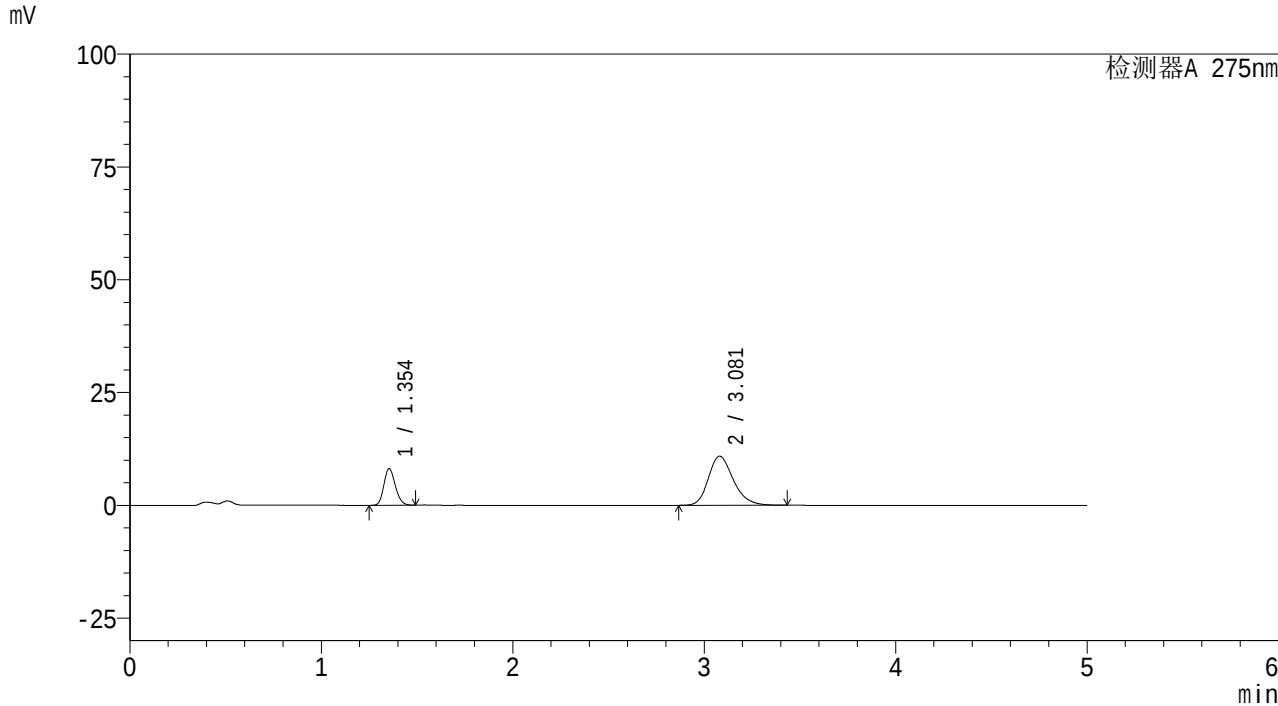

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	33659	25.446	8123	2450	1.178	--
2	3.081	98618	74.554	10895	2765	1.220	10.047
总计		132277	100.000	19018			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-886-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:27:51
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

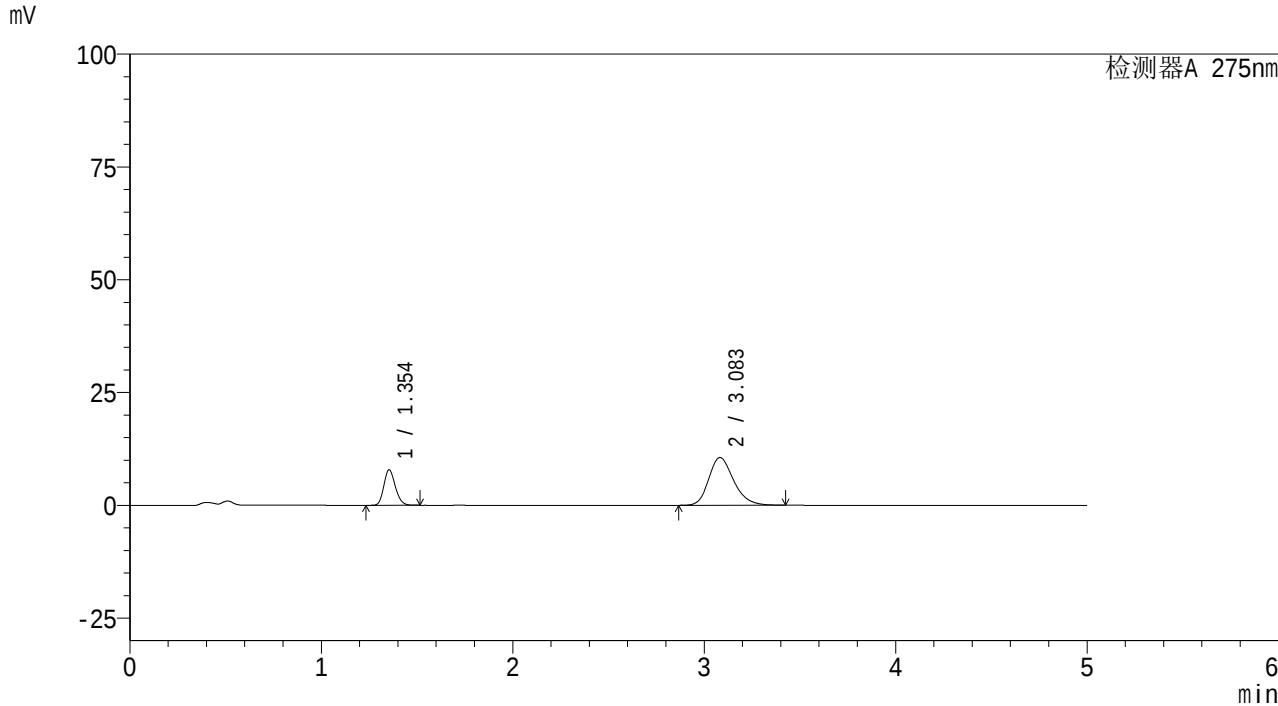

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	32651	25.409	7854	2443	1.181	--
2	3.083	95848	74.591	10574	2768	1.219	10.053
总计		128499	100.000	18429			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-887-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:33:14

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

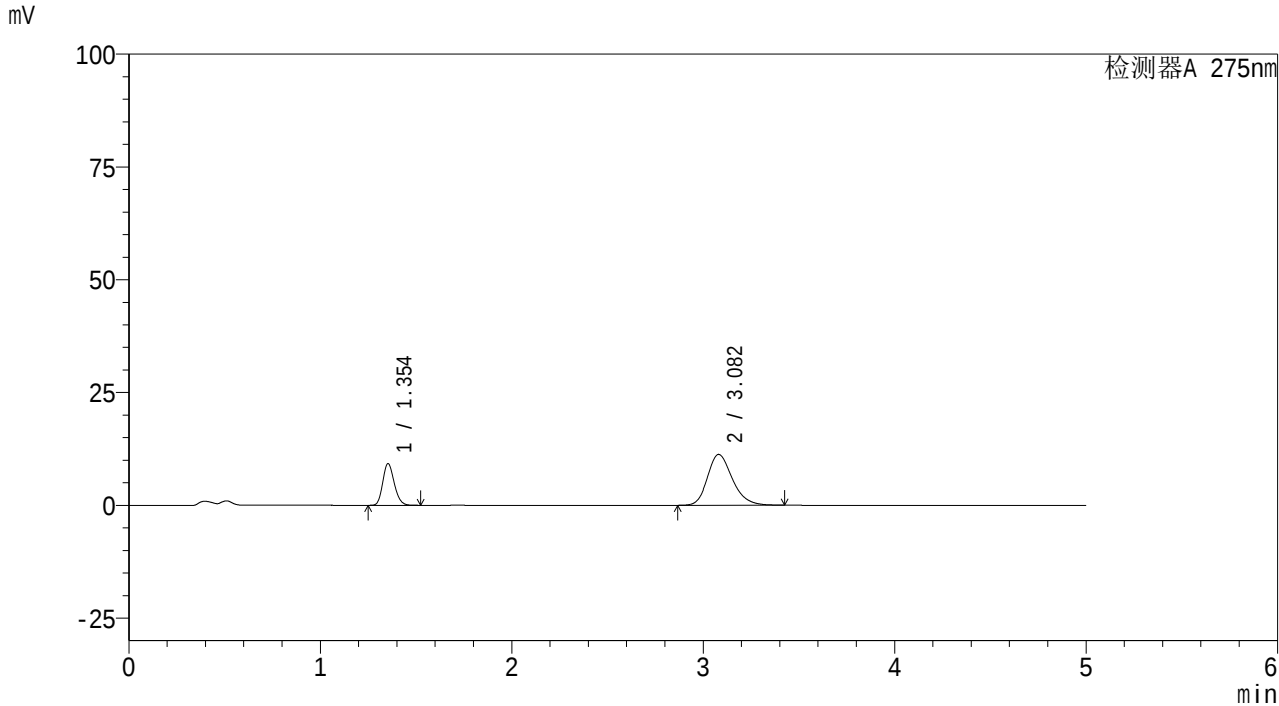

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	38483	27.437	9246	2448	1.182	--
2	3.082	101778	72.563	11269	2776	1.219	10.065
总计		140261	100.000	20515			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-888-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:38:37
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

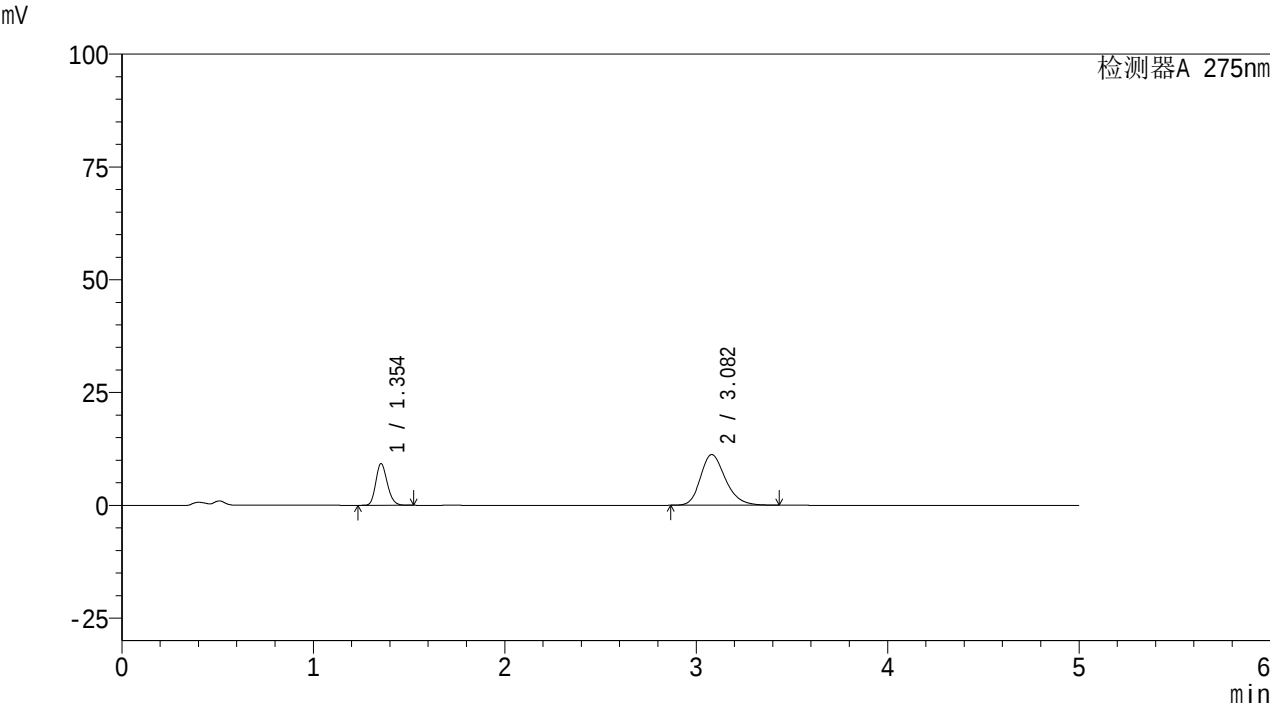

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	38427	27.425	9232	2443	1.182	--
2	3.082	101691	72.575	11229	2767	1.222	10.049
总计		140119	100.000	20461			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-889-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 22:44:00
处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

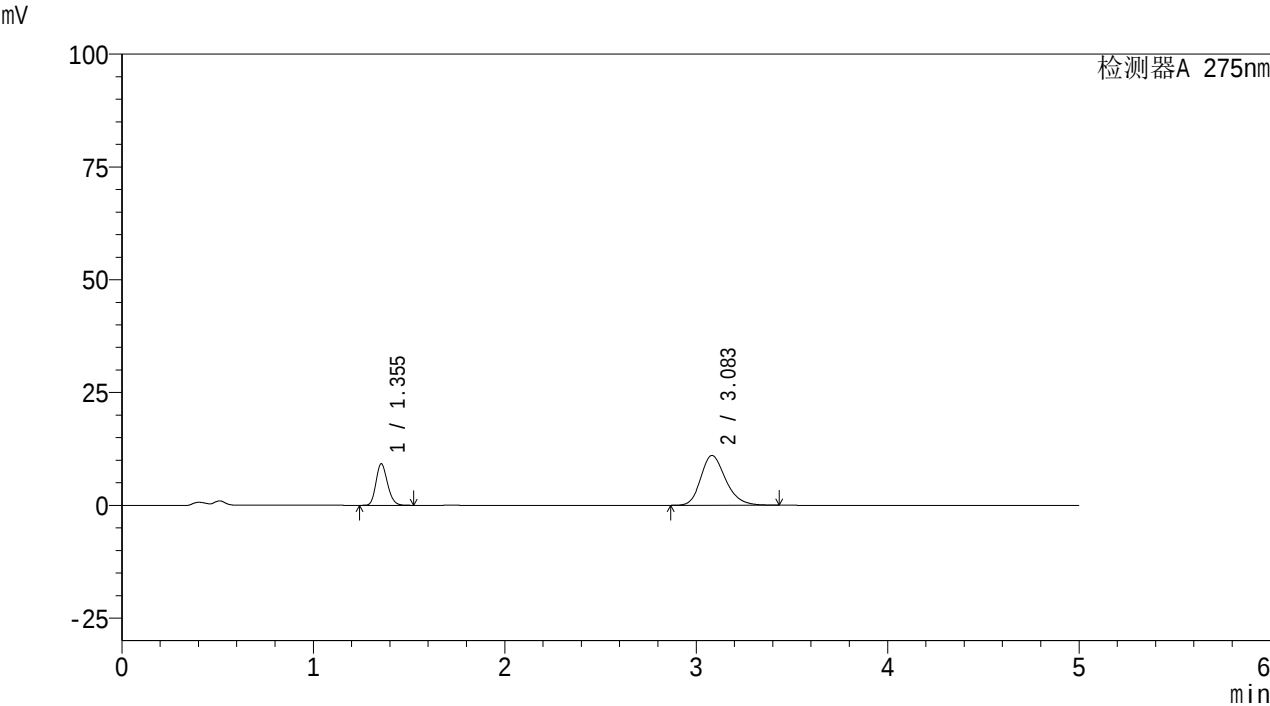

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	38354	27.789	9215	2440	1.184	--
2	3.083	99663	72.211	11018	2781	1.220	10.062
总计		138018	100.000	20233			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-890-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:49:22

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

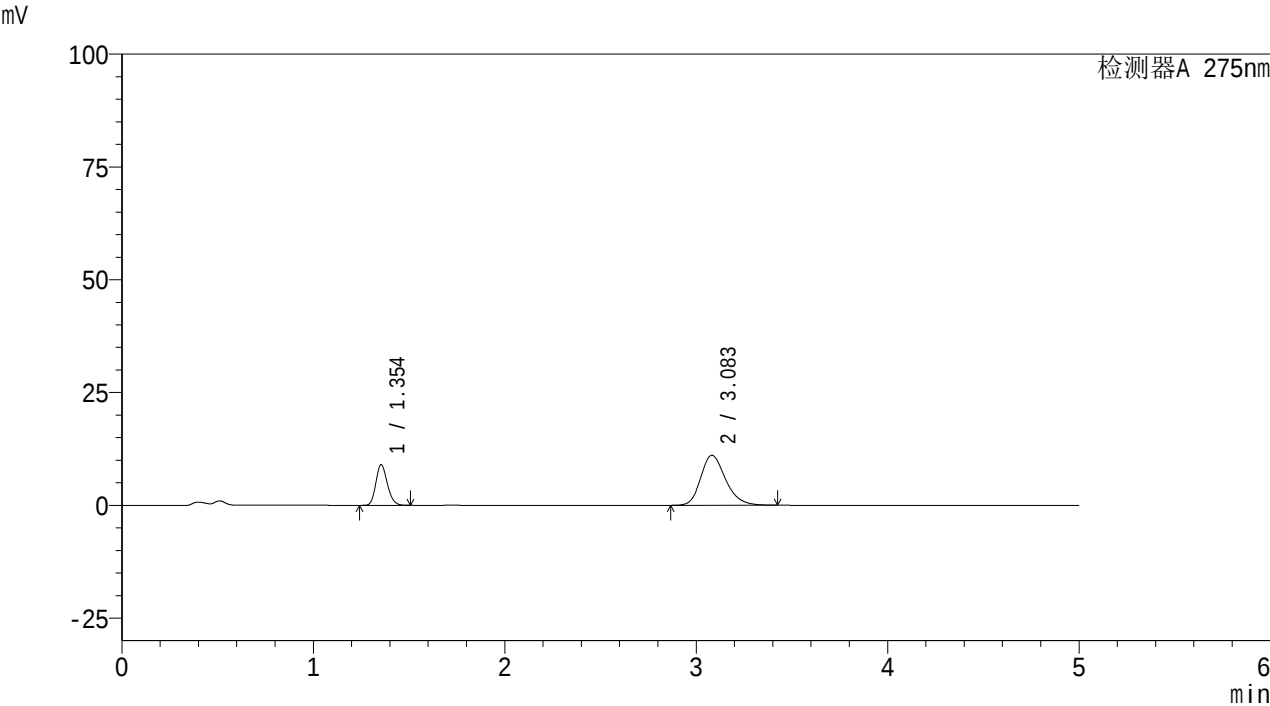

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	37407	27.190	9002	2445	1.181	--
2	3.083	100171	72.810	11075	2780	1.219	10.067
总计		137578	100.000	20077			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-891-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 22:54:46

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

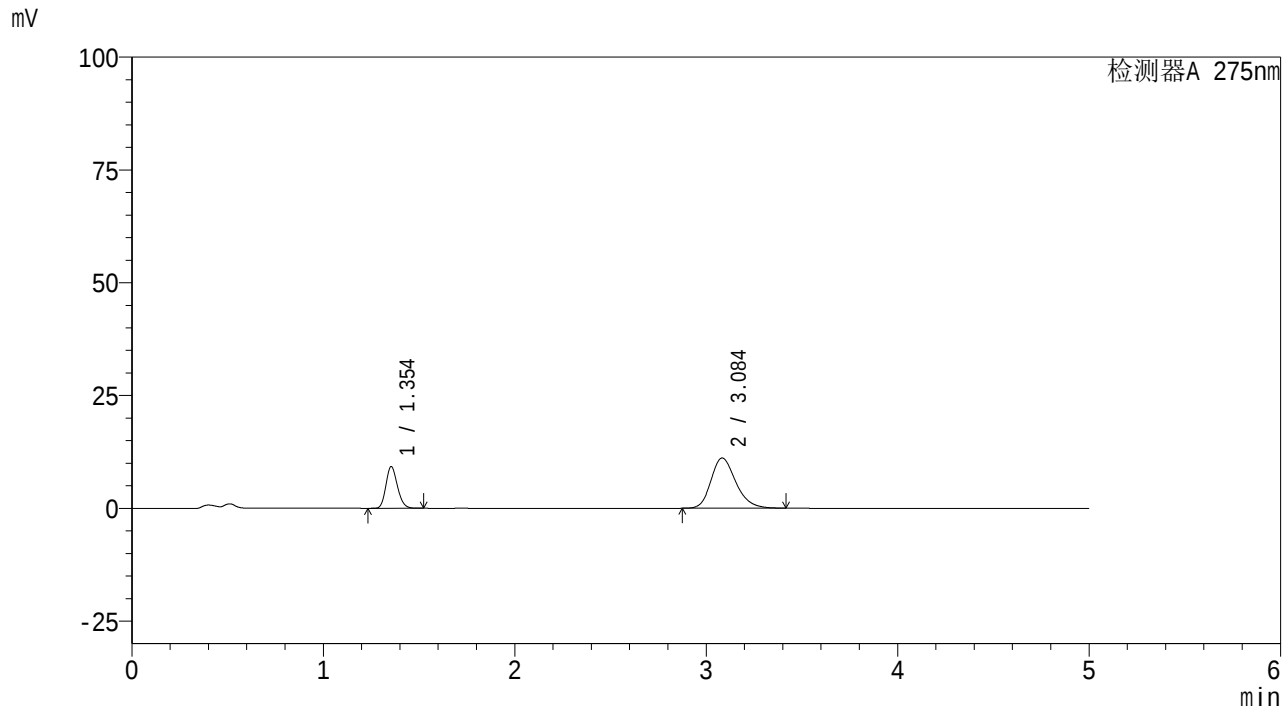

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	38460	27.663	9245	2441	1.182	--
2	3.084	100569	72.337	11114	2782	1.219	10.069
总计		139028	100.000	20360			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-892-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:00:08

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

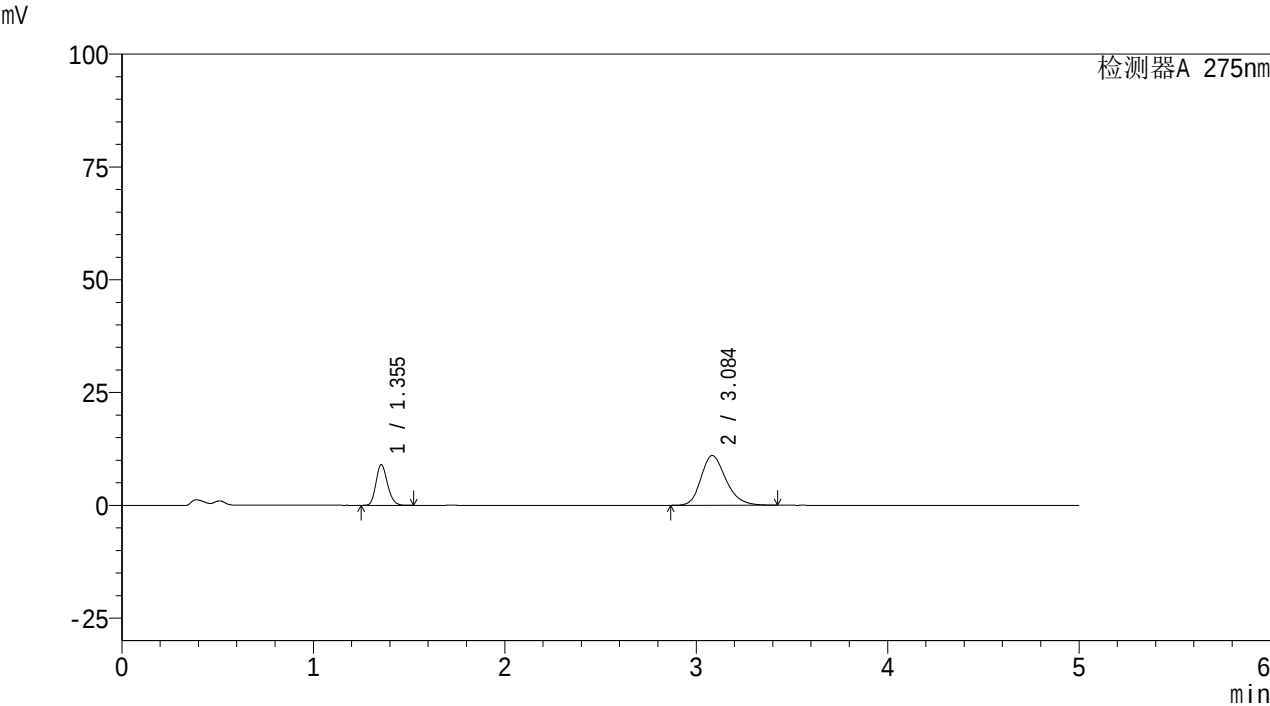

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	37480	27.369	9021	2445	1.181	--
2	3.084	99465	72.631	10988	2775	1.218	10.062
总计		136946	100.000	20009			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-893-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:05:31

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

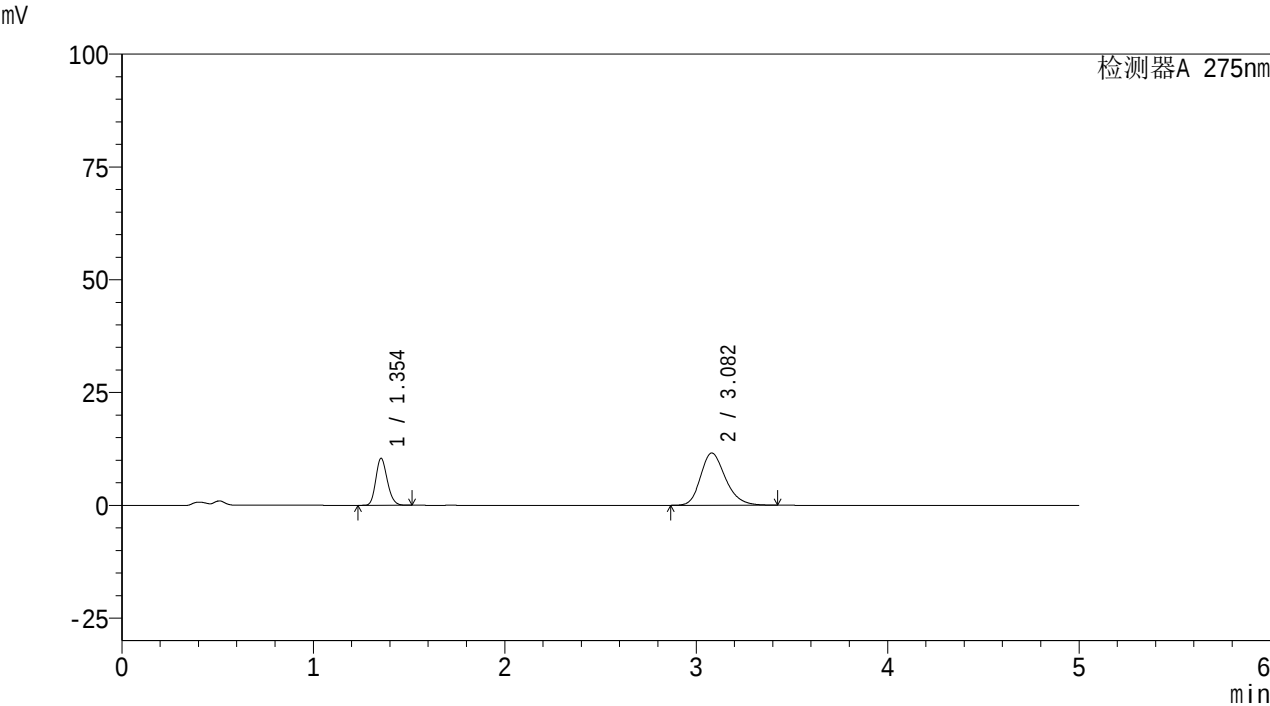

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	43233	29.243	10404	2448	1.181	--
2	3.082	104610	70.757	11574	2773	1.222	10.061
总计		147843	100.000	21978			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-894-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:10:55

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

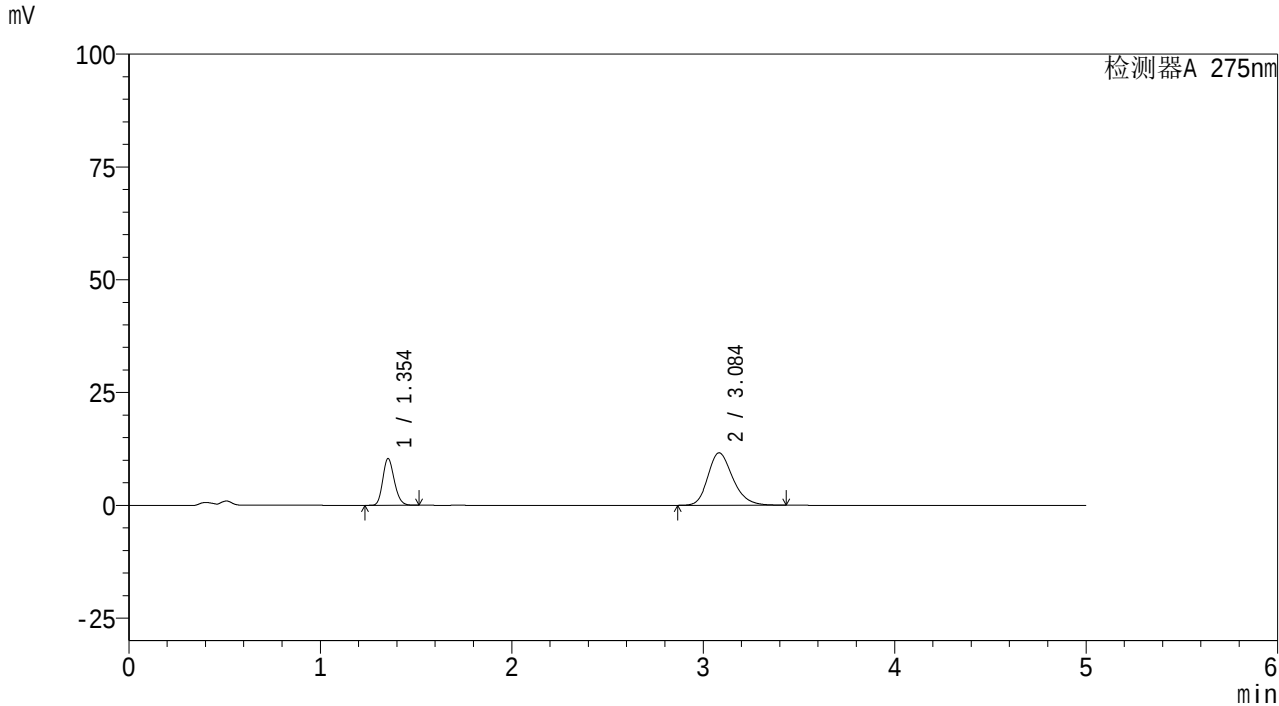

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	43111	29.101	10362	2445	1.181	--
2	3.084	105033	70.899	11605	2782	1.221	10.077
总计		148144	100.000	21967			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-895-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:16:17

处理时间(V2): 2026/05/15 17:14:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

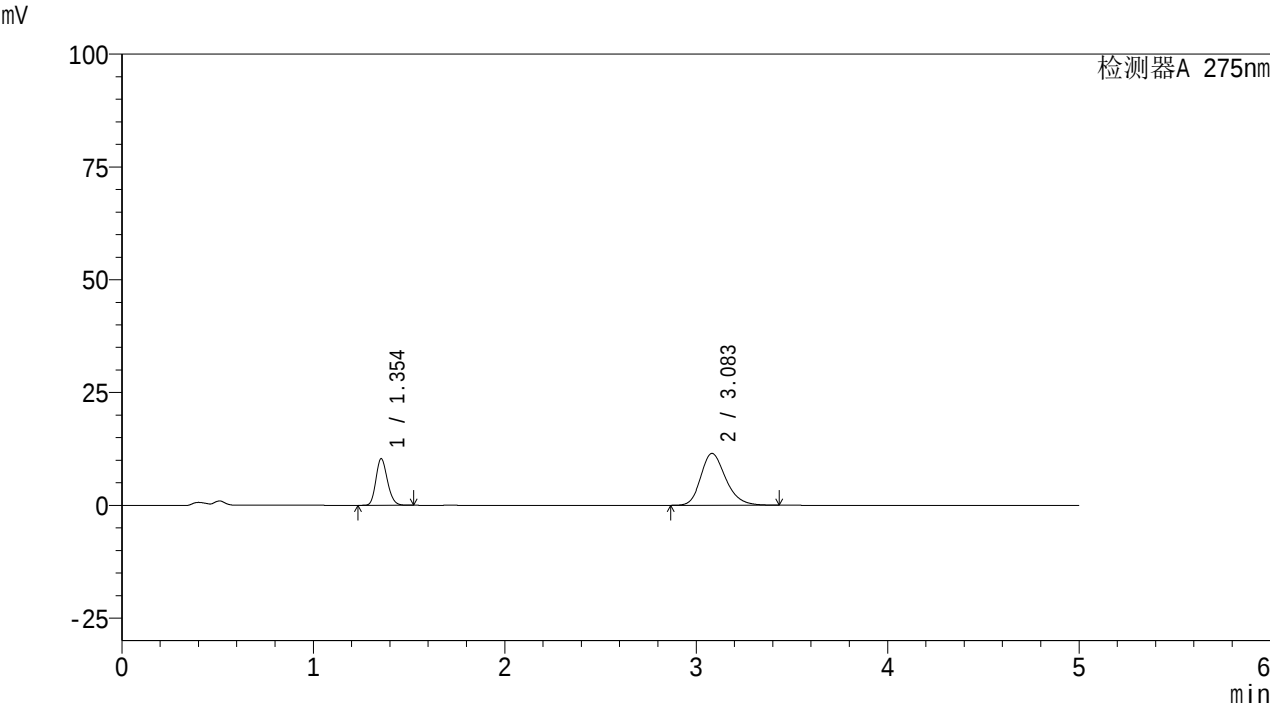

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	42987	29.260	10338	2443	1.182	--
2	3.083	103926	70.740	11477	2775	1.222	10.059
总计		146913	100.000	21814			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-896-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:21:39

处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

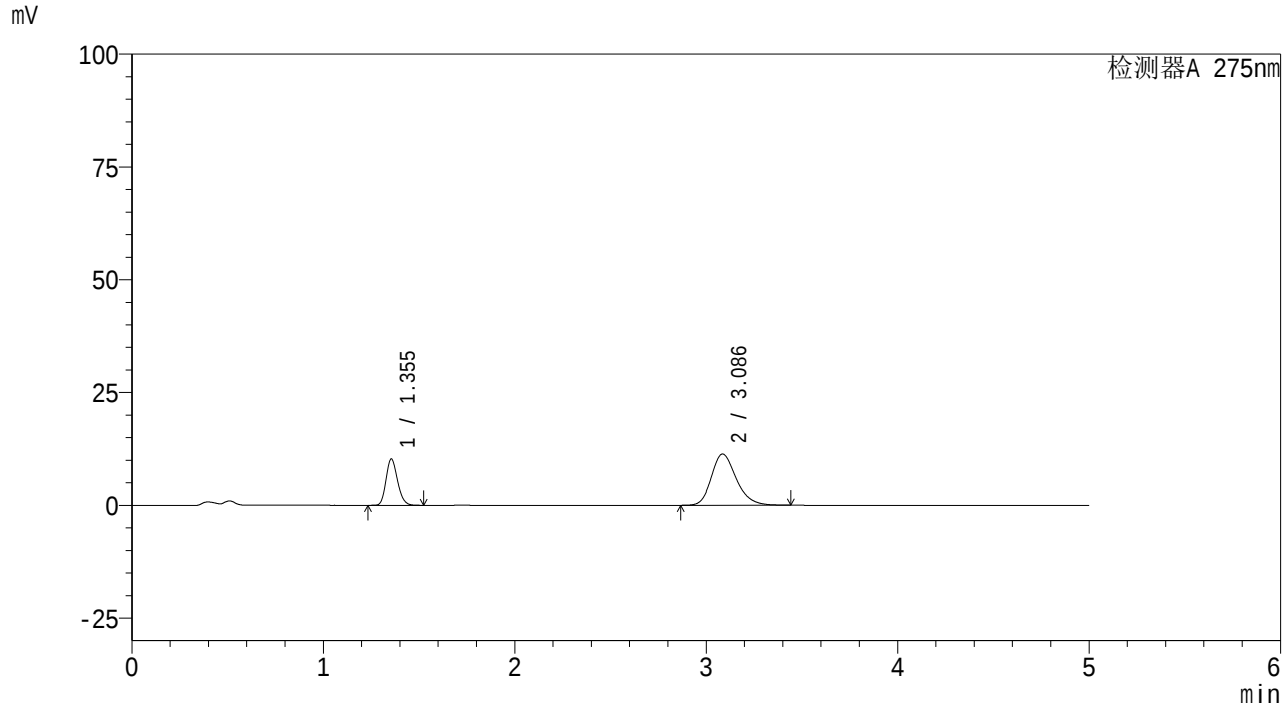

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	42780	29.380	10281	2445	1.182	--
2	3.086	102826	70.620	11357	2783	1.221	10.076
总计		145606	100.000	21637			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-897-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:27:02
处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

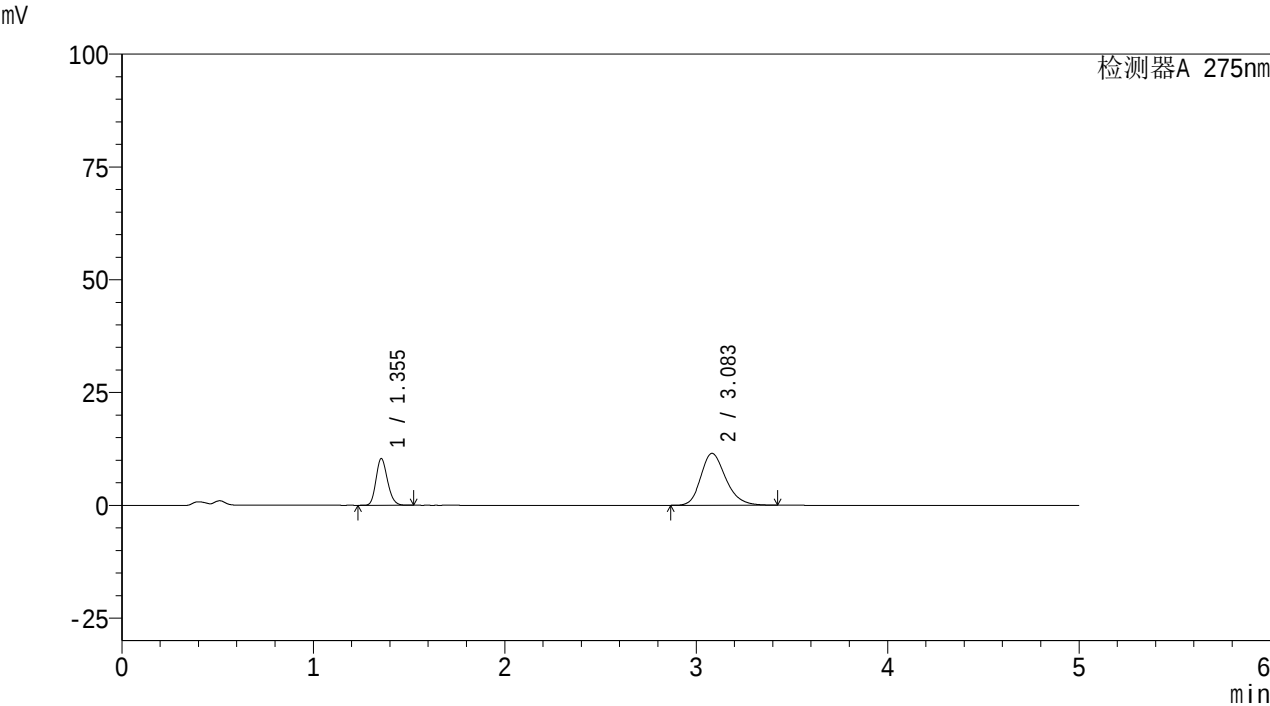

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	43052	29.275	10353	2447	1.182	--
2	3.083	104010	70.725	11478	2773	1.220	10.057
总计		147062	100.000	21831			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-898-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:32:26

处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

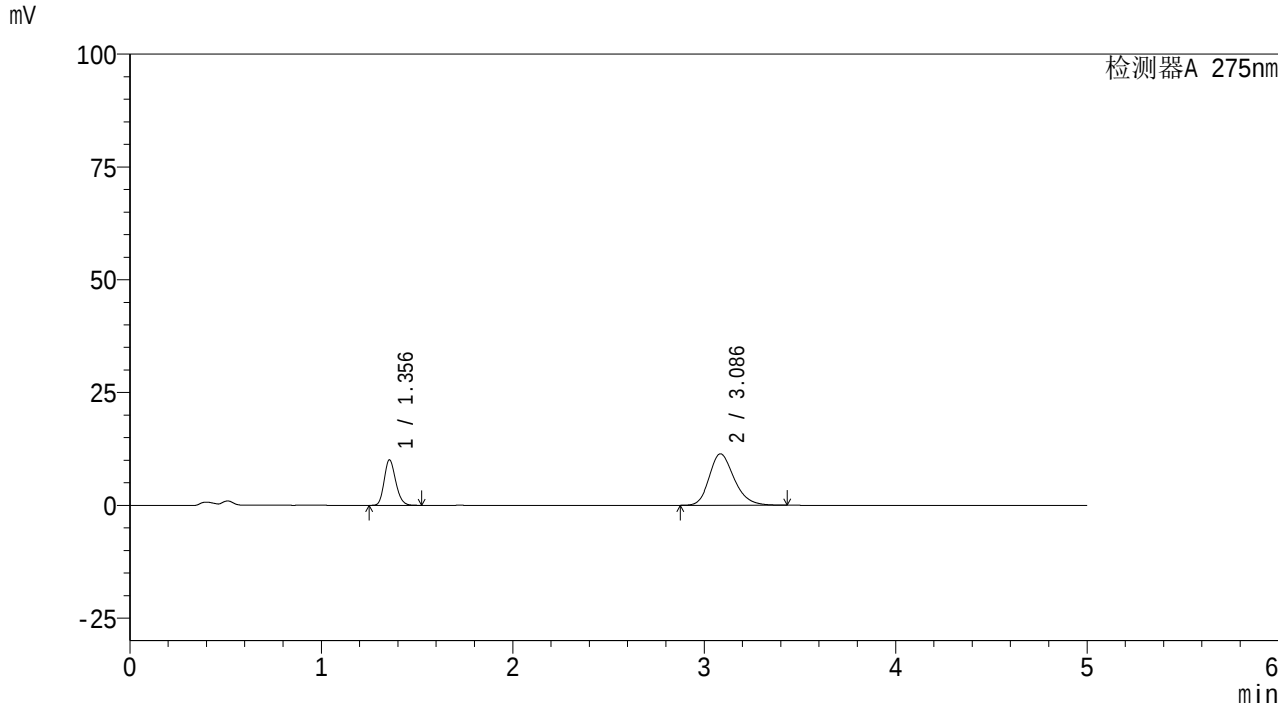

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	41916	28.914	10084	2452	1.183	--
2	3.086	103051	71.086	11394	2786	1.220	10.076
总计		144968	100.000	21478			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-899-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:37:49

处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

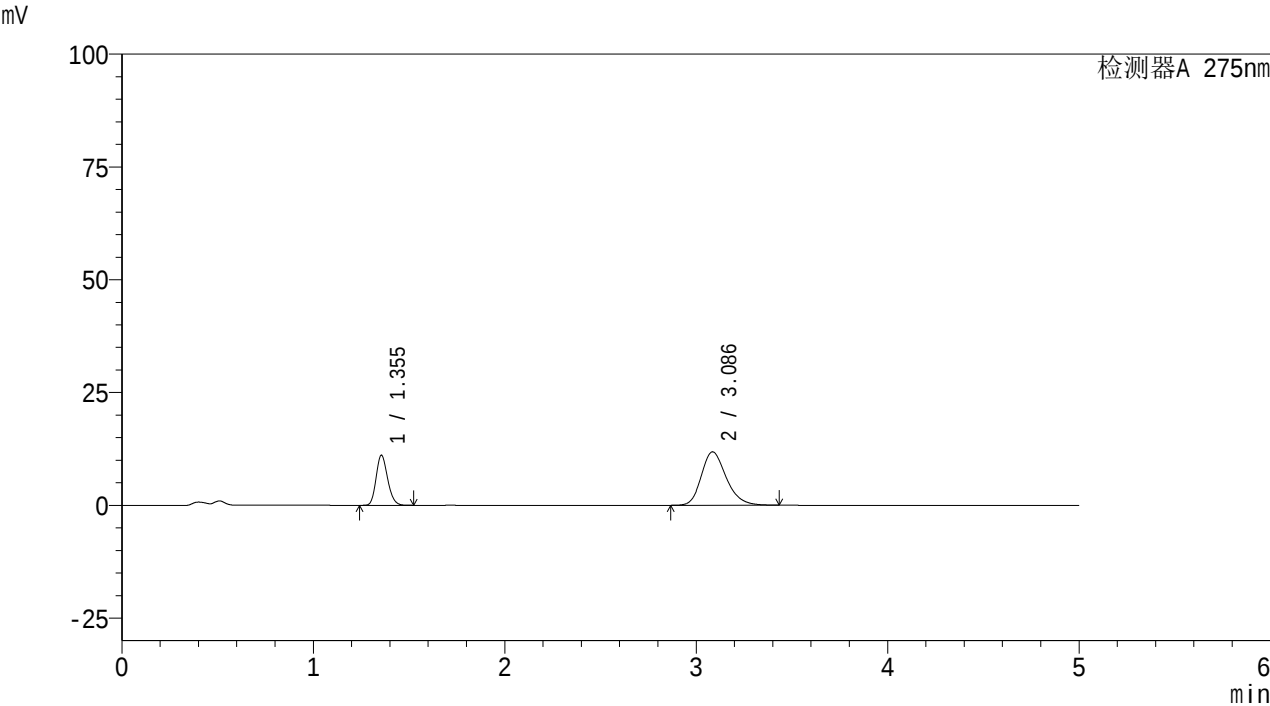

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	46229	30.170	11109	2445	1.182	--
2	3.086	106998	69.830	11830	2781	1.221	10.070
总计		153227	100.000	22938			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-900-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:43:11
处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

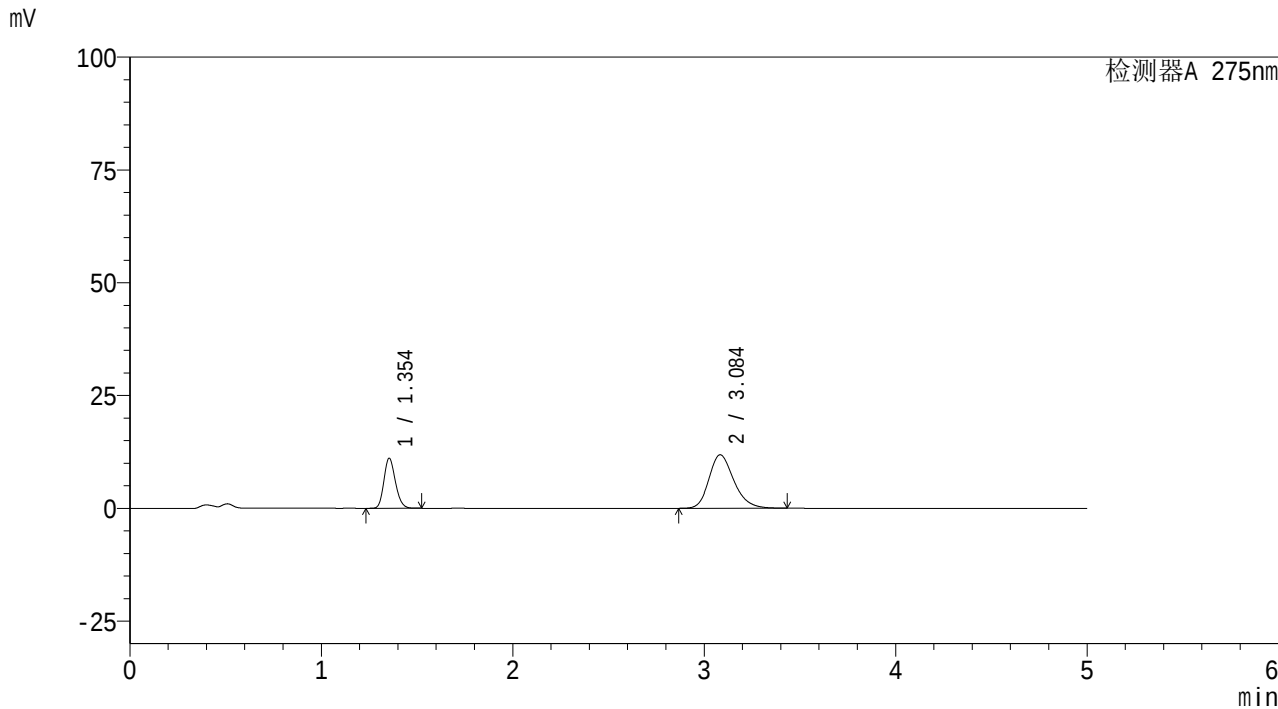

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	46115	30.095	11094	2446	1.181	--
2	3.084	107117	69.905	11819	2775	1.221	10.064
总计		153232	100.000	22912			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-901-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:48:34
处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

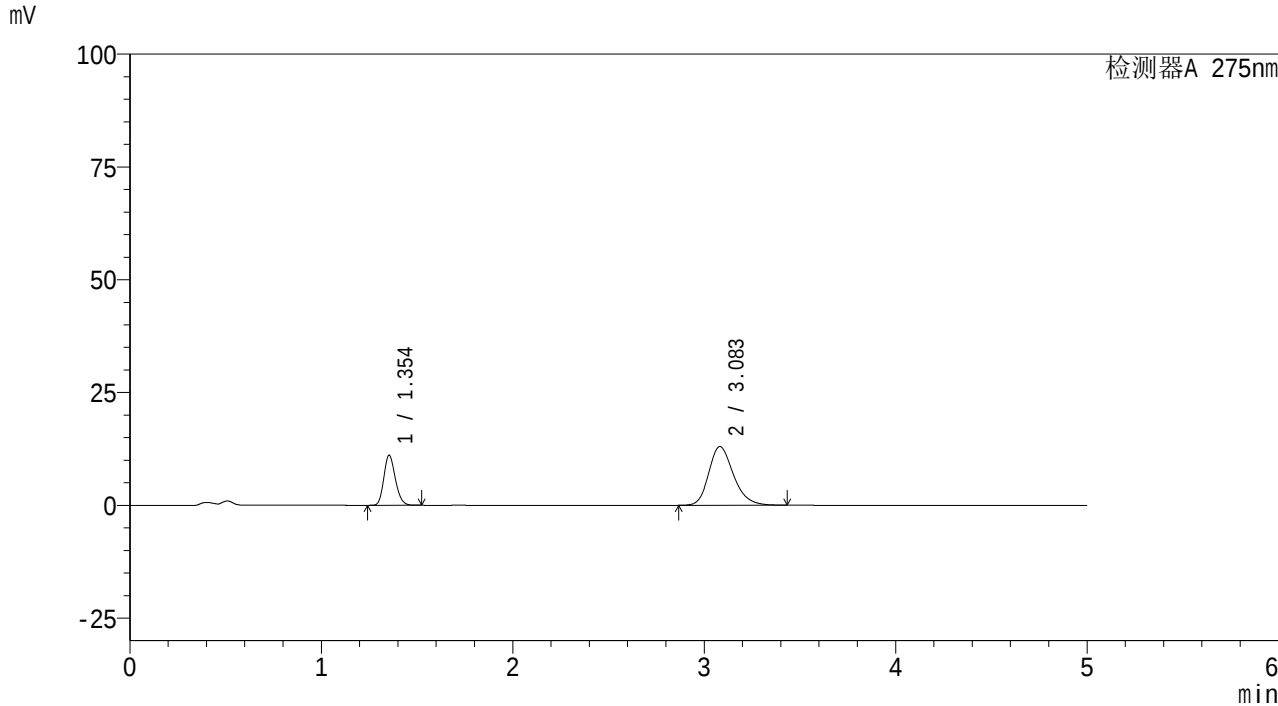

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	46144	28.332	11093	2441	1.181	--
2	3.083	116724	71.668	12995	2818	1.218	10.112
总计		162868	100.000	24088			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-902-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 23:53:56
处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

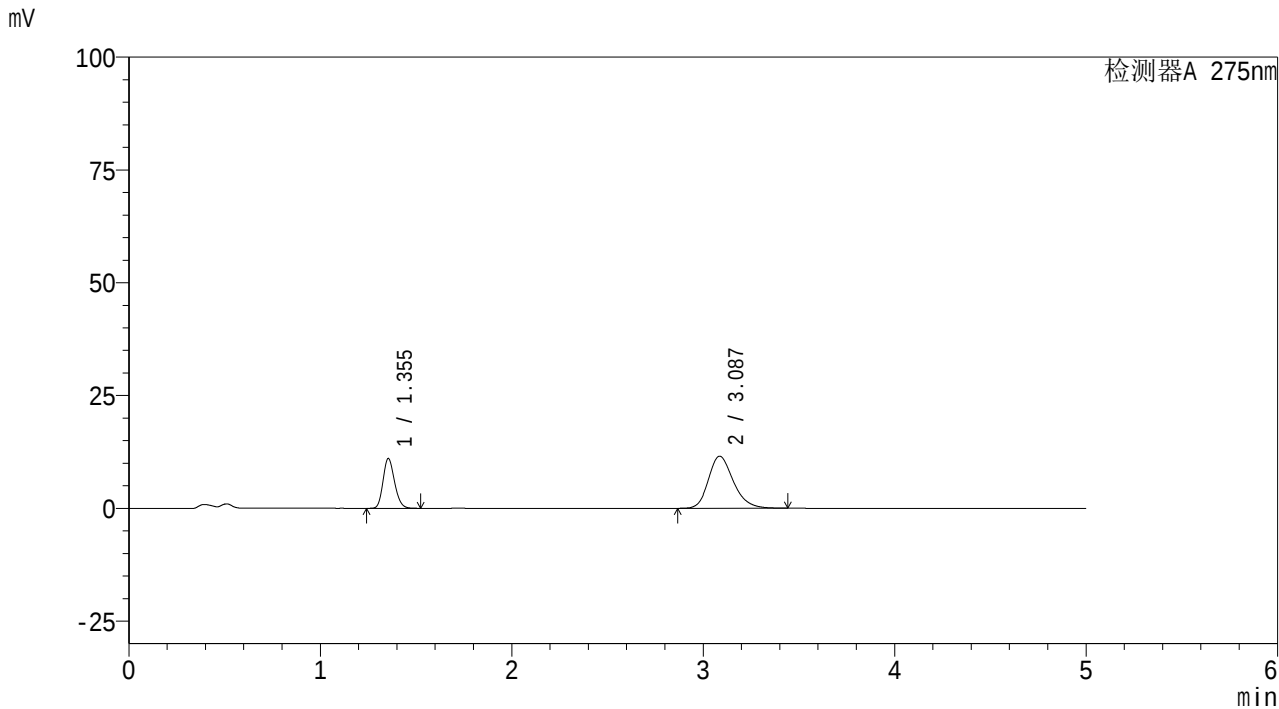

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	45984	30.555	11050	2444	1.182	--
2	3.087	104514	69.445	11543	2777	1.221	10.069
总计		150497	100.000	22593			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-903-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 23:59:20

处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

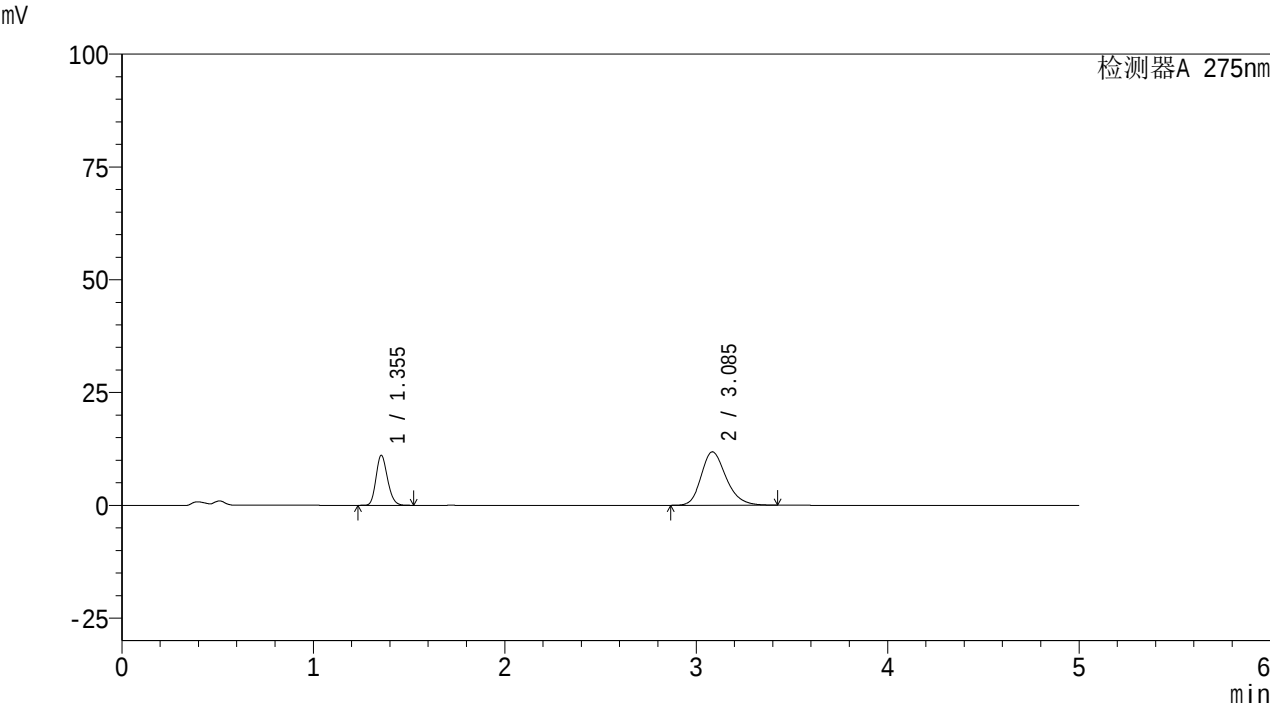

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	46116	30.103	11087	2445	1.182	--
2	3.085	107079	69.897	11822	2775	1.221	10.065
总计		153194	100.000	22909			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-904-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:04:42

处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

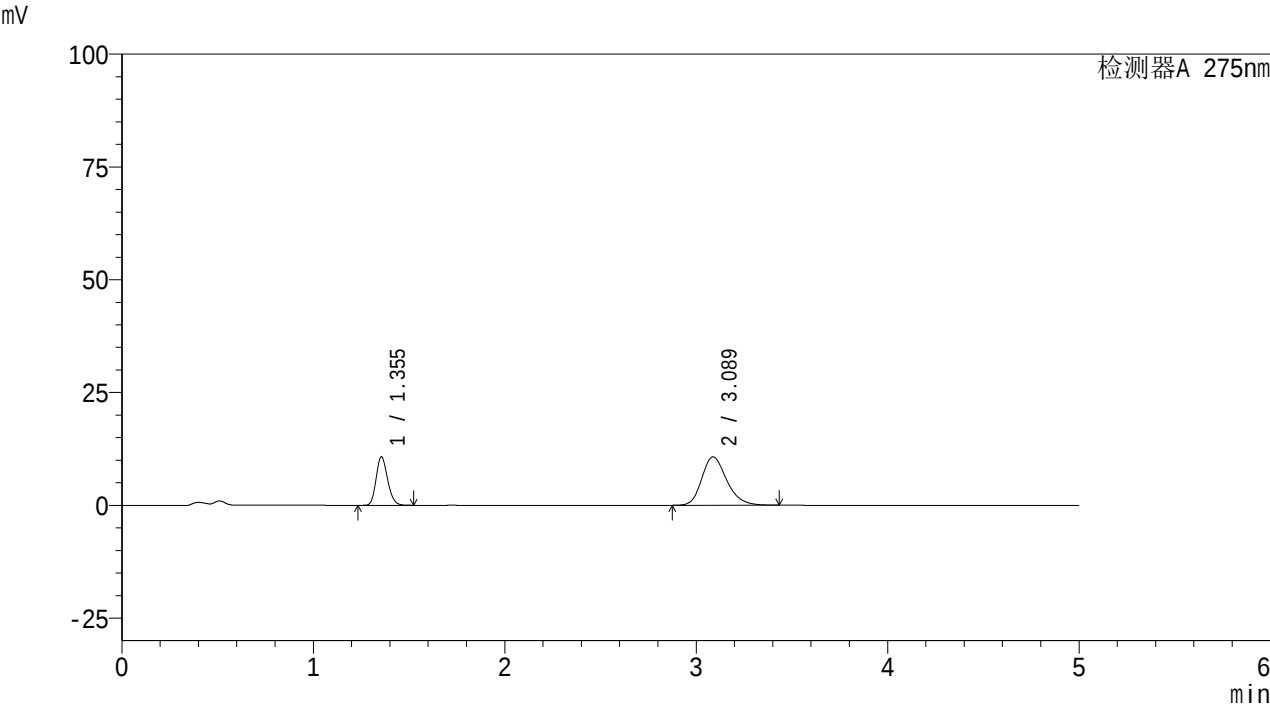

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	44788	31.573	10763	2444	1.182	--
2	3.089	97066	68.427	10725	2775	1.217	10.070
总计		141854	100.000	21488			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-27/27-905-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:10:06
处理时间(V2): 2026/05/15 17:15:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

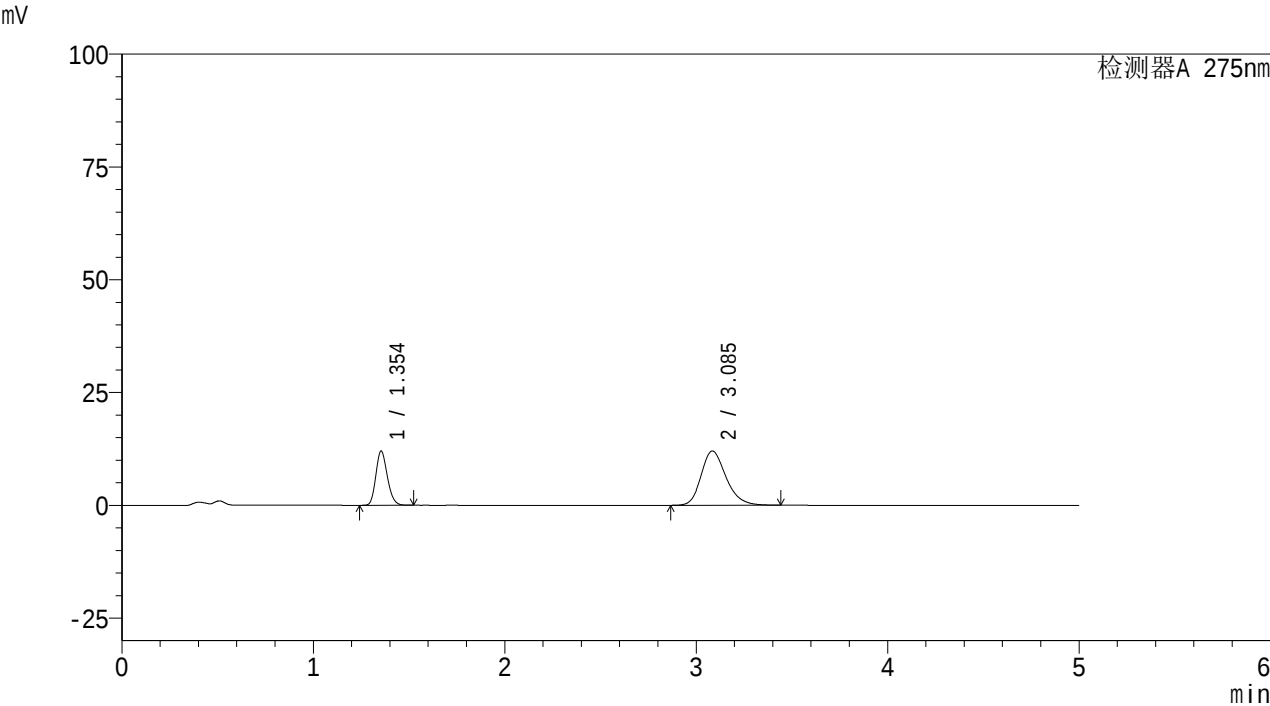

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	50015	31.496	12026	2444	1.181	--
2	3.085	108783	68.504	12005	2777	1.221	10.072
总计		158797	100.000	24031			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-28/27-906-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:15:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:18:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

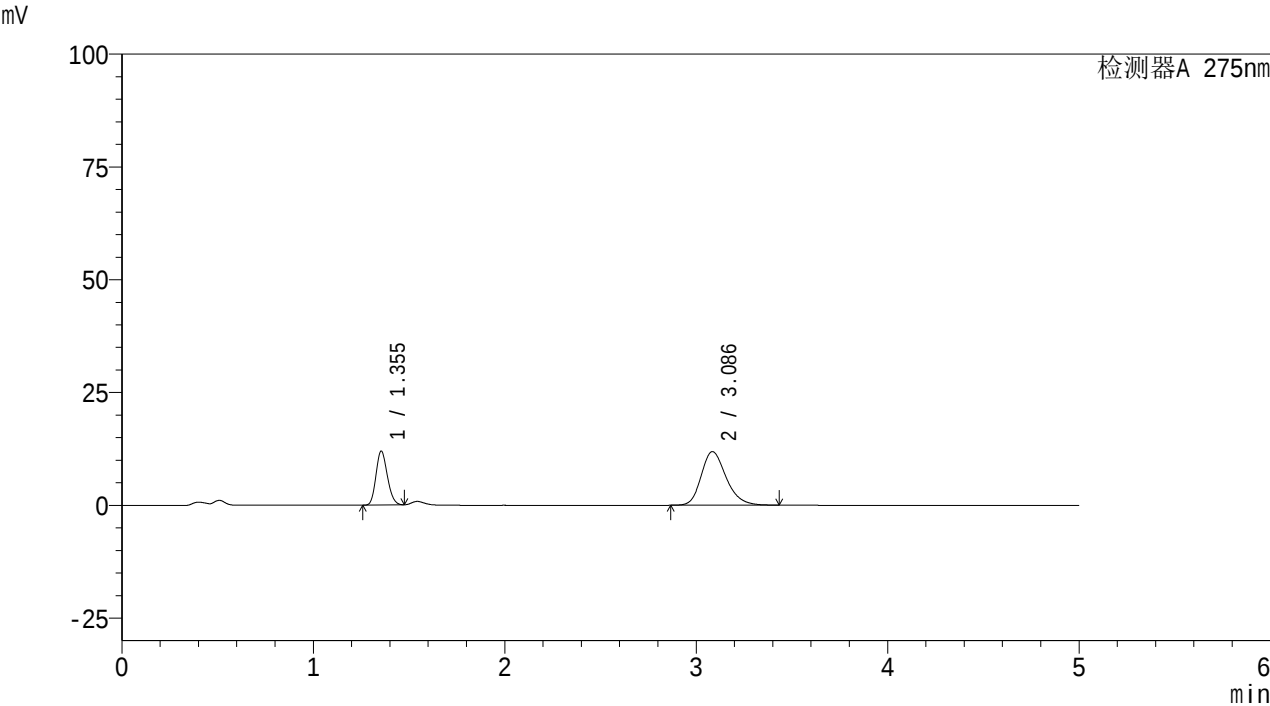

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	49270	31.409	11964	2461	1.166	--
2	3.086	107596	68.591	11883	2783	1.222	10.087
总计		156866	100.000	23847			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-907-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:20:53
处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

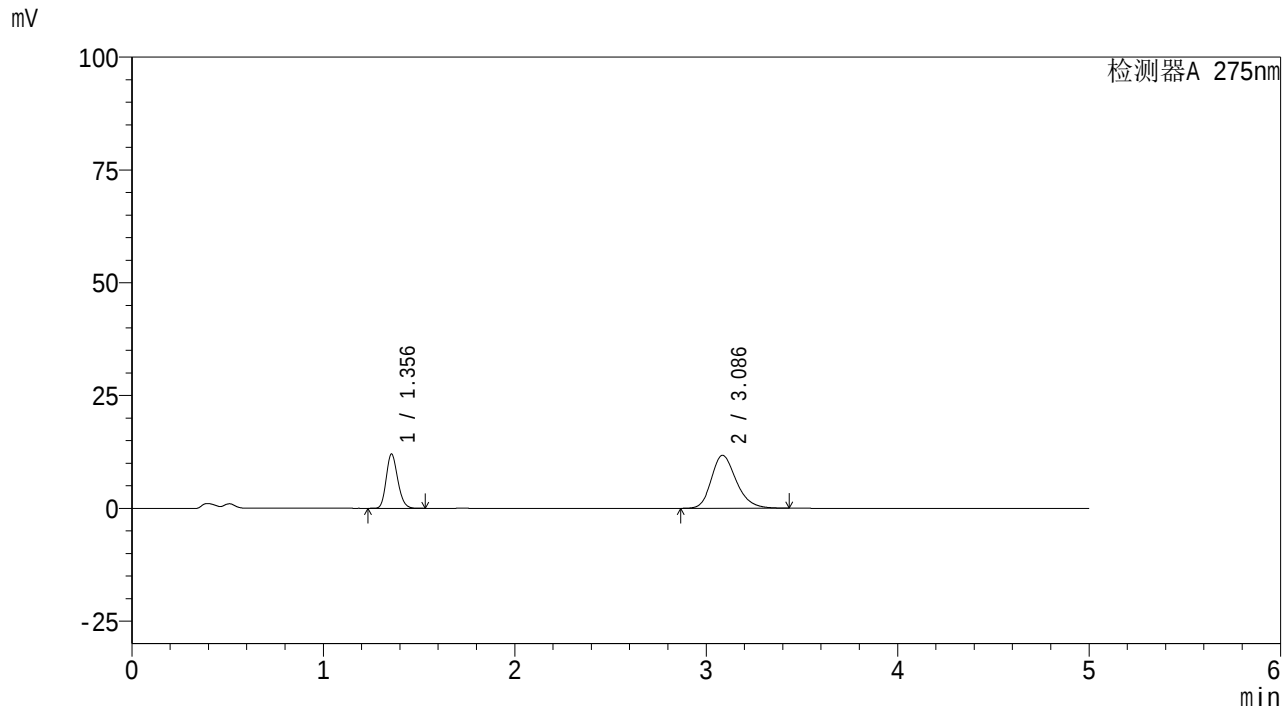

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	50072	32.042	12019	2442	1.183	--
2	3.086	106198	67.958	11729	2777	1.220	10.059
总计		156270	100.000	23748			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-908-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:26:16

处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

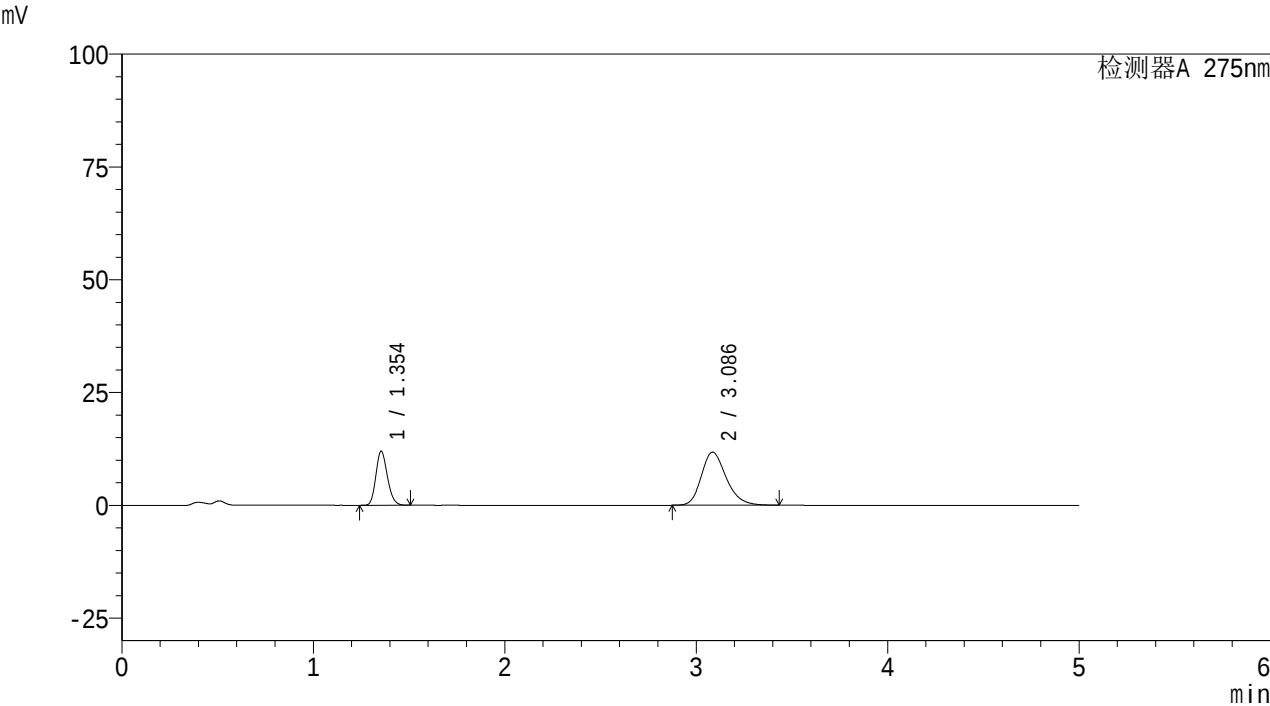

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	49884	31.937	12002	2442	1.180	--
2	3.086	106313	68.063	11754	2782	1.221	10.079
总计		156197	100.000	23756			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-909-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:31:40

处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

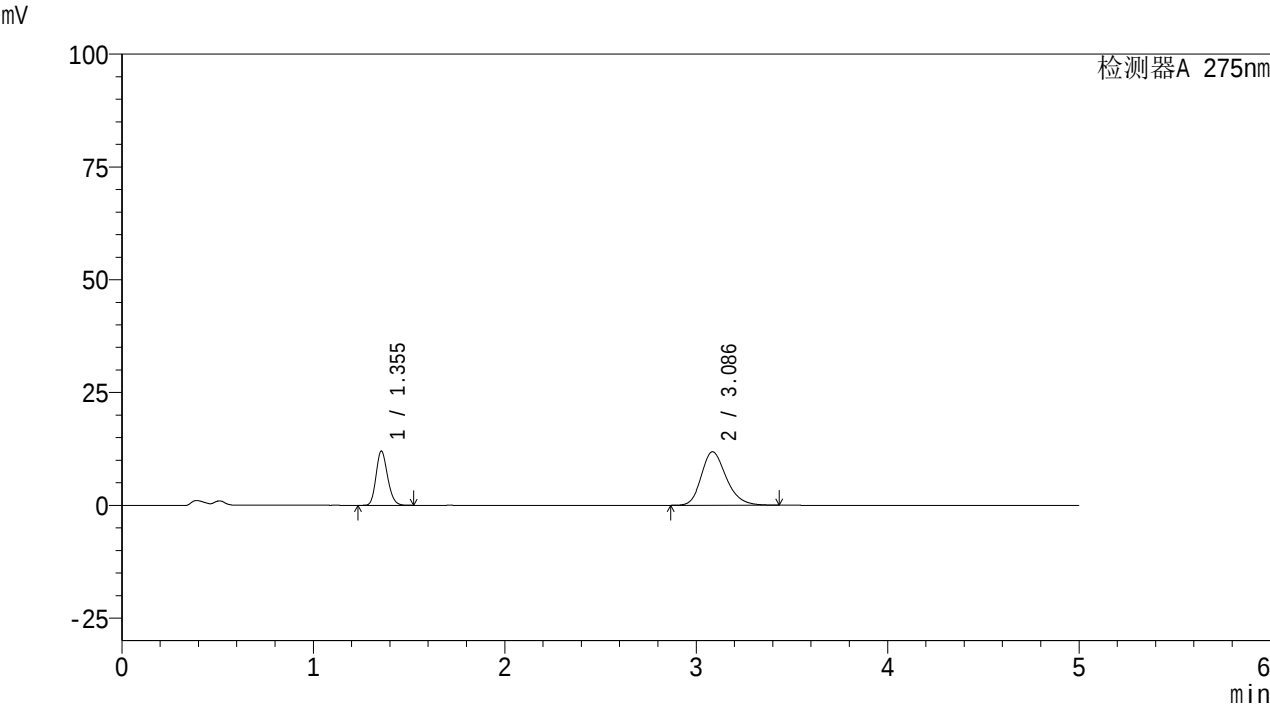

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	50072	31.808	12035	2446	1.183	--
2	3.086	107347	68.192	11850	2774	1.222	10.063
总计		157420	100.000	23885			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-910-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:37:03
处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

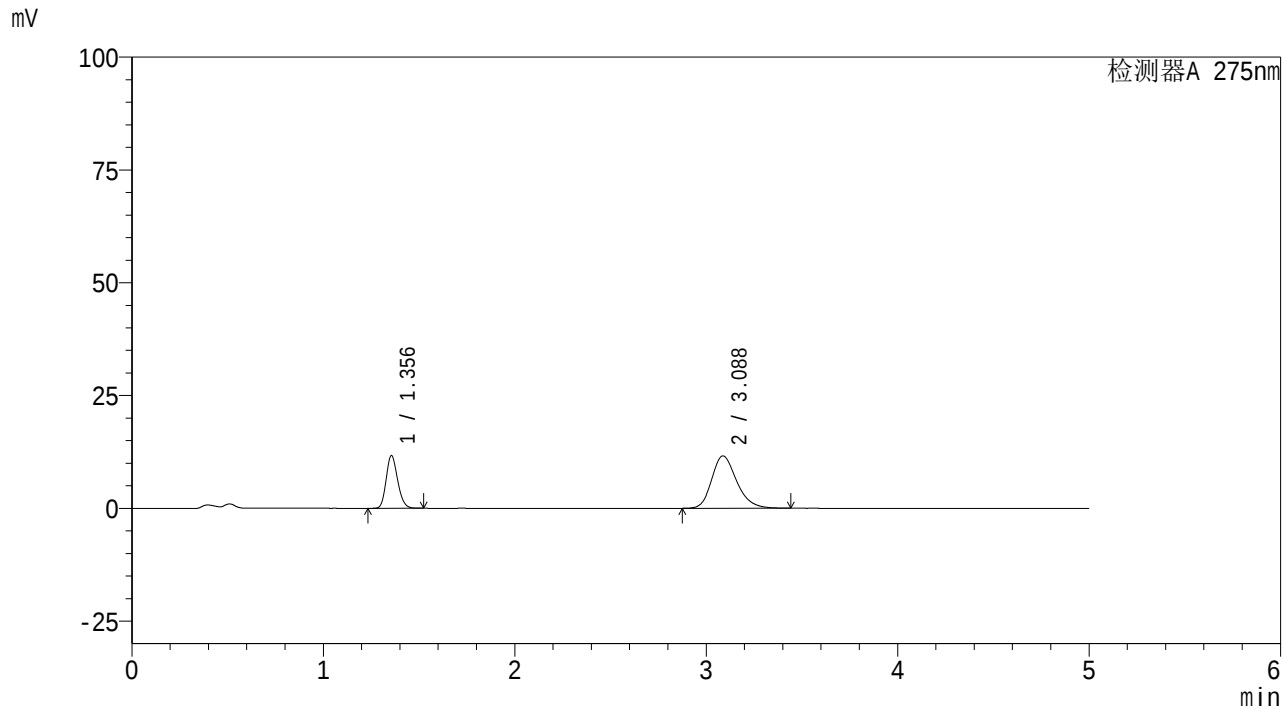

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	48594	31.605	11687	2447	1.182	--
2	3.088	105162	68.395	11608	2775	1.222	10.069
总计		153756	100.000	23295			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-911-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:42:26
处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

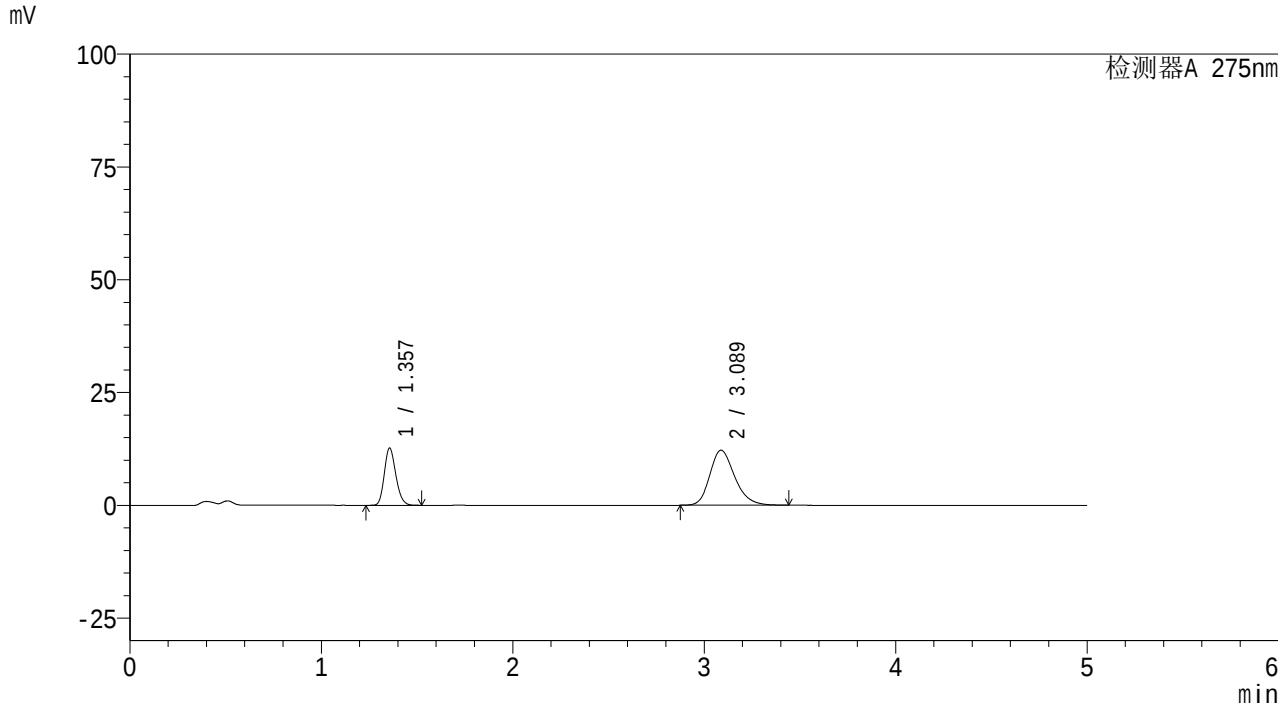

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	52833	32.405	12680	2449	1.182	--
2	3.089	110205	67.595	12197	2786	1.221	10.079
总计		163038	100.000	24877			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-912-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:47:49

处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

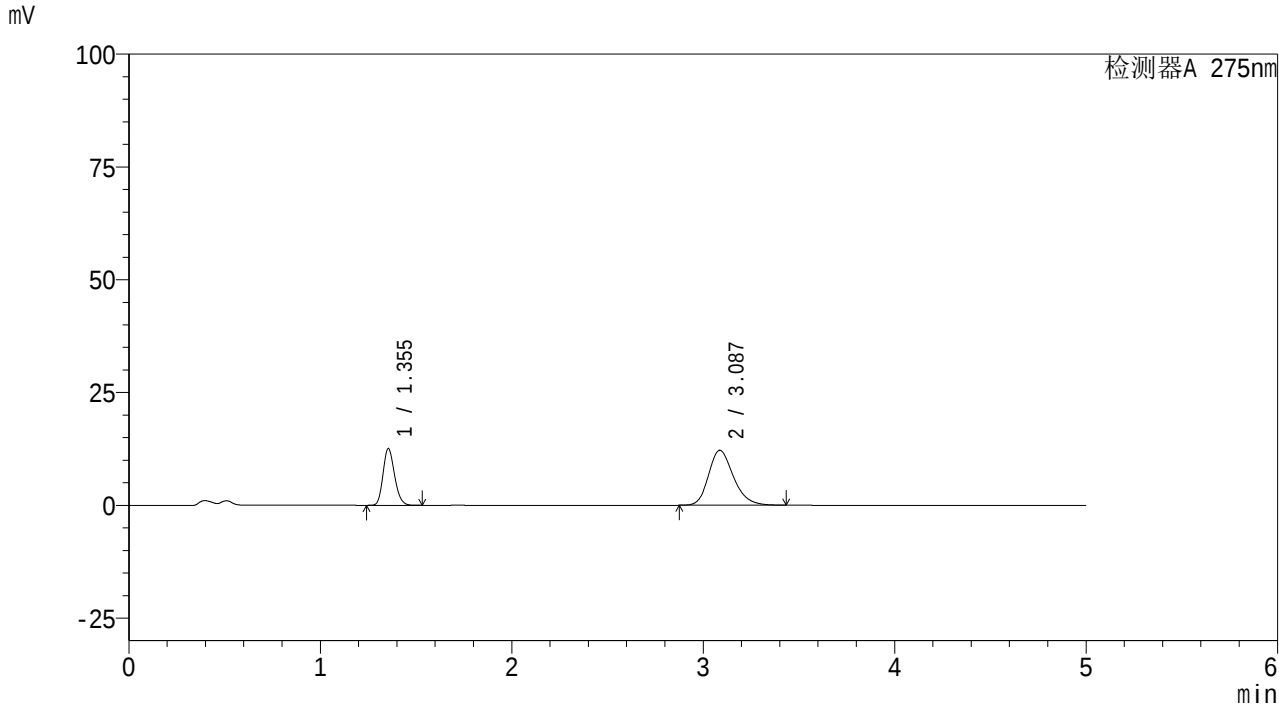

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	52412	32.271	12600	2445	1.181	--
2	3.087	110000	67.729	12184	2788	1.219	10.087
总计		162412	100.000	24784			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-913-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 00:53:11

处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

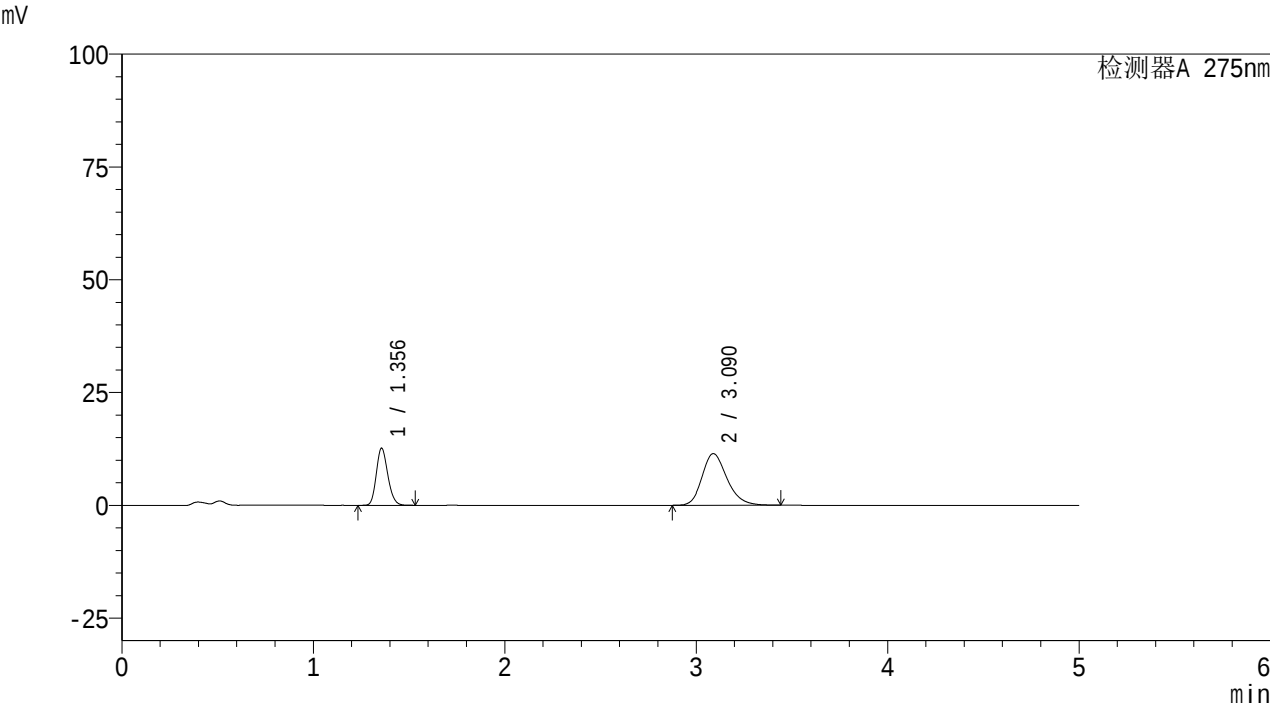

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	52721	33.703	12652	2448	1.182	--
2	3.090	103705	66.297	11450	2780	1.218	10.077
总计		156426	100.000	24102			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-914-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 00:58:34
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

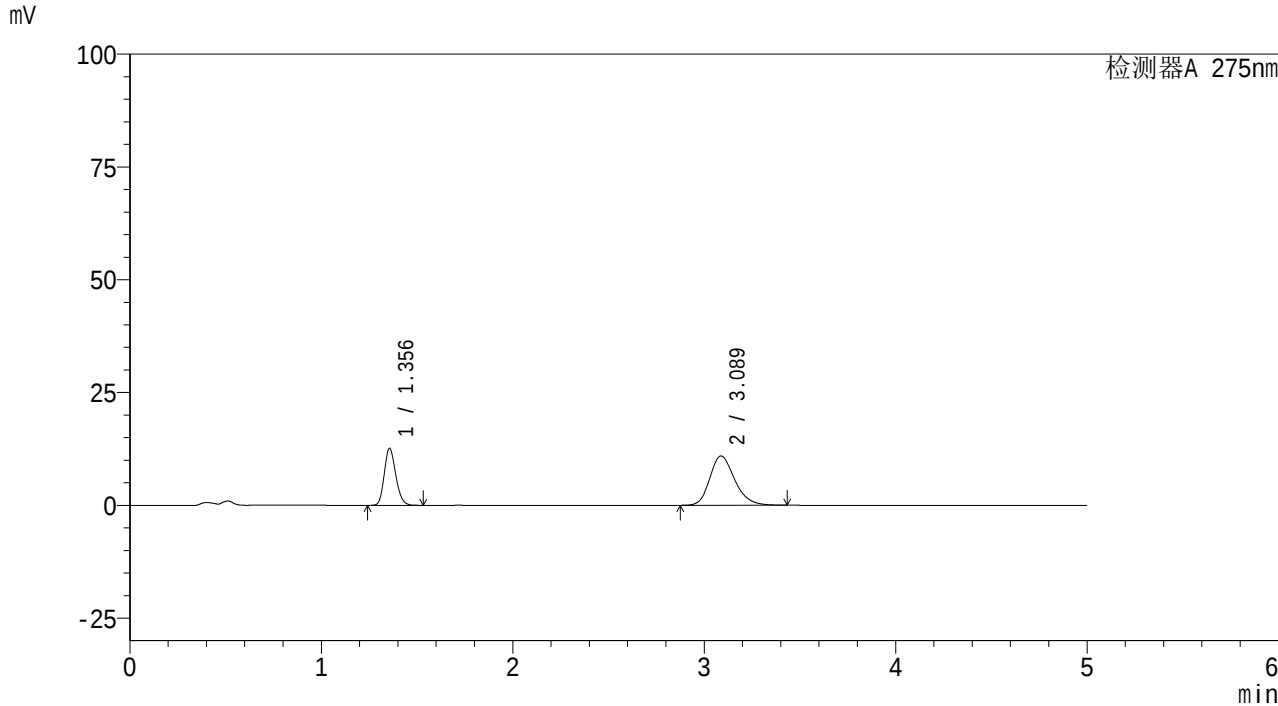

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	52589	34.736	12632	2447	1.182	--
2	3.089	98807	65.264	10933	2785	1.215	10.079
总计		151396	100.000	23565			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-915-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 01:03:57

处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

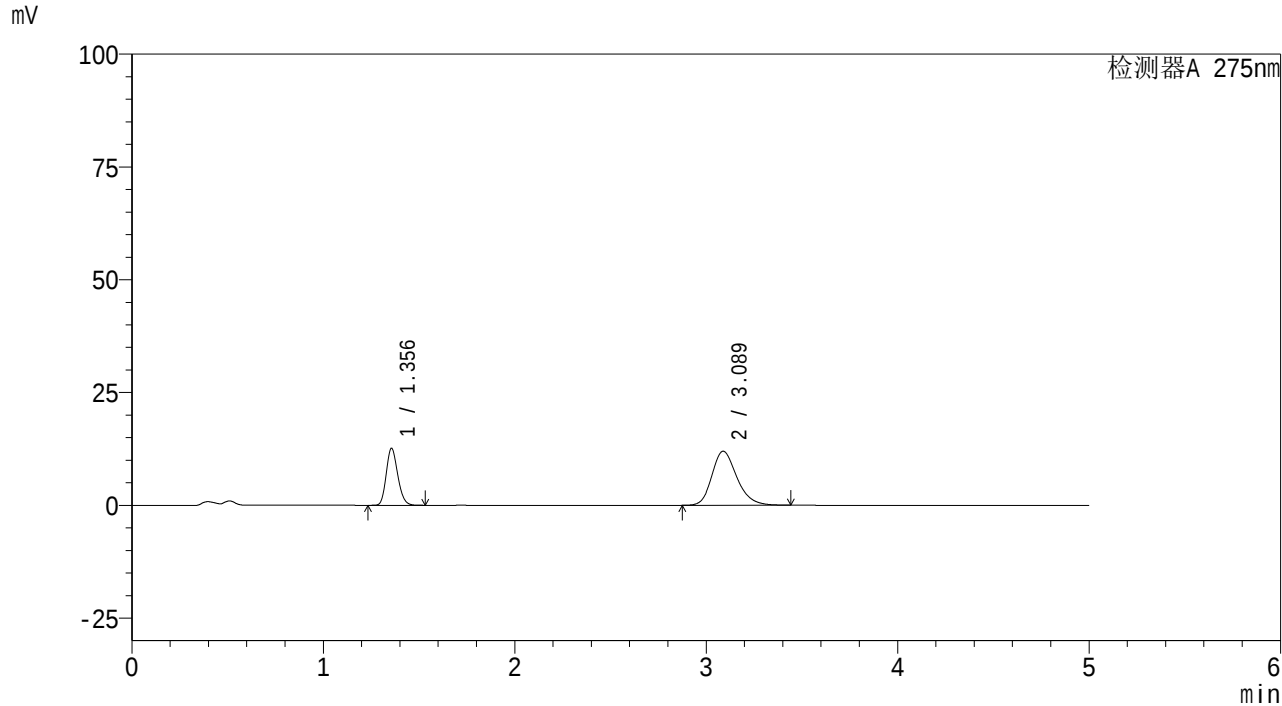

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	52583	32.665	12639	2449	1.183	--
2	3.089	108392	67.335	11983	2783	1.221	10.081
总计		160975	100.000	24623			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-916-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:09:19
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

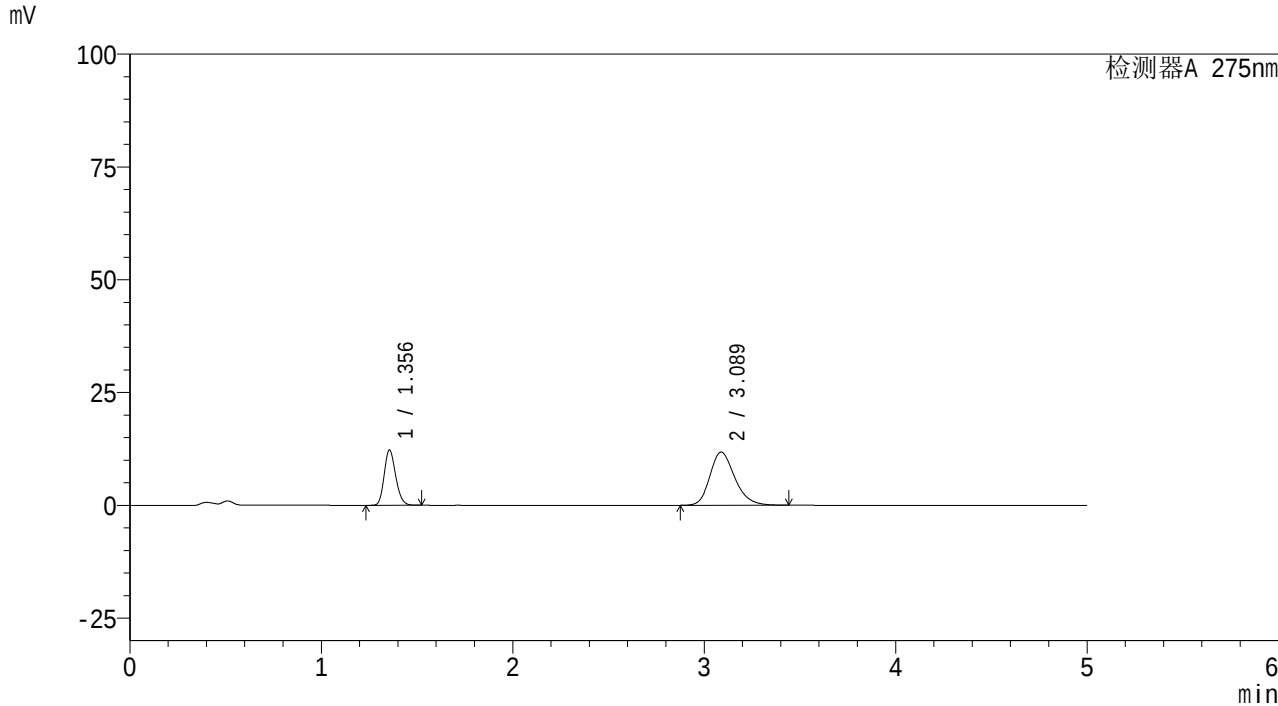

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	50975	32.365	12277	2453	1.181	--
2	3.089	106525	67.635	11785	2790	1.219	10.094
总计		157500	100.000	24062			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-917-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:14:42
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

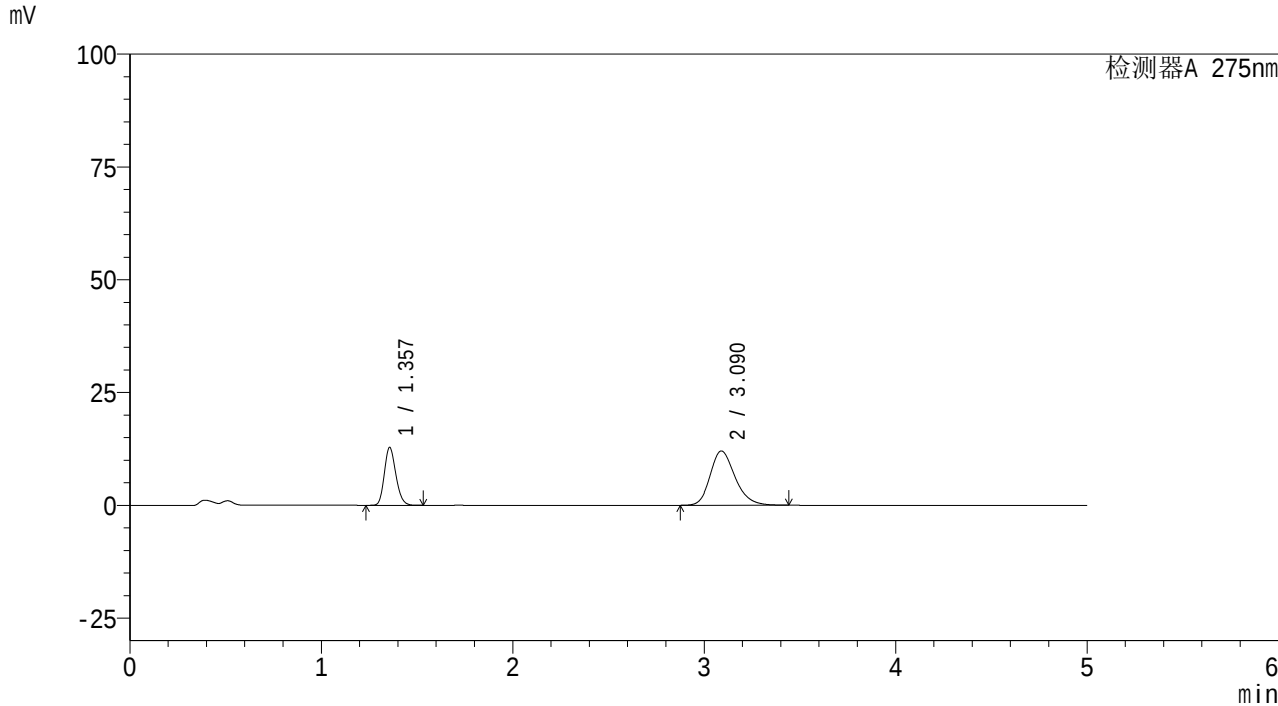

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	53406	32.885	12811	2451	1.182	--
2	3.090	108997	67.115	12036	2786	1.221	10.084
总计		162403	100.000	24847			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-918-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 01:20:05

处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

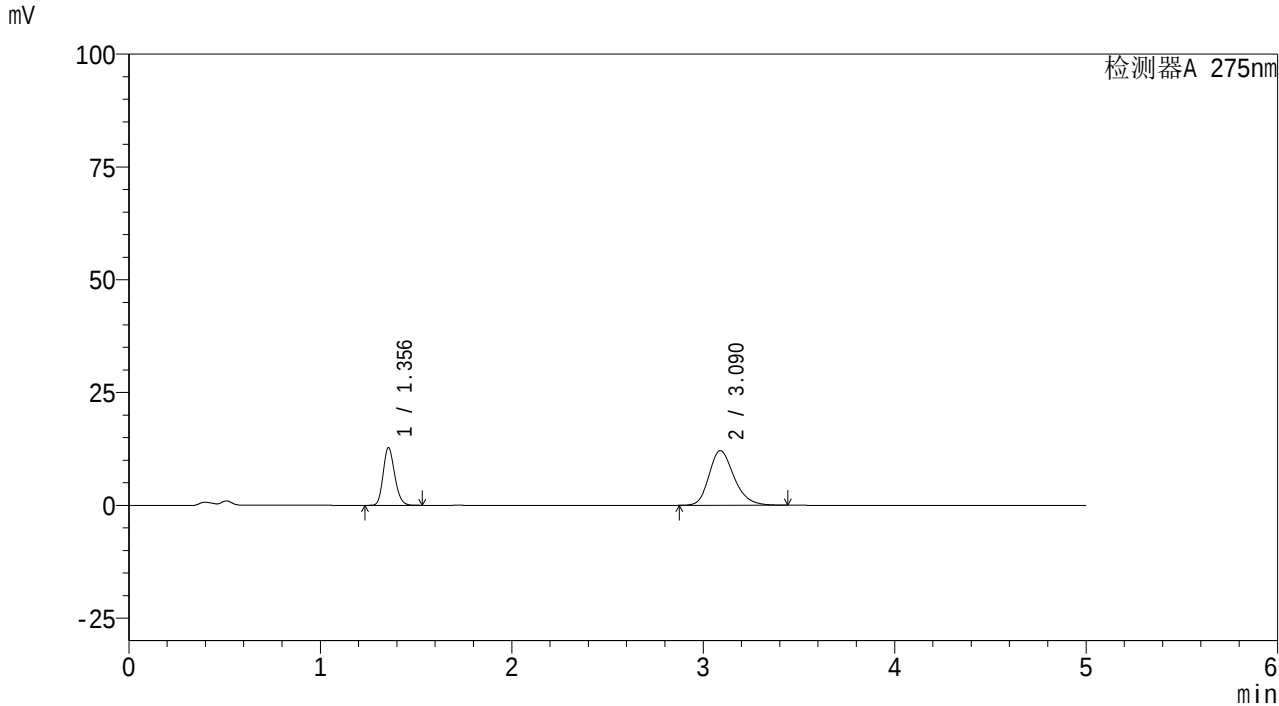

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	53196	32.676	12778	2445	1.181	--
2	3.090	109601	67.324	12109	2783	1.222	10.084
总计		162797	100.000	24887			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-919-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:25:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

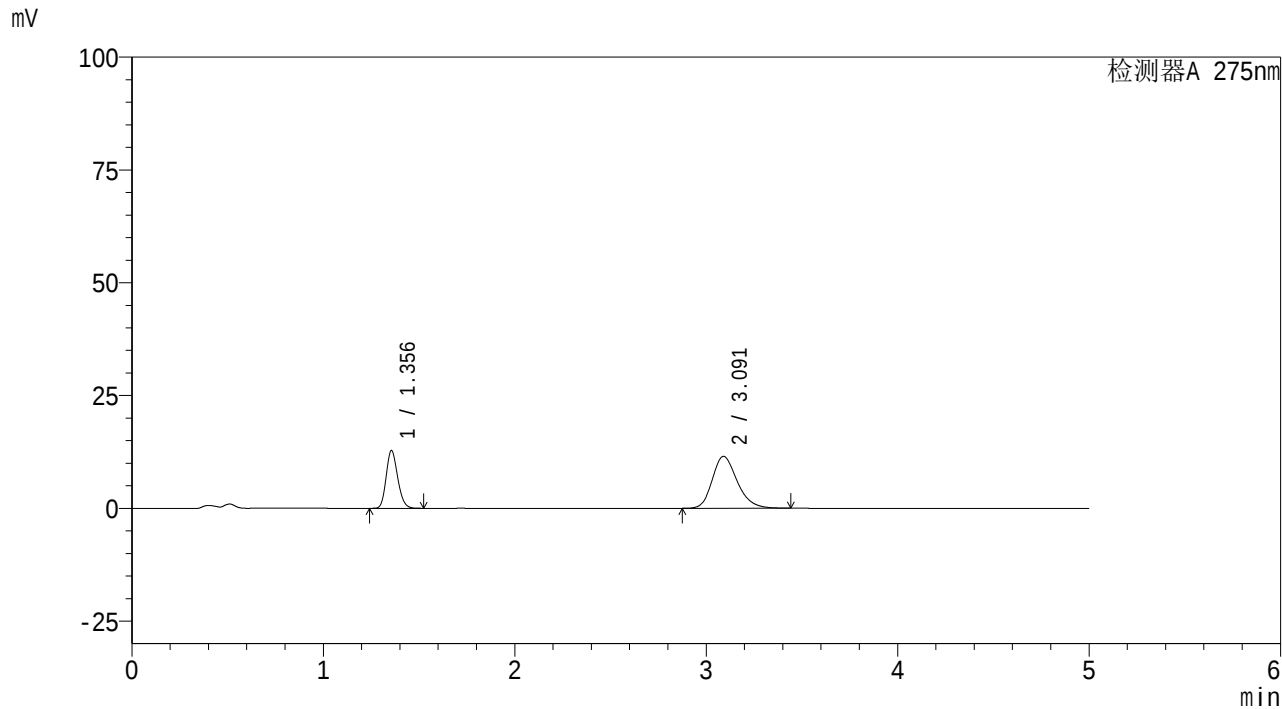

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	53324	33.862	12814	2444	1.181	--
2	3.091	104153	66.138	11489	2781	1.219	10.084
总计		157477	100.000	24303			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-32/27-920-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:30:51
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

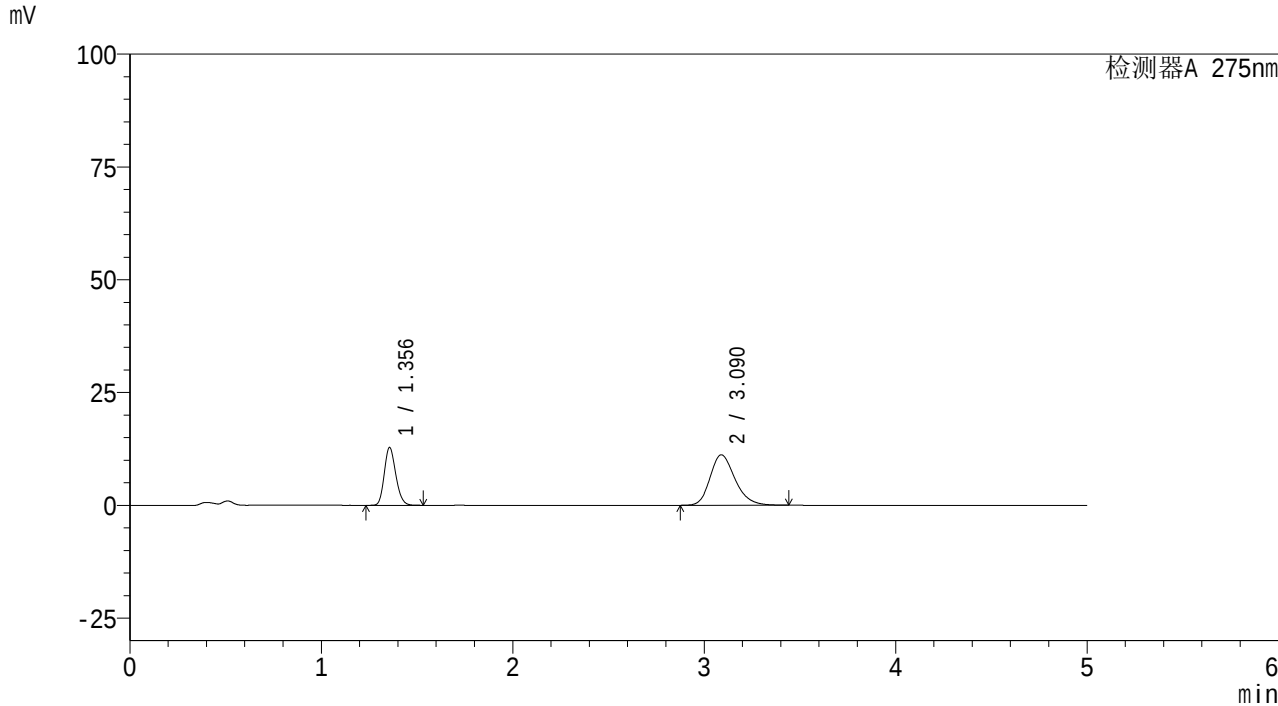

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	53328	34.472	12823	2451	1.182	--
2	3.090	101373	65.528	11188	2778	1.220	10.078
总计		154701	100.000	24011			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-29/27-921-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:36:15
处理时间(V2): 2026/05/15 17:19:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

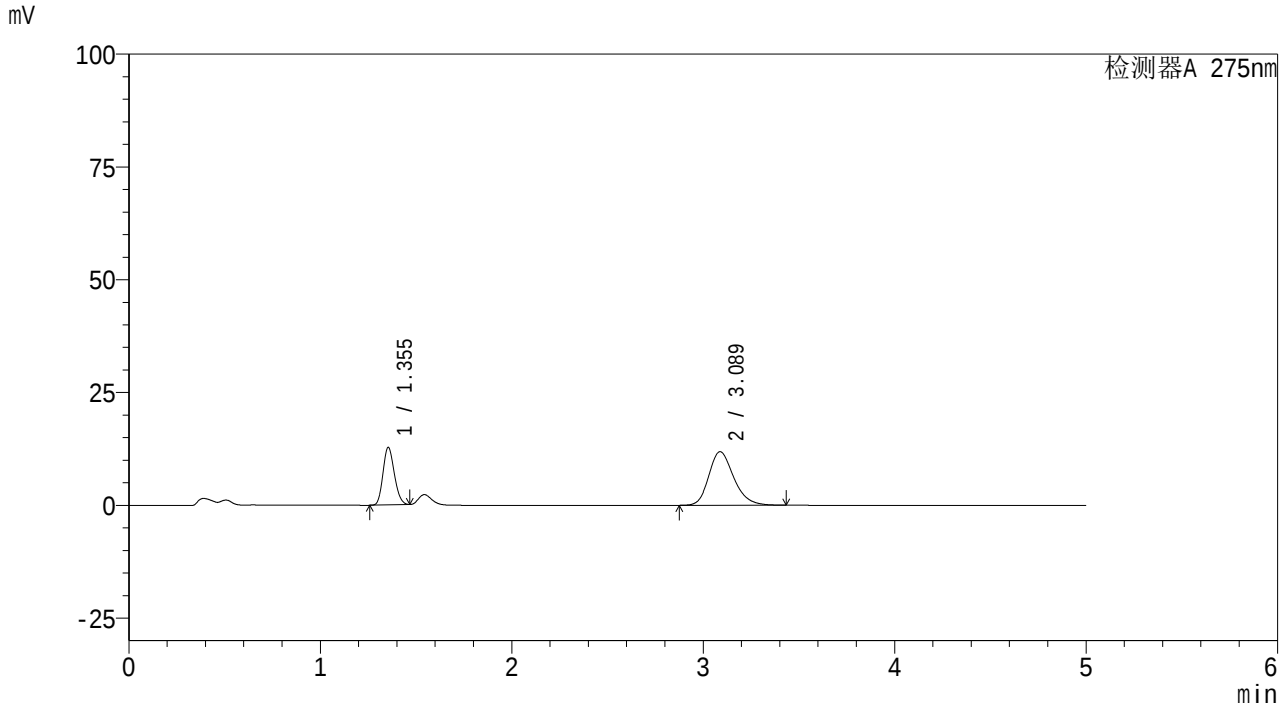

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	52310	32.762	12771	2475	1.159	--
2	3.089	107358	67.238	11879	2788	1.220	10.114
总计		159668	100.000	24650			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-922-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:41:38
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

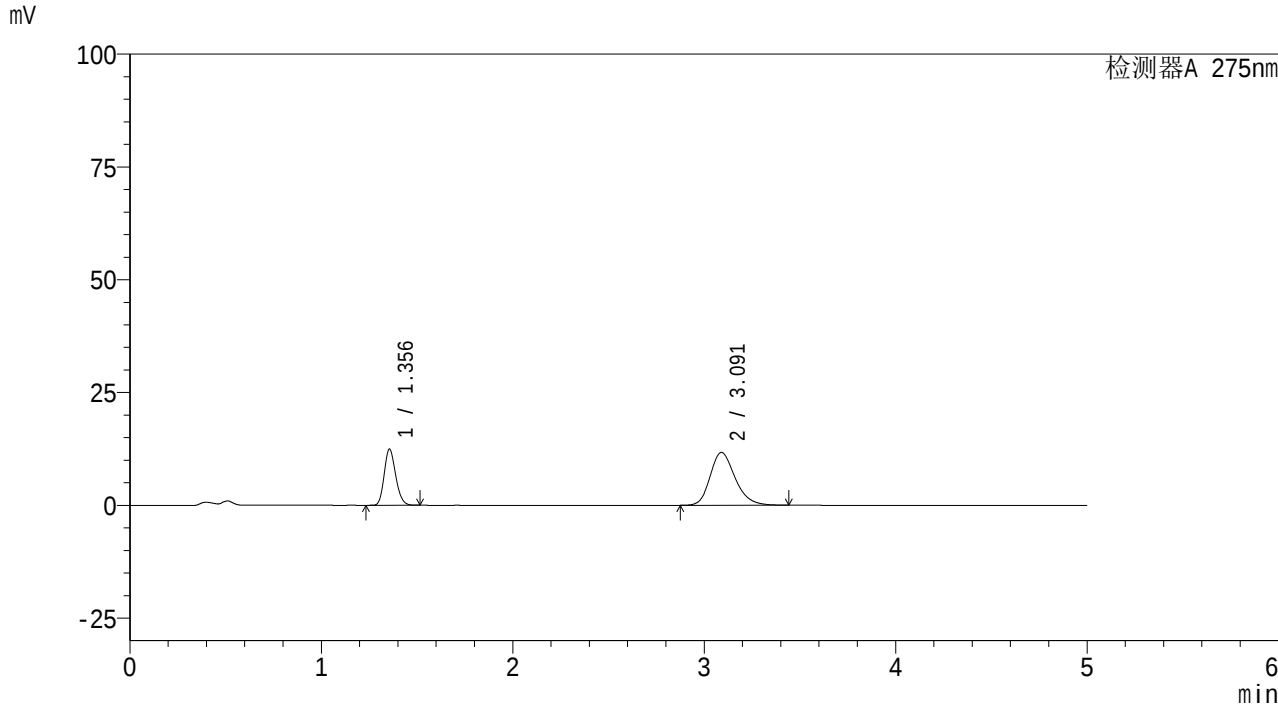

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	51724	32.803	12446	2449	1.182	--
2	3.091	105958	67.197	11699	2784	1.220	10.089
总计		157681	100.000	24145			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-923-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:47:01
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

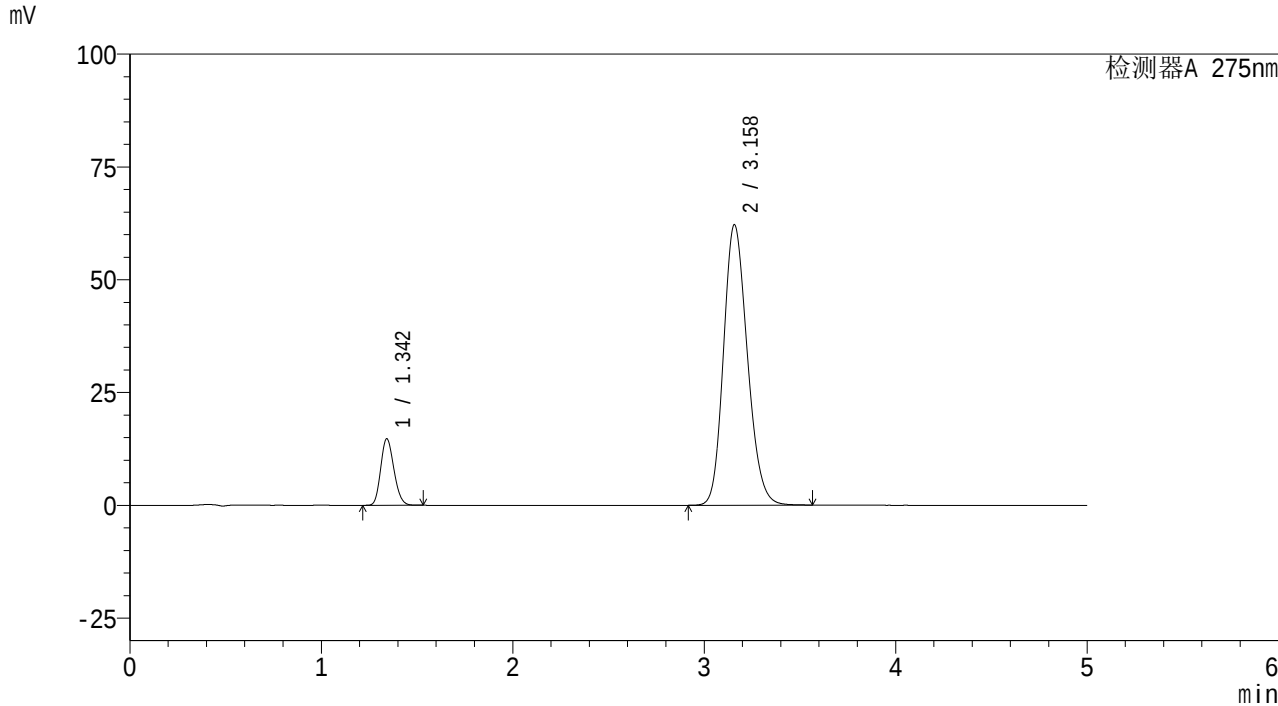

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	70527	11.620	14680	1803	1.175	--
2	3.158	536422	88.380	62089	3115	1.184	10.299
总计		606949	100.000	76769			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-924-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:52:25
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

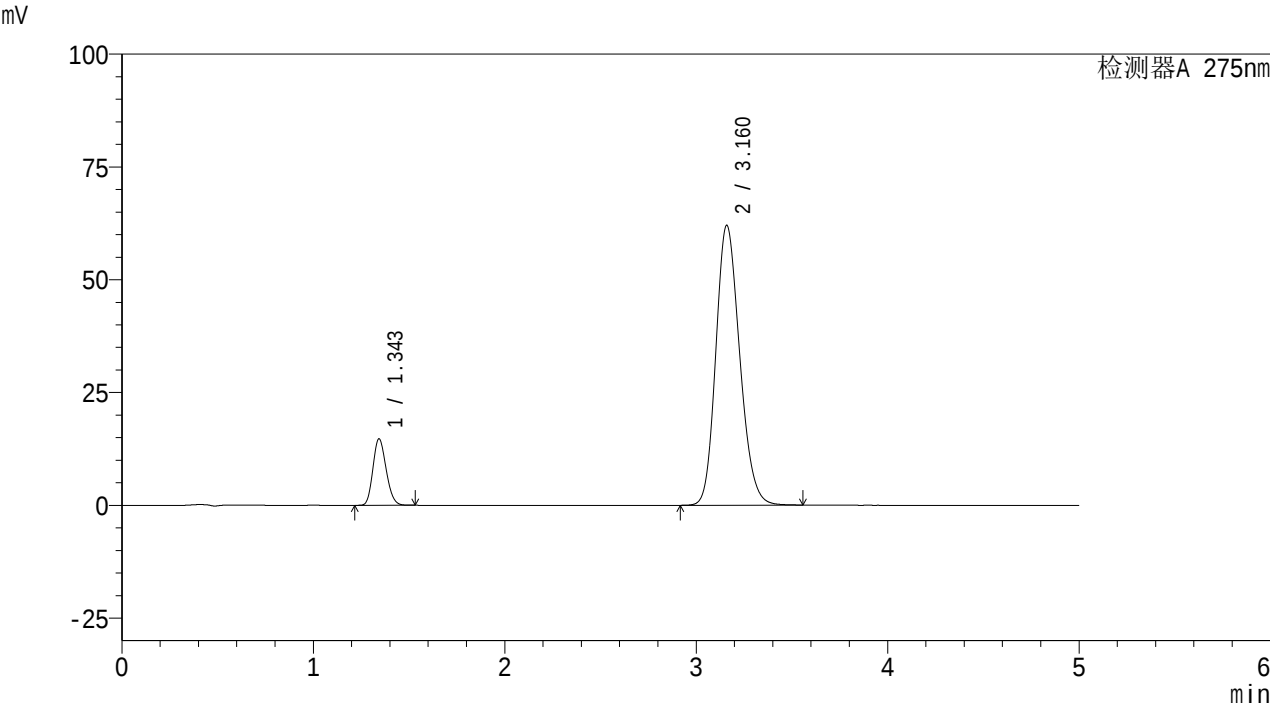

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	70533	11.641	14634	1800	1.176	--
2	3.160	535366	88.359	61934	3116	1.184	10.293
总计		605899	100.000	76568			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-925-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 01:57:50
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

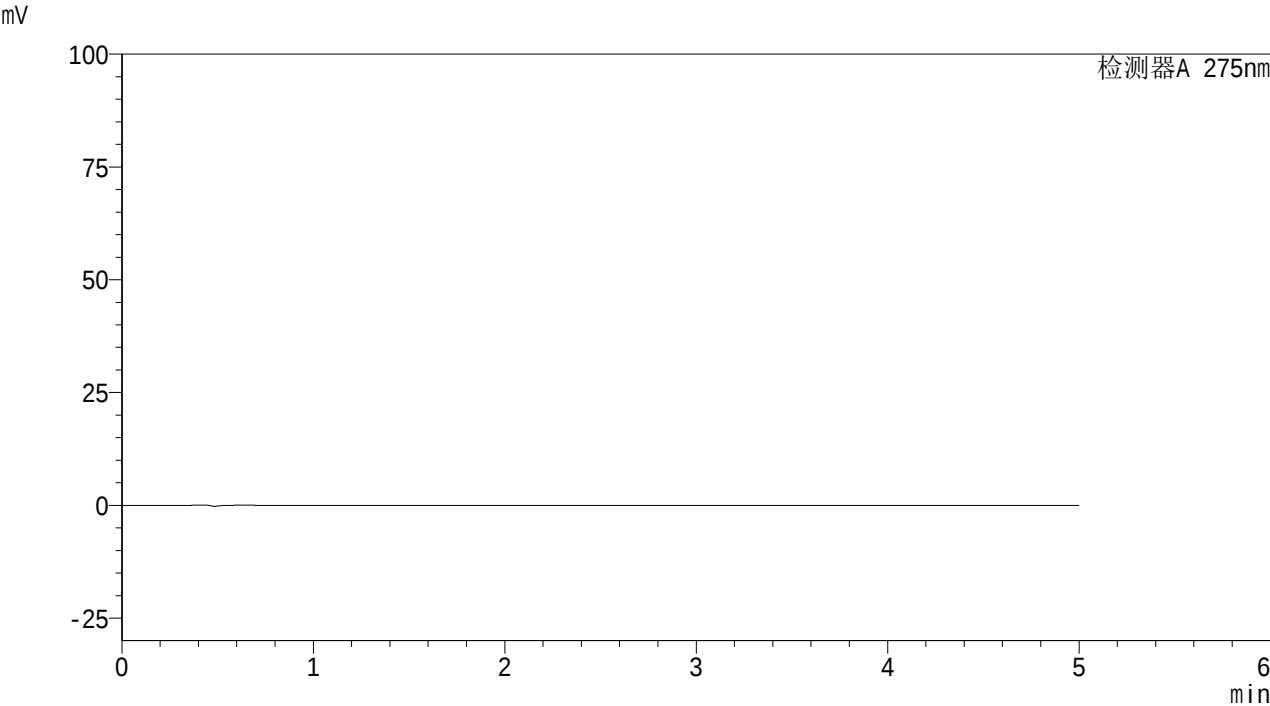

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-926-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 02:03:15

处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

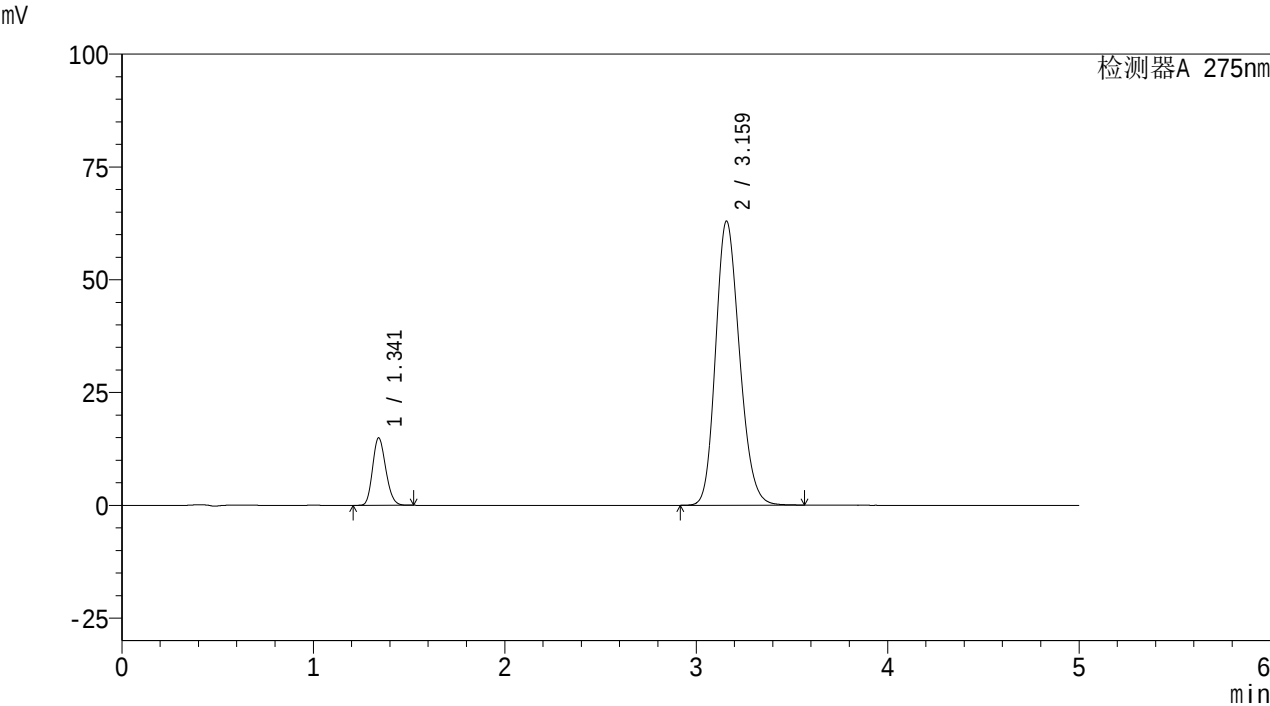

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	71162	11.577	14900	1813	1.175	--
2	3.159	543540	88.423	62861	3116	1.184	10.317
总计		614702	100.000	77761			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-927-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:08:39
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

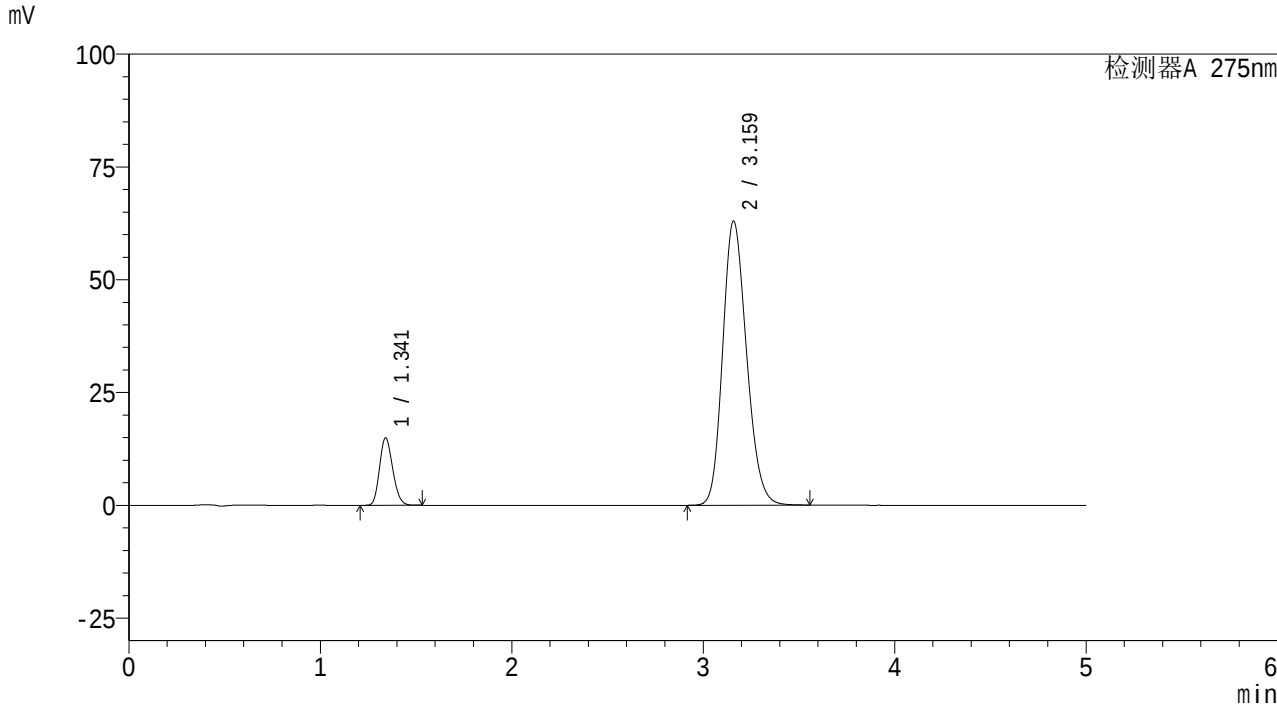

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	71310	11.599	14930	1808	1.178	--
2	3.159	543475	88.401	62837	3117	1.185	10.318
总计		614785	100.000	77767			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-928-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:14:04
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

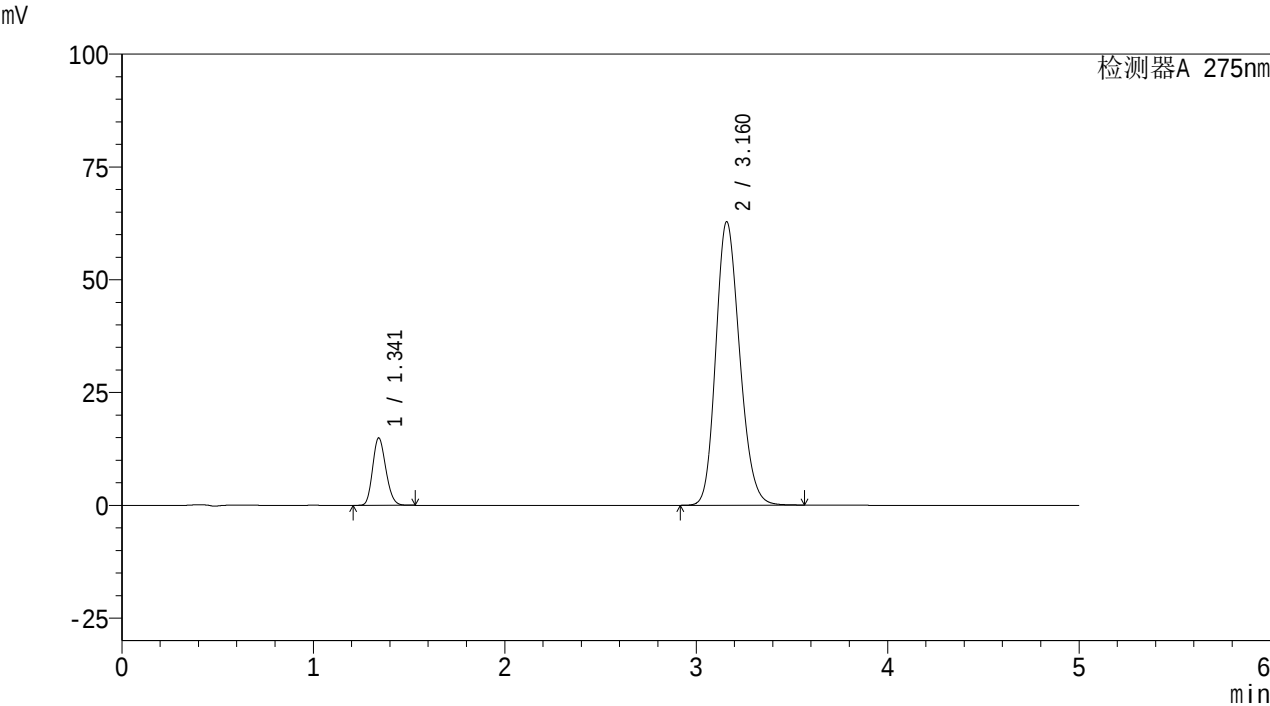

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	71296	11.630	14876	1807	1.175	--
2	3.160	541749	88.370	62728	3123	1.183	10.321
总计		613045	100.000	77604			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-929-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:19:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

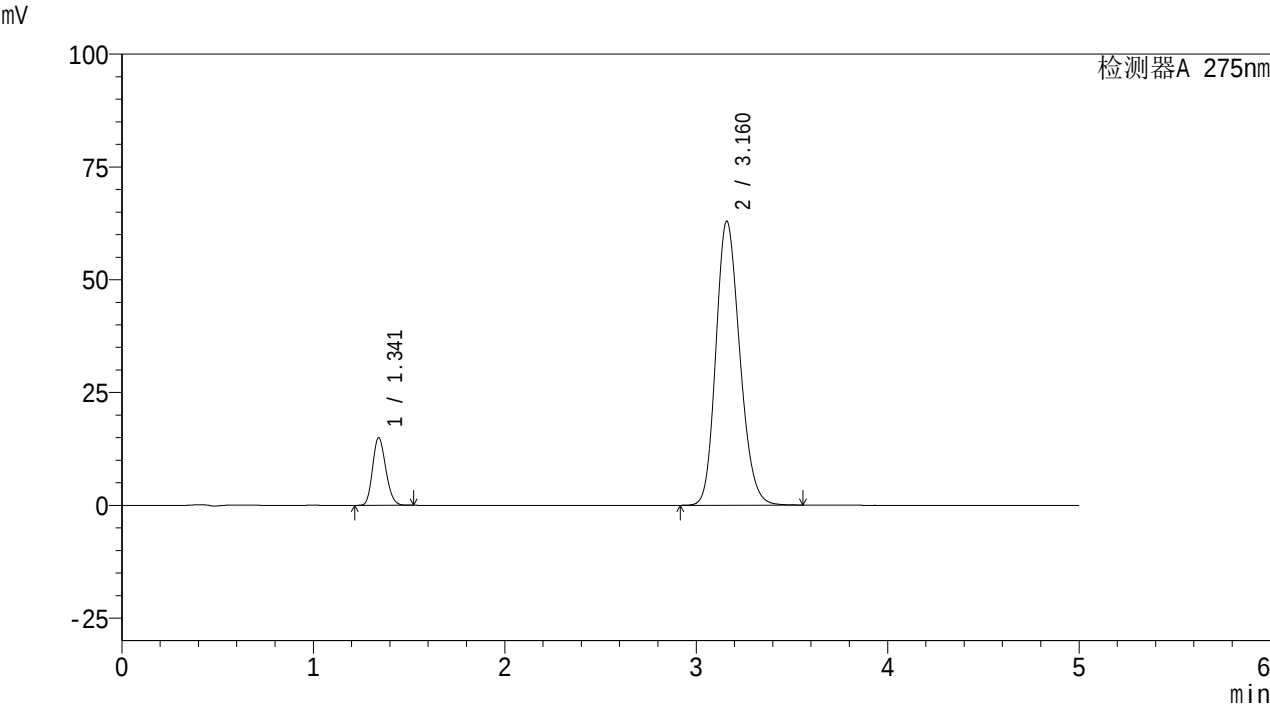

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	71437	11.615	14938	1810	1.175	--
2	3.160	543583	88.385	62883	3115	1.184	10.318
总计		615020	100.000	77821			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-930-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 02:24:55

处理时间(V2): 2026/05/15 17:22:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

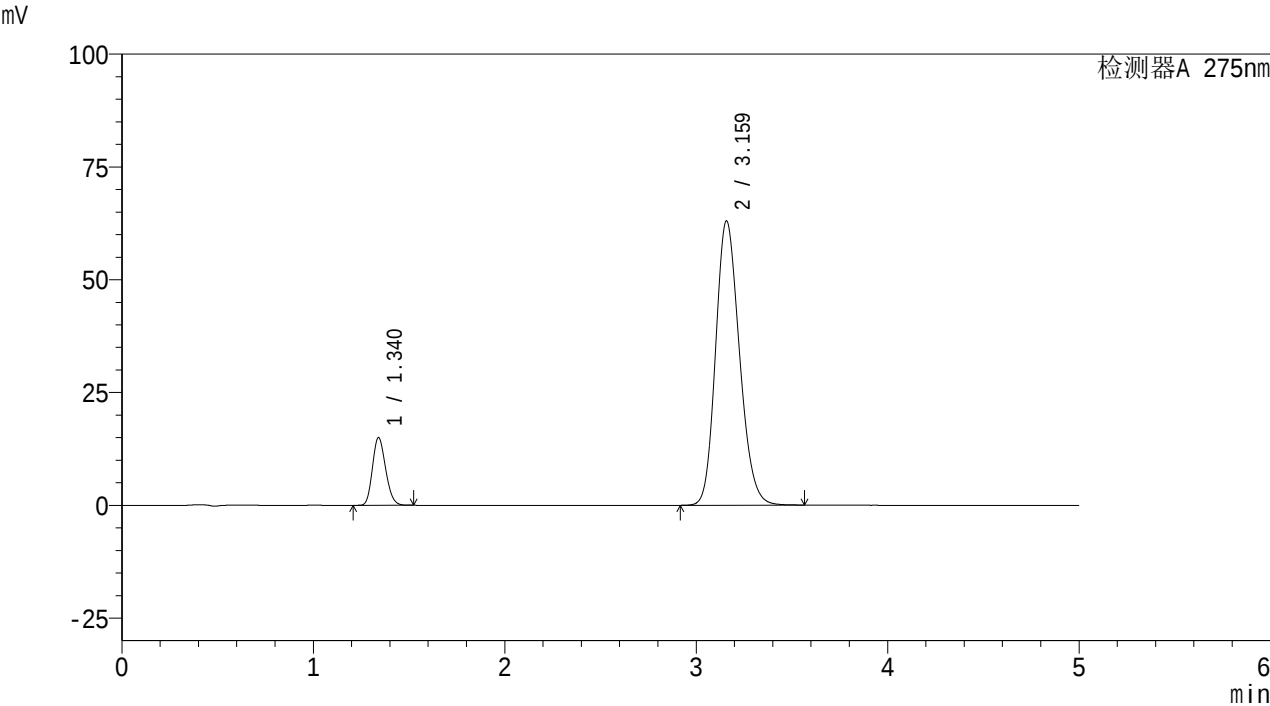

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	71540	11.637	14993	1809	1.177	--
2	3.159	543201	88.363	62891	3122	1.184	10.326
总计		614741	100.000	77884			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-931-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:30:18
处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

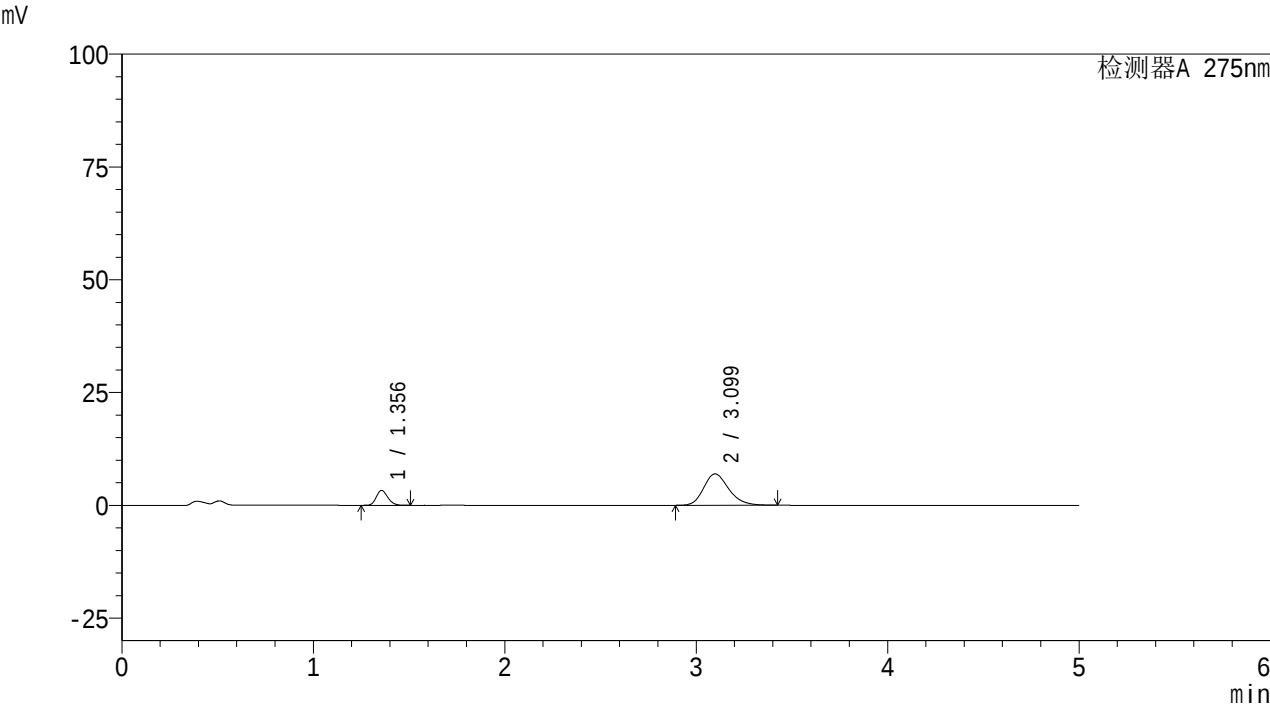

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	13752	17.836	3304	2446	1.178	--
2	3.099	63352	82.164	6955	2761	1.207	10.084
总计		77104	100.000	10260			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-33/27-932-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:35:42
处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

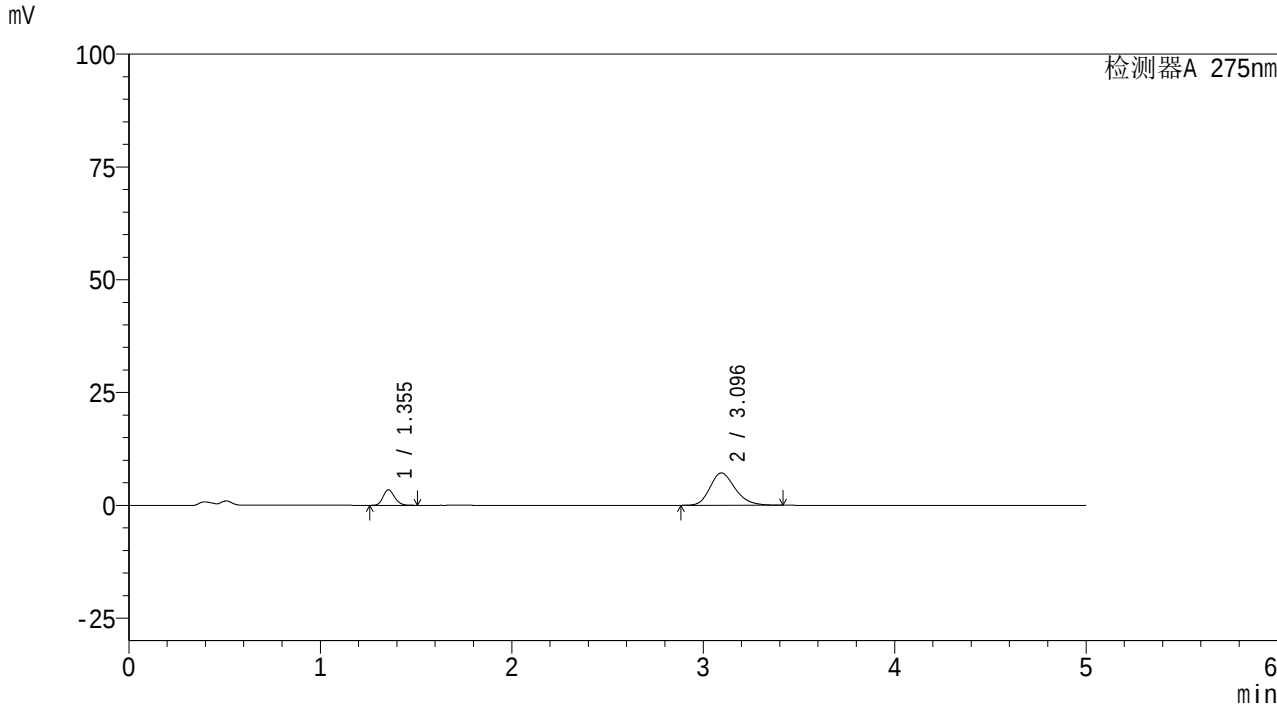

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	14254	17.917	3431	2446	1.181	--
2	3.096	65302	82.083	7167	2748	1.209	10.065
总计		79557	100.000	10598			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-31/27-933-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:41:05
处理时间(V2): 2026/05/15 17:21:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

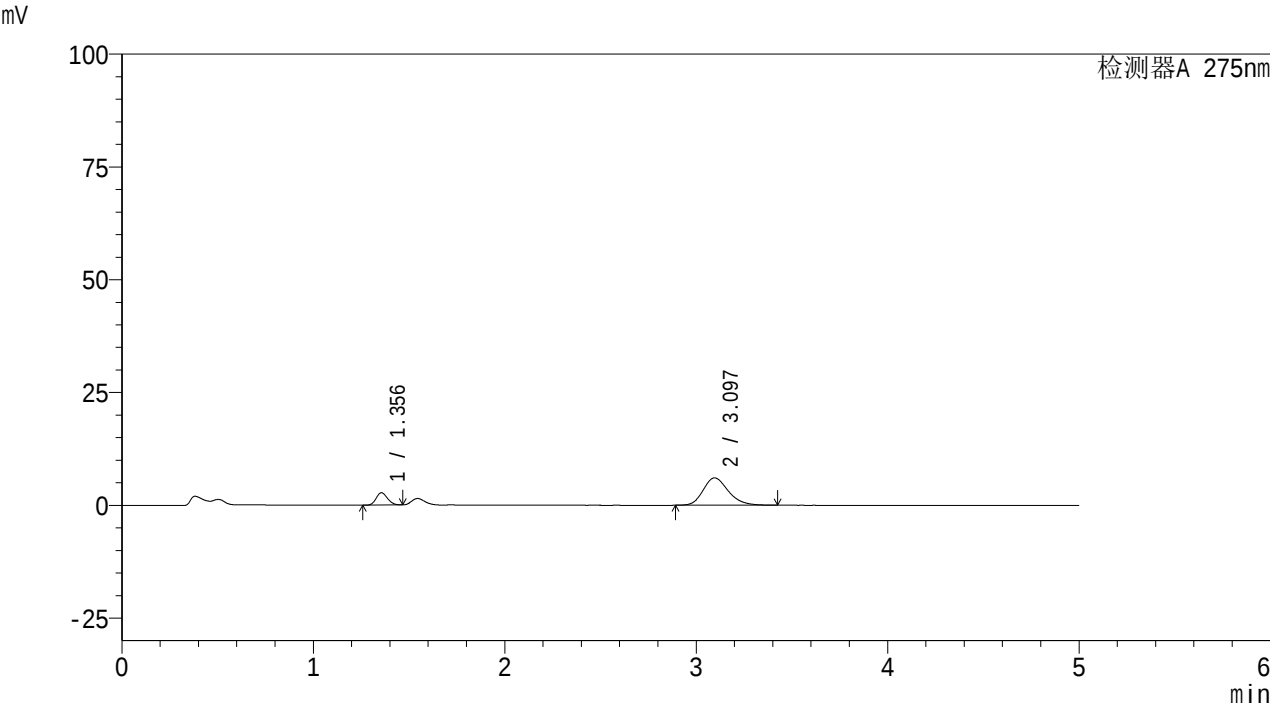

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	11143	16.750	2732	2481	1.148	--
2	3.097	55385	83.250	6066	2728	1.206	10.063
总计		66528	100.000	8798			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-34/27-934-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:46:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

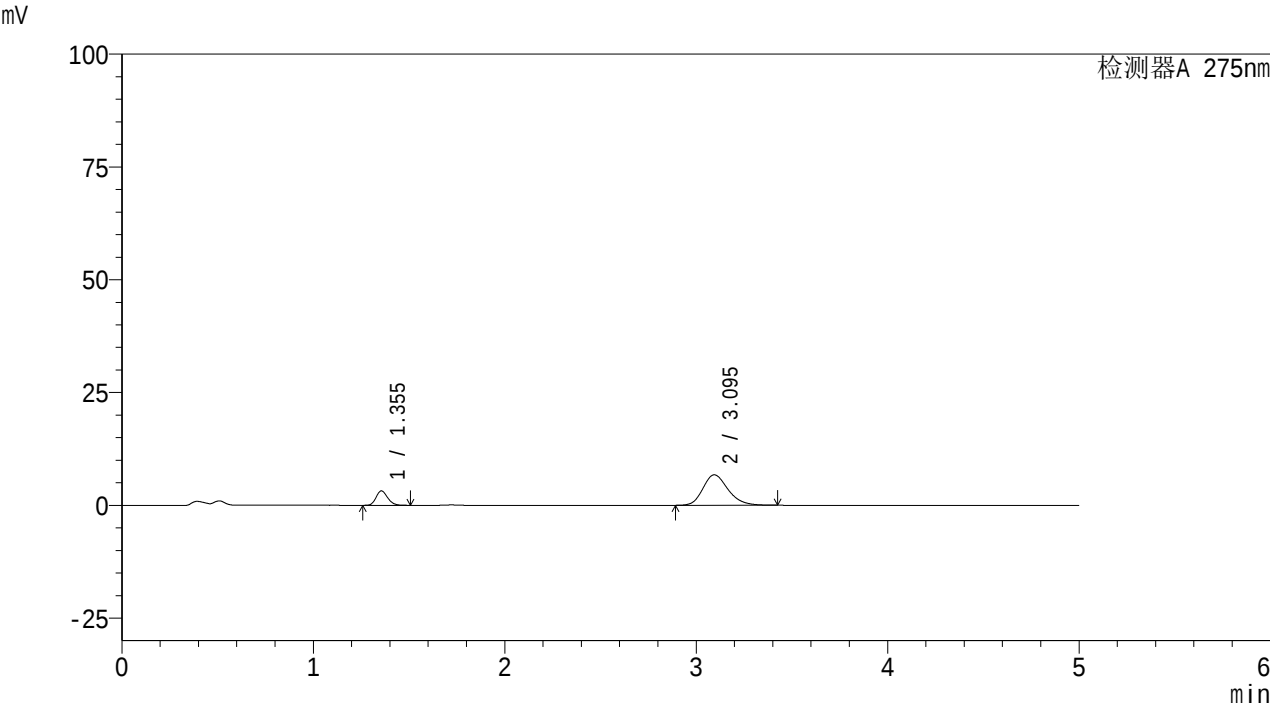

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	13300	17.767	3203	2447	1.178	--
2	3.095	61561	82.233	6751	2741	1.209	10.055
总计		74861	100.000	9954			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-34/27-935-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 02:51:54
处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

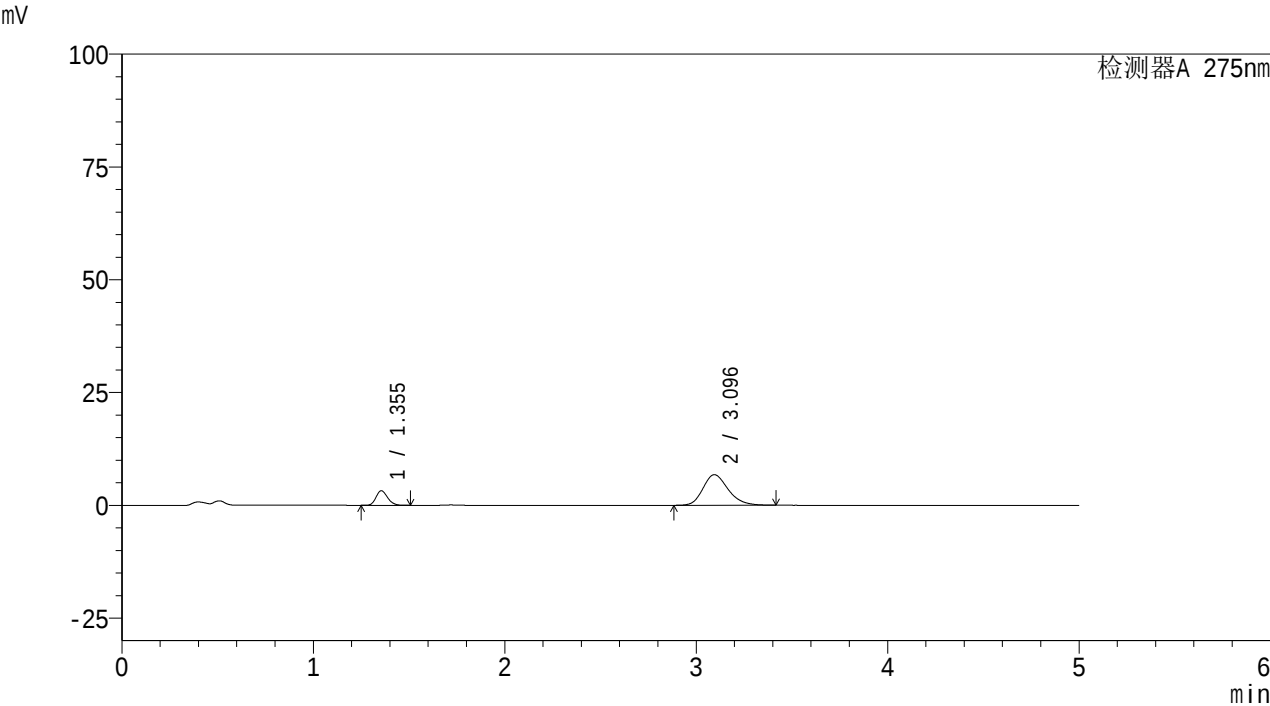

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	13464	17.843	3236	2441	1.179	--
2	3.096	61993	82.157	6785	2735	1.210	10.047
总计		75456	100.000	10021			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-34/27-936-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 02:57:18

处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

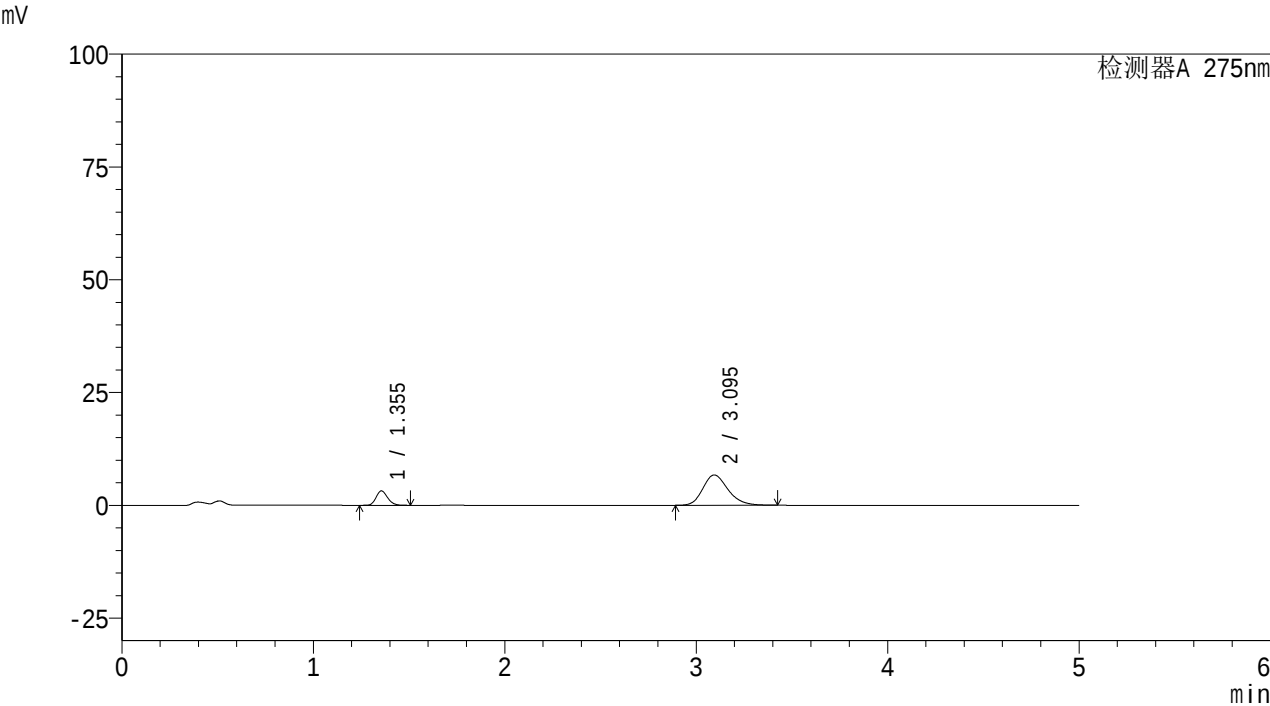

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	13290	17.814	3196	2447	1.178	--
2	3.095	61315	82.186	6724	2744	1.208	10.058
总计		74605	100.000	9919			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-34/27-937-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:02:42
处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

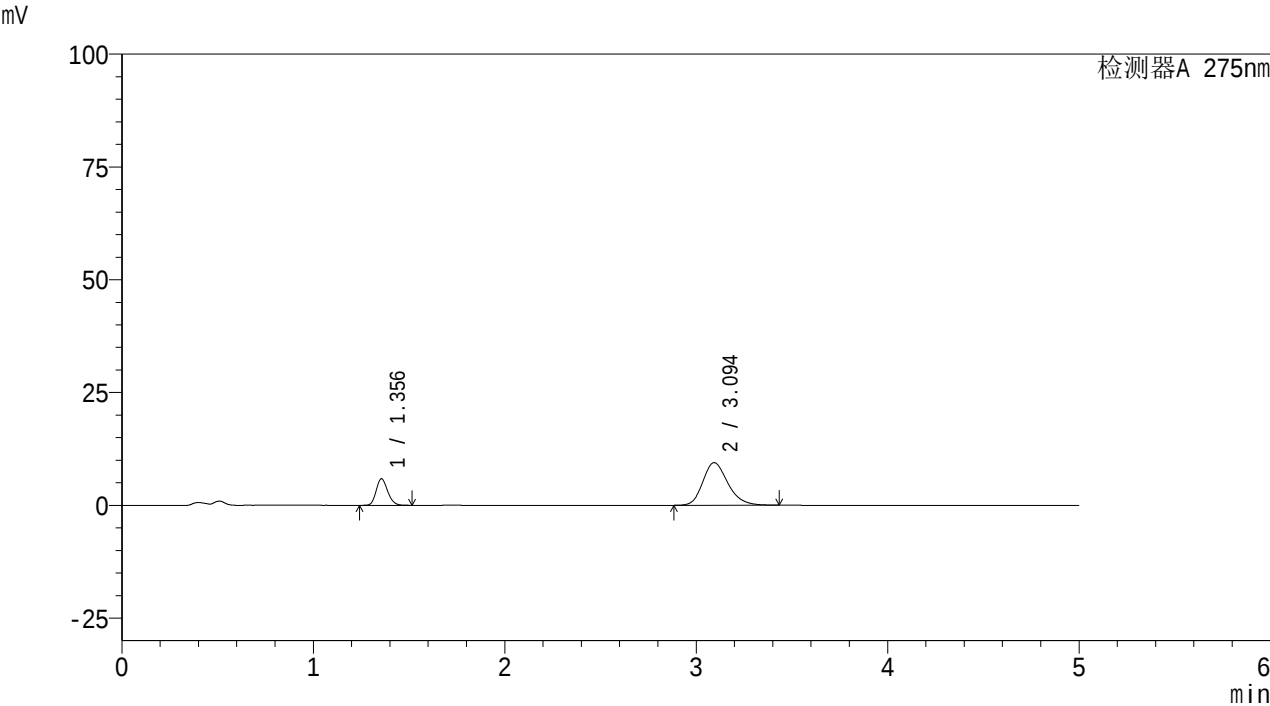

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	24447	22.172	5879	2445	1.179	--
2	3.094	85815	77.828	9439	2767	1.213	10.080
总计		110262	100.000	15318			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-34/27-938-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:08:05

处理时间(V2): 2026/05/15 17:23:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

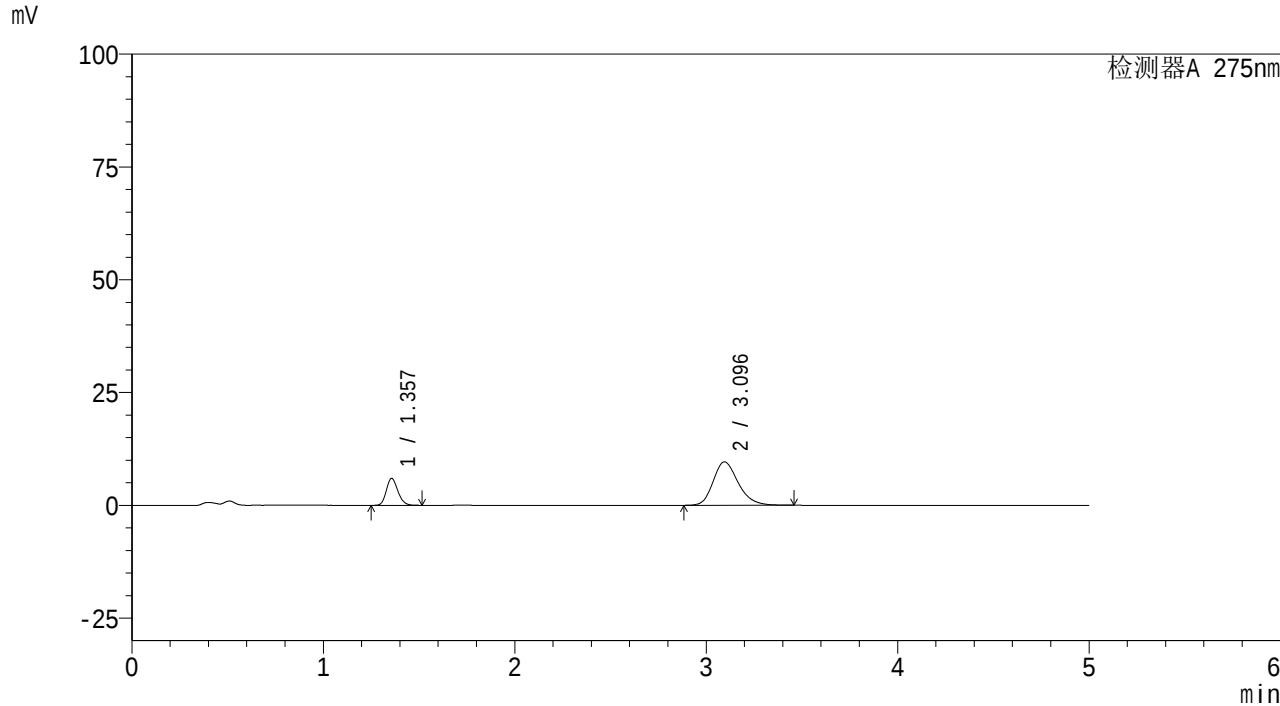

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	24904	22.136	5975	2451	1.182	--
2	3.096	87601	77.864	9628	2765	1.217	10.080
总计		112505	100.000	15604			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-30/27-939-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:13:29

处理时间(V2): 2026/05/15 17:20:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

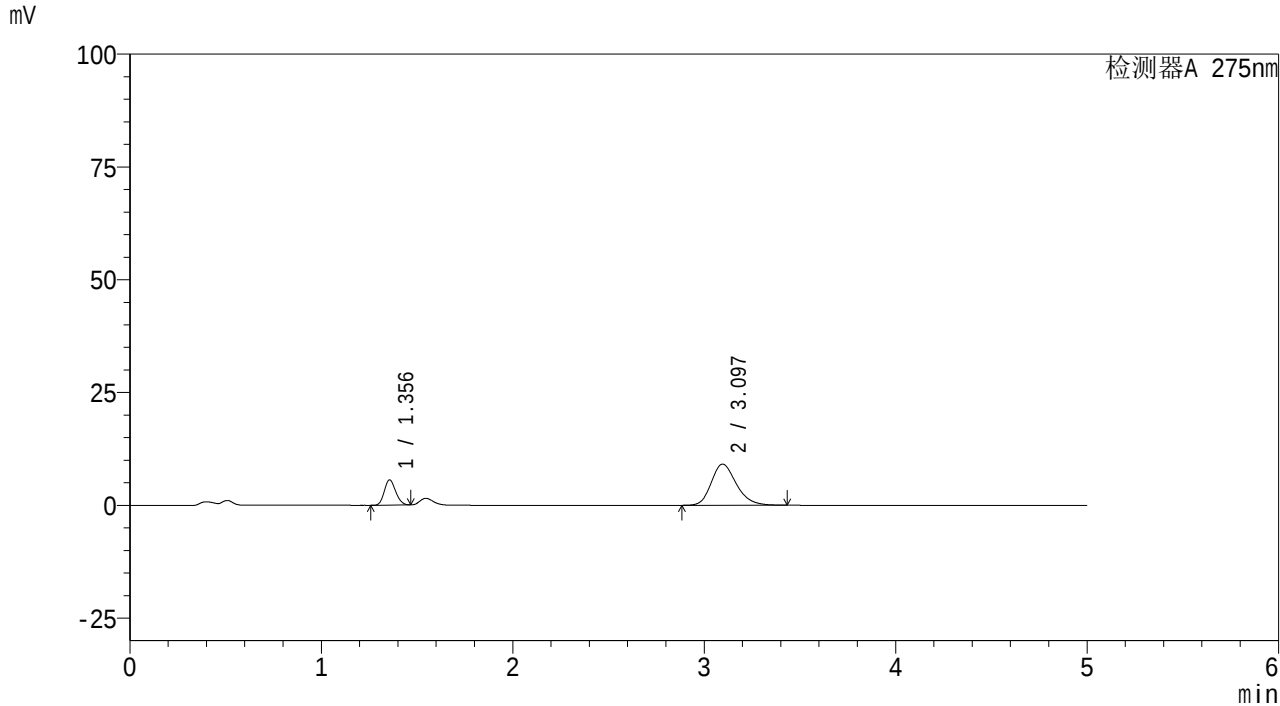

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	22968	21.678	5598	2474	1.156	--
2	3.097	82981	78.322	9130	2765	1.215	10.100
总计		105949	100.000	14729			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-940-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:18:53

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

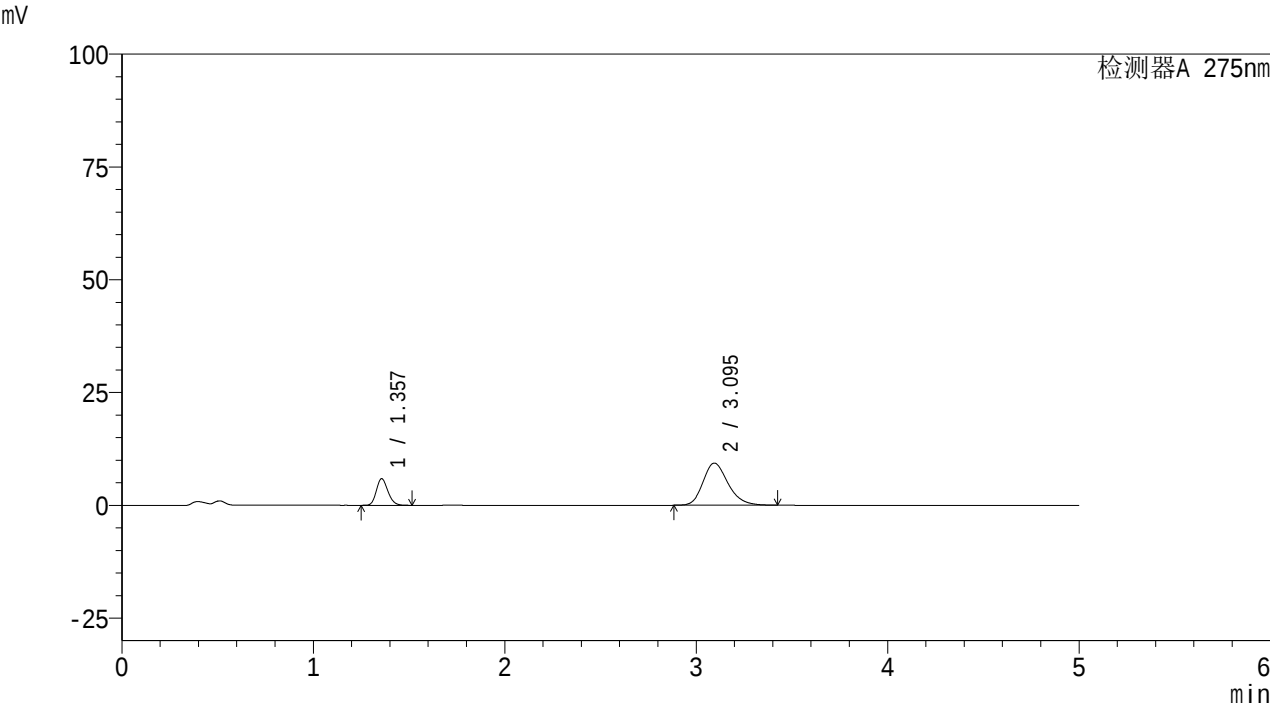

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	24577	22.478	5898	2453	1.183	--
2	3.095	84760	77.522	9344	2769	1.214	10.083
总计		109337	100.000	15243			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-941-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:24:17

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

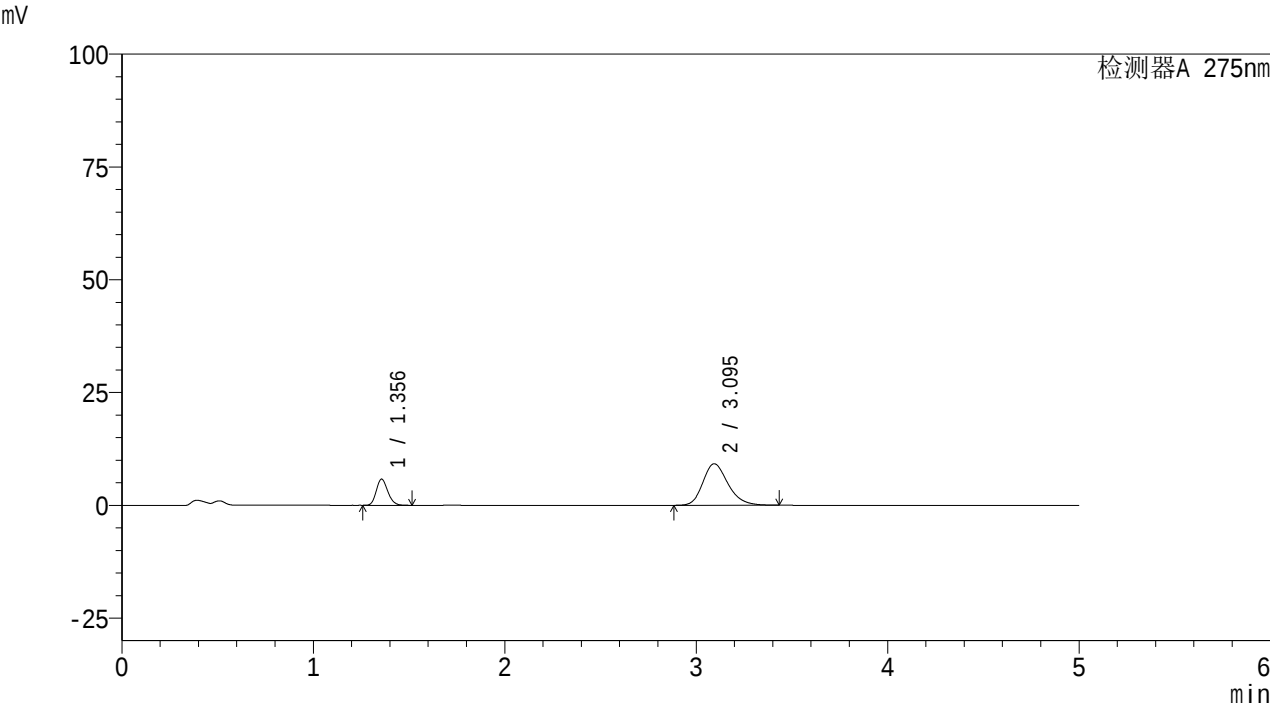

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	24115	22.344	5797	2449	1.183	--
2	3.095	83813	77.656	9195	2754	1.218	10.063
总计		107928	100.000	14992			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-942-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:29:40
处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

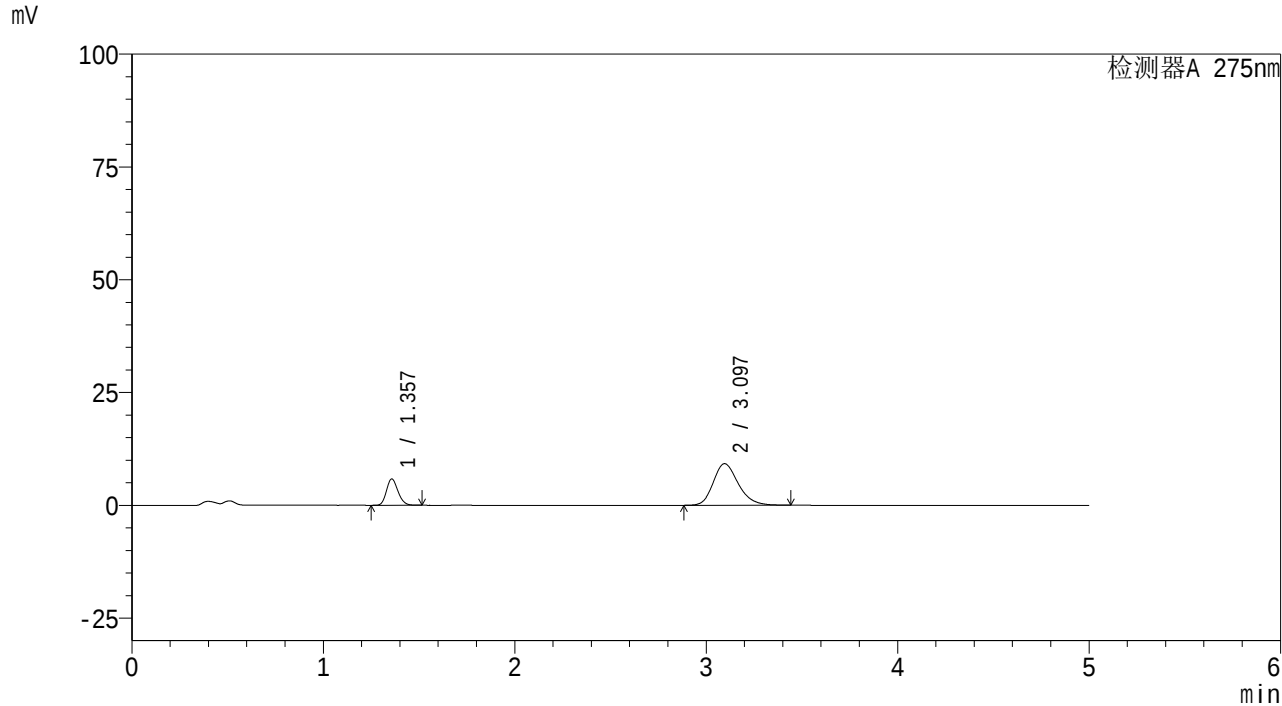

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	24329	22.516	5826	2450	1.181	--
2	3.097	83722	77.484	9219	2776	1.212	10.089
总计		108051	100.000	15046			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-943-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:35:05
处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

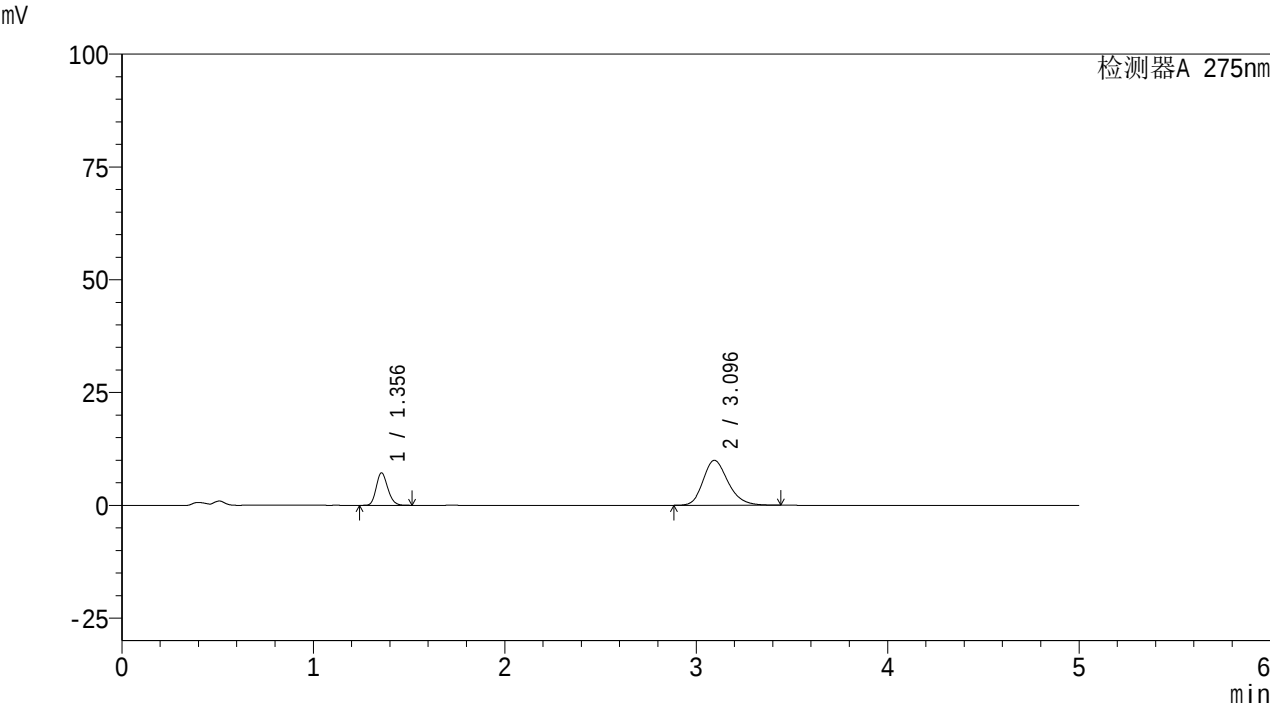

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	29974	24.914	7203	2447	1.182	--
2	3.096	90337	75.086	9952	2774	1.214	10.093
总计		120311	100.000	17156			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-944-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:40:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

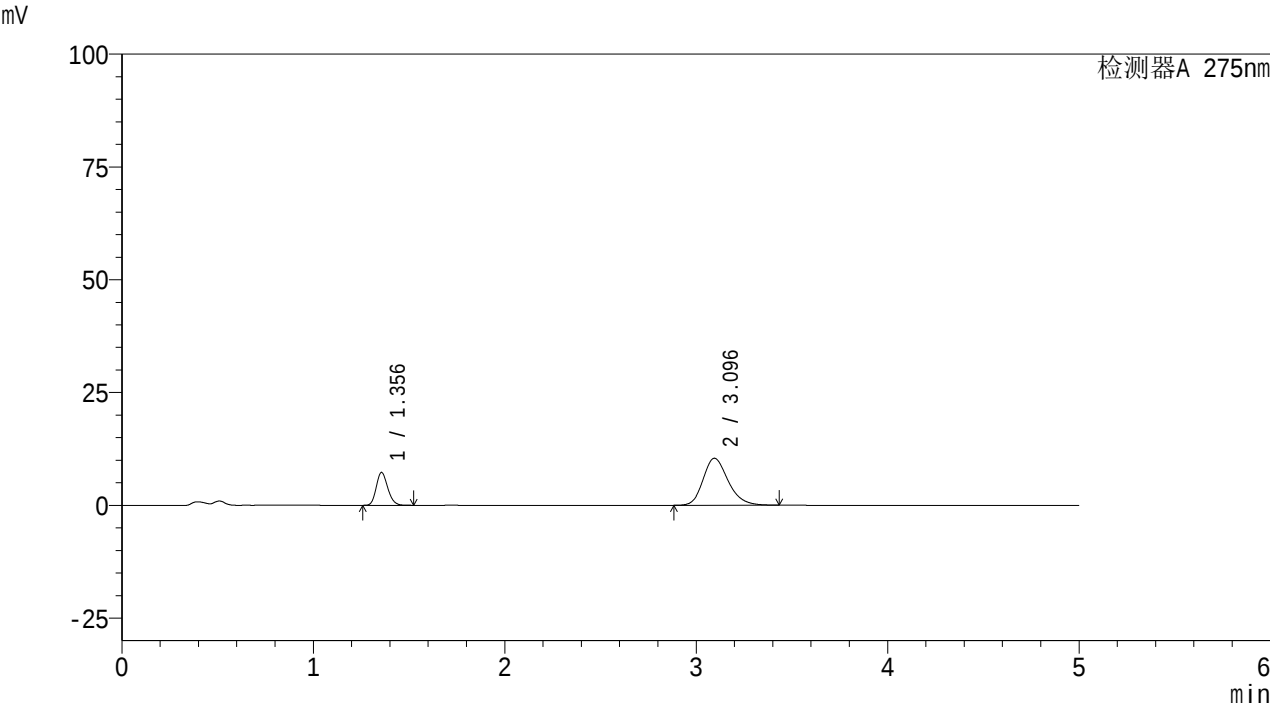

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	30285	24.260	7283	2450	1.180	--
2	3.096	94548	75.740	10418	2768	1.214	10.087
总计		124833	100.000	17701			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-945-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:45:53

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

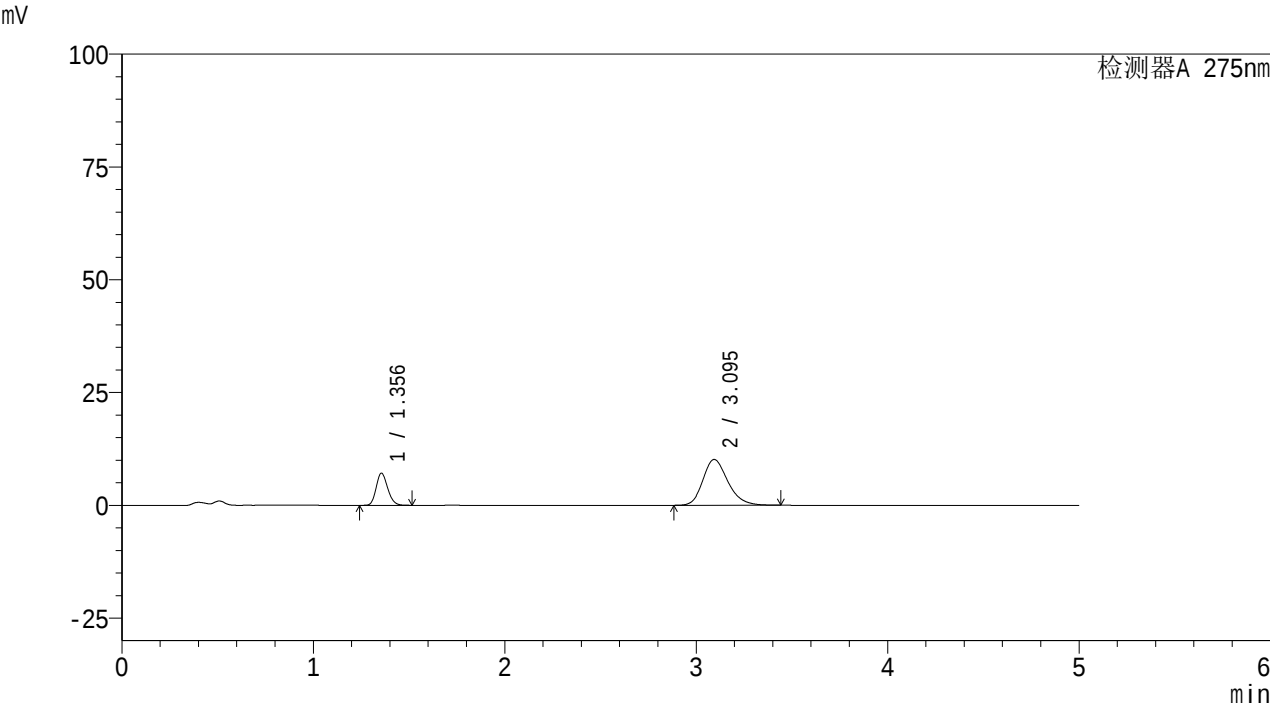

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	29666	24.349	7131	2445	1.180	--
2	3.095	92167	75.651	10148	2772	1.217	10.087
总计		121833	100.000	17280			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-946-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 03:51:17

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

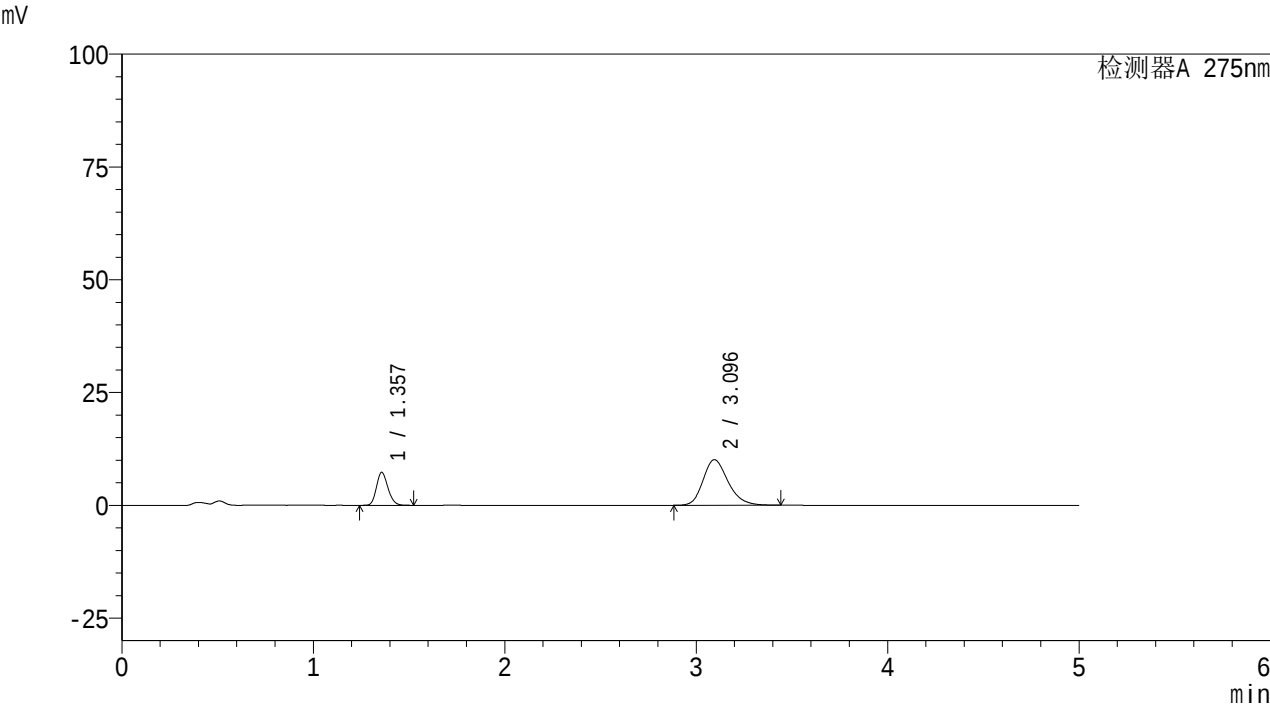

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	30400	24.902	7288	2456	1.183	--
2	3.096	91679	75.098	10094	2773	1.217	10.087
总计		122079	100.000	17383			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-947-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 03:56:41
处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

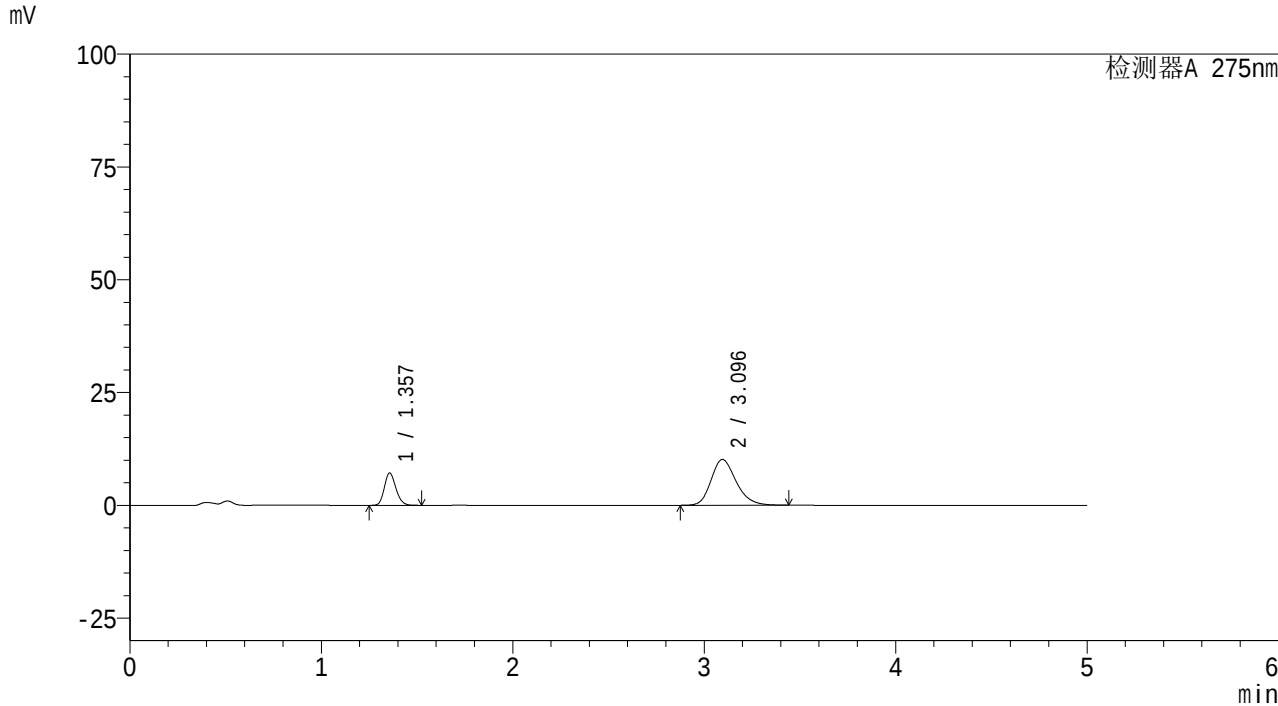

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	29885	24.459	7172	2453	1.181	--
2	3.096	92301	75.541	10154	2769	1.214	10.084
总计		122186	100.000	17327			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-948-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:02:05
处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

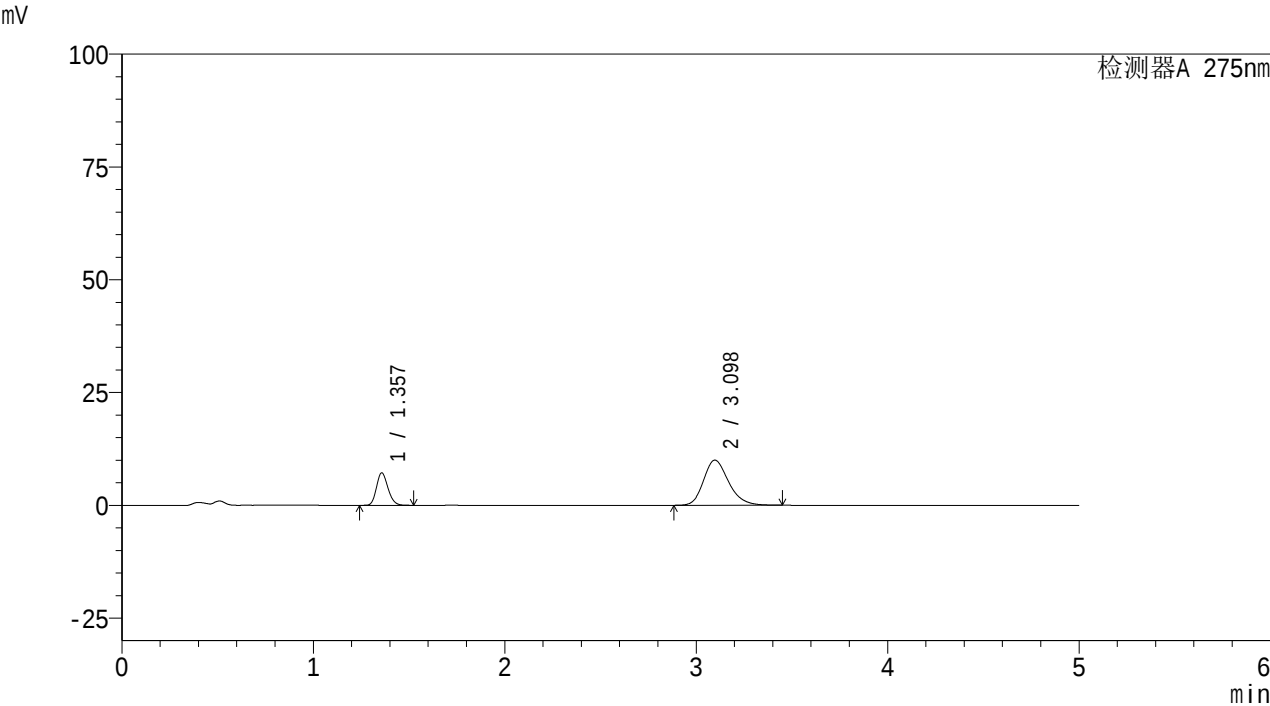

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	29991	24.798	7185	2453	1.183	--
2	3.098	90947	75.202	10003	2773	1.217	10.094
总计		120937	100.000	17188			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-949-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:07:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

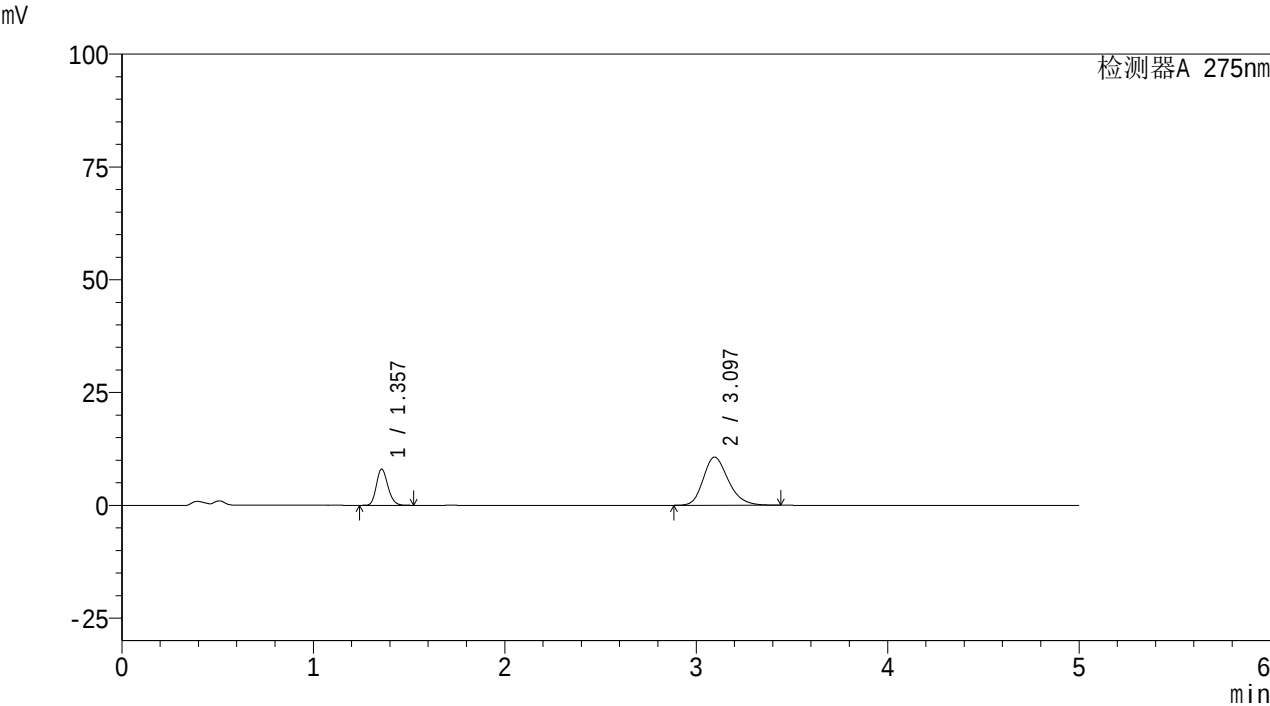

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33461	25.644	8036	2456	1.182	--
2	3.097	97023	74.356	10685	2775	1.218	10.097
总计		130484	100.000	18721			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-950-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:12:54

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

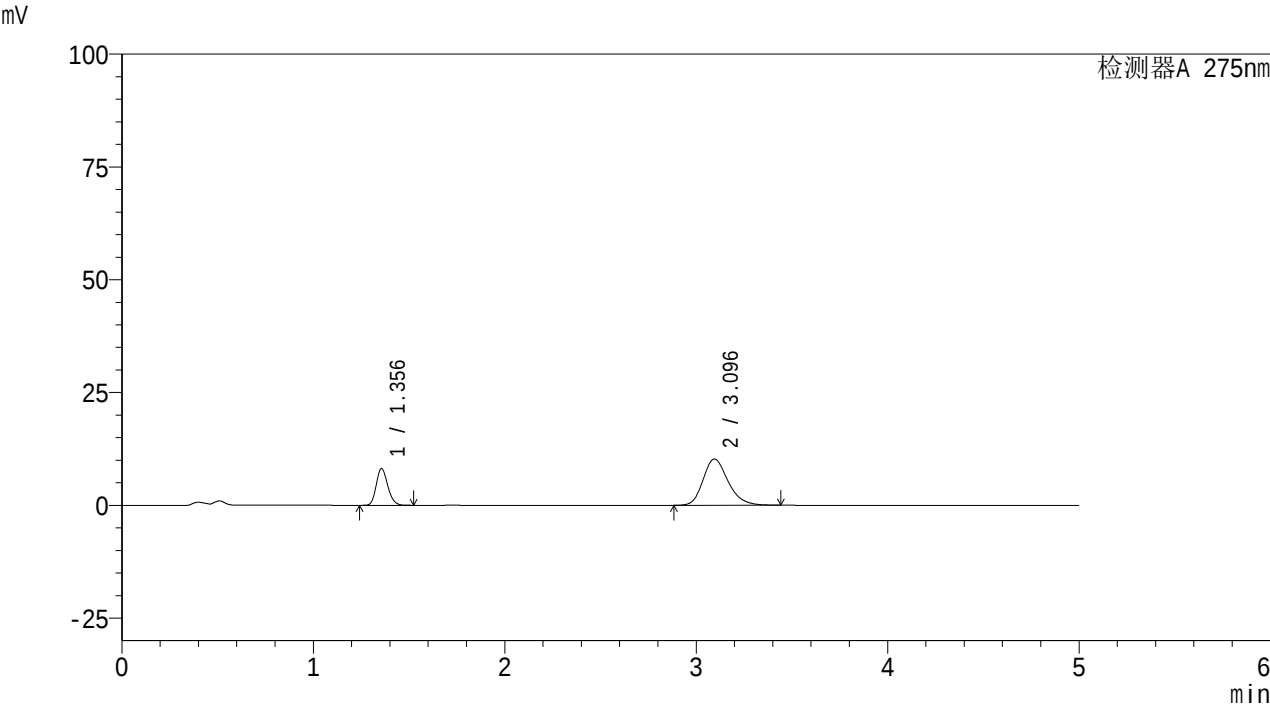

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	33894	26.719	8141	2446	1.181	--
2	3.096	92959	73.281	10250	2783	1.215	10.102
总计		126853	100.000	18391			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-951-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:18:19

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

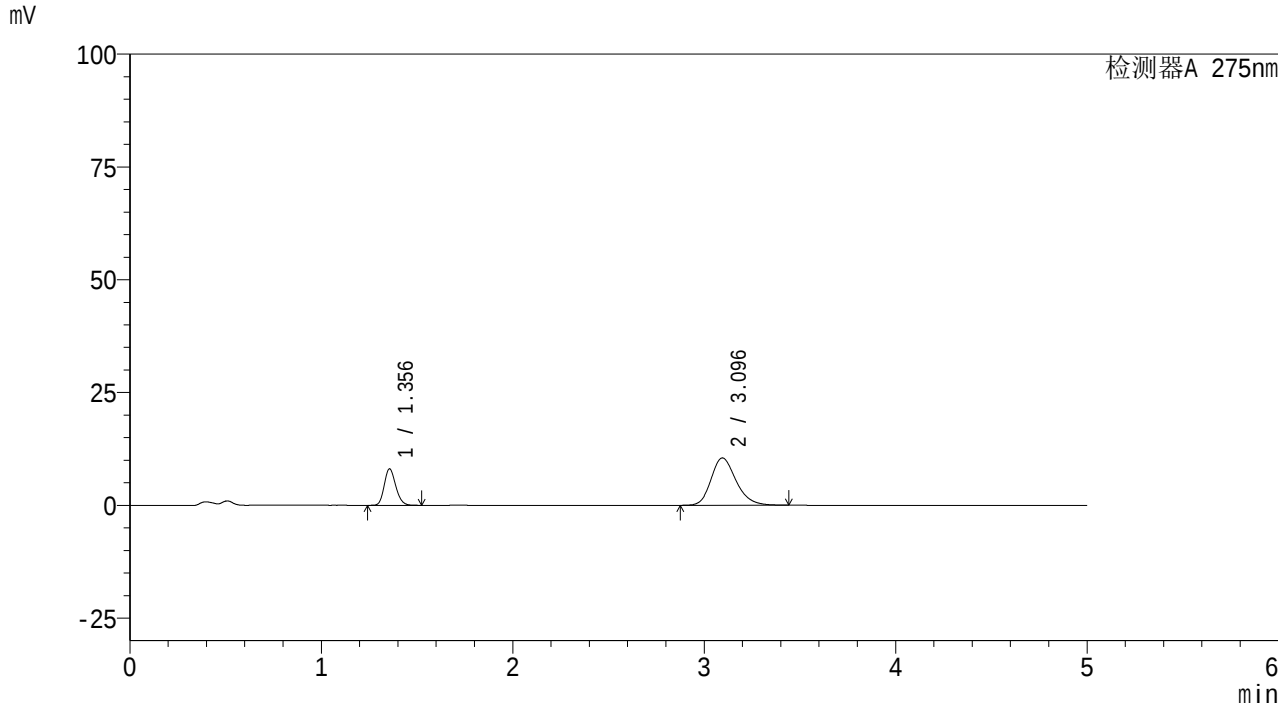

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	33622	26.084	8080	2449	1.181	--
2	3.096	95278	73.916	10494	2781	1.214	10.101
总计		128899	100.000	18573			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-952-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:23:43

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

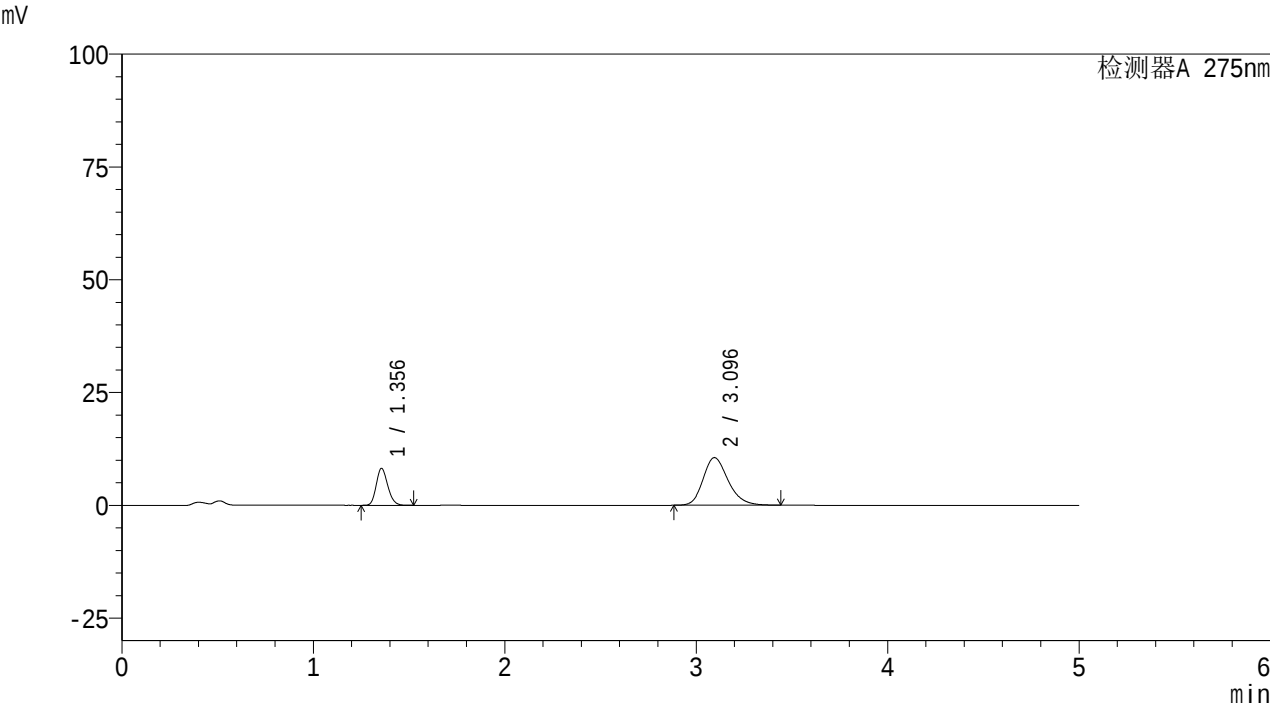

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	34105	26.235	8197	2448	1.179	--
2	3.096	95892	73.765	10554	2767	1.218	10.083
总计		129996	100.000	18751			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-953-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:29:07

处理时间(V2): 2026/05/15 17:24:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

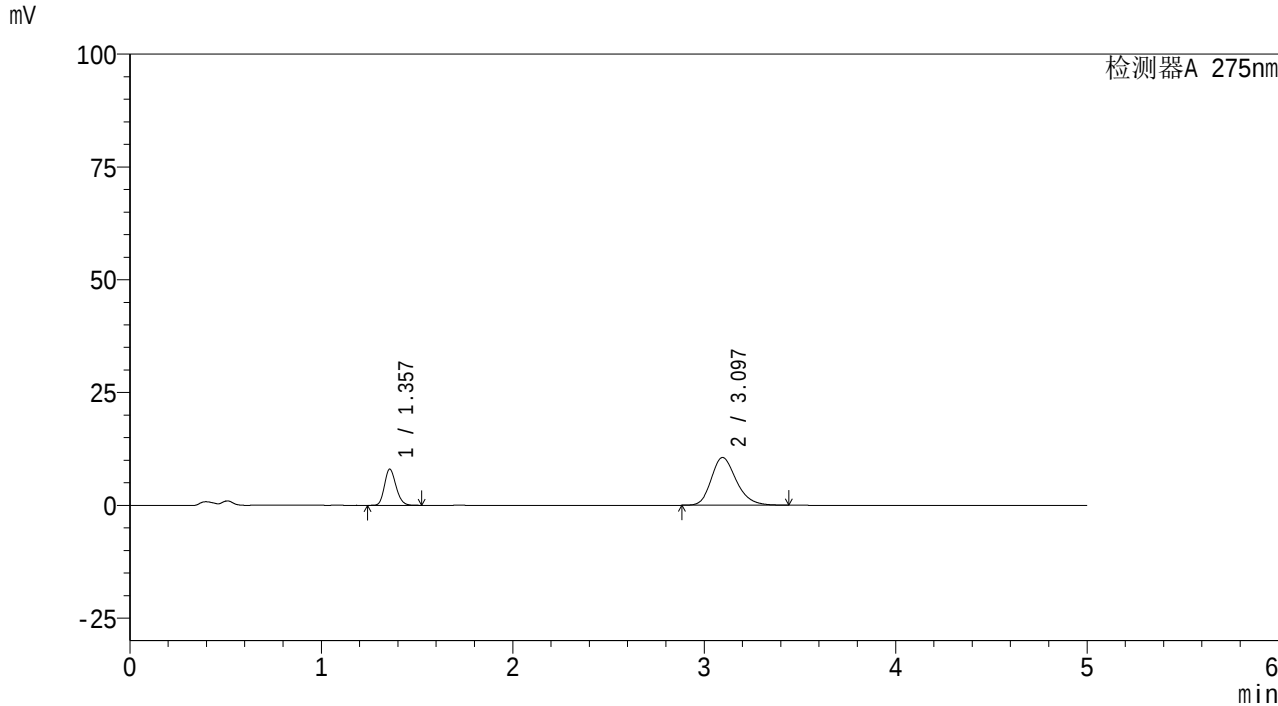

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33377	25.763	7996	2453	1.182	--
2	3.097	96176	74.237	10592	2779	1.219	10.094
总计		129552	100.000	18588			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-954-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:34:31
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

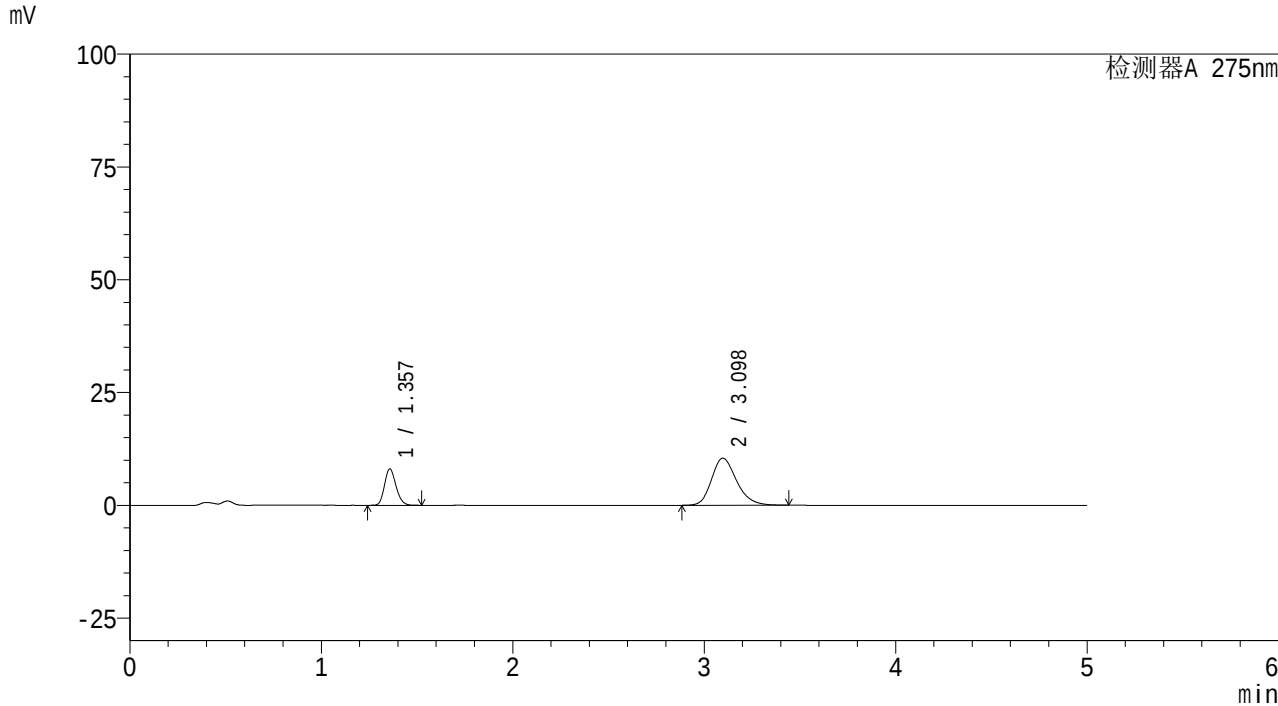

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	33590	26.169	8041	2449	1.183	--
2	3.098	94770	73.831	10431	2777	1.215	10.095
总计		128360	100.000	18471			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-955-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:39:56
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

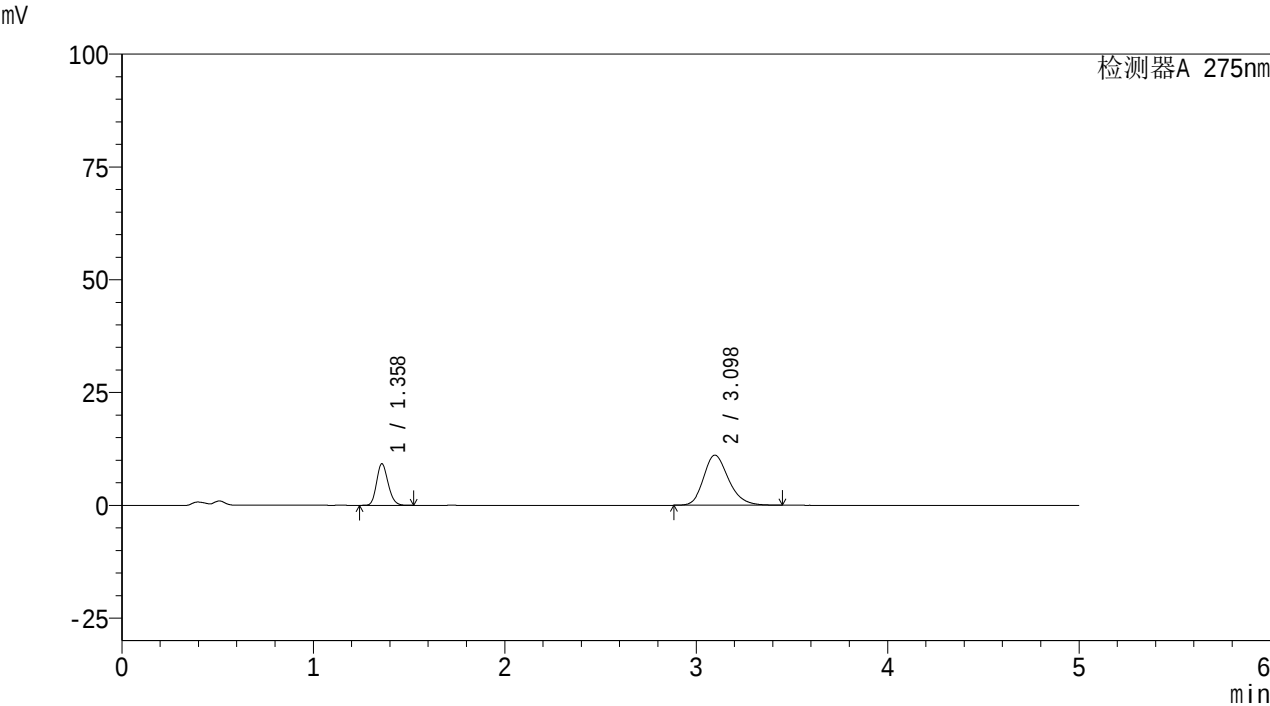

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	38376	27.584	9169	2449	1.181	--
2	3.098	100747	72.416	11109	2784	1.218	10.099
总计		139124	100.000	20278			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-956-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:45:21

处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

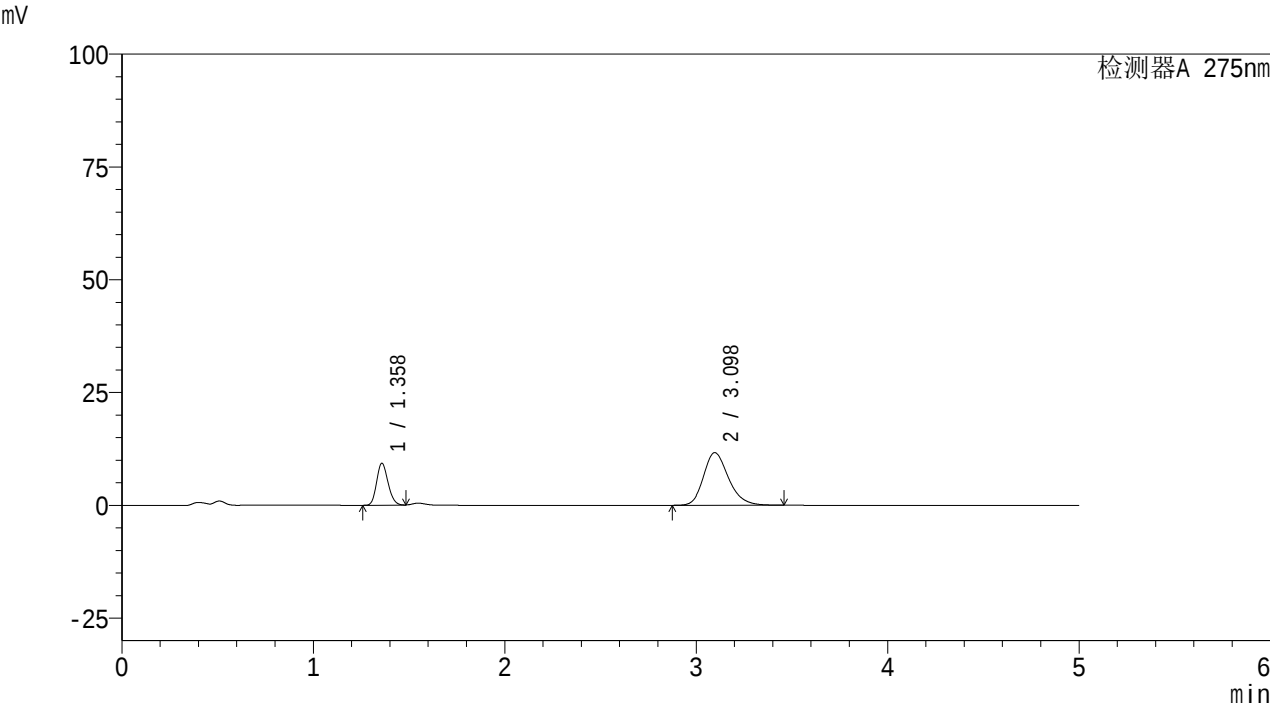

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	38332	26.587	9240	2471	1.170	--
2	3.098	105842	73.413	11662	2785	1.218	10.113
总计		144174	100.000	20902			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-957-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 04:50:45
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

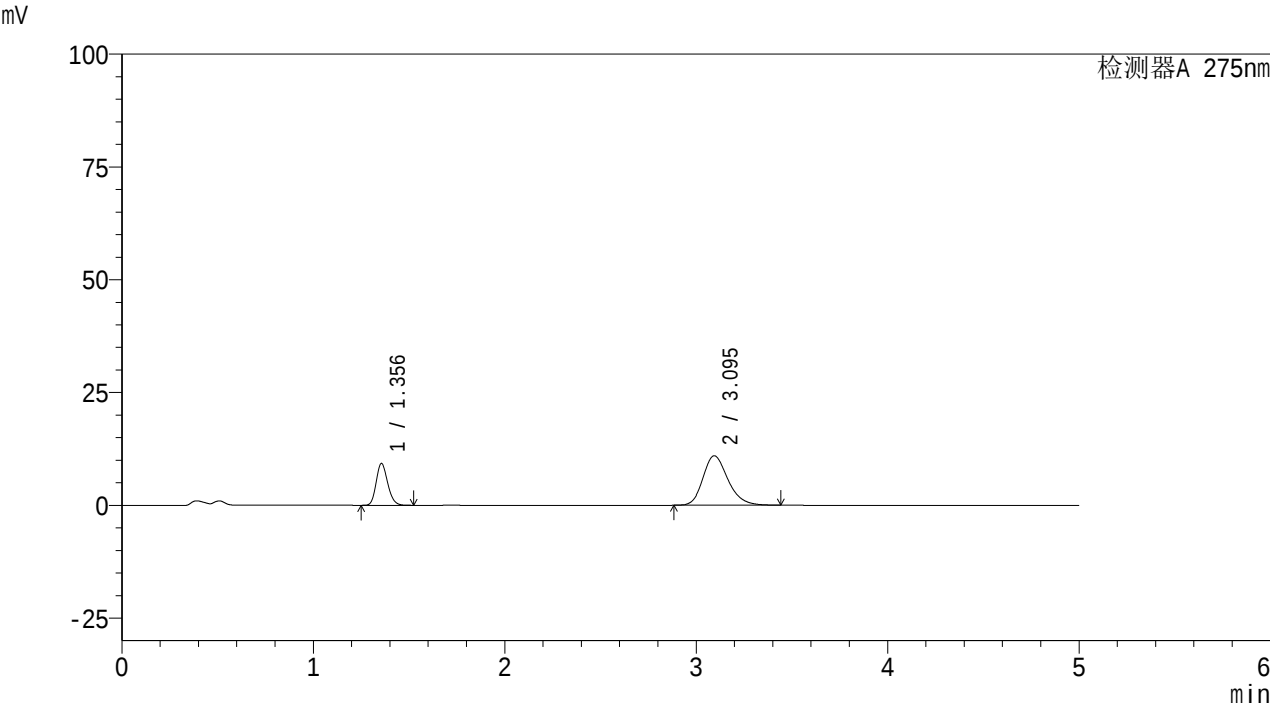

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	38624	27.971	9279	2447	1.182	--
2	3.095	99463	72.029	10970	2785	1.216	10.105
总计		138087	100.000	20249			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-958-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 04:56:09

处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

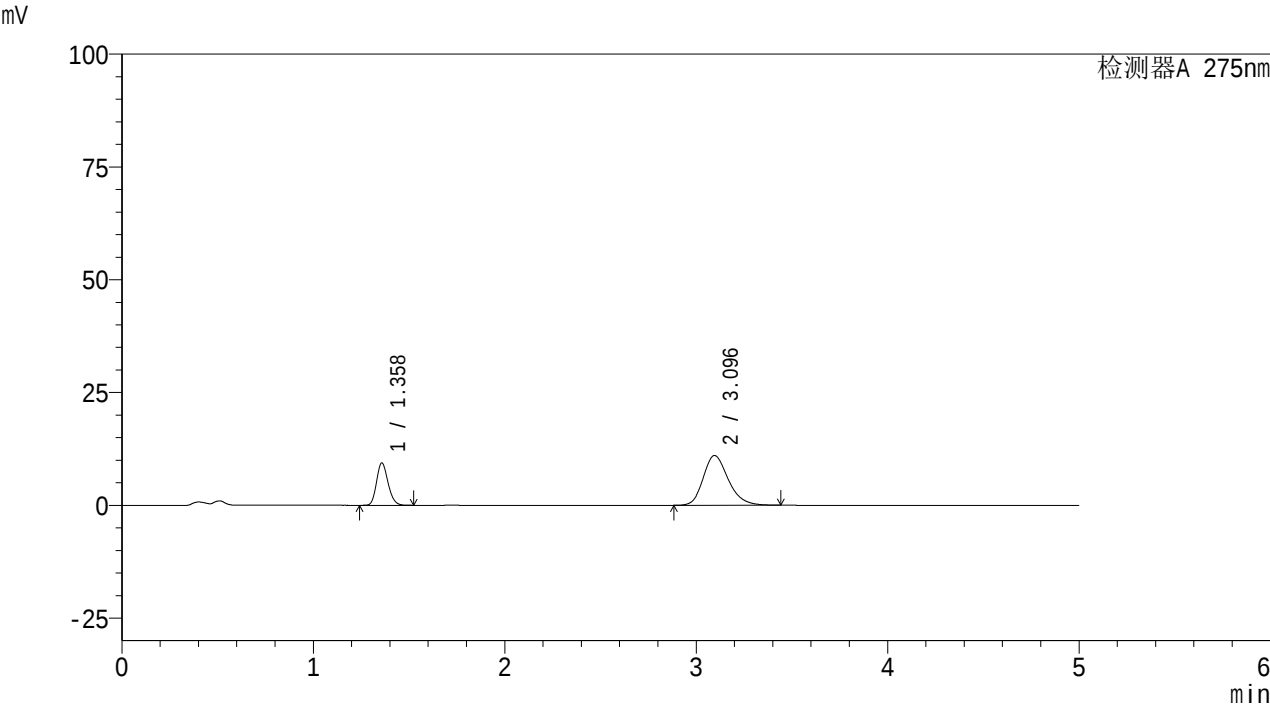

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	39144	28.116	9363	2450	1.183	--
2	3.096	100083	71.884	11026	2775	1.219	10.085
总计		139227	100.000	20389			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-959-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:01:33
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

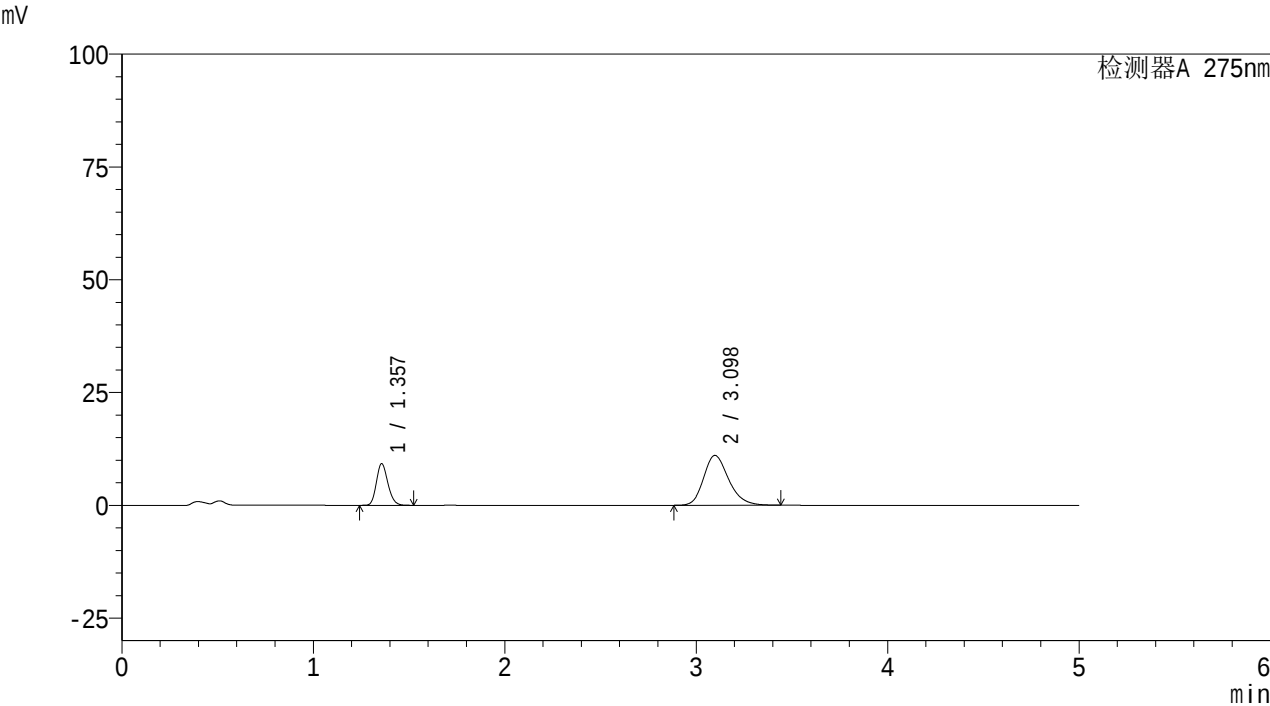

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	38404	27.655	9213	2452	1.182	--
2	3.098	100462	72.345	11053	2774	1.218	10.099
总计		138866	100.000	20267			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-960-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:06:57
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

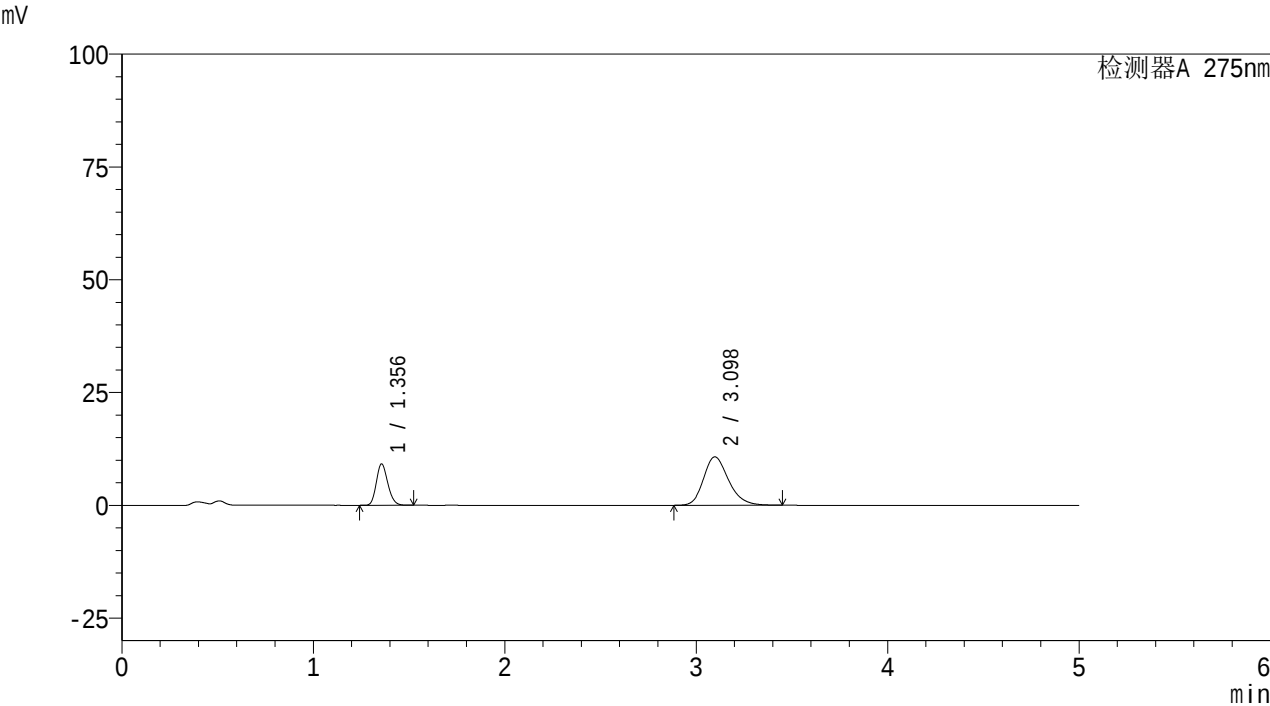

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.356	38121	28.098	9171	2458	1.181	--
2	3.098	97549	71.902	10728	2780	1.217	10.112
总计		135670	100.000	19900			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-961-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:12:23
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

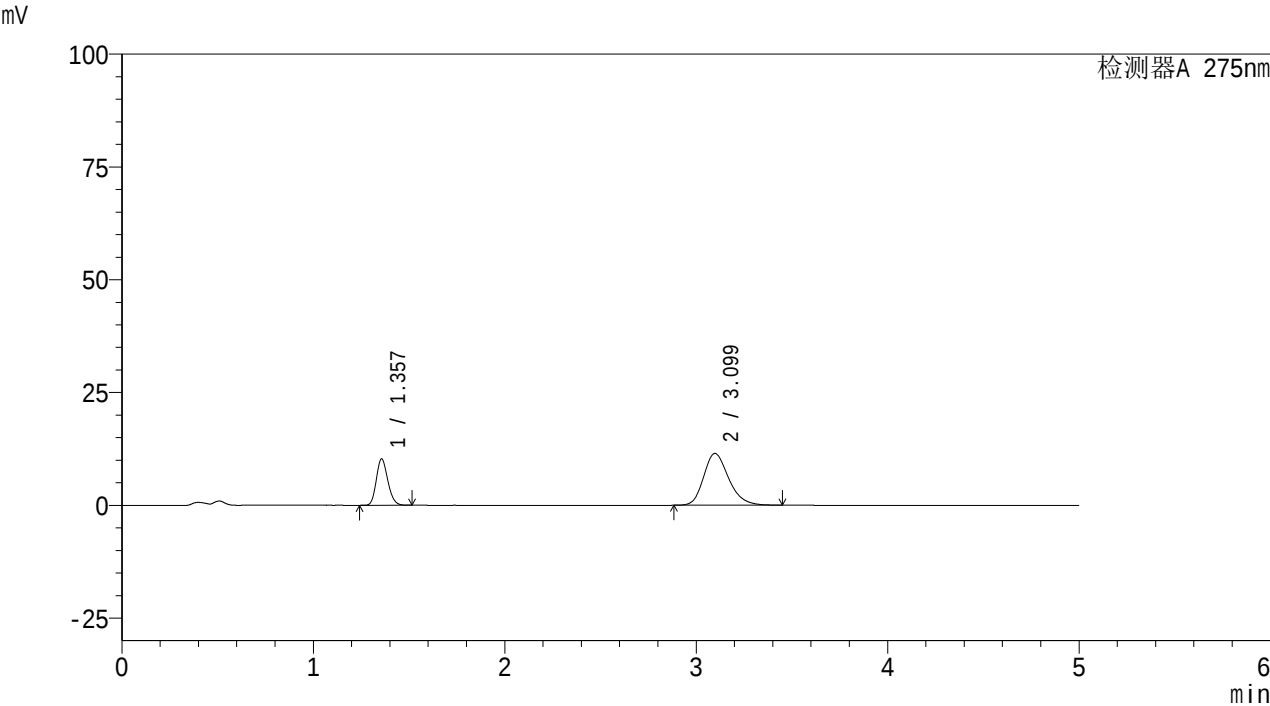

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	42745	29.096	10277	2454	1.179	--
2	3.099	104164	70.904	11478	2787	1.218	10.119
总计		146909	100.000	21755			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-962-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:17:47
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

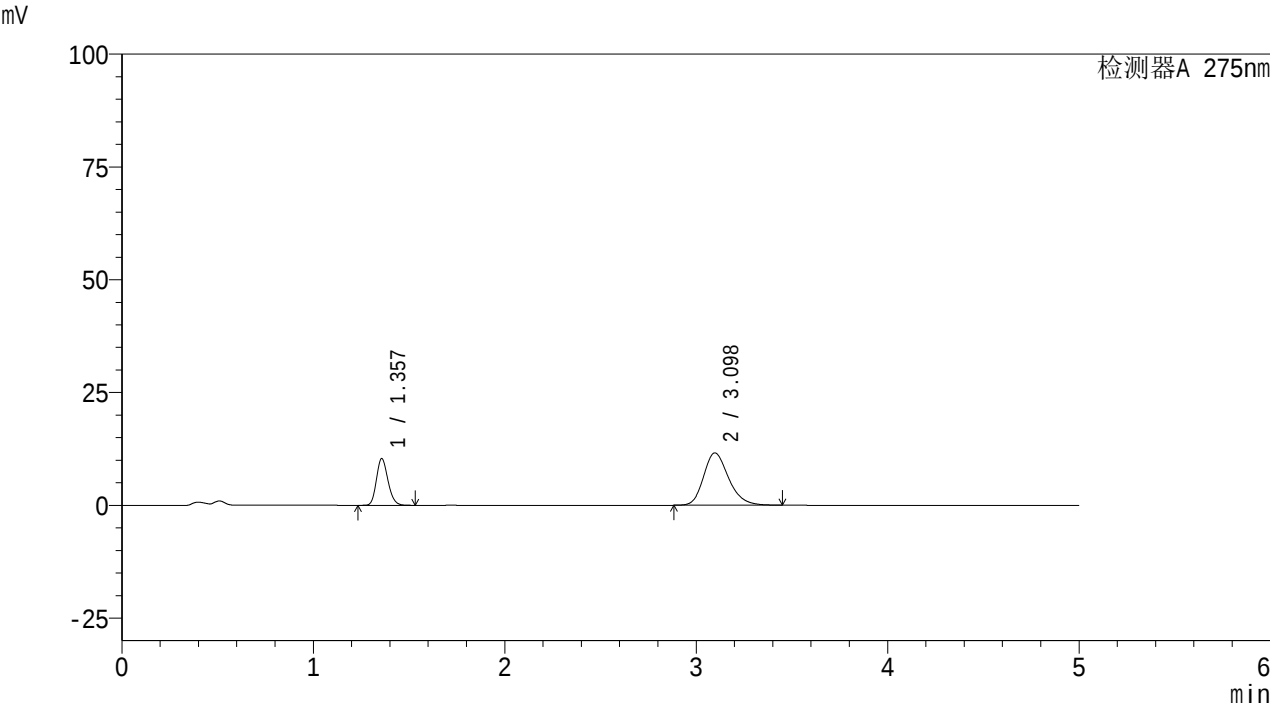

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	43258	29.113	10358	2453	1.181	--
2	3.098	105328	70.887	11596	2780	1.220	10.104
总计		148586	100.000	21954			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-963-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:23:11
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

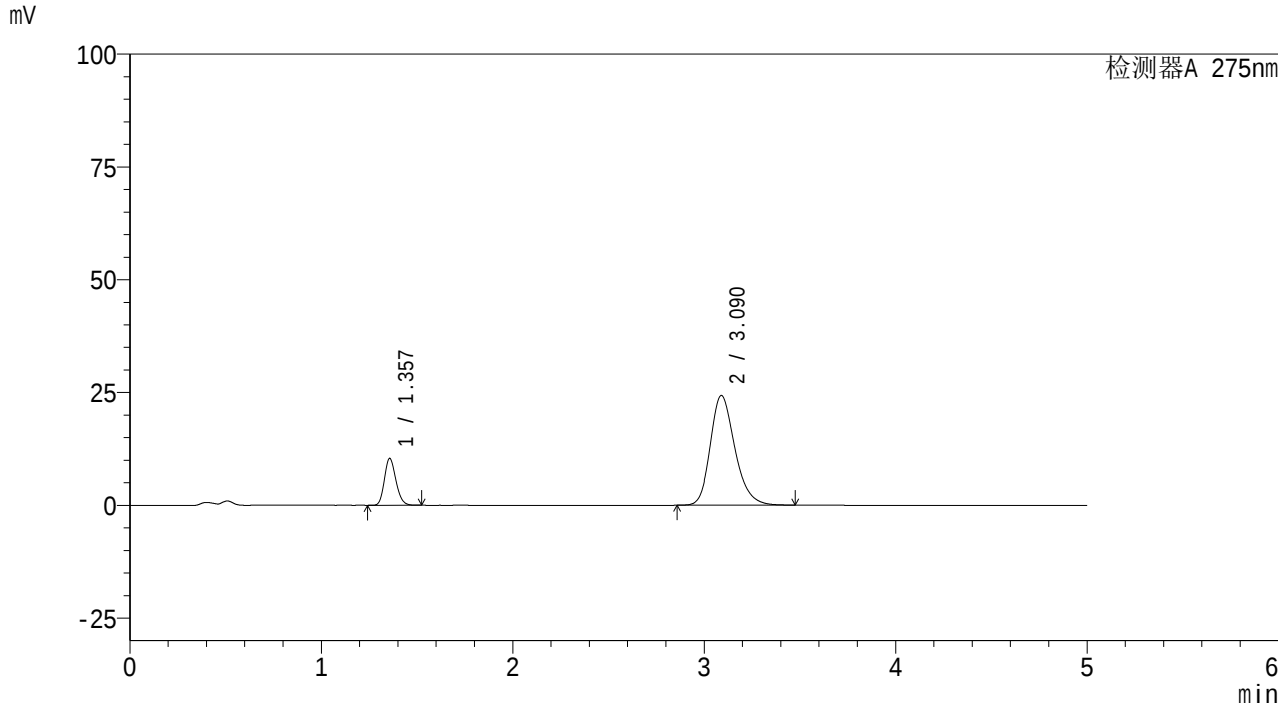

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	43257	16.615	10374	2453	1.181	--
2	3.090	217089	83.385	24317	2872	1.231	10.188
总计		260346	100.000	34690			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-964-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:28:36
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

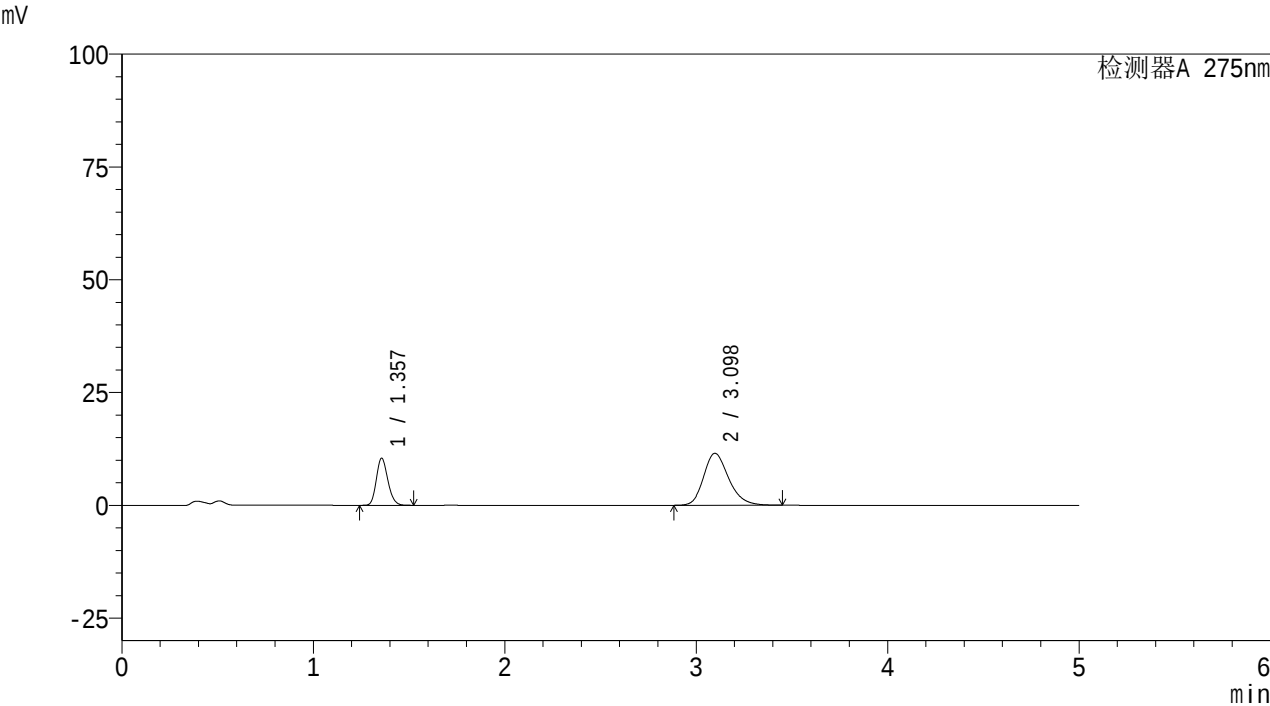

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	43490	29.344	10438	2452	1.181	--
2	3.098	104719	70.656	11520	2776	1.221	10.103
总计		148209	100.000	21958			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-965-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:34:00
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

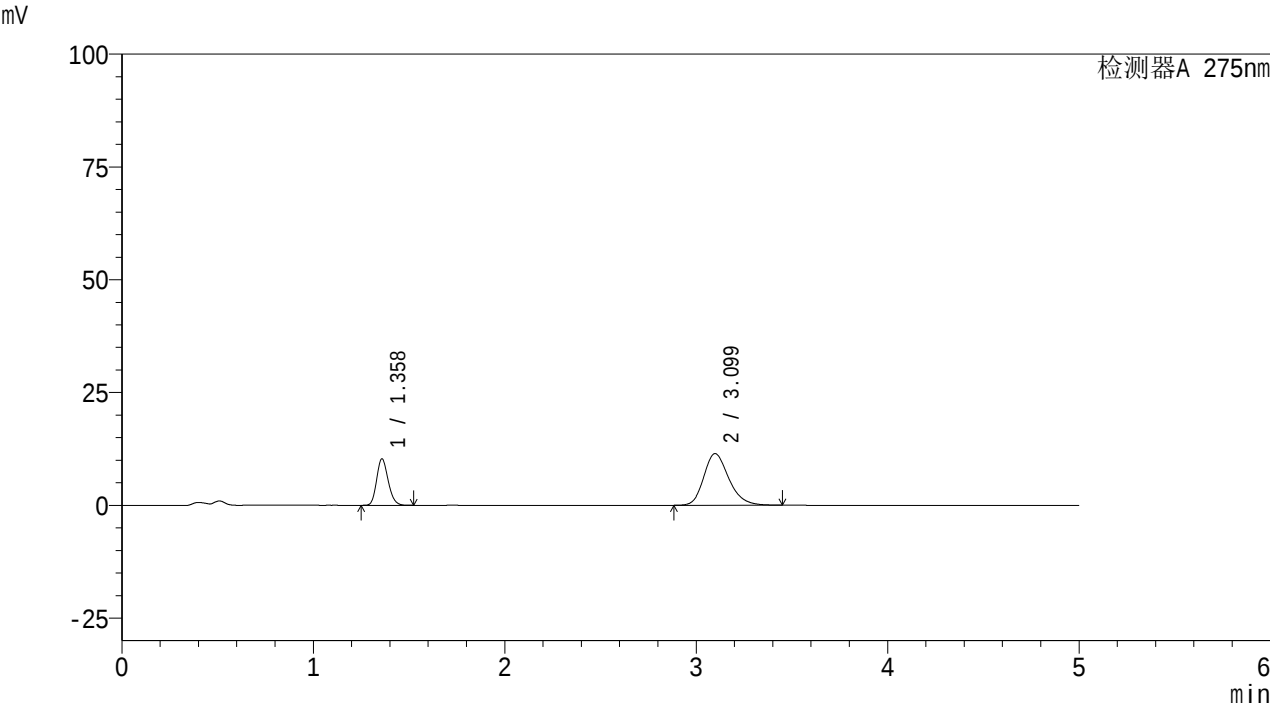

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	42900	29.209	10239	2455	1.183	--
2	3.099	103971	70.791	11438	2785	1.221	10.106
总计		146870	100.000	21677			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-966-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:39:25
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

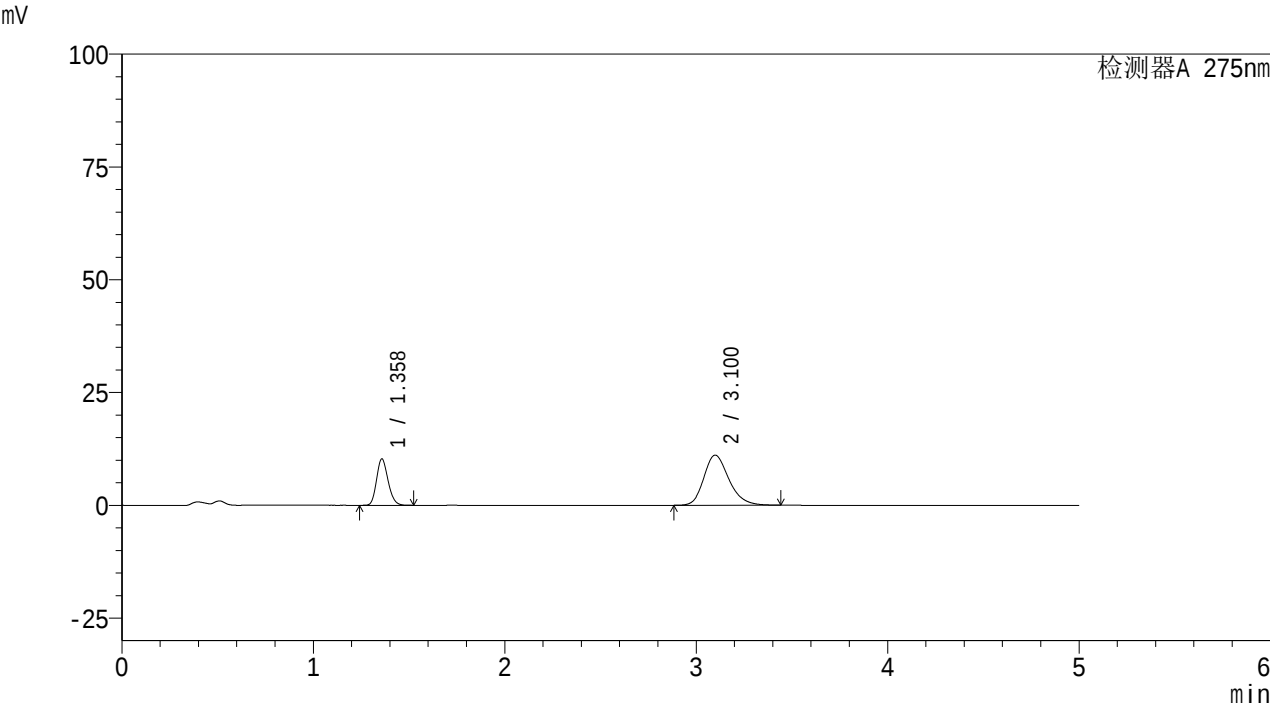

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	42879	29.797	10251	2450	1.182	--
2	3.100	101027	70.203	11104	2778	1.221	10.099
总计		143905	100.000	21355			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-967-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 05:44:49

处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

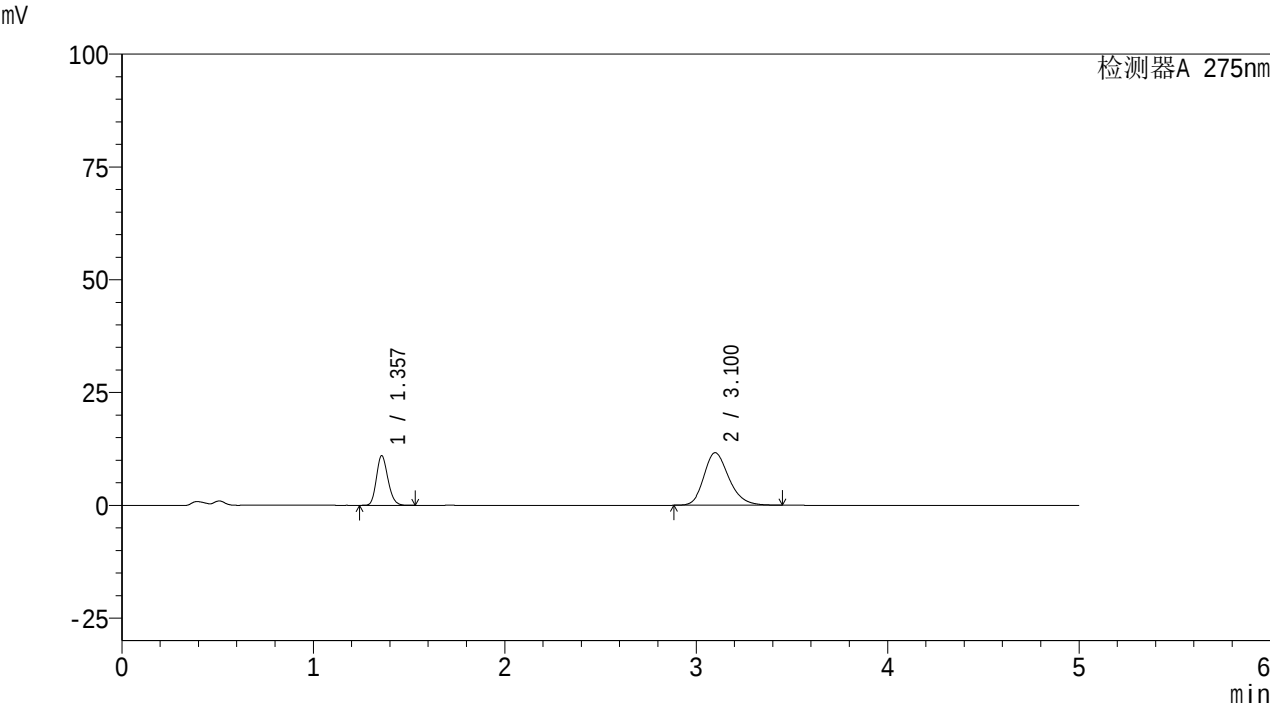

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	45751	30.176	10968	2451	1.183	--
2	3.100	105862	69.824	11634	2776	1.220	10.104
总计		151614	100.000	22602			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-968-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:50:13
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

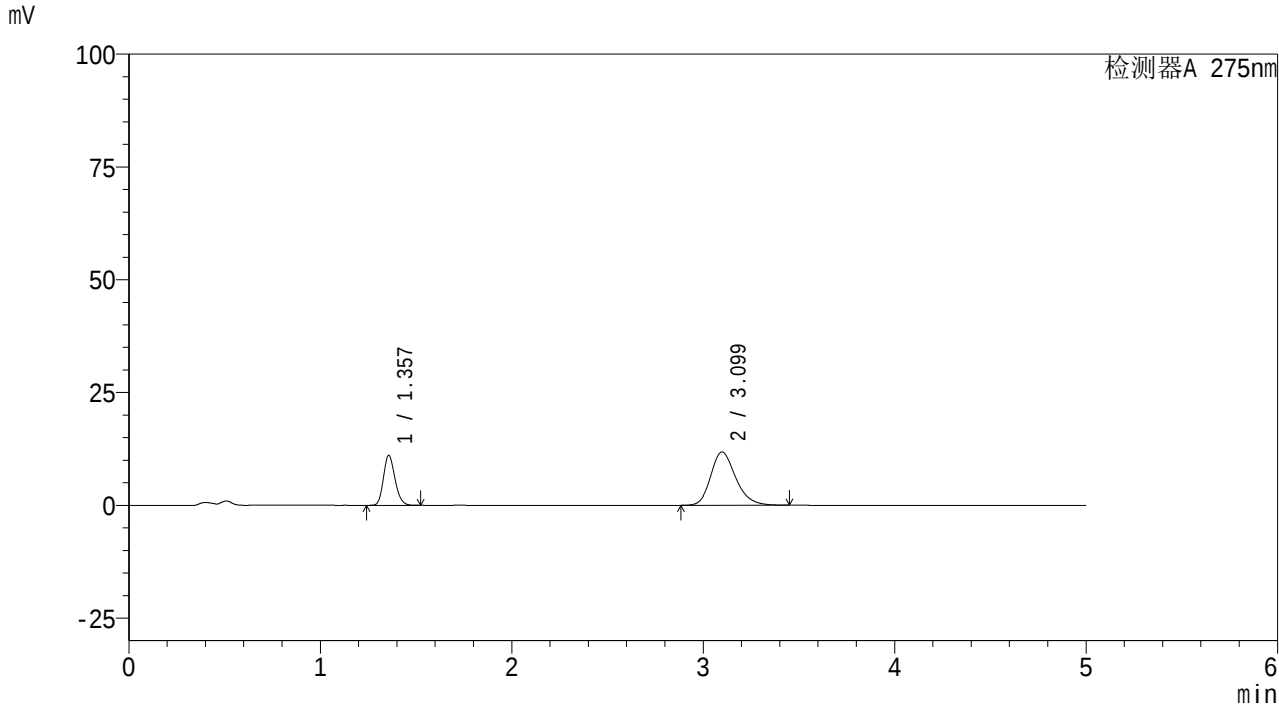

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	46077	30.095	11042	2451	1.183	--
2	3.099	107028	69.905	11797	2789	1.219	10.115
总计		153105	100.000	22840			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-969-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 05:55:38
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

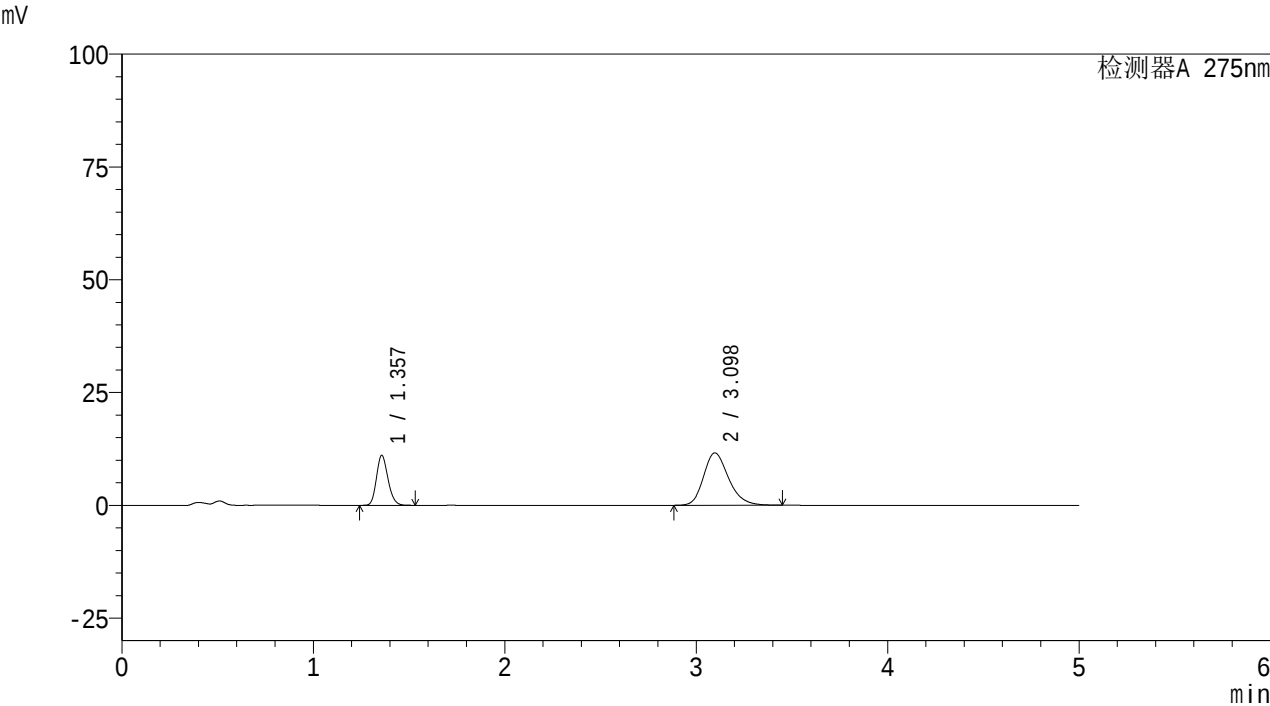

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	46103	30.472	11042	2450	1.182	--
2	3.098	105192	69.528	11604	2788	1.218	10.110
总计		151296	100.000	22647			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-970-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:01:03

处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

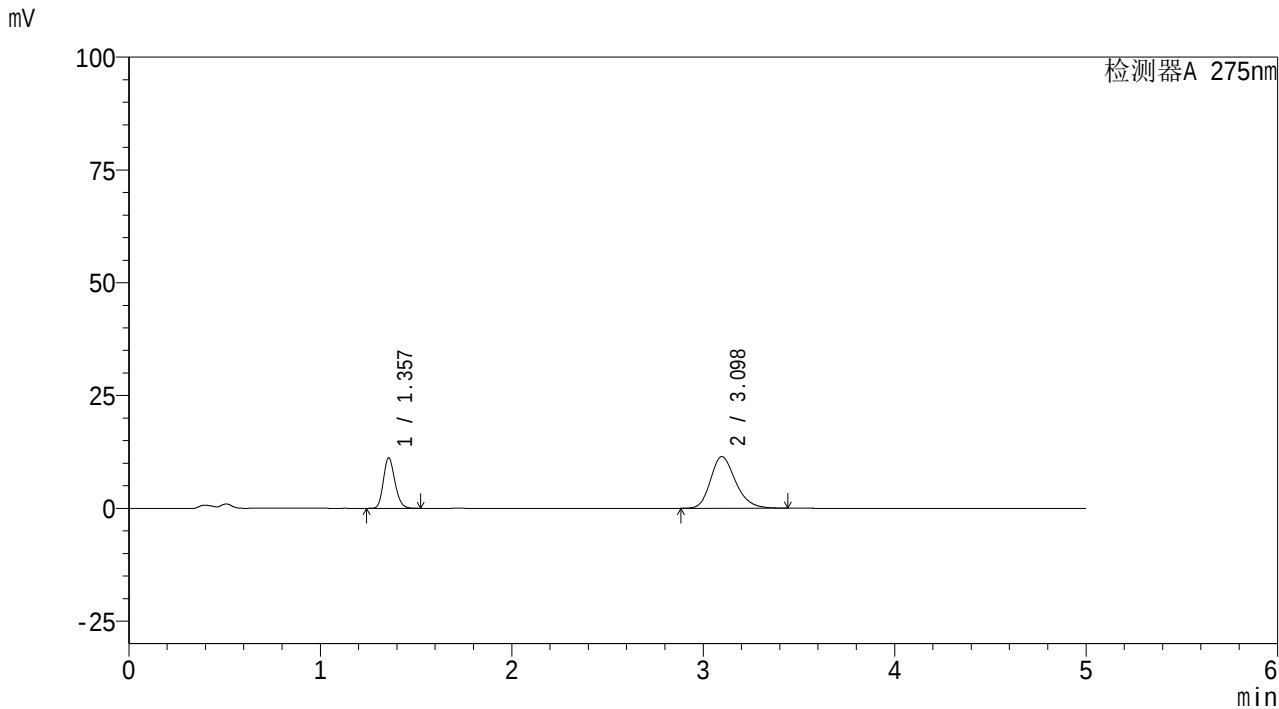

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	46524	30.937	11165	2454	1.181	--
2	3.098	103857	69.063	11451	2788	1.219	10.116
总计		150381	100.000	22615			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-971-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:06:27

处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

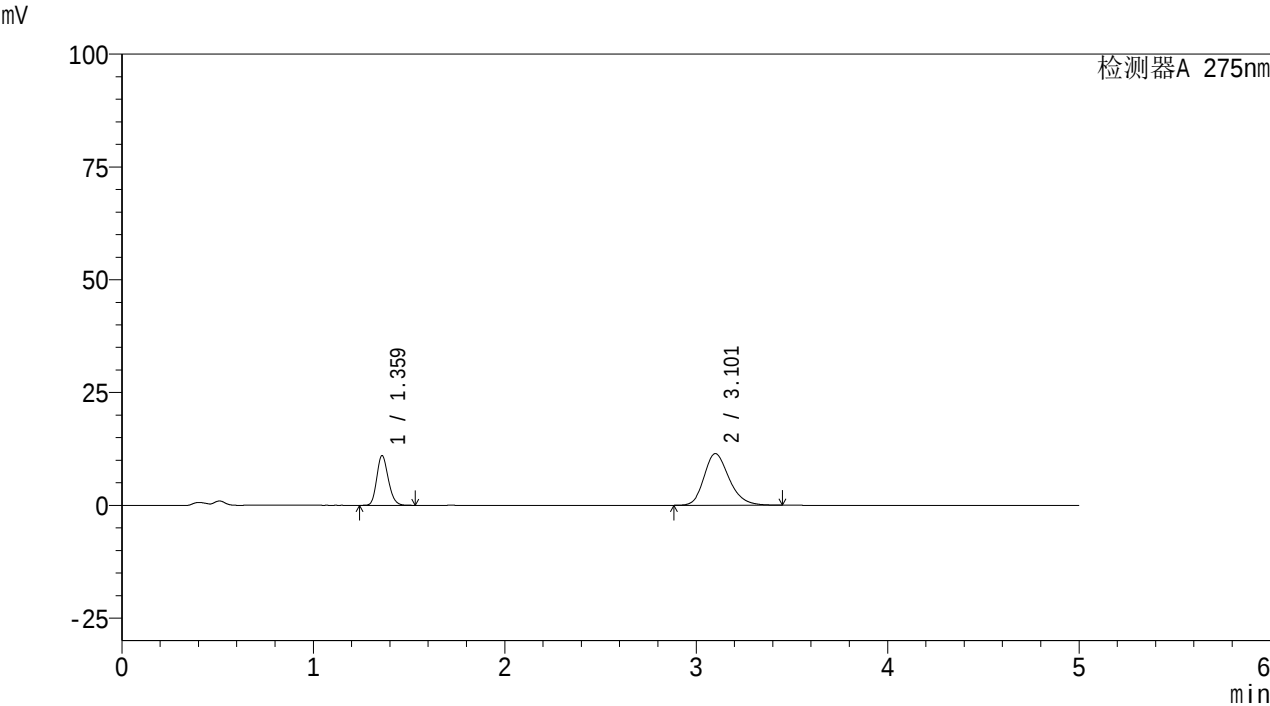

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	45875	30.600	10921	2461	1.184	--
2	3.101	104043	69.400	11426	2784	1.221	10.110
总计		149918	100.000	22348			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-972-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:11:52
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

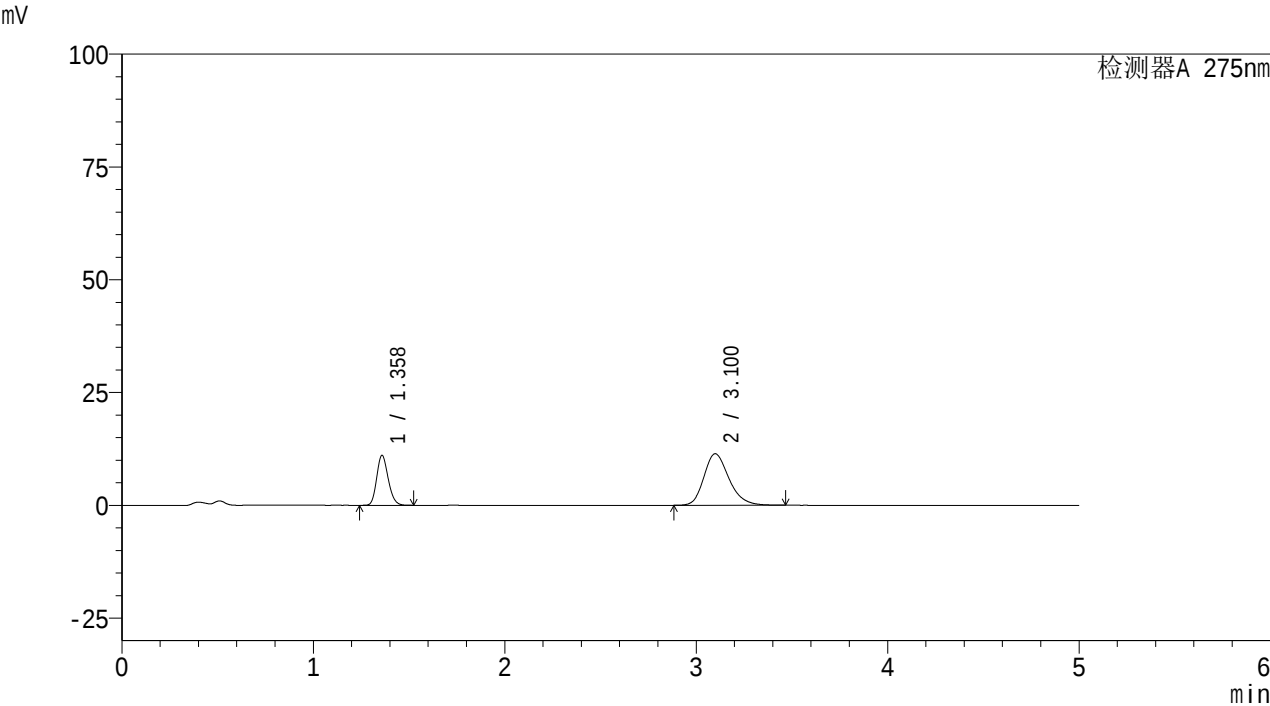

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	46077	30.726	10994	2460	1.184	--
2	3.100	103885	69.274	11408	2784	1.223	10.109
总计		149962	100.000	22402			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-973-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:17:17
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

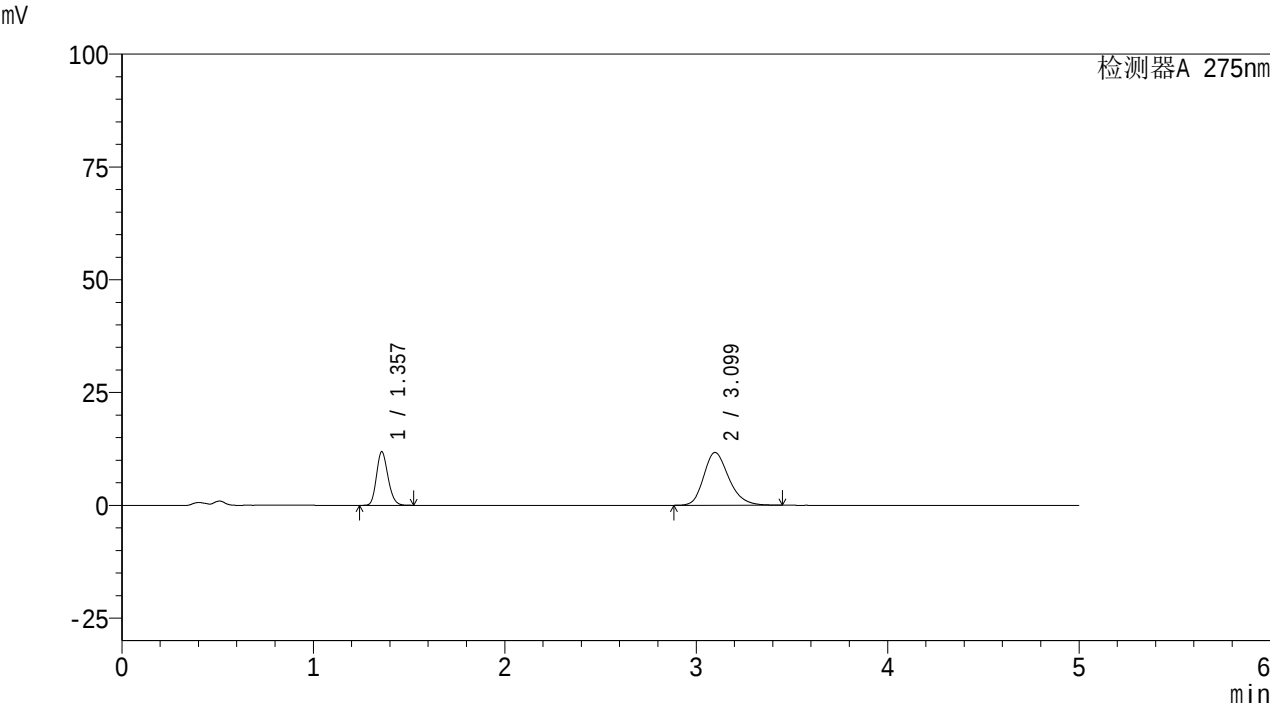

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	49446	31.738	11847	2451	1.183	--
2	3.099	106347	68.262	11693	2776	1.221	10.098
总计		155793	100.000	23539			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-974-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:22:42
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

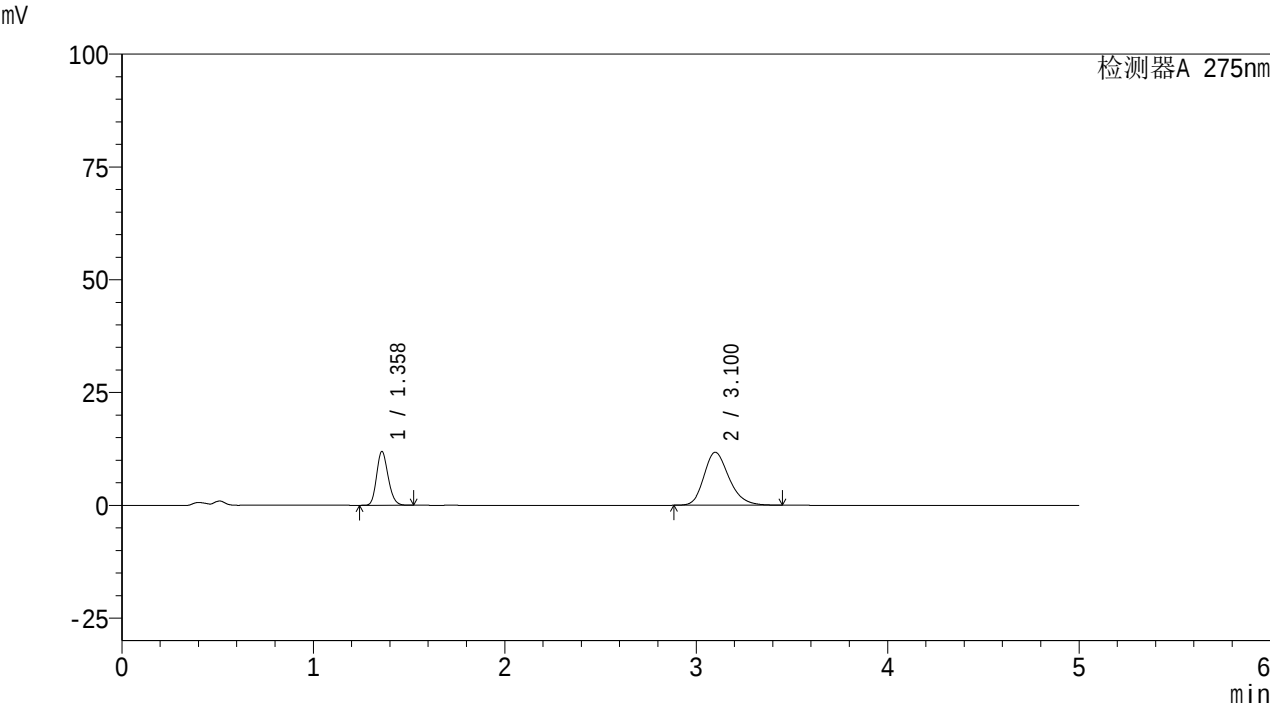

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	49688	31.751	11870	2450	1.183	--
2	3.100	106803	68.249	11718	2770	1.223	10.089
总计		156491	100.000	23588			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-975-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:28:06
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

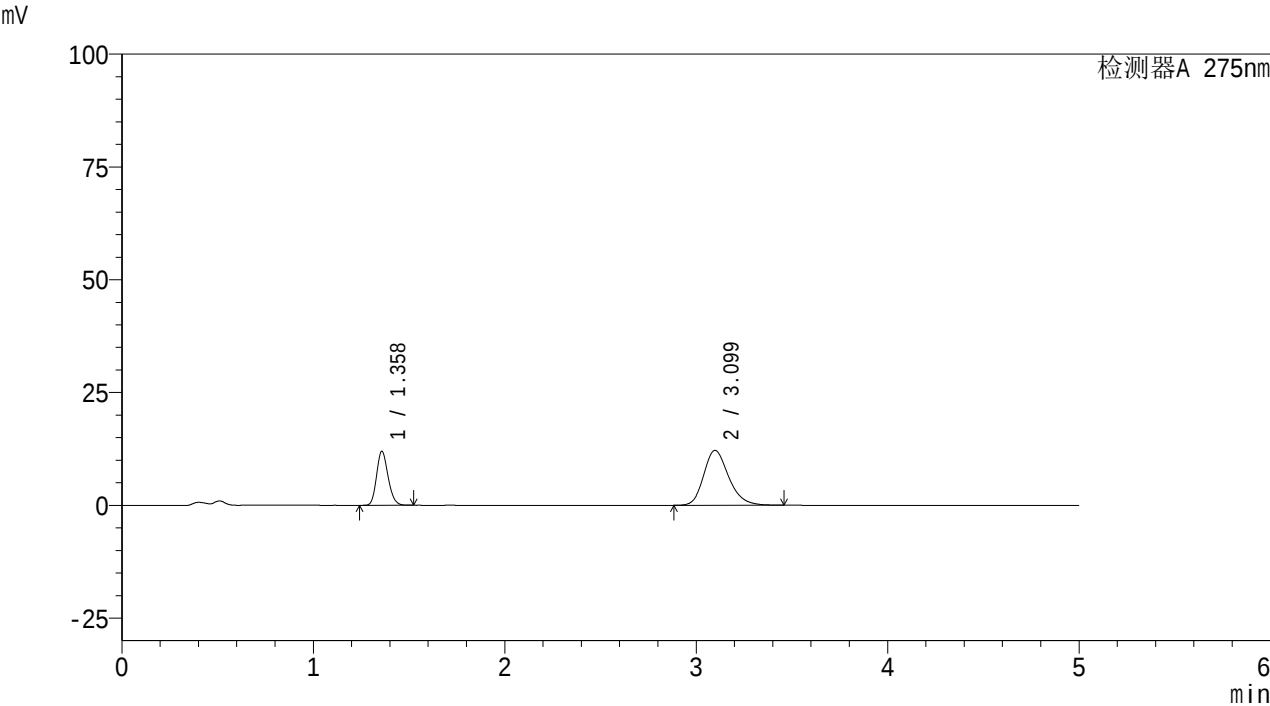

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	49803	31.127	11923	2457	1.181	--
2	3.099	110199	68.873	12161	2800	1.218	10.126
总计		160003	100.000	24084			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-976-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:33:32

处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

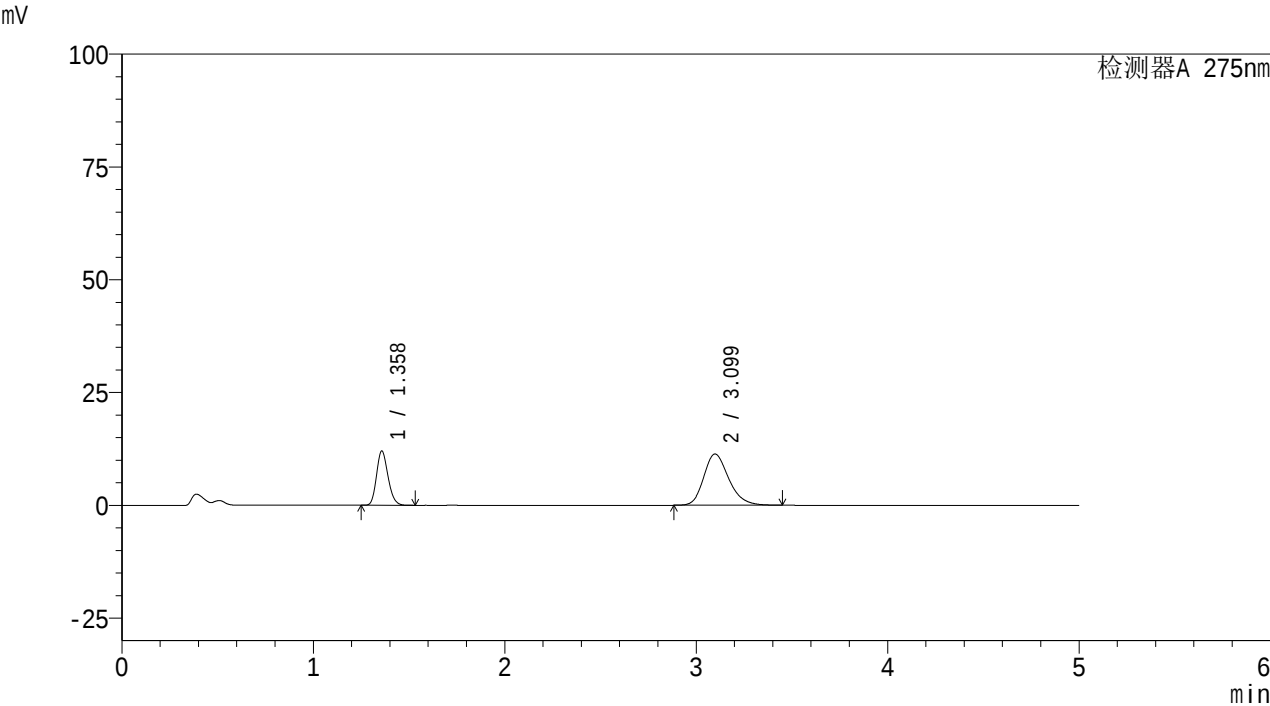

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	50033	32.680	11981	2453	1.182	--
2	3.099	103066	67.320	11350	2783	1.219	10.107
总计		153100	100.000	23331			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-977-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:38:56
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

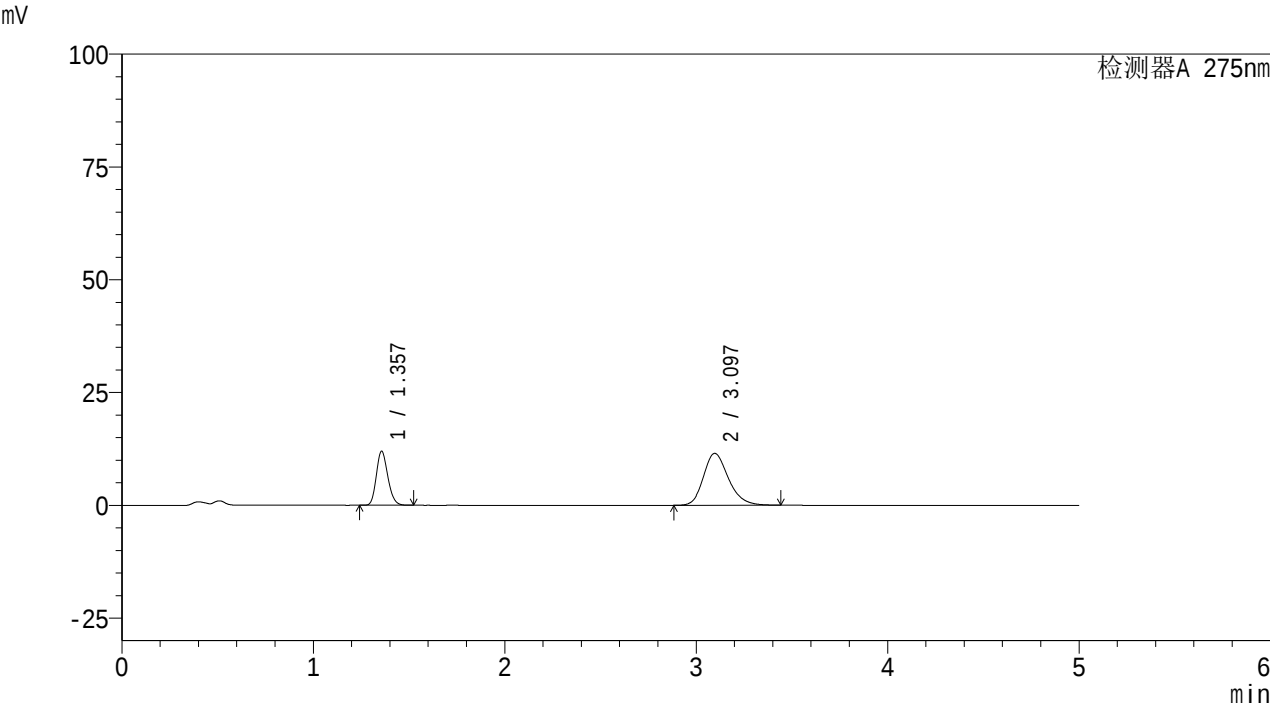

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	49845	32.359	11968	2452	1.182	--
2	3.097	104194	67.641	11504	2791	1.217	10.119
总计		154040	100.000	23472			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-978-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:44:20
处理时间(V2): 2026/05/15 17:25:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

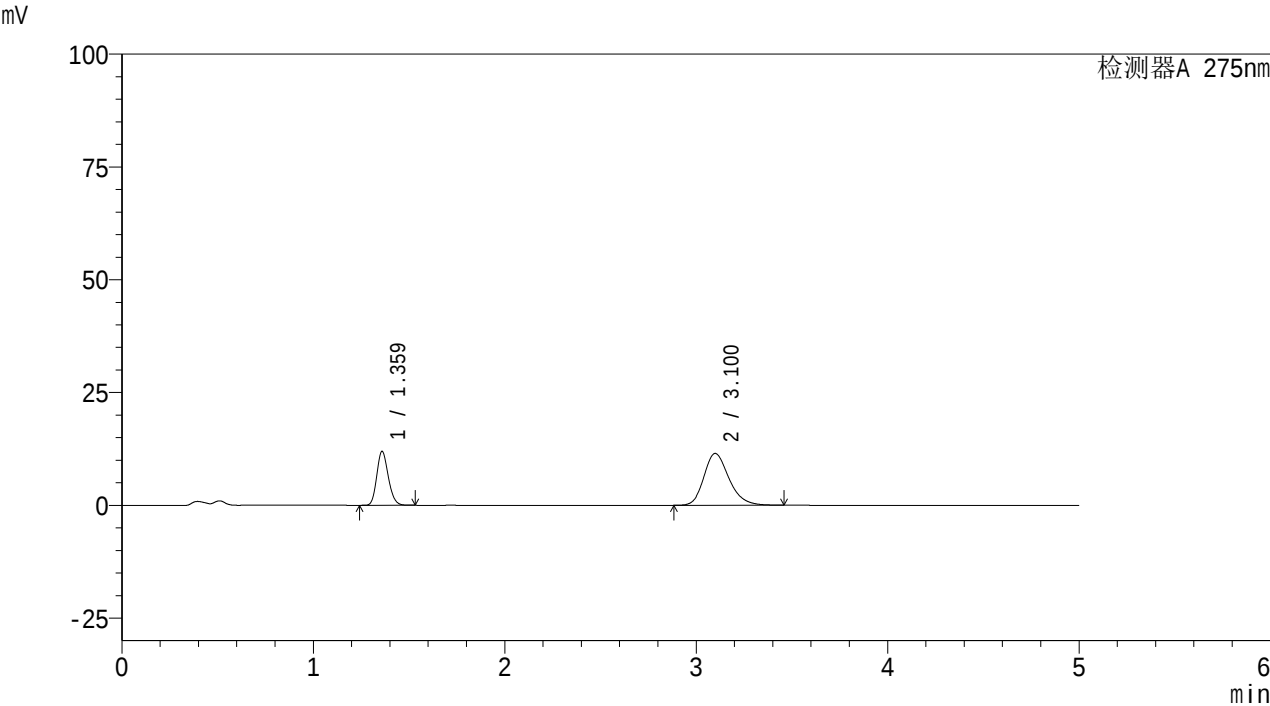

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	49779	32.277	11837	2452	1.182	--
2	3.100	104447	67.723	11469	2781	1.220	10.097
总计		154226	100.000	23306			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-979-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 06:49:44

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

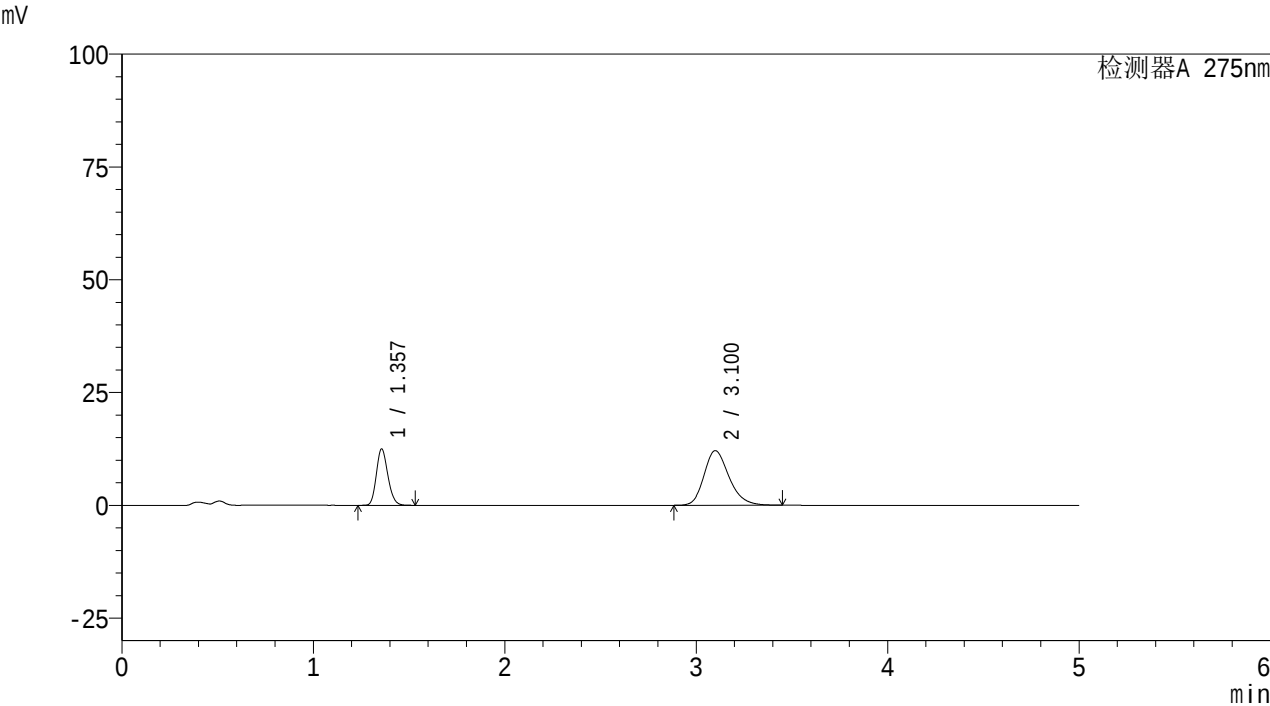

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	52073	32.175	12496	2453	1.181	--
2	3.100	109769	67.825	12083	2789	1.221	10.126
总计		161841	100.000	24580			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-980-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 06:55:08
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

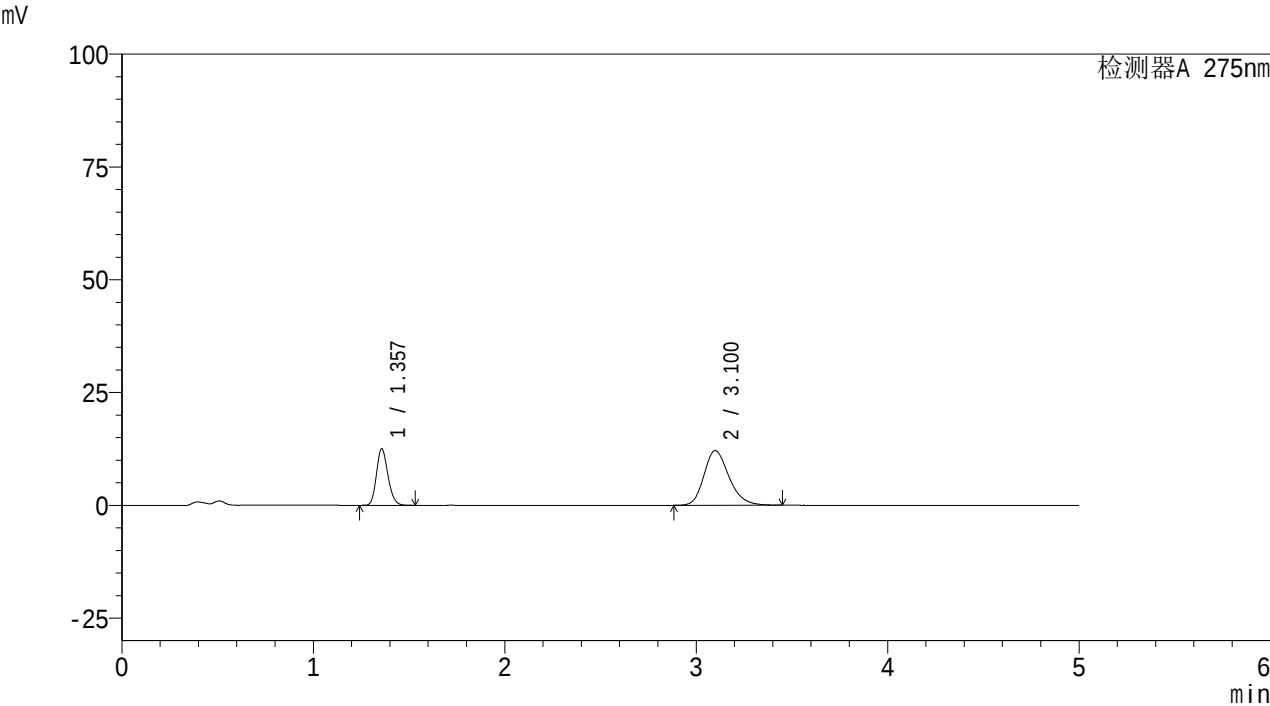

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	52098	32.148	12498	2455	1.181	--
2	3.100	109957	67.852	12097	2785	1.220	10.118
总计		162055	100.000	24595			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-981-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:00:30
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

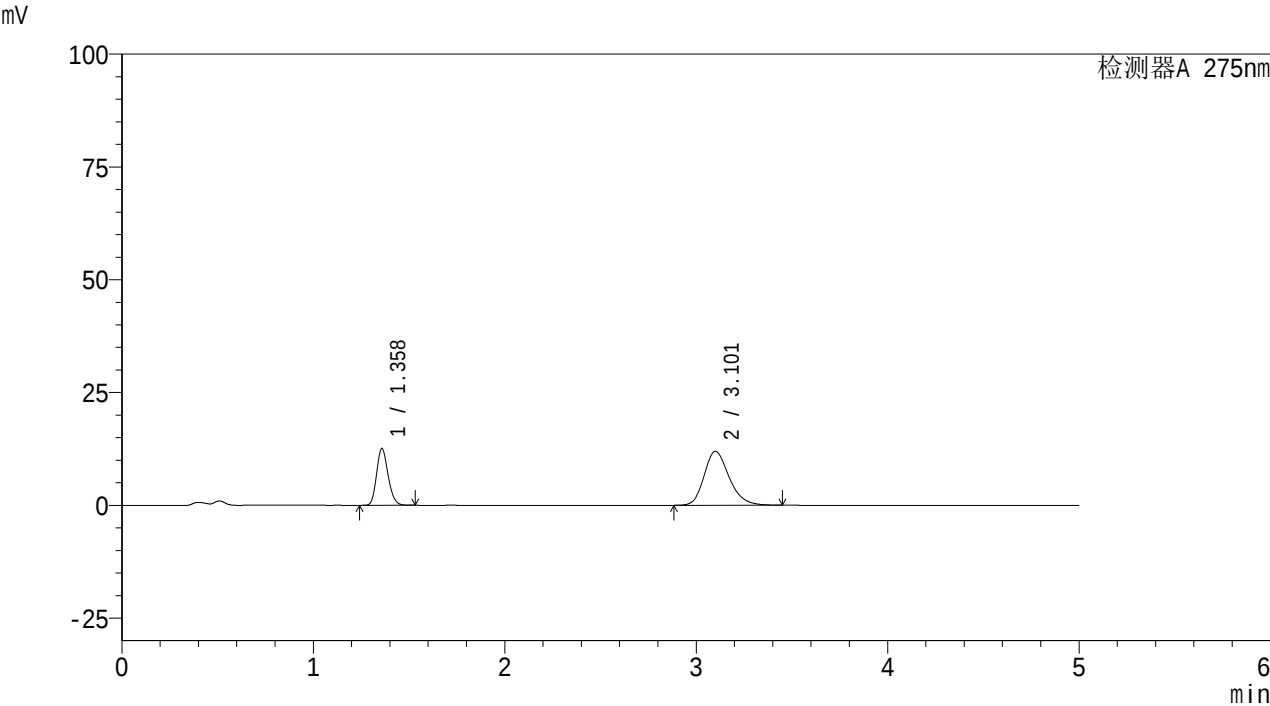

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52384	32.566	12531	2454	1.182	--
2	3.101	108474	67.434	11936	2797	1.219	10.130
总计		160858	100.000	24467			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-982-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:05:54
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

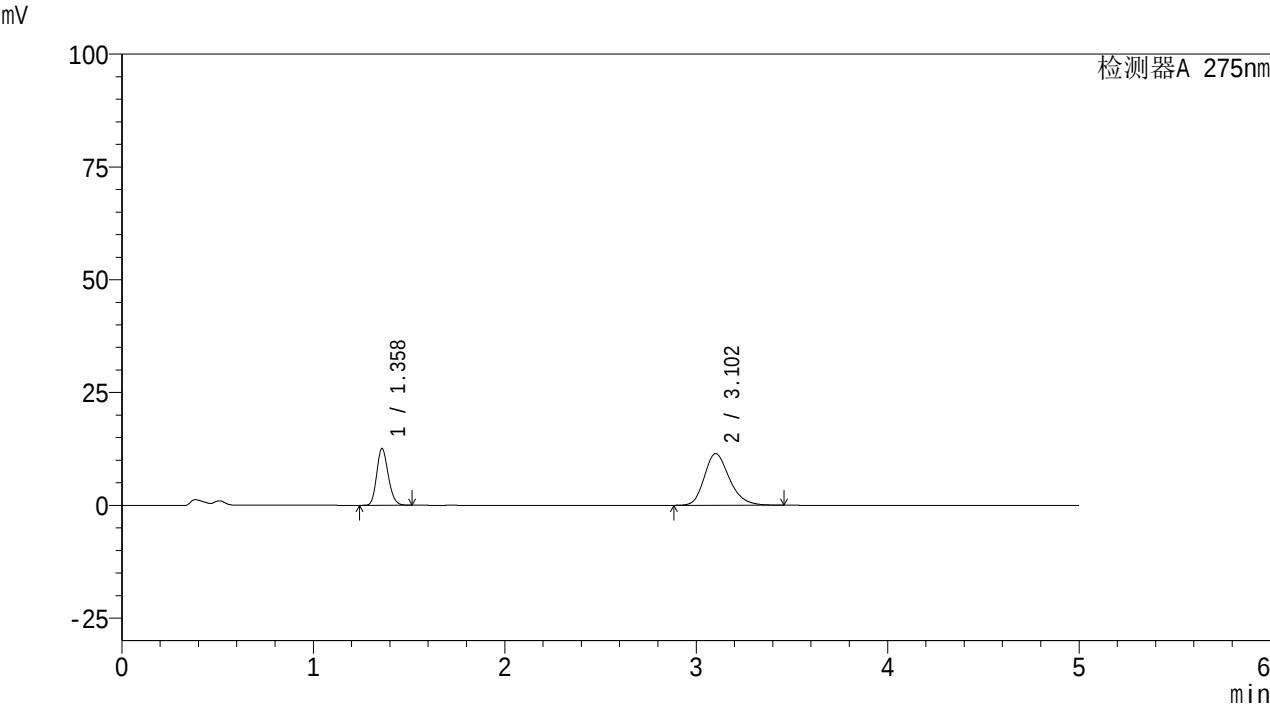

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52363	33.478	12490	2457	1.181	--
2	3.102	104046	66.522	11440	2785	1.221	10.116
总计		156409	100.000	23929			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-983-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:11:17

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

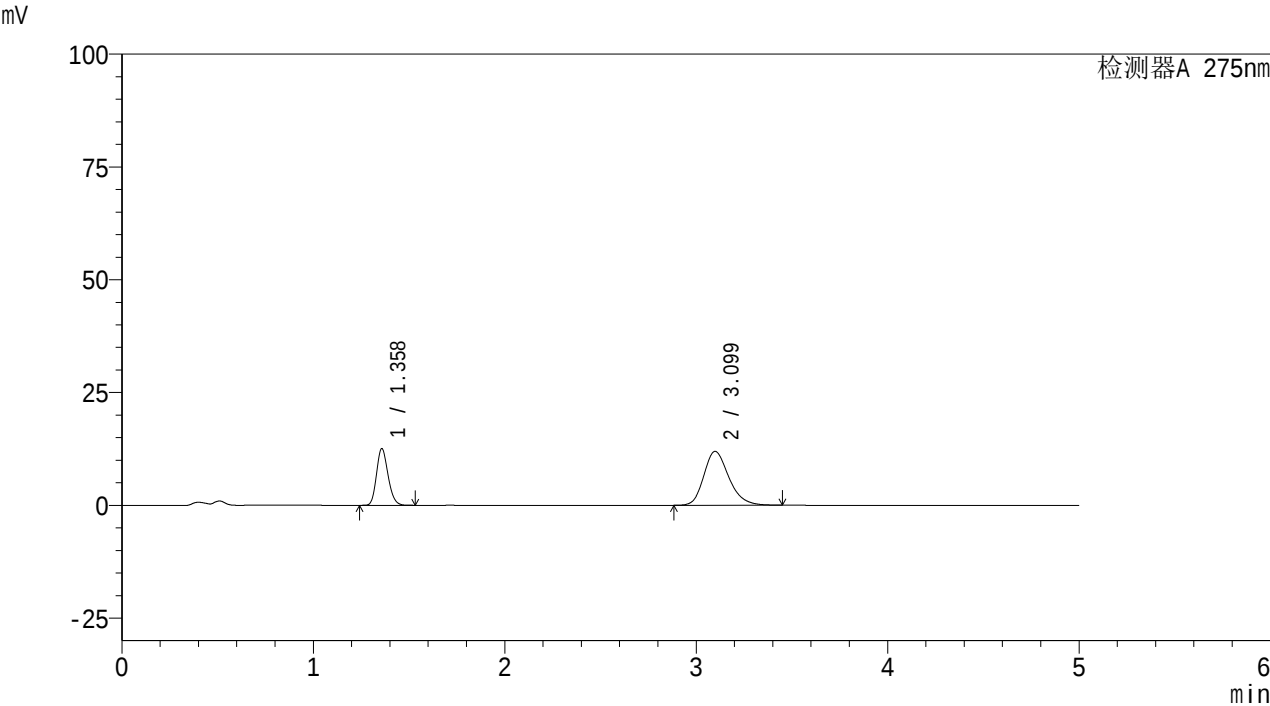

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52347	32.579	12535	2453	1.183	--
2	3.099	108330	67.421	11931	2787	1.221	10.113
总计		160678	100.000	24466			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-984-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:16:40

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

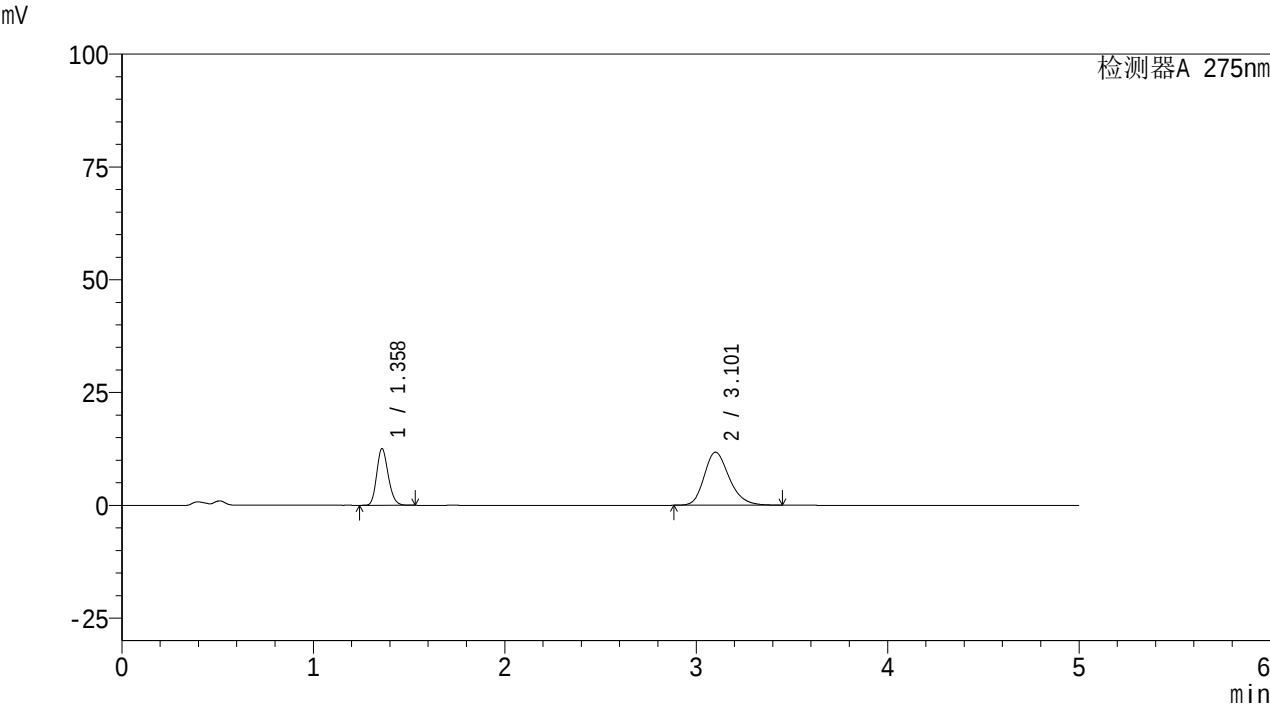

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52343	32.930	12476	2460	1.183	--
2	3.101	106608	67.070	11738	2791	1.220	10.122
总计		158951	100.000	24215			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-985-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:22:03
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

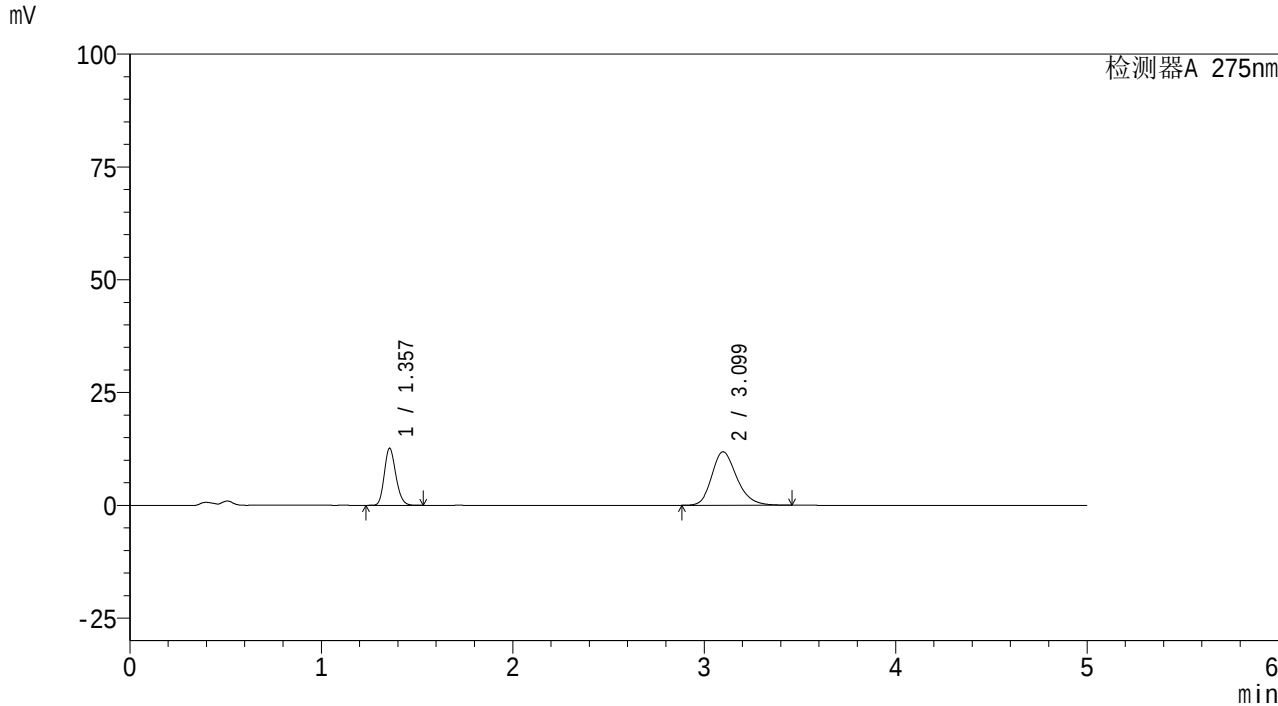

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	52690	32.873	12647	2452	1.180	--
2	3.099	107596	67.127	11845	2790	1.221	10.124
总计		160286	100.000	24492			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-986-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:27:27

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

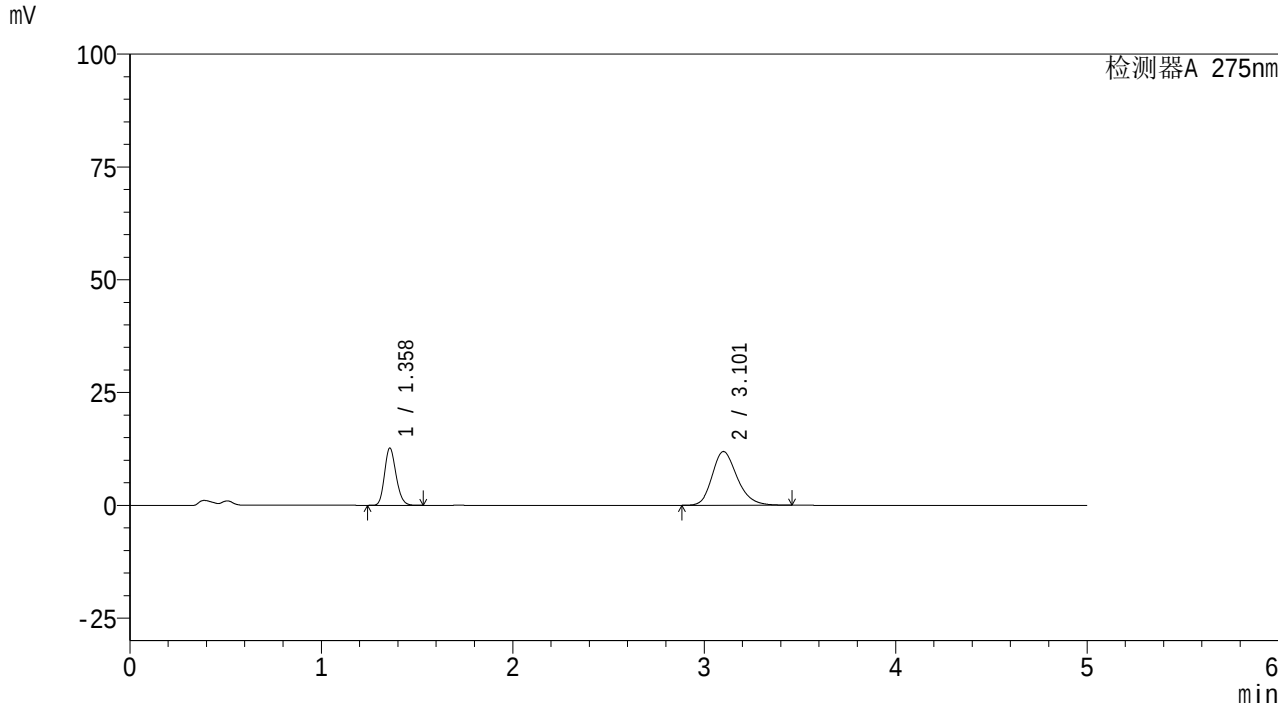

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52834	32.846	12644	2457	1.182	--
2	3.101	108020	67.154	11880	2792	1.219	10.127
总计		160854	100.000	24524			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-987-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:32:50
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

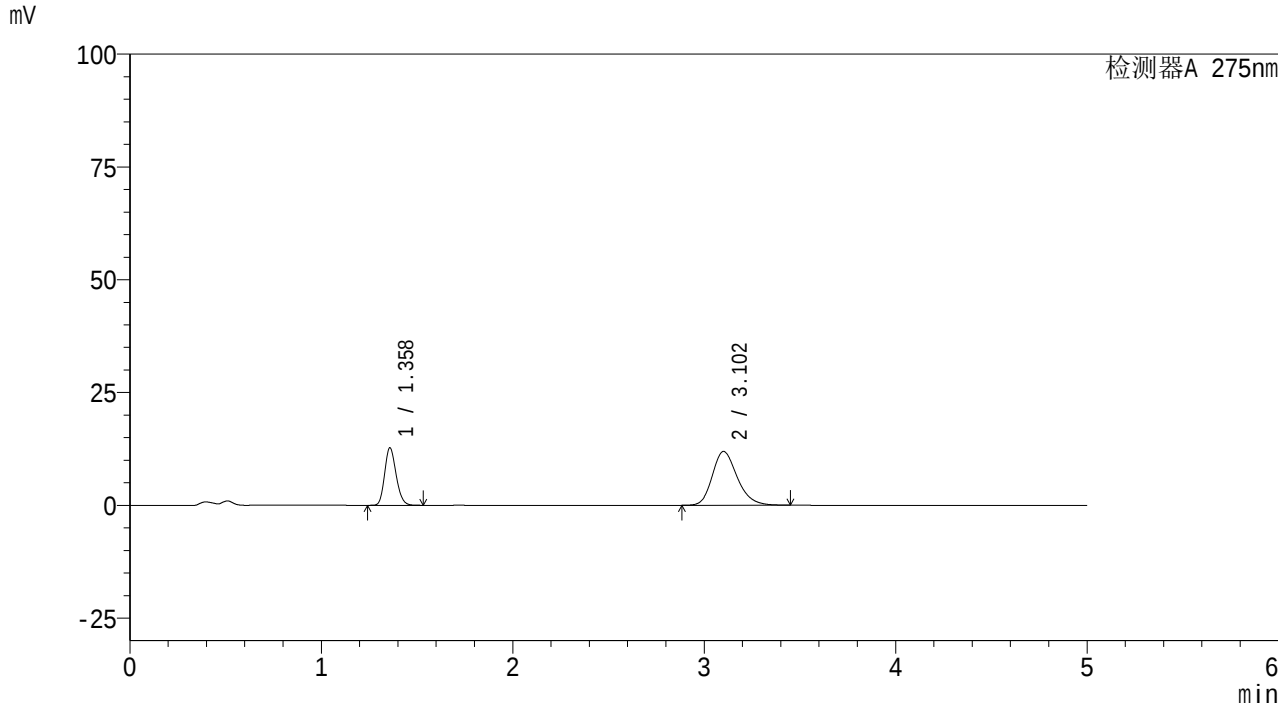

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52923	32.919	12677	2473	1.182	--
2	3.102	107843	67.081	11910	2806	1.216	10.154
总计		160766	100.000	24587			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-988-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 07:38:13

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

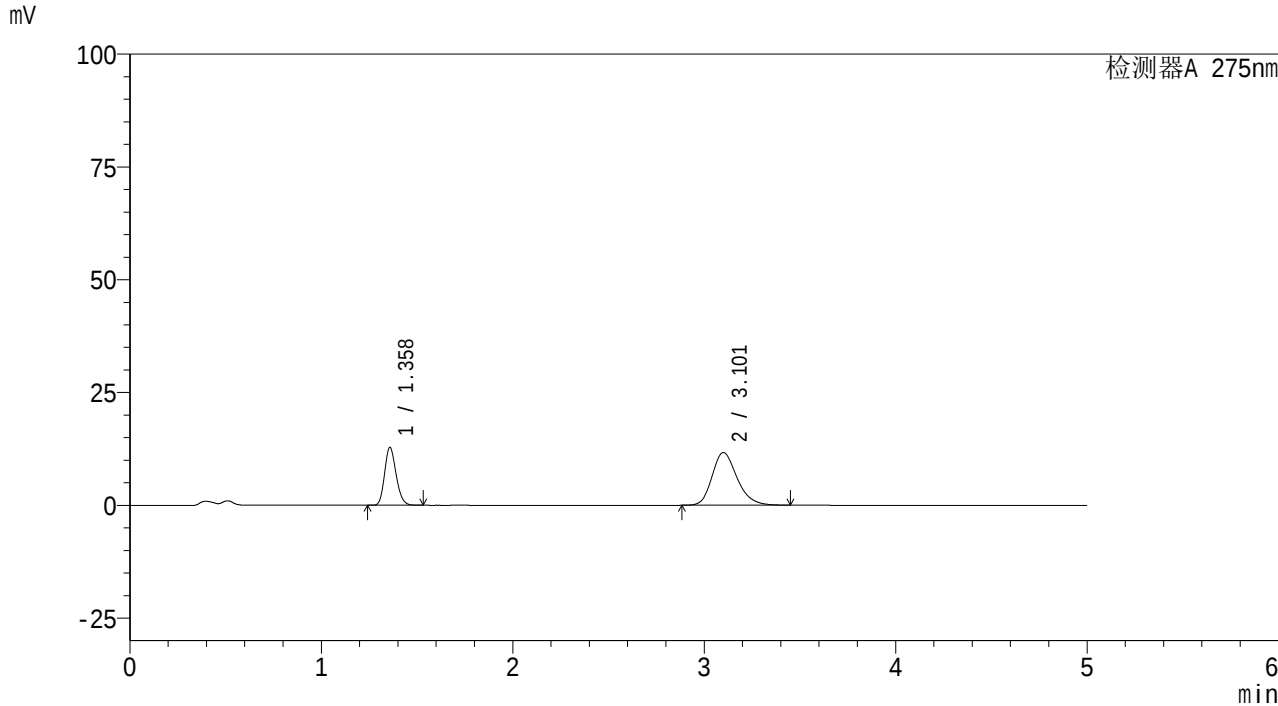

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	53438	33.550	12772	2459	1.183	--
2	3.101	105843	66.450	11658	2797	1.219	10.130
总计		159281	100.000	24430			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-989-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:43:35
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

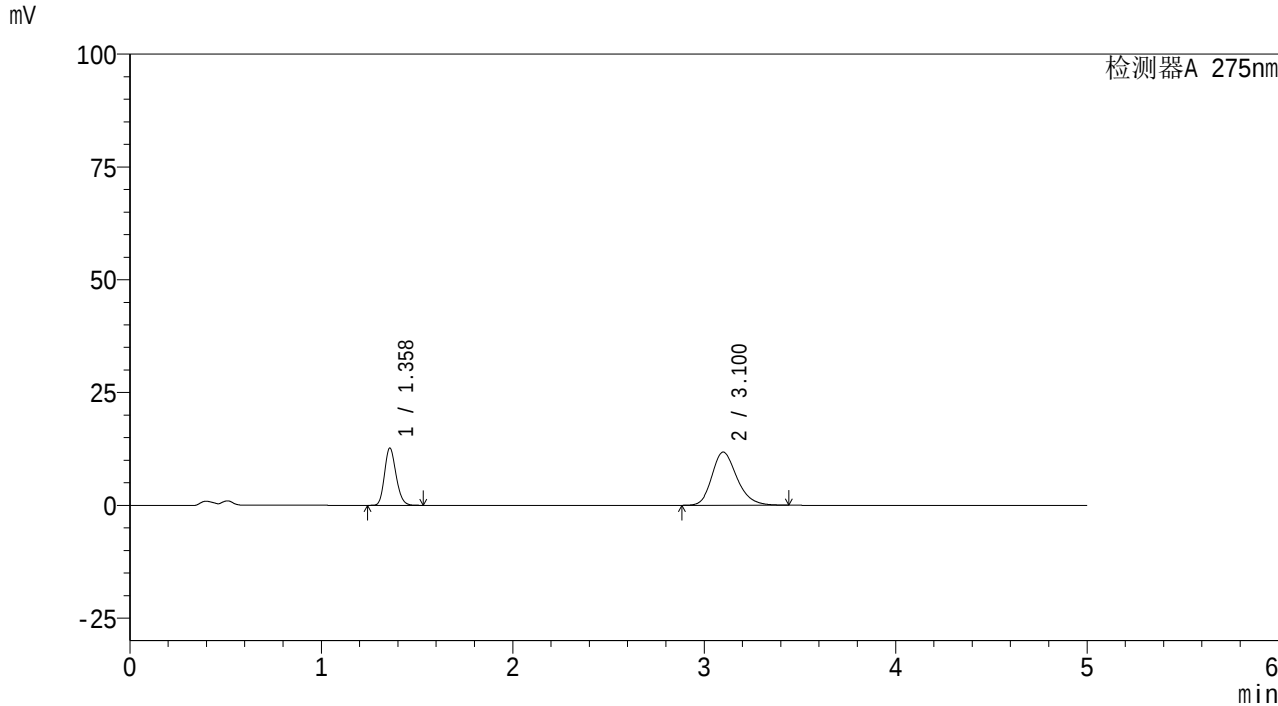

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52859	33.065	12655	2455	1.183	--
2	3.100	107008	66.935	11777	2783	1.220	10.111
总计		159867	100.000	24432			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-990-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:48:58
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

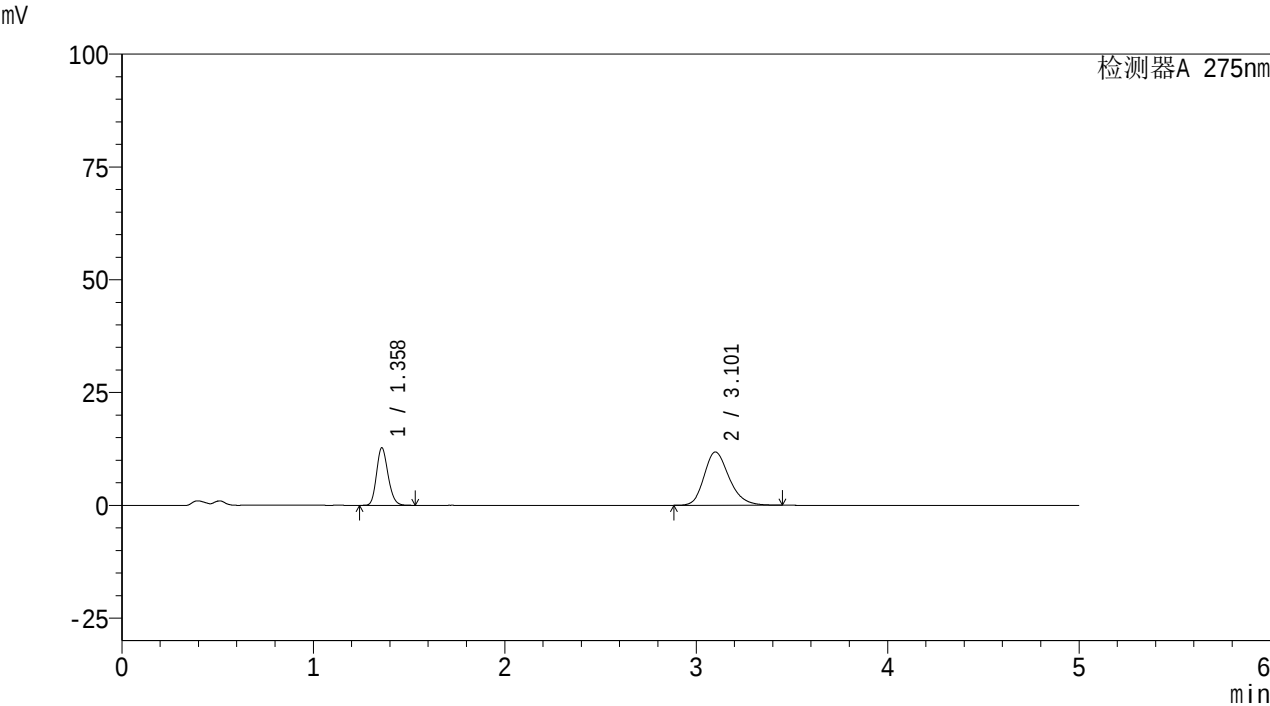

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	53027	33.130	12693	2453	1.183	--
2	3.101	107031	66.870	11779	2794	1.219	10.127
总计		160059	100.000	24472			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-991-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:54:23
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

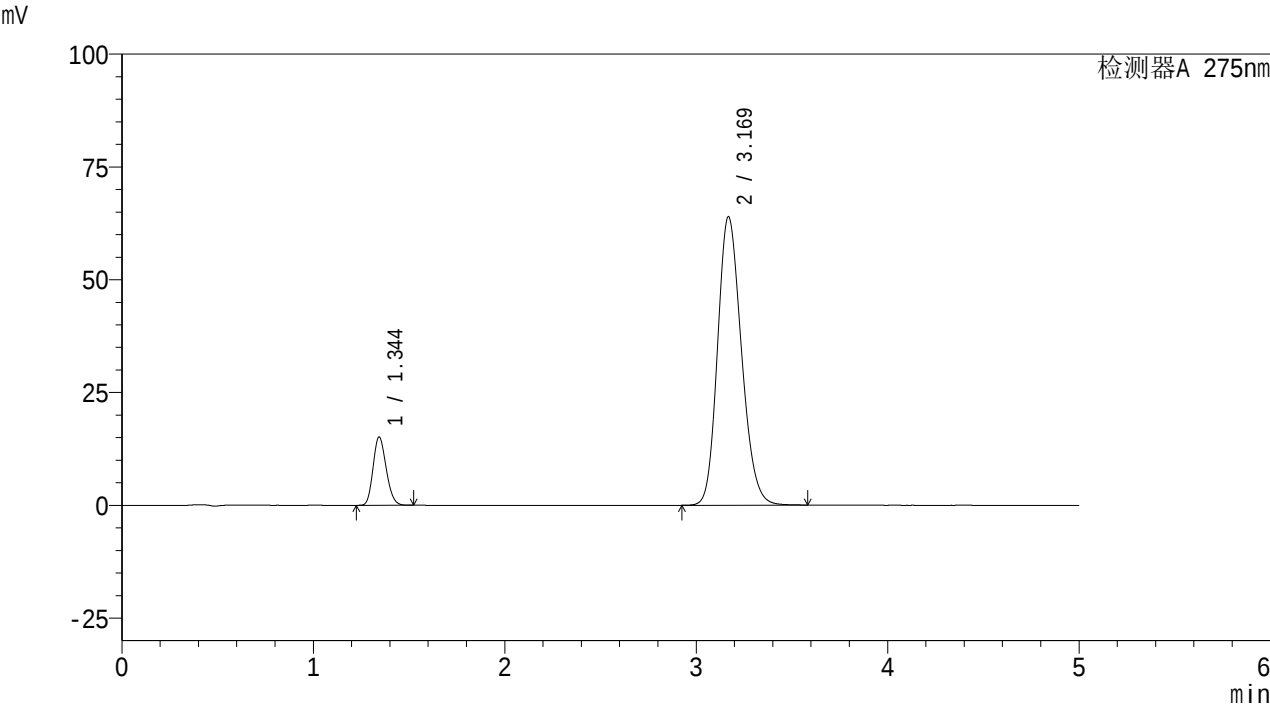

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	71787	11.496	15064	1835	1.175	--
2	3.169	552681	88.504	63876	3126	1.187	10.366
总计		624469	100.000	78940			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-992-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 07:59:47
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

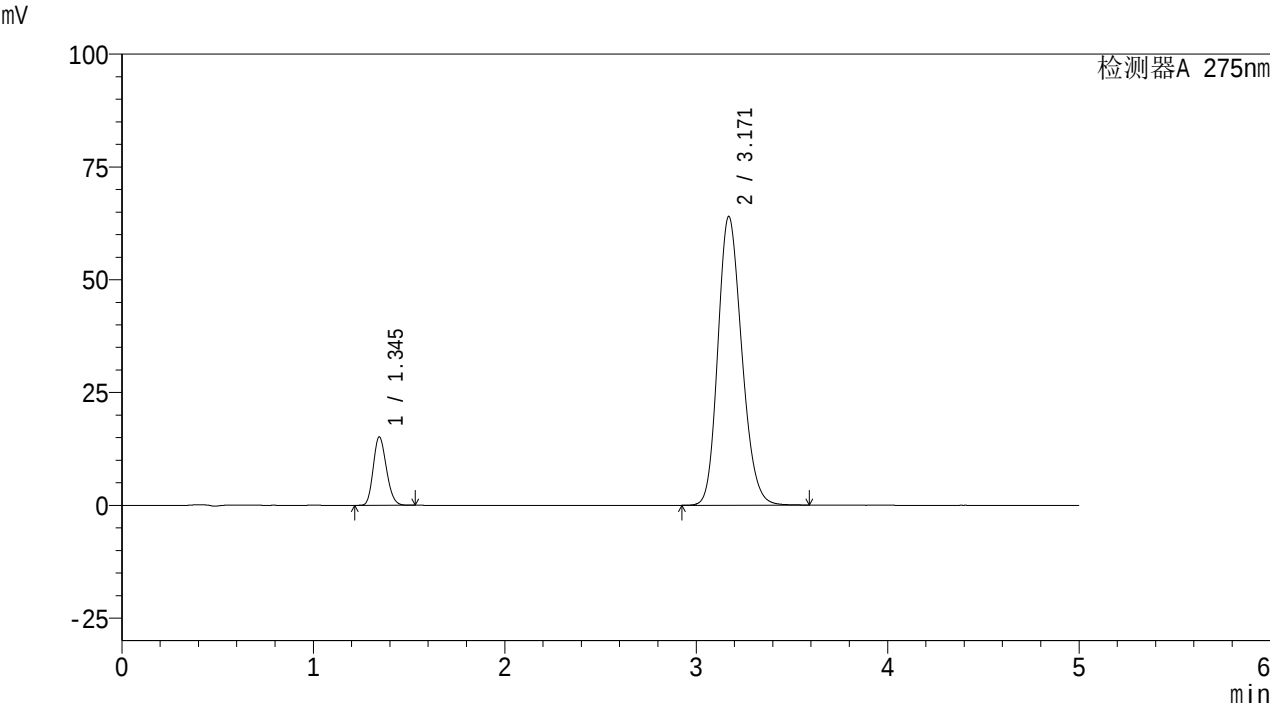

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	72019	11.530	15137	1833	1.173	--
2	3.171	552630	88.470	63997	3136	1.187	10.372
总计		624649	100.000	79133			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-993-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:05:11
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

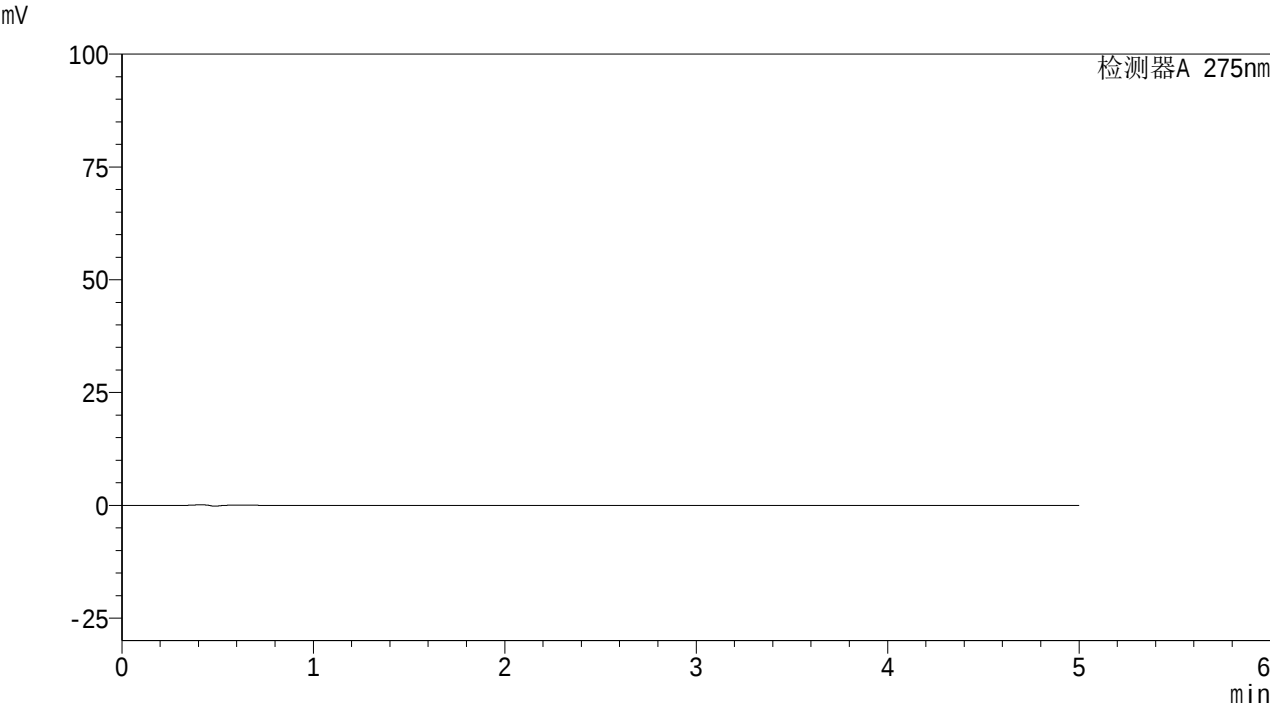

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-994-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:10:34
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

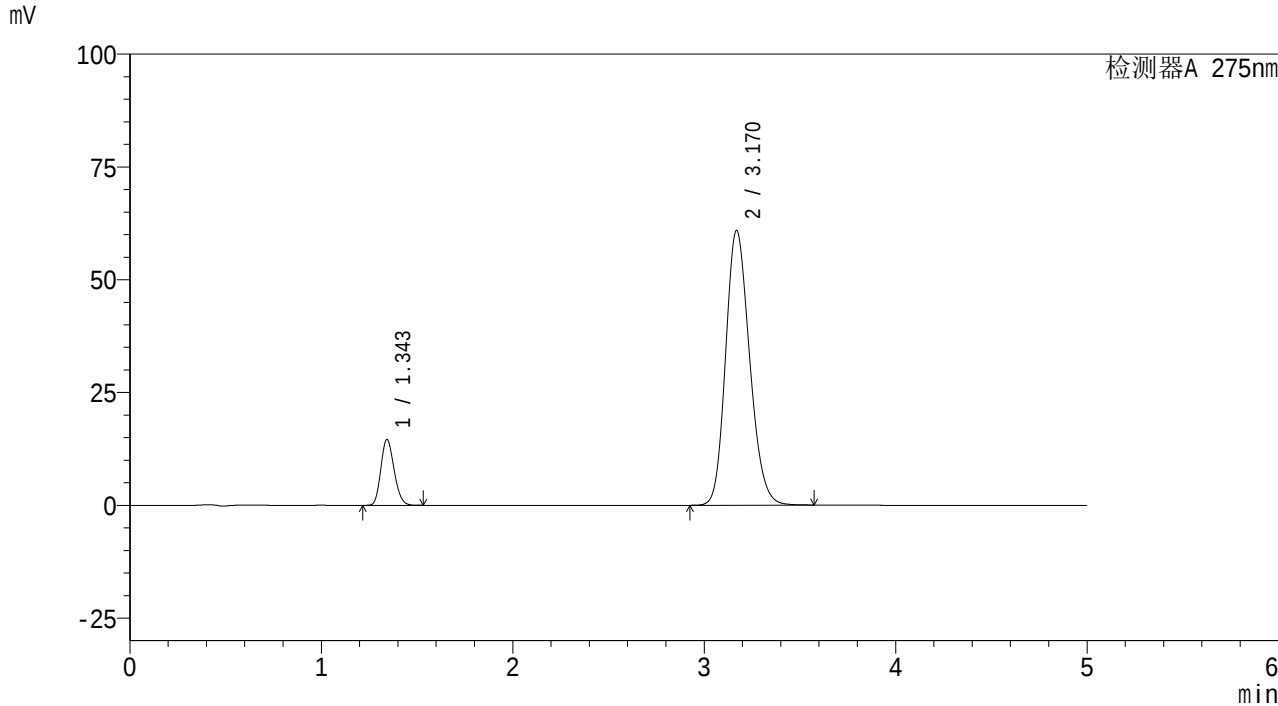

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	69951	11.698	14489	1795	1.175	--
2	3.170	528022	88.302	60855	3104	1.185	10.313
总计		597972	100.000	75344			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-995-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:15:56

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

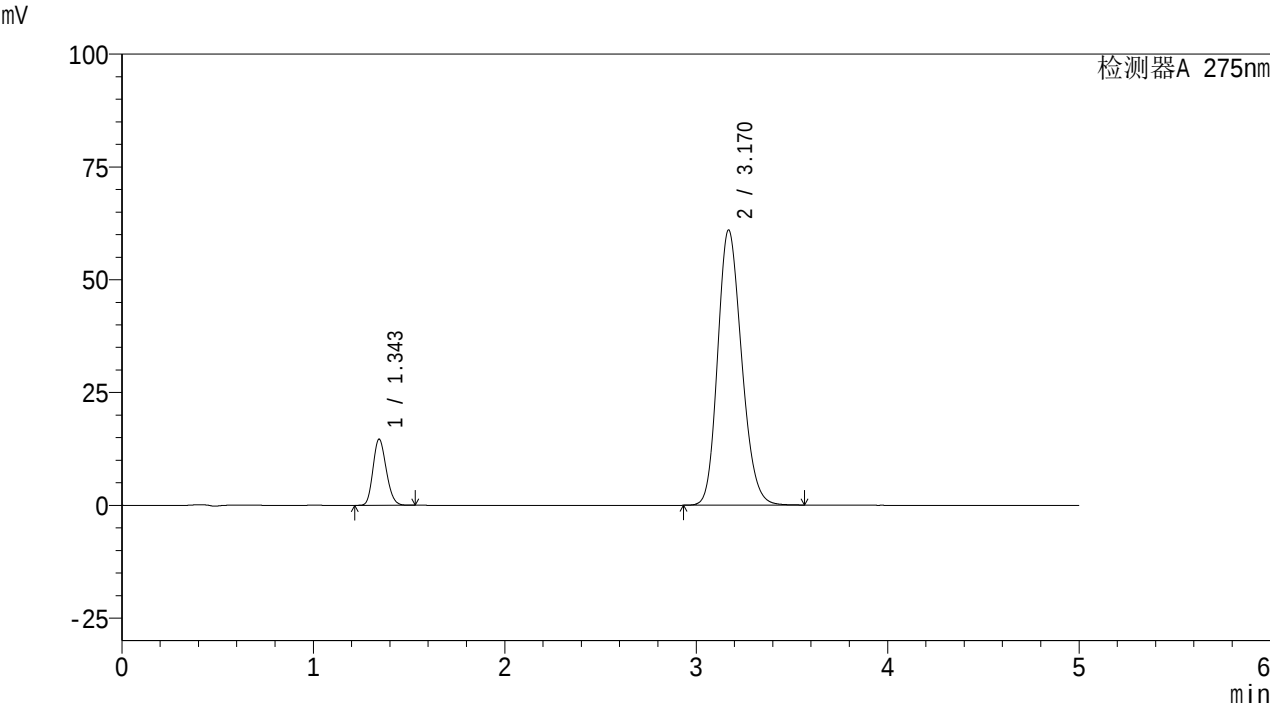

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	70116	11.723	14587	1803	1.174	--
2	3.170	527974	88.277	60978	3115	1.185	10.326
总计		598090	100.000	75565			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-996-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:21:21

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

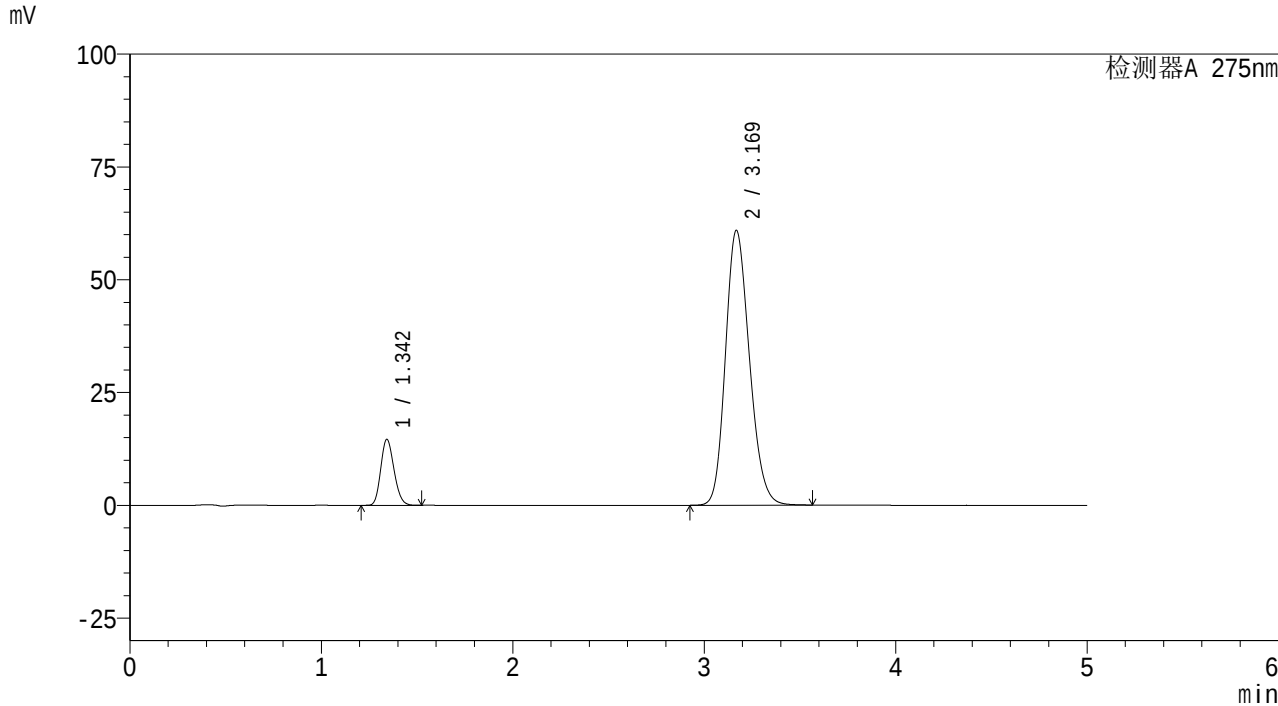

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	70064	11.728	14534	1795	1.176	--
2	3.169	527333	88.272	60839	3113	1.185	10.323
总计		597396	100.000	75372			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-997-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:26:44
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

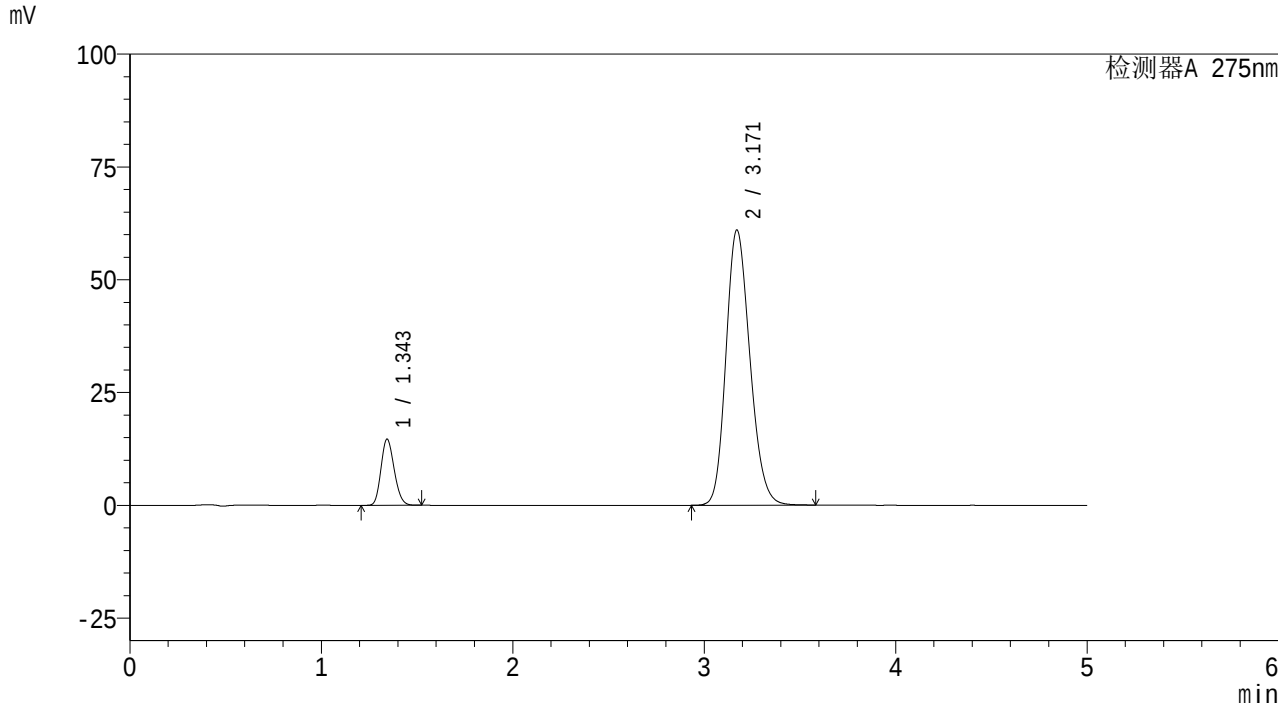

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	70134	11.724	14583	1803	1.175	--
2	3.171	528068	88.276	61025	3120	1.185	10.337
总计		598203	100.000	75609			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-998-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:32:07
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

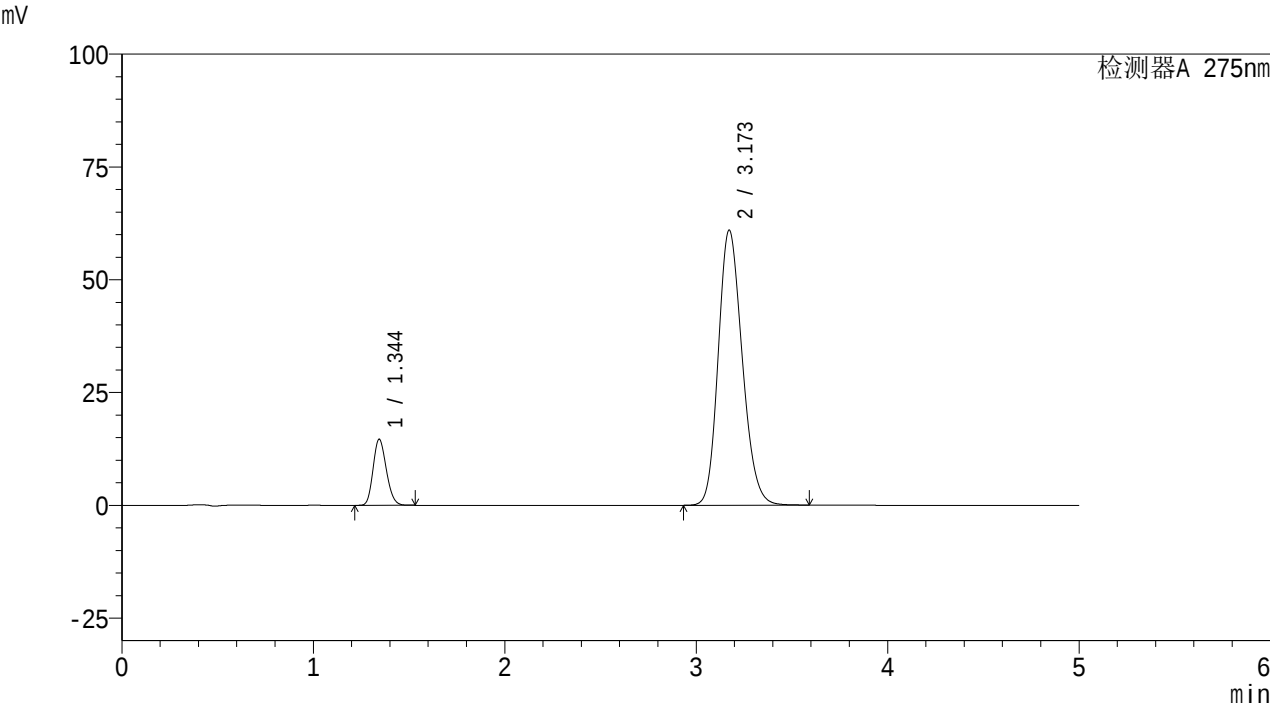

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	70108	11.709	14599	1801	1.174	--
2	3.173	528655	88.291	60983	3112	1.185	10.328
总计		598763	100.000	75582			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-999-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:37:30
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

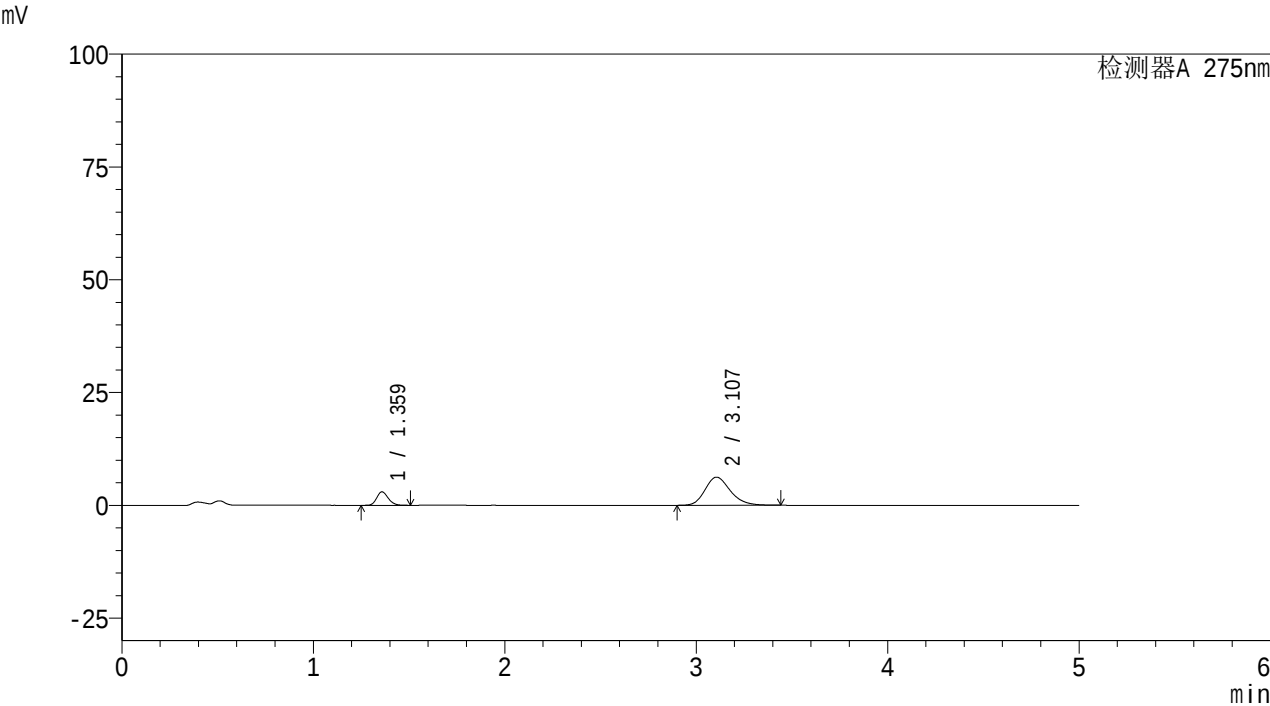

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	12447	17.896	2960	2446	1.181	--
2	3.107	57106	82.104	6234	2747	1.208	10.077
总计		69553	100.000	9195			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1000-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 08:42:53
处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

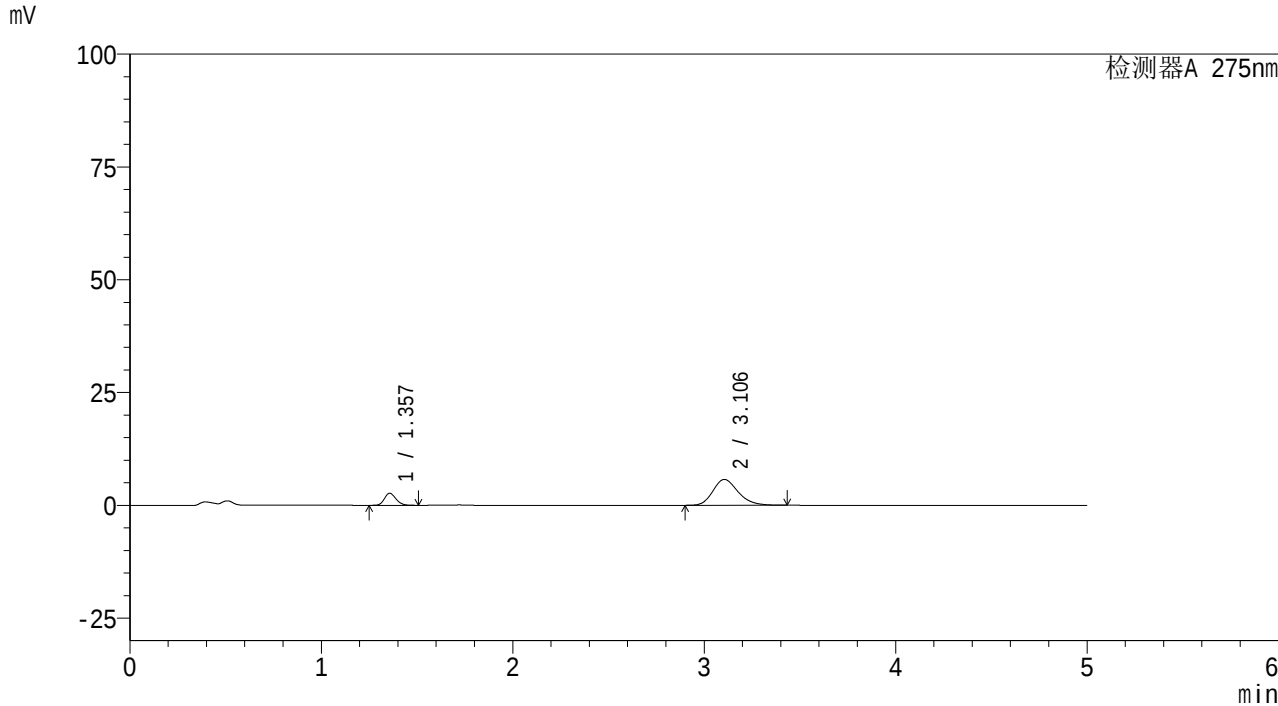

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	11202	17.594	2683	2446	1.181	--
2	3.106	52467	82.406	5734	2745	1.207	10.083
总计		63668	100.000	8417			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1001-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:48:15

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

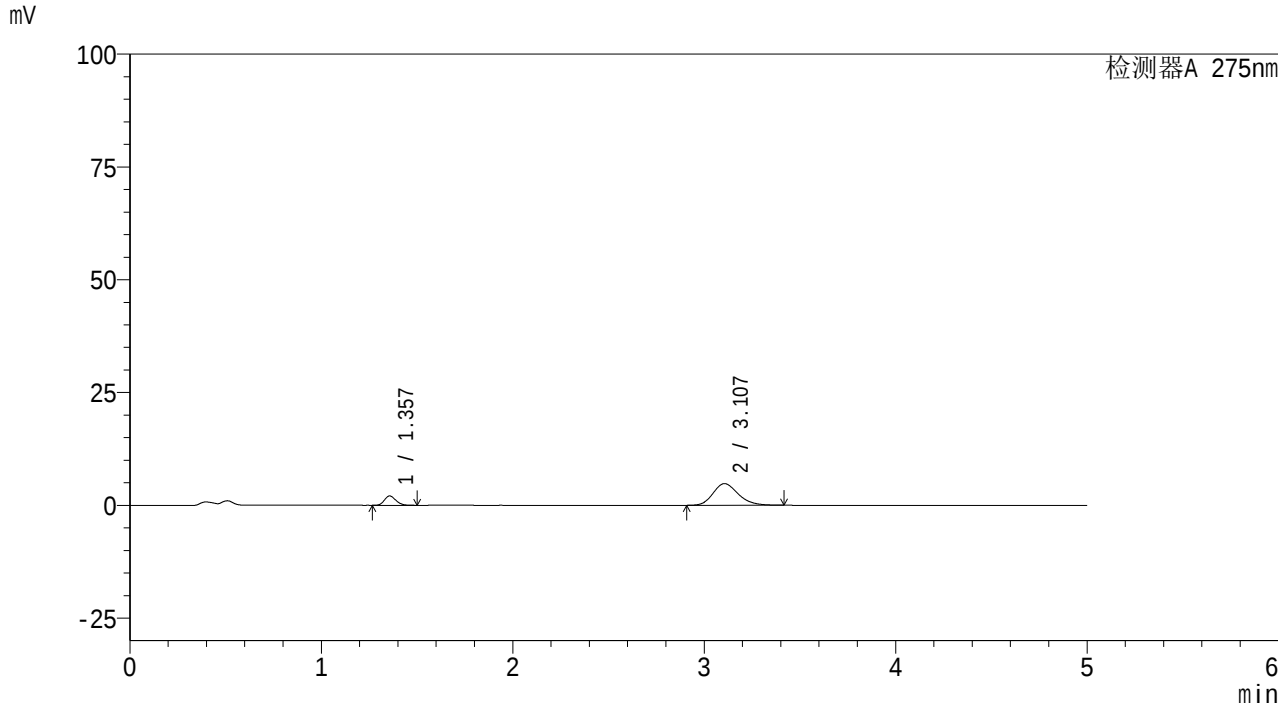

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	8586	16.358	2066	2447	1.178	--
2	3.107	43902	83.642	4799	2733	1.199	10.074
总计		52488	100.000	6865			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1002-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:53:38

处理时间(V2): 2026/05/15 17:26:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

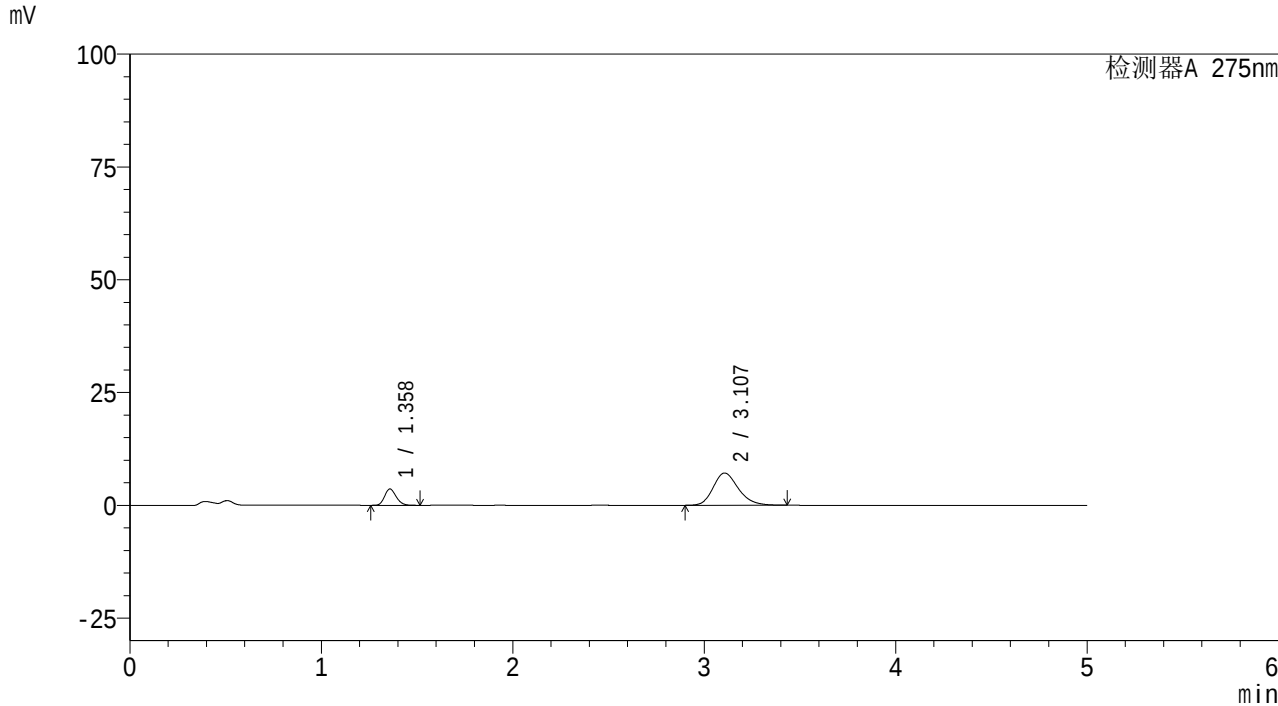

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	15100	18.780	3606	2446	1.183	--
2	3.107	65302	81.220	7145	2755	1.206	10.093
总计		80402	100.000	10751			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1003-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 08:59:00

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

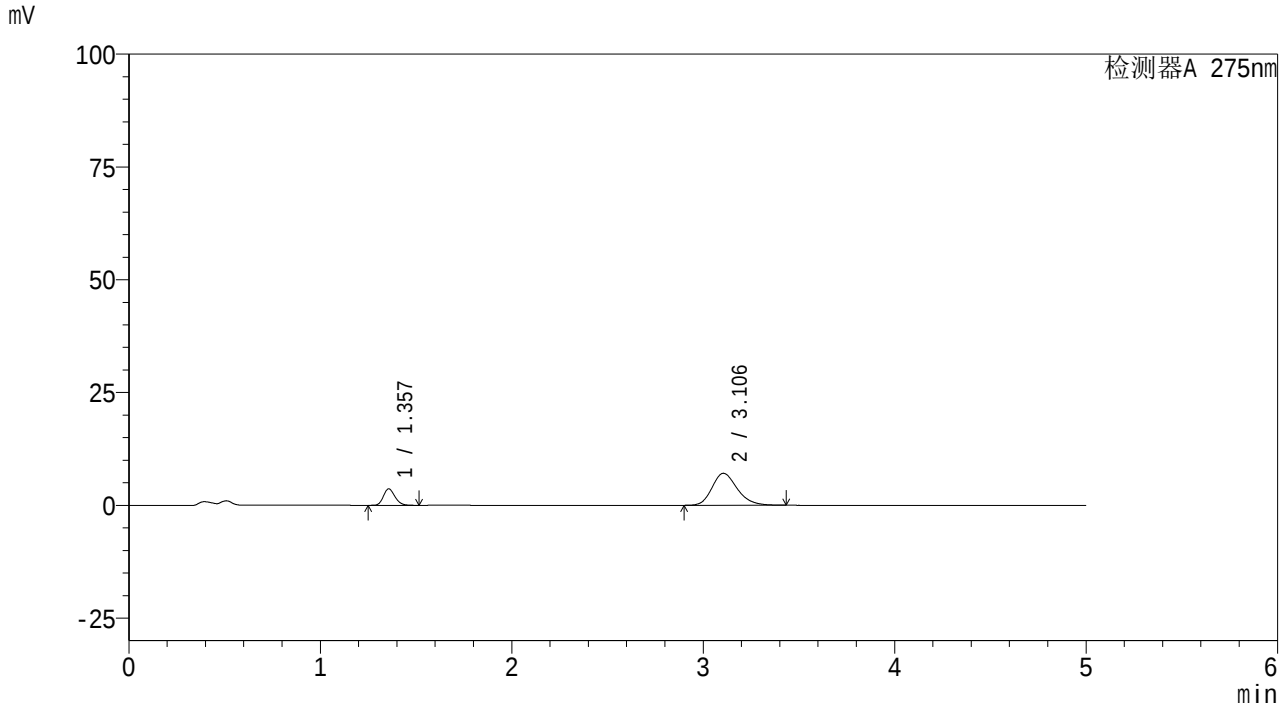

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	15211	19.029	3644	2450	1.184	--
2	3.106	64726	80.971	7089	2754	1.208	10.100
总计		79937	100.000	10733			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1004-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:04:23
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

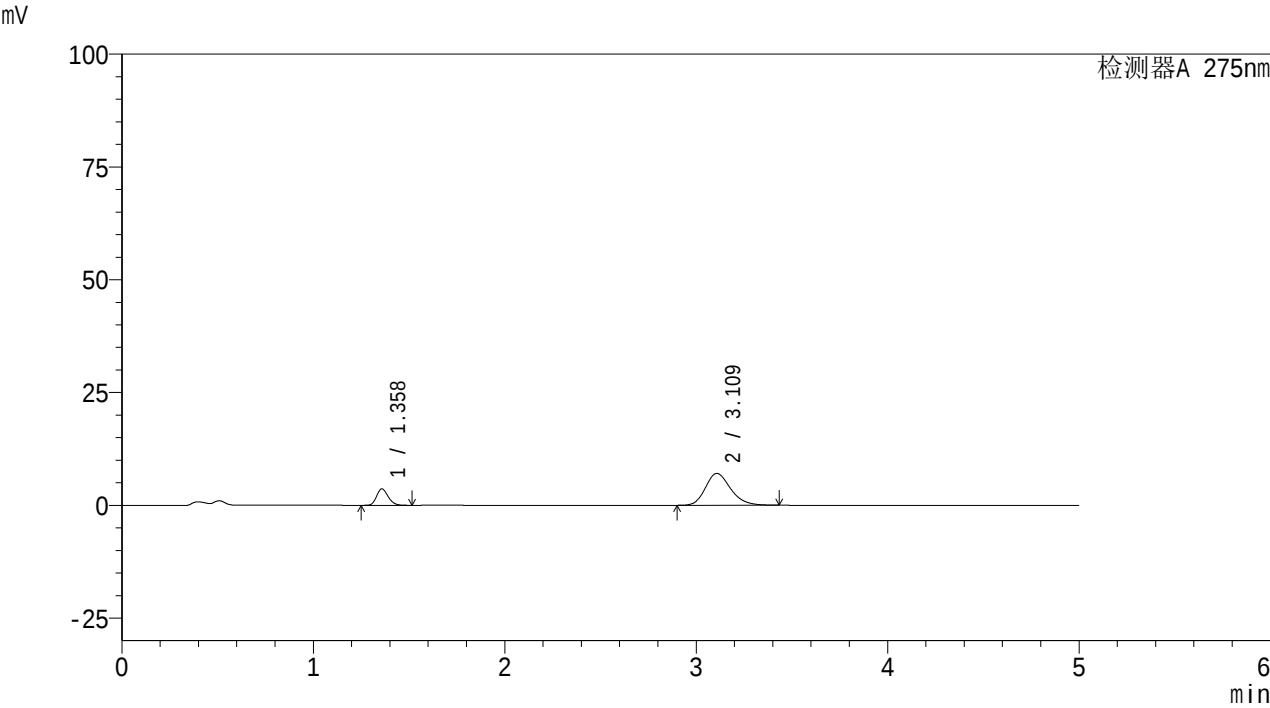

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	15207	19.080	3628	2445	1.181	--
2	3.109	64491	80.920	7051	2759	1.208	10.103
总计		79698	100.000	10679			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1005-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 09:09:45

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

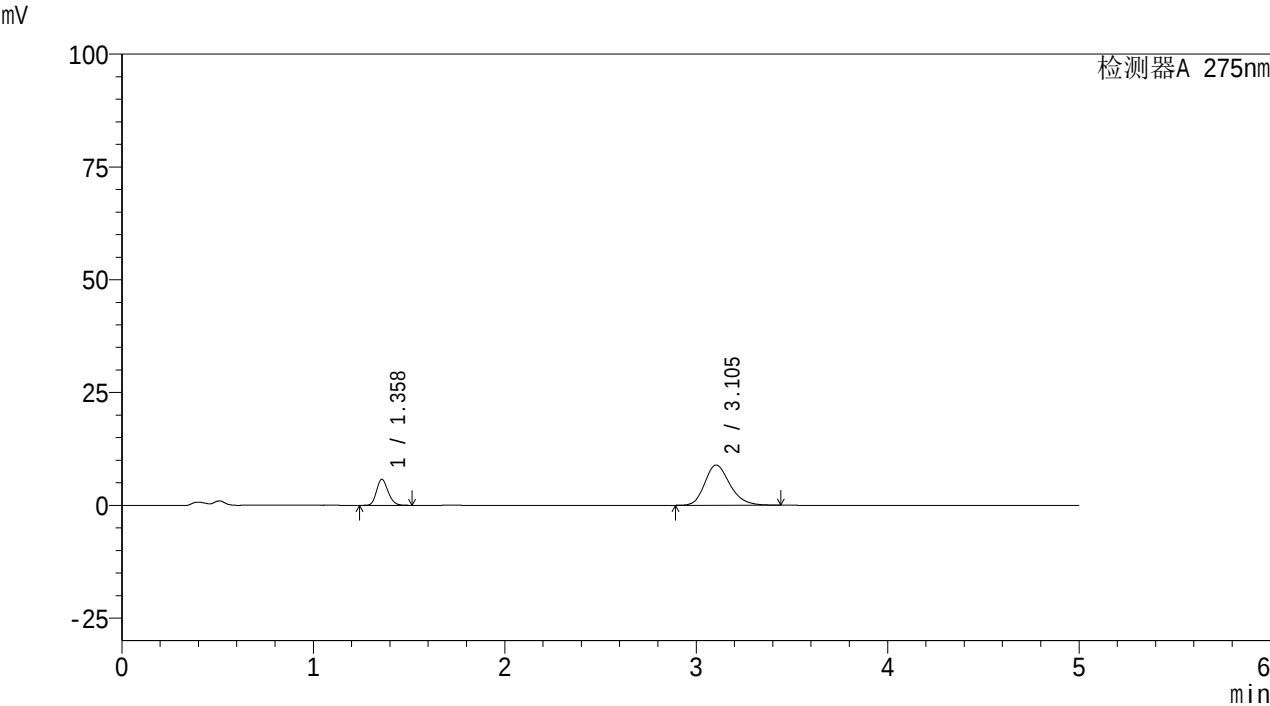

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	24005	22.800	5748	2456	1.181	--
2	3.105	81282	77.200	8927	2770	1.214	10.113
总计		105287	100.000	14675			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1006-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:15:08
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

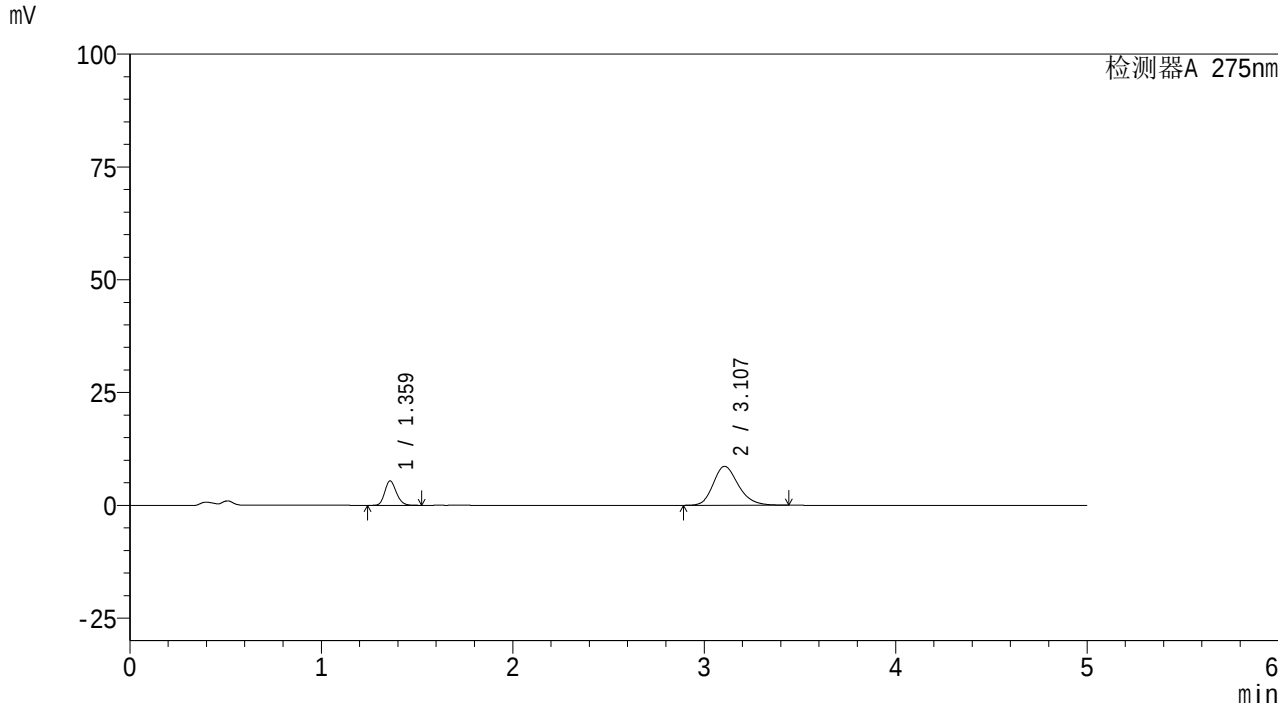

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	22561	22.269	5354	2450	1.183	--
2	3.107	78751	77.731	8634	2775	1.211	10.112
总计		101313	100.000	13988			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1007-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 09:20:30

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

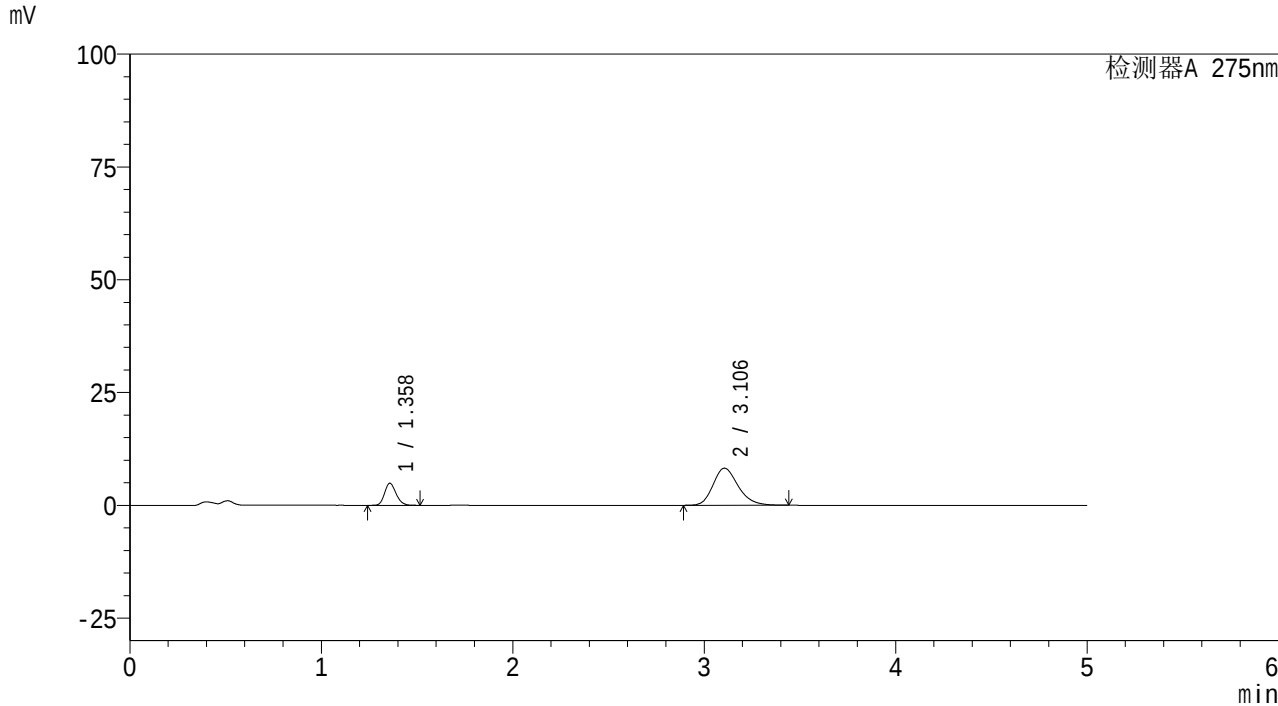

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	20352	21.359	4869	2455	1.183	--
2	3.106	74934	78.641	8227	2766	1.211	10.111
总计		95287	100.000	13096			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1008-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:25:53
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

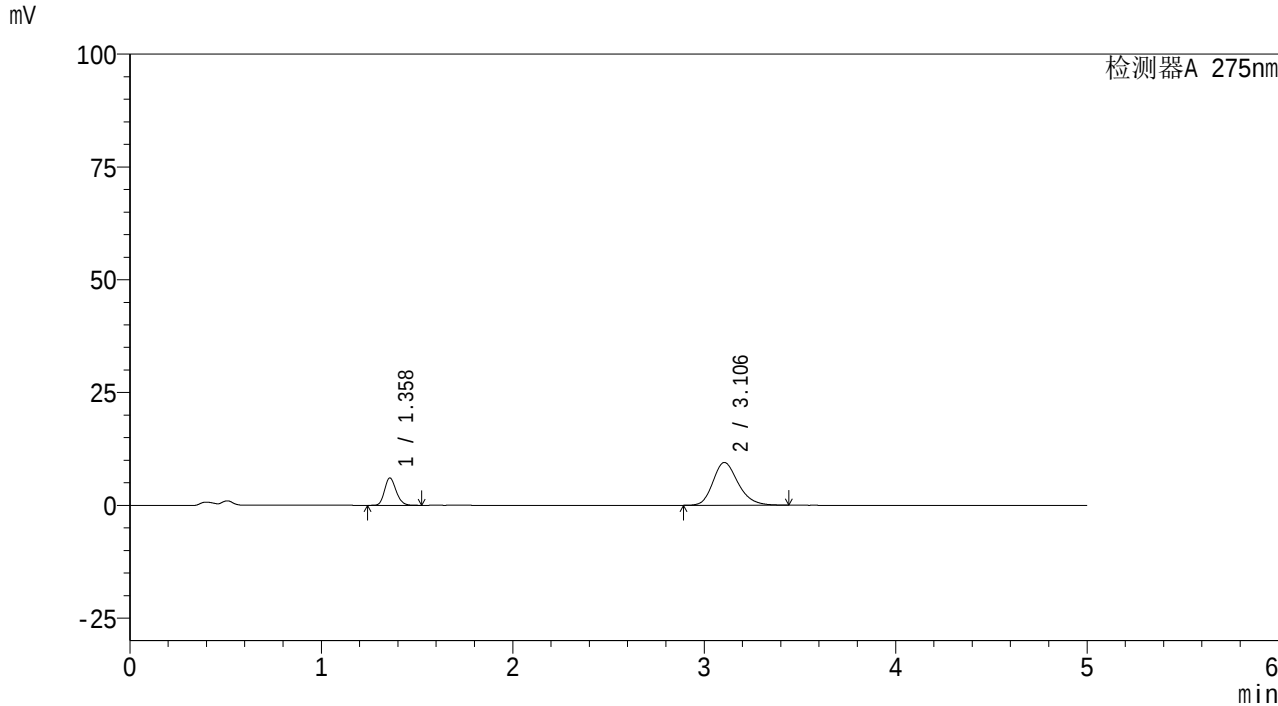

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	25327	22.651	6043	2445	1.182	--
2	3.106	86486	77.349	9487	2769	1.214	10.107
总计		111812	100.000	15529			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1009-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:31:15
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

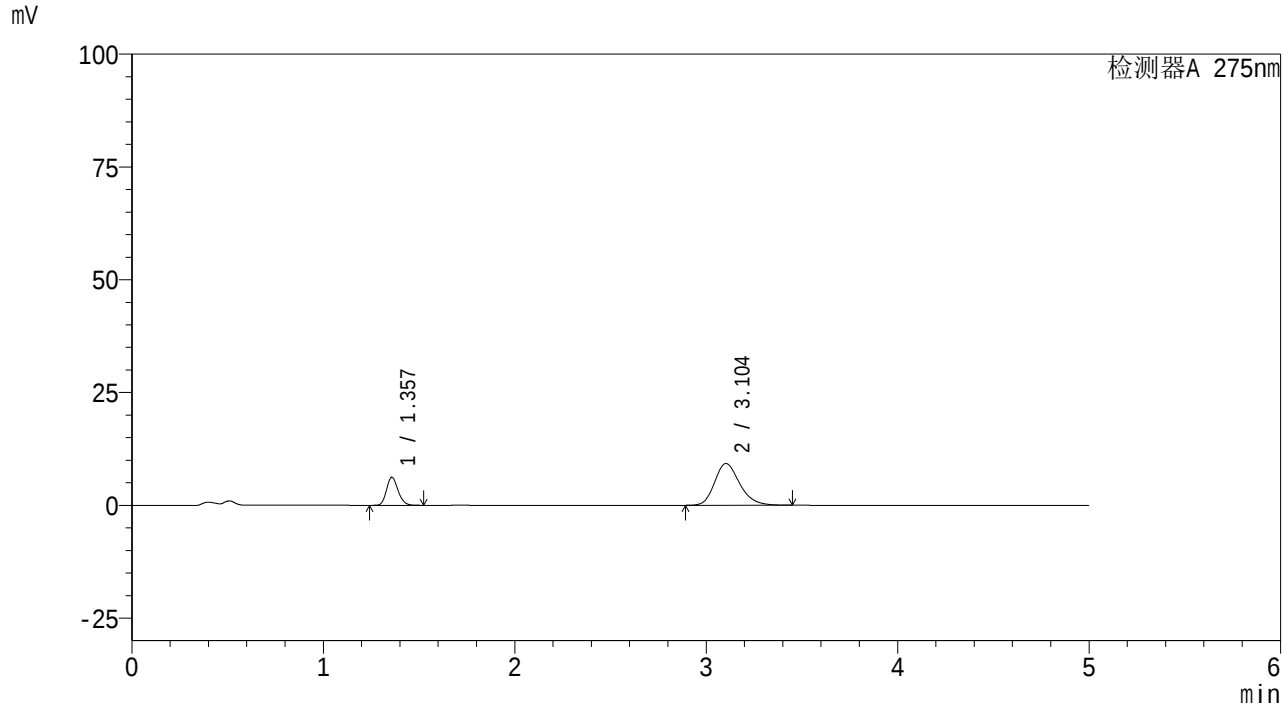

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	25922	23.514	6203	2450	1.183	--
2	3.104	84318	76.486	9255	2772	1.214	10.110
总计		110240	100.000	15458			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1010-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:36:37
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

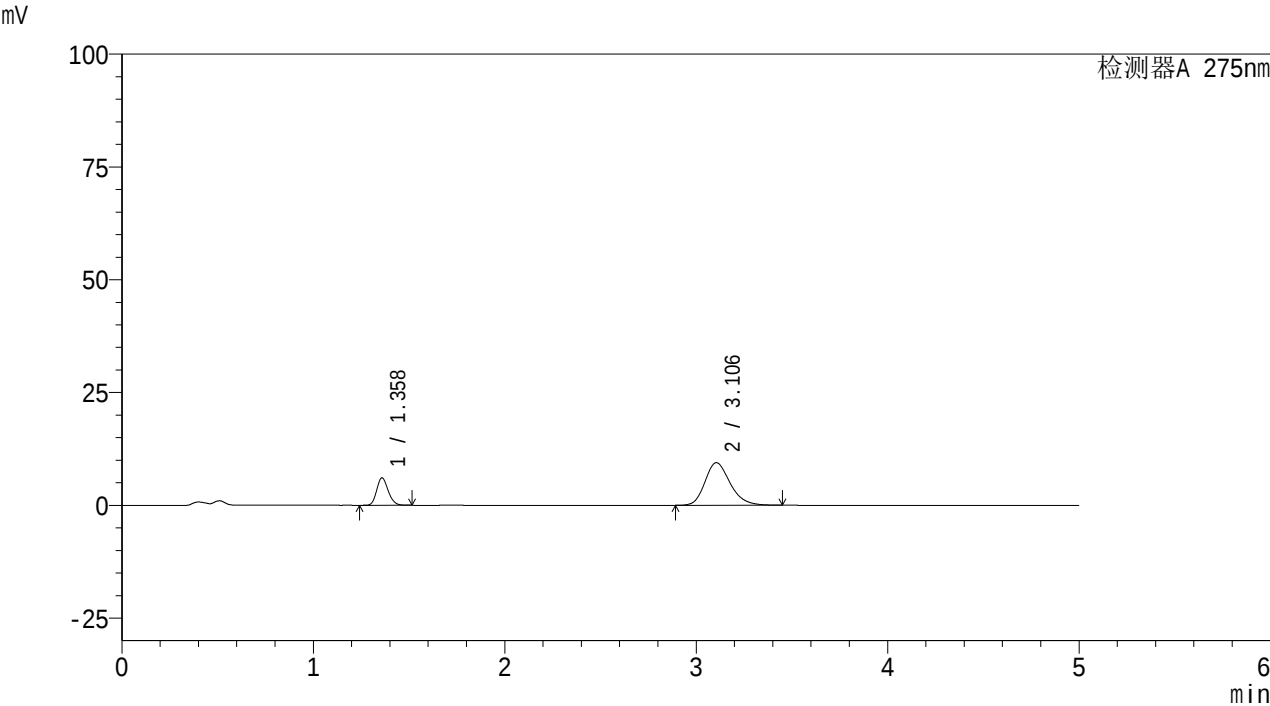

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	25332	22.744	6042	2459	1.182	--
2	3.106	86046	77.256	9438	2766	1.216	10.107
总计		111377	100.000	15480			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1011-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 09:42:00
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

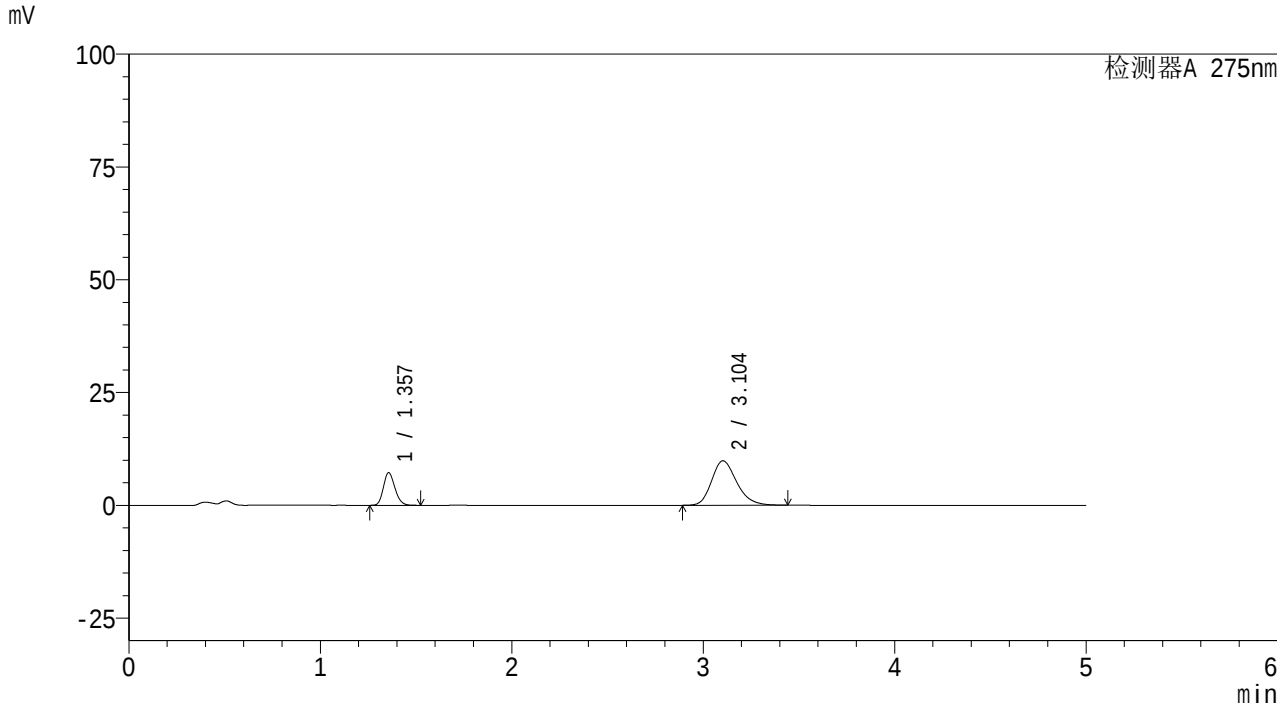

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	30184	25.194	7233	2452	1.183	--
2	3.104	89621	74.806	9859	2777	1.214	10.121
总计		119805	100.000	17092			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1012-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 09:47:22

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

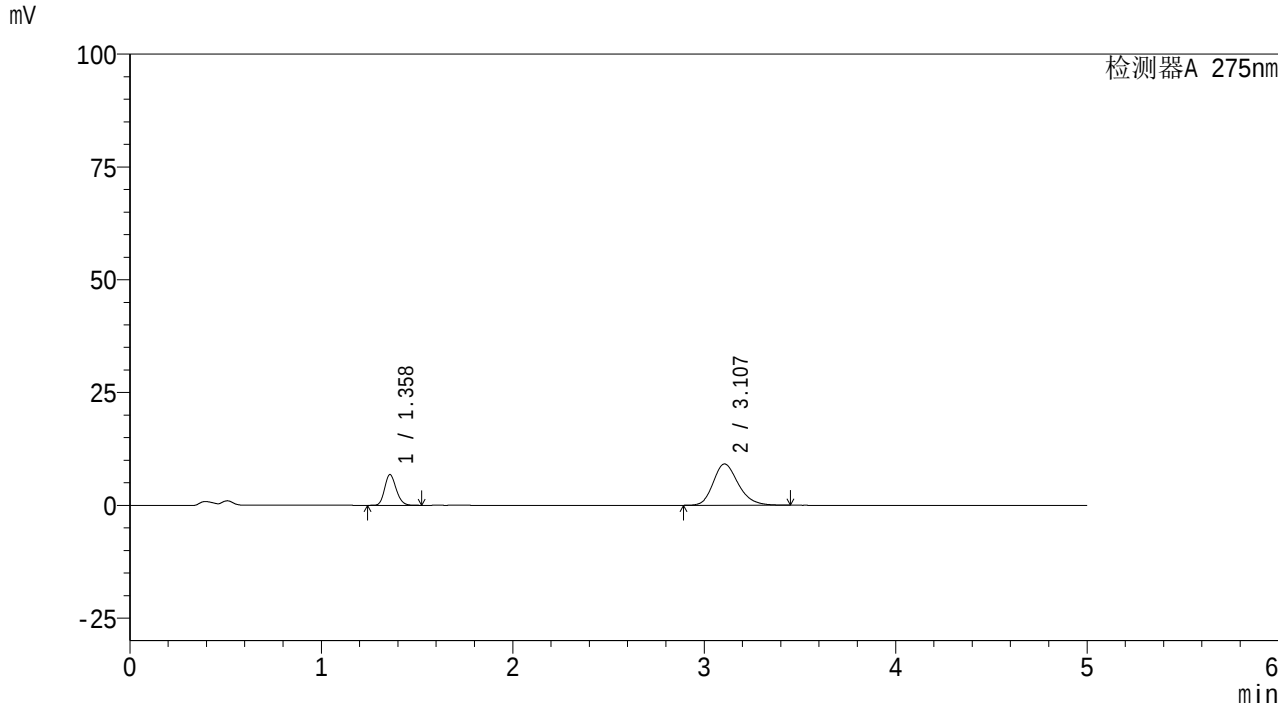

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	28372	25.404	6761	2449	1.182	--
2	3.107	83311	74.596	9155	2783	1.213	10.126
总计		111683	100.000	15916			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1013-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 09:52:45

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

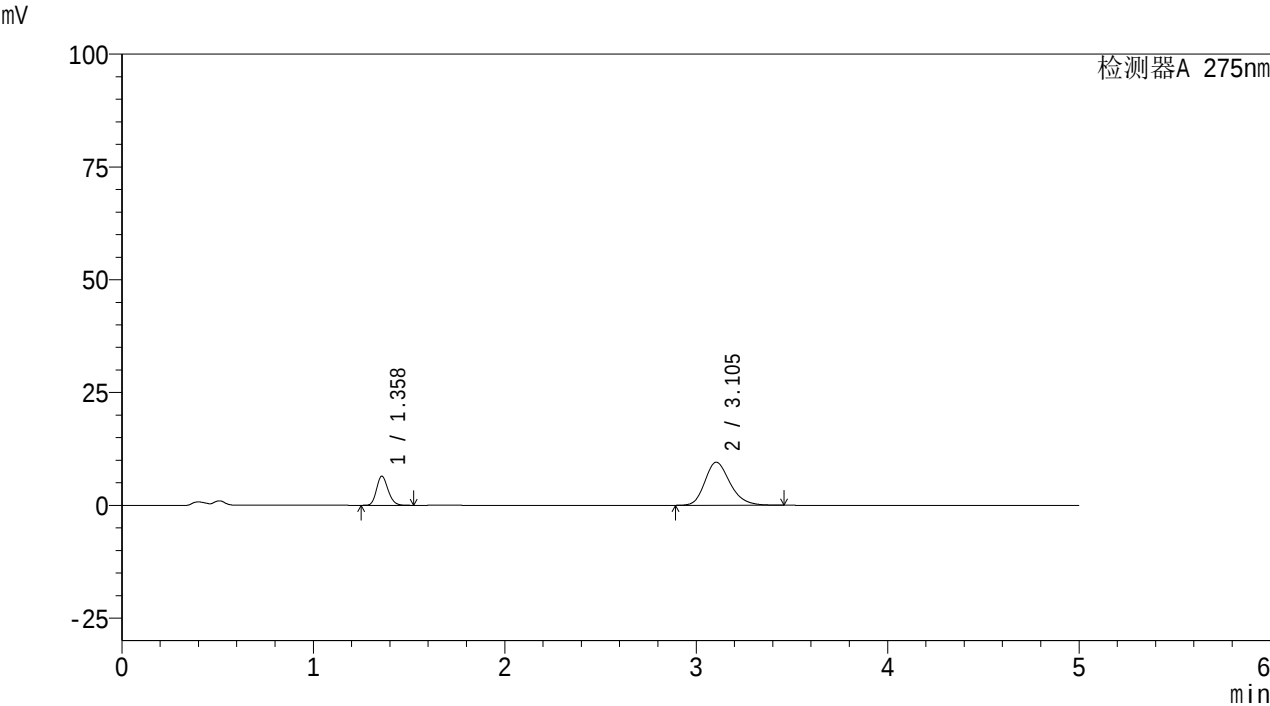

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	26876	23.576	6428	2451	1.183	--
2	3.105	87122	76.424	9556	2774	1.215	10.117
总计		113997	100.000	15984			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1014-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 09:58:07

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

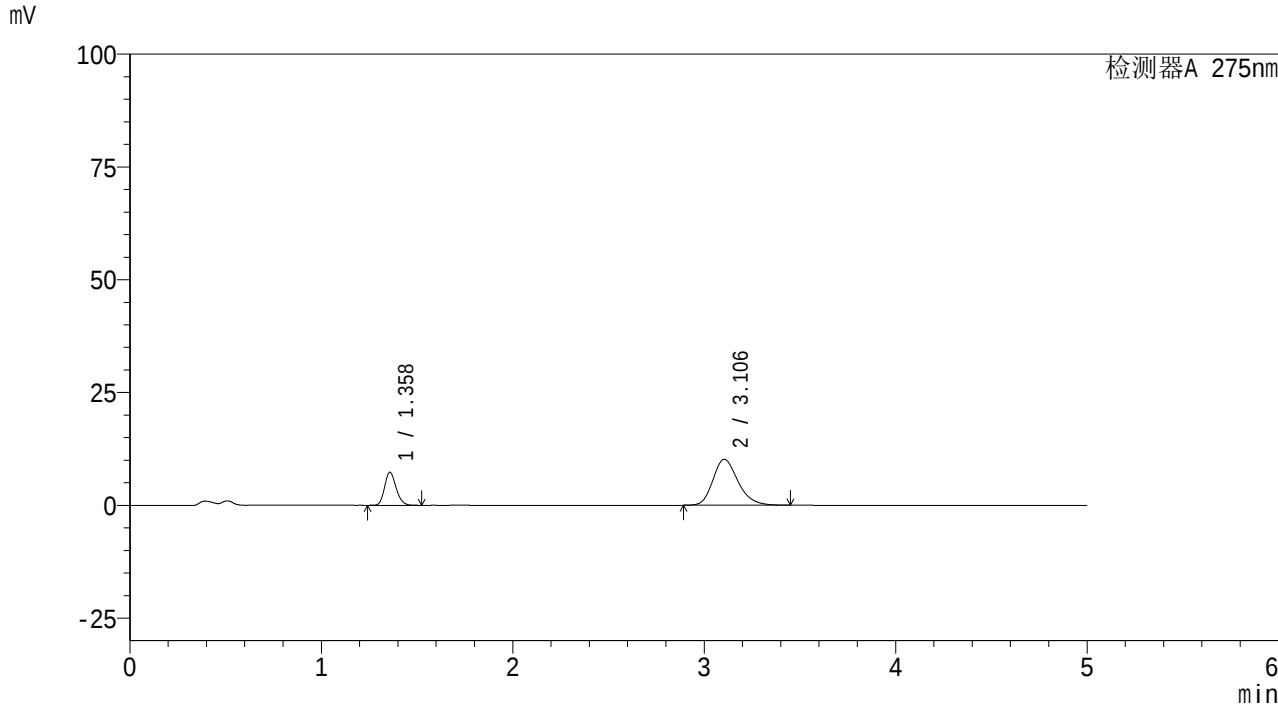

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	30472	24.731	7285	2453	1.183	--
2	3.106	92741	75.269	10191	2777	1.217	10.120
总计		123213	100.000	17476			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1015-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:03:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

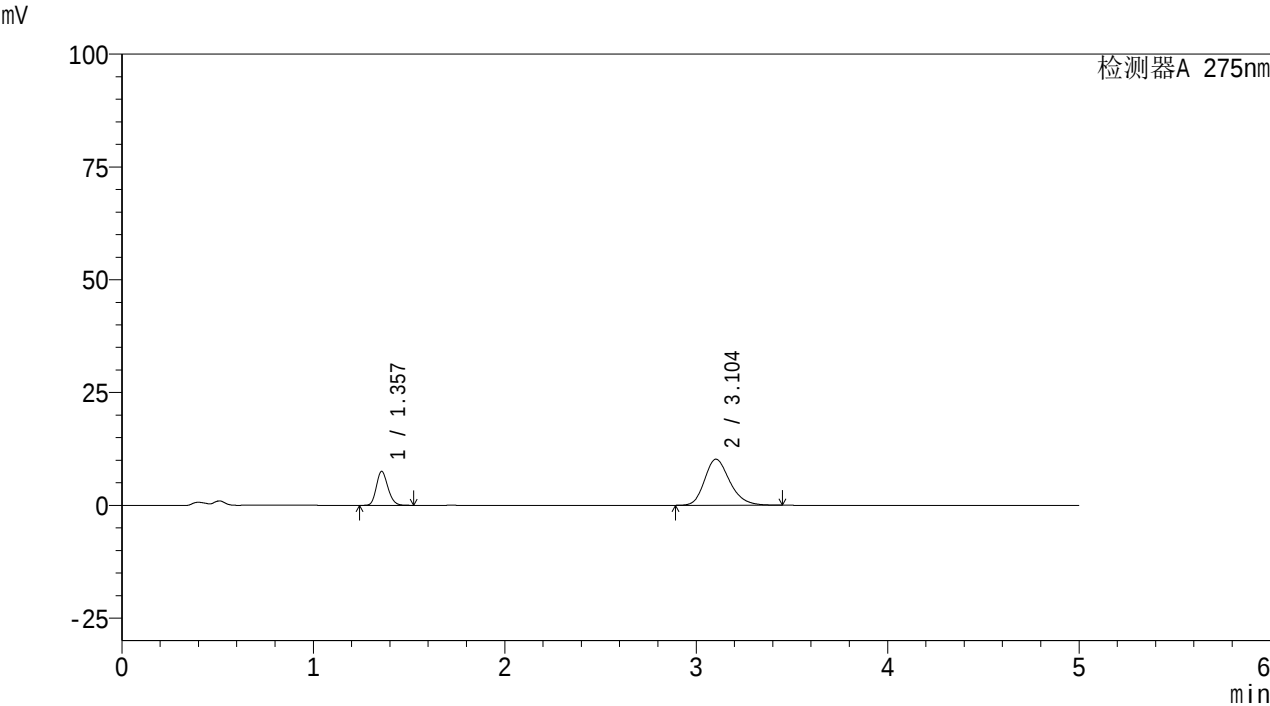

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	31411	25.175	7513	2443	1.182	--
2	3.104	93360	74.825	10220	2759	1.220	10.093
总计		124771	100.000	17733			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1016-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:08:52

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

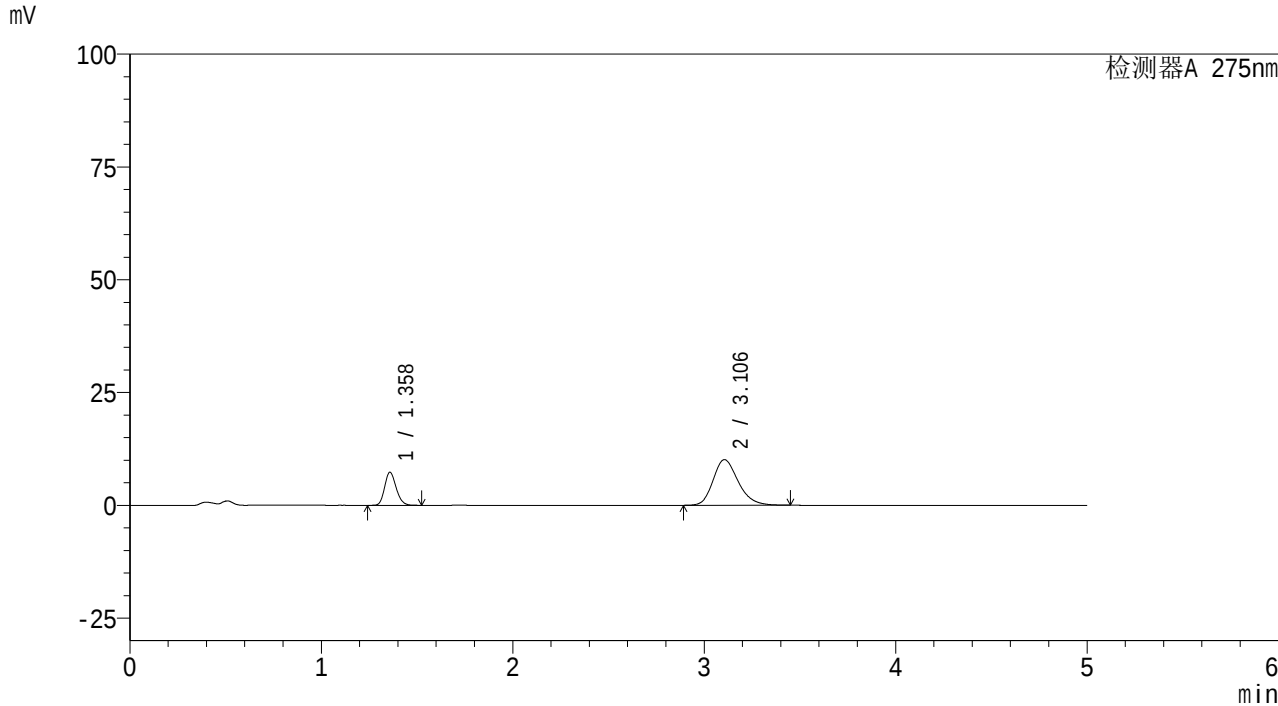

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	30567	24.917	7292	2452	1.181	--
2	3.106	92110	75.083	10123	2782	1.216	10.127
总计		122677	100.000	17414			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1017-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:14:14
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

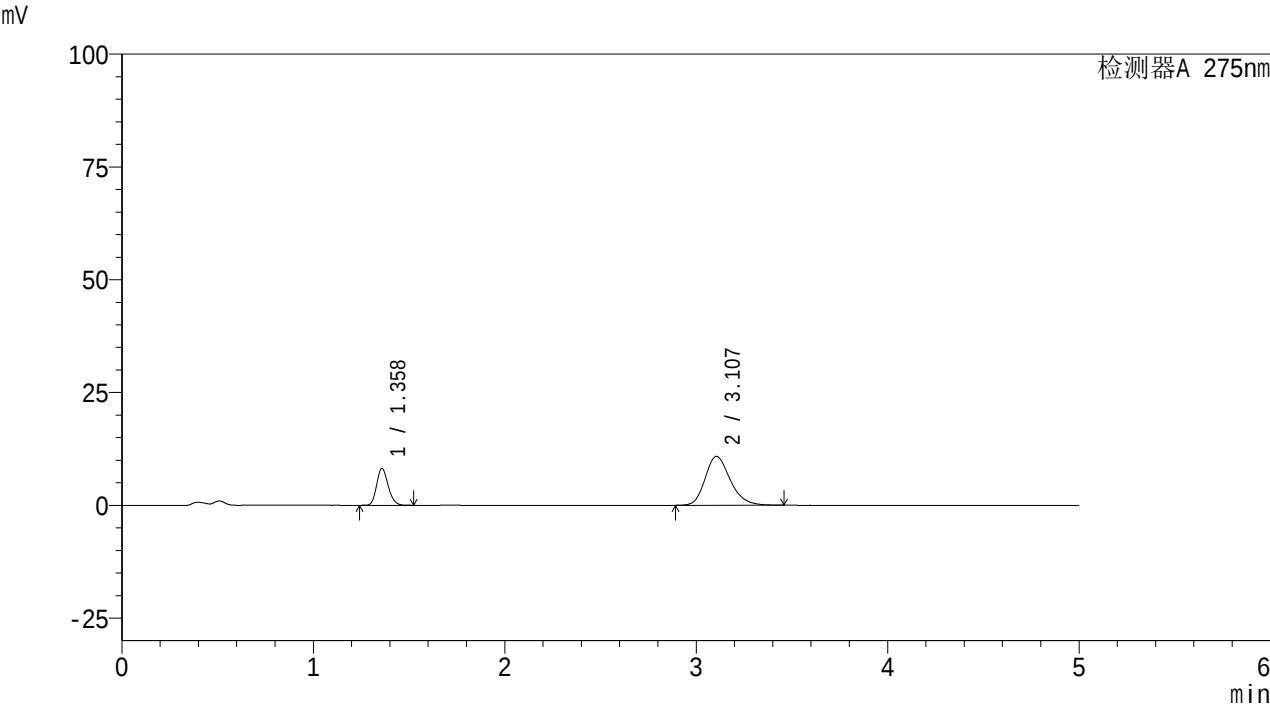

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34097	25.683	8135	2454	1.183	--
2	3.107	98666	74.317	10844	2786	1.219	10.133
总计		132764	100.000	18979			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1018-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:19:36
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

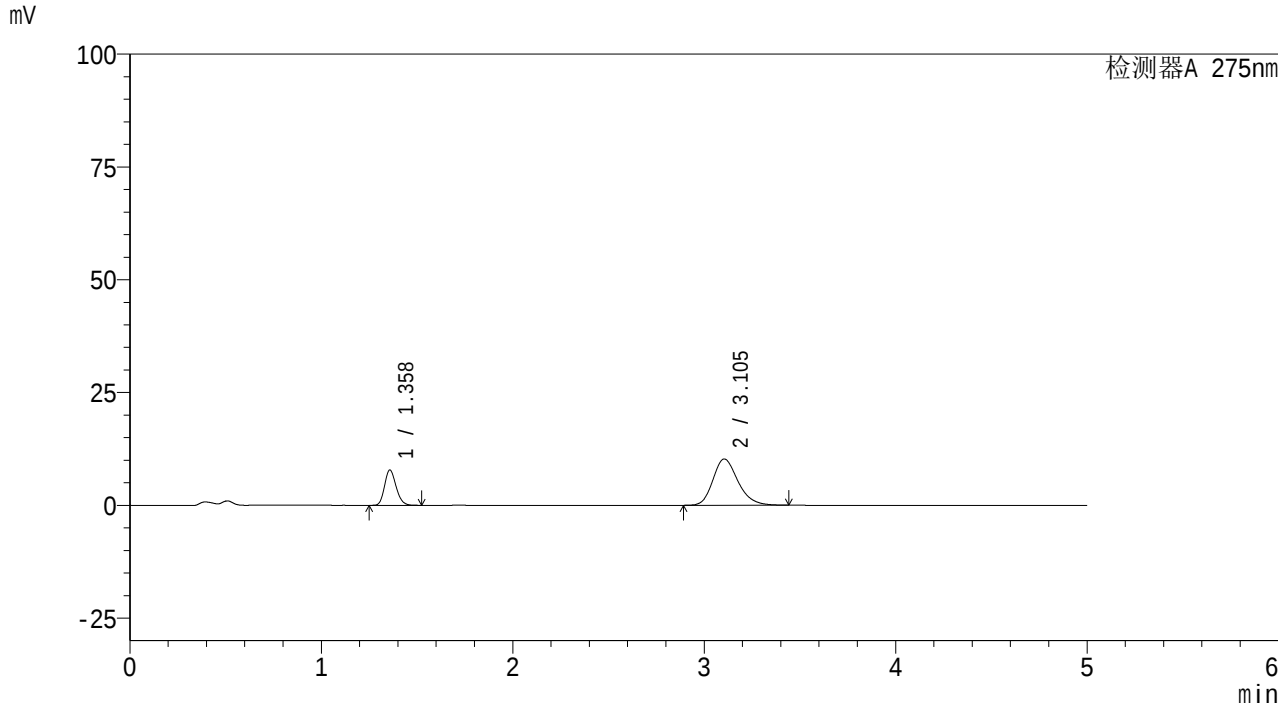

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	32639	25.948	7796	2448	1.182	--
2	3.105	93149	74.052	10259	2788	1.214	10.131
总计		125788	100.000	18055			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1019-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:24:57

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

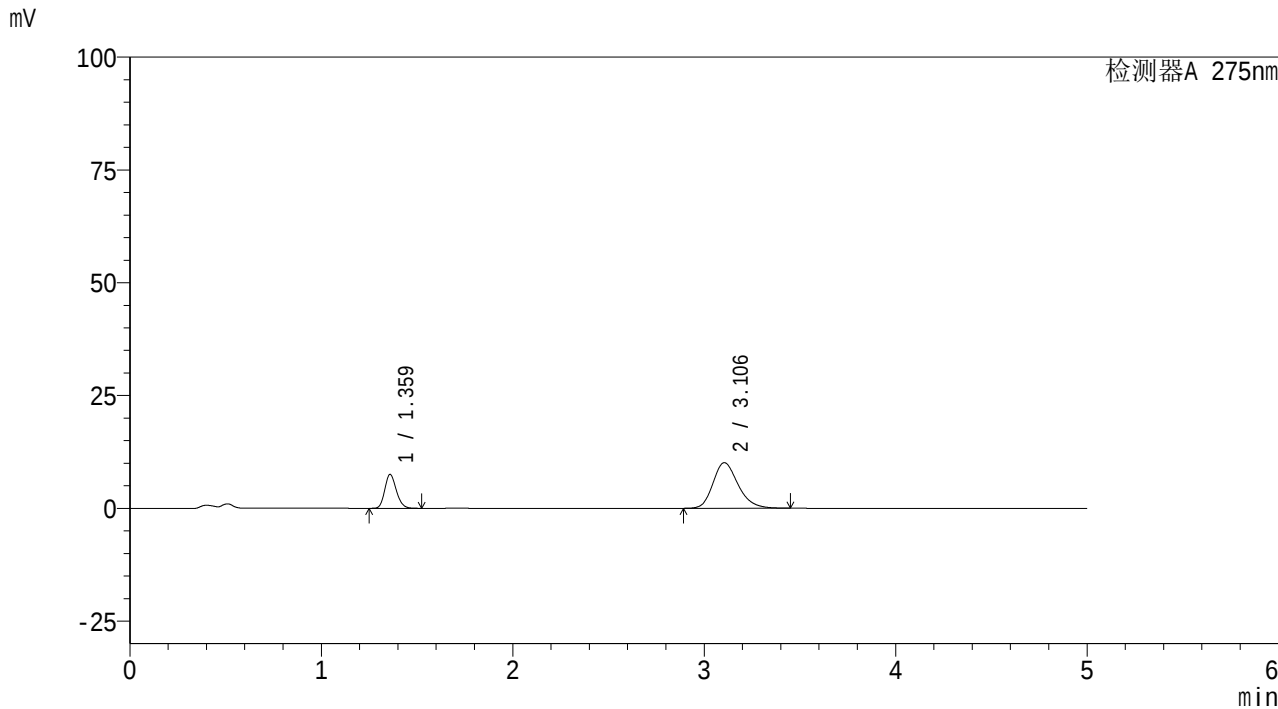

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	31338	25.404	7440	2452	1.184	--
2	3.106	92021	74.596	10110	2775	1.215	10.110
总计		123359	100.000	17550			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1020-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:30:20

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

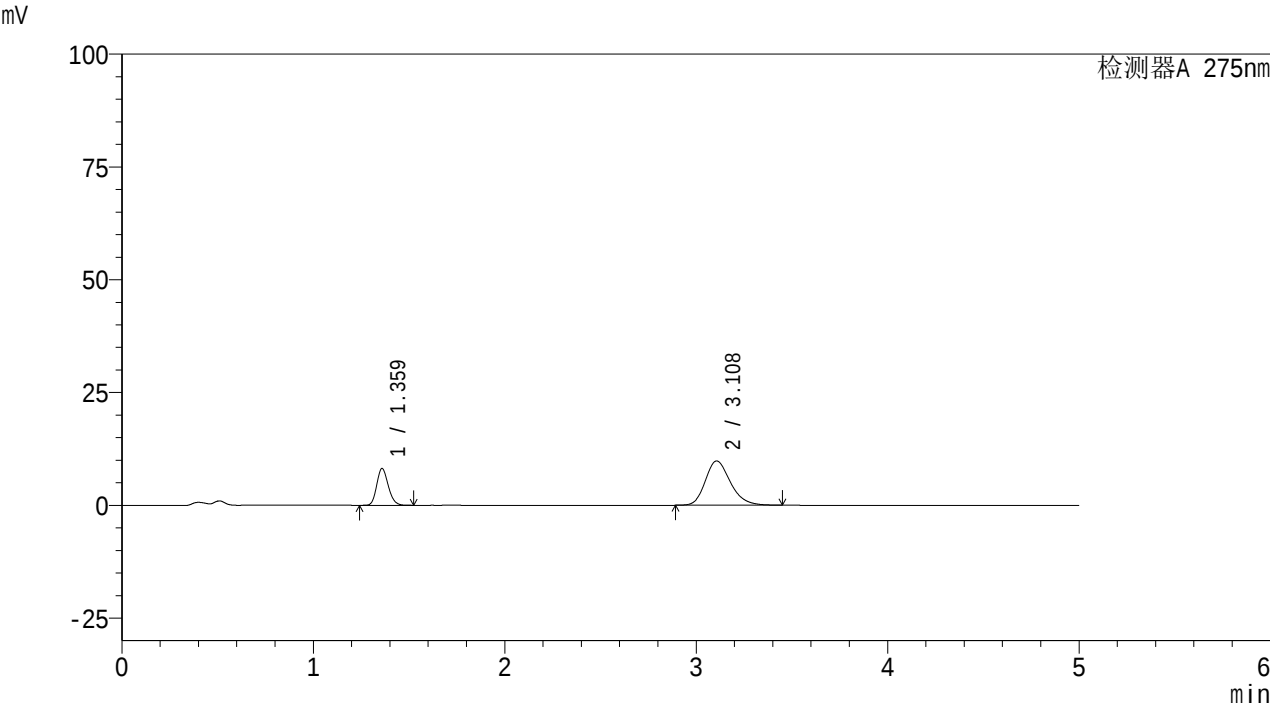

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	34043	27.581	8093	2452	1.182	--
2	3.108	89389	72.419	9816	2783	1.214	10.127
总计		123432	100.000	17909			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1021-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:35:42
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

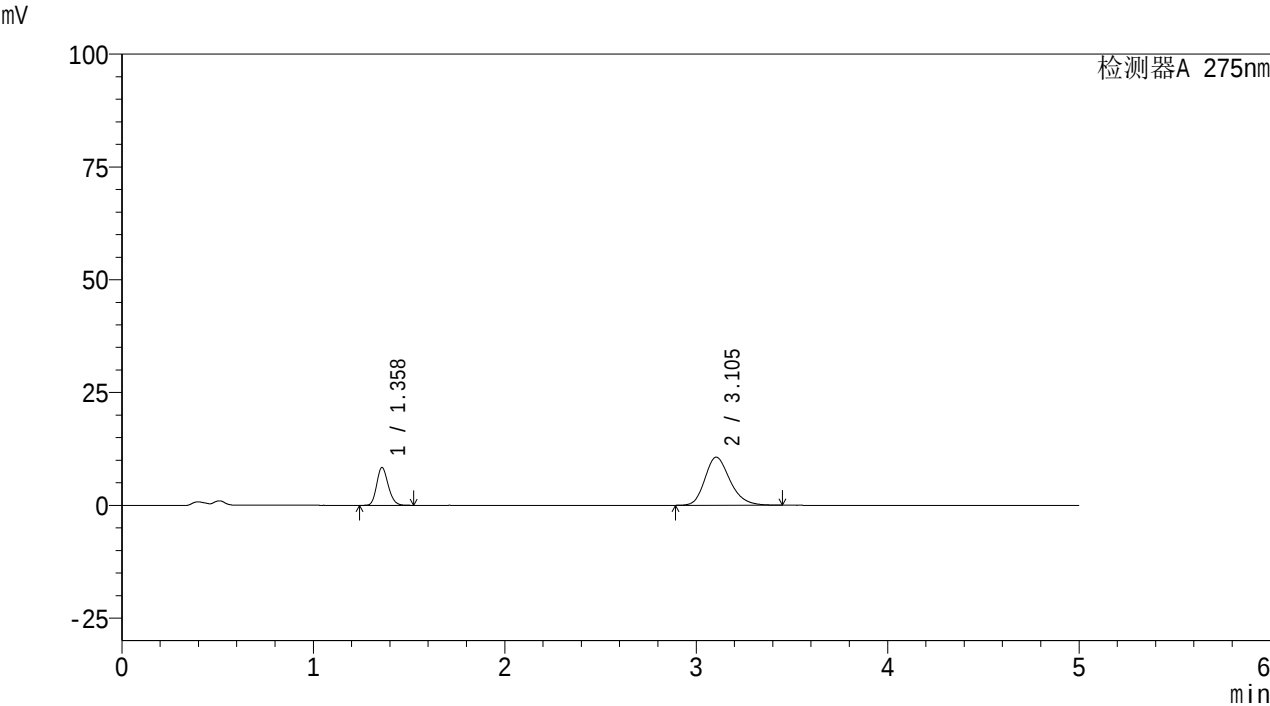

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34909	26.479	8321	2456	1.183	--
2	3.105	96928	73.521	10659	2781	1.217	10.121
总计		131837	100.000	18980			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1022-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:41:04
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

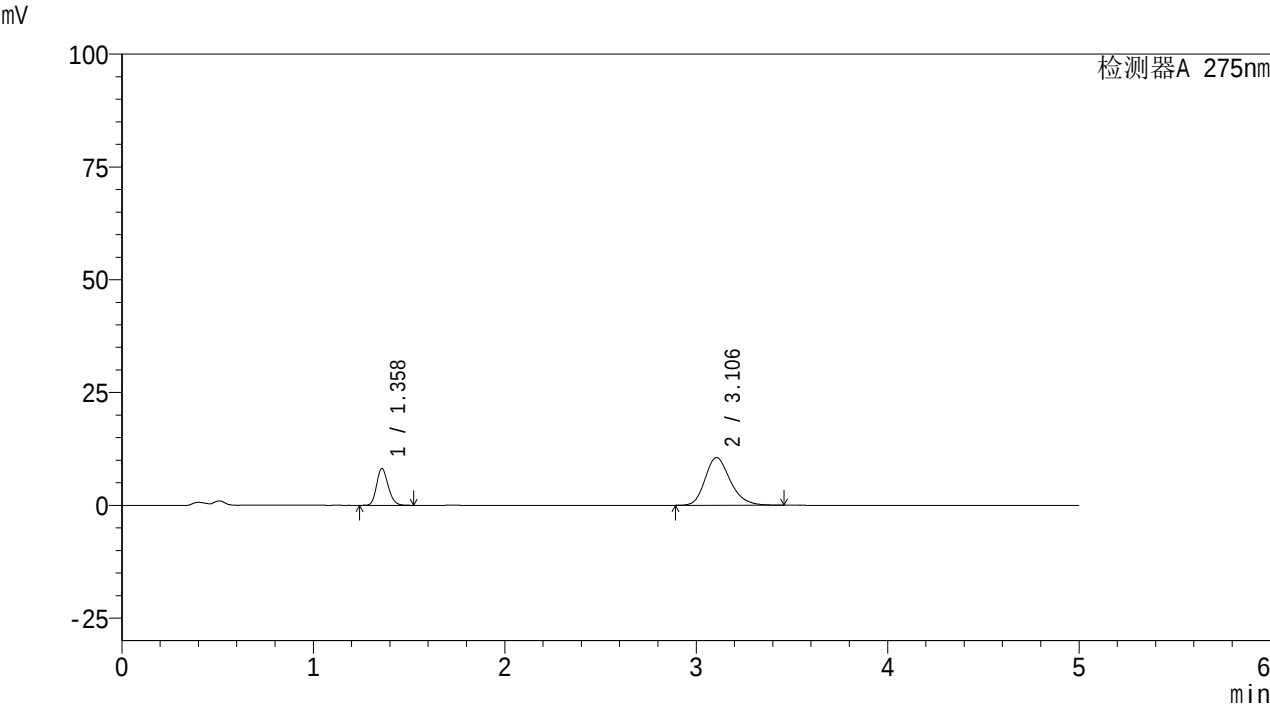

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	34046	26.086	8122	2448	1.183	--
2	3.106	96467	73.914	10587	2779	1.219	10.121
总计		130513	100.000	18709			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1023-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:46:26

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

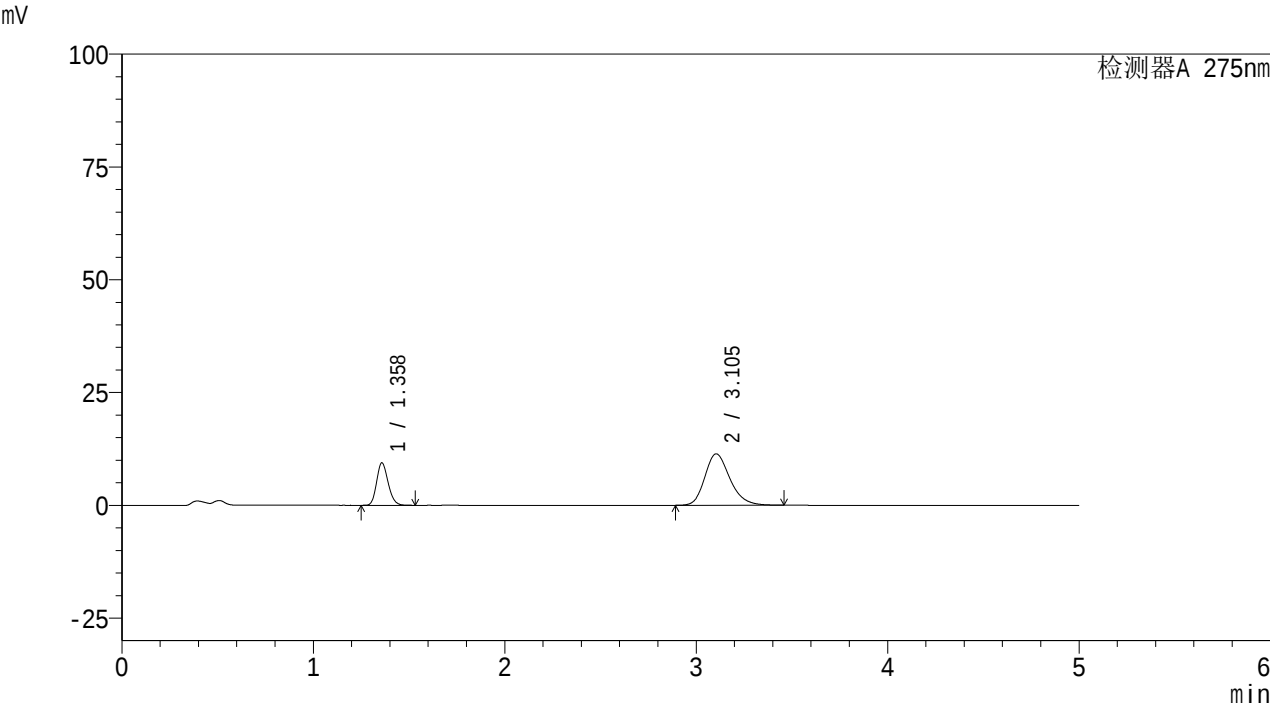

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	39206	27.467	9358	2456	1.184	--
2	3.105	103536	72.533	11400	2787	1.218	10.131
总计		142743	100.000	20759			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1024-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 10:51:48

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

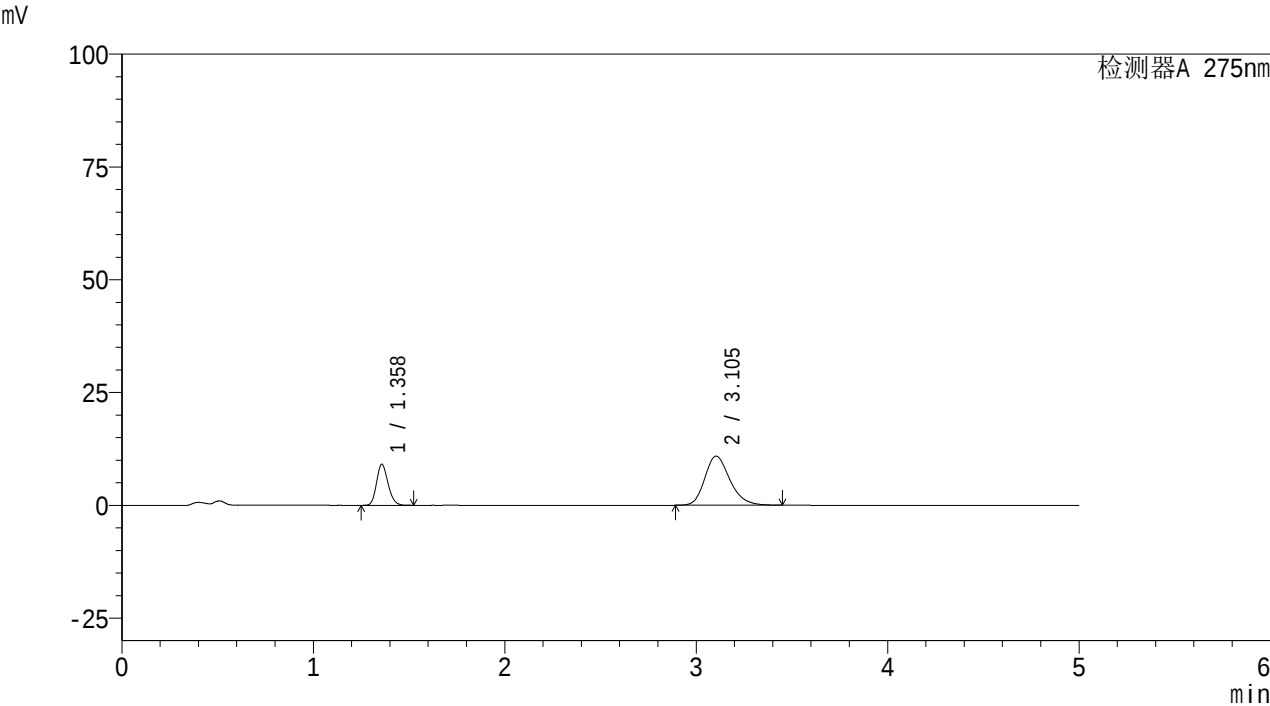

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	37855	27.659	9057	2453	1.183	--
2	3.105	99008	72.341	10898	2785	1.218	10.129
总计		136863	100.000	19955			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1025-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 10:57:09
处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

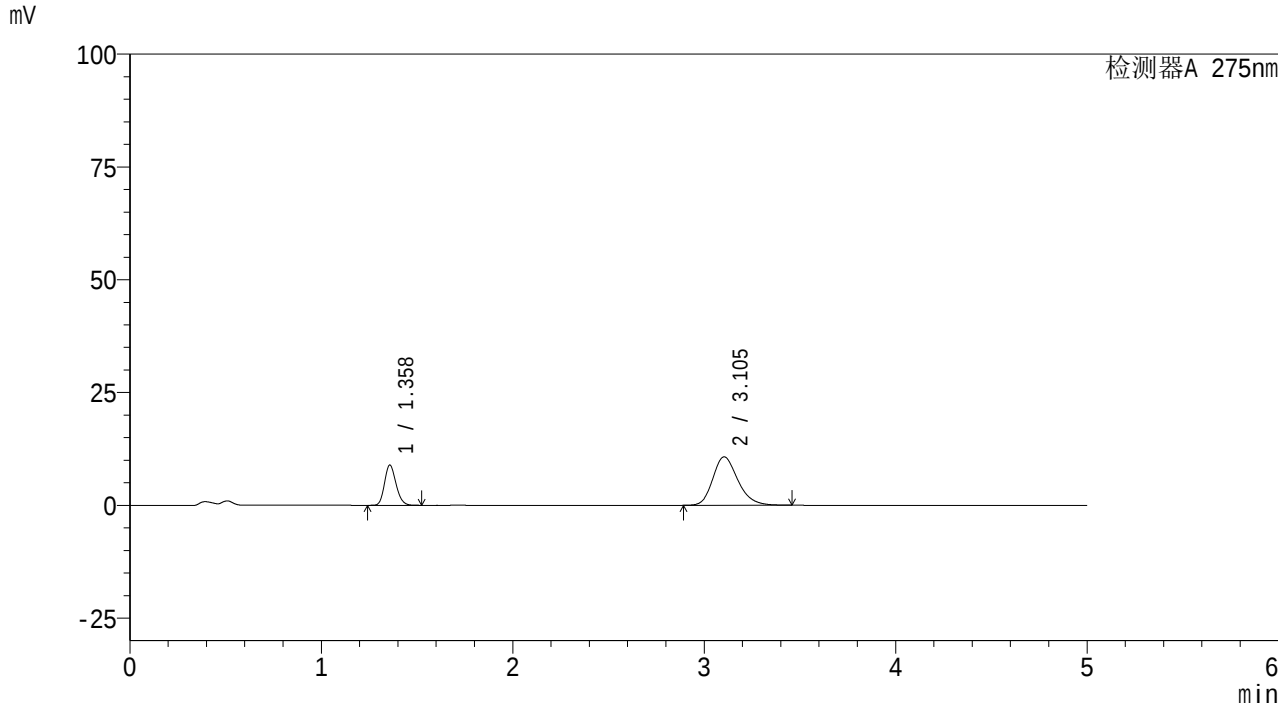

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	37159	27.613	8891	2452	1.182	--
2	3.105	97413	72.387	10735	2791	1.217	10.136
总计		134571	100.000	19626			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1026-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:02:30

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

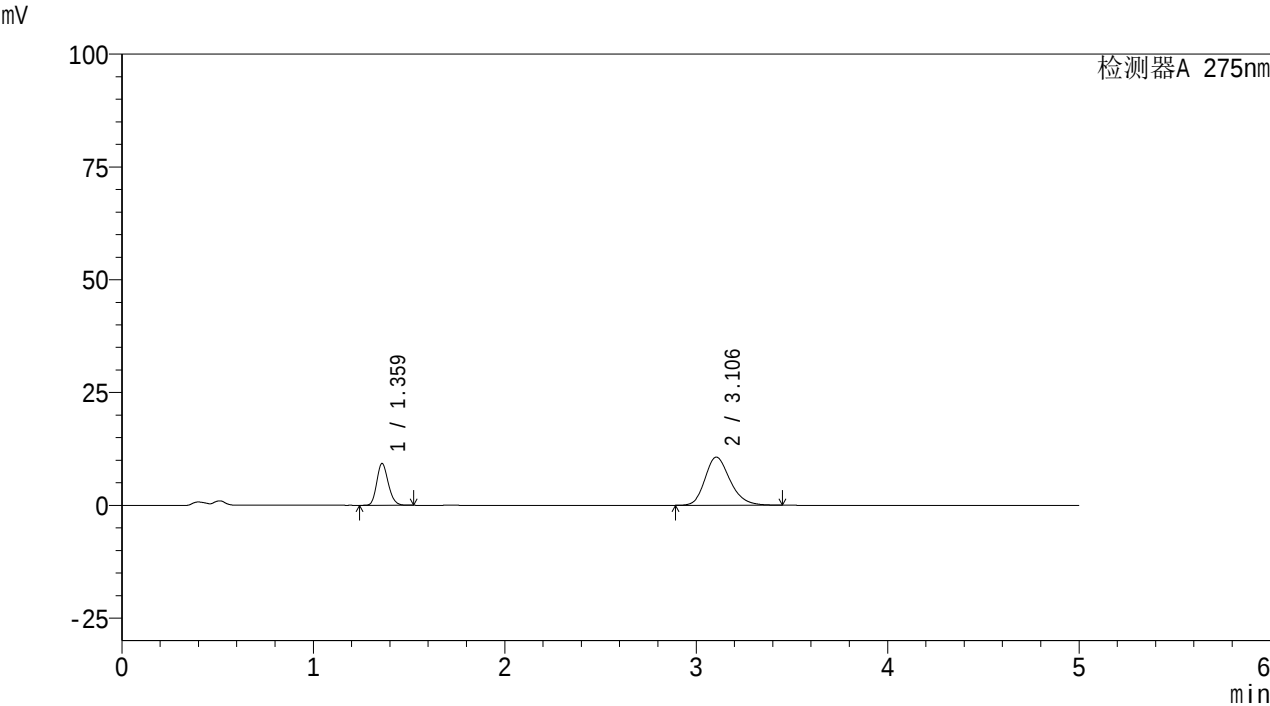

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	38569	28.454	9183	2456	1.183	--
2	3.106	96980	71.546	10676	2787	1.216	10.128
总计		135548	100.000	19859			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1027-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:07:51

处理时间(V2): 2026/05/15 17:27:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

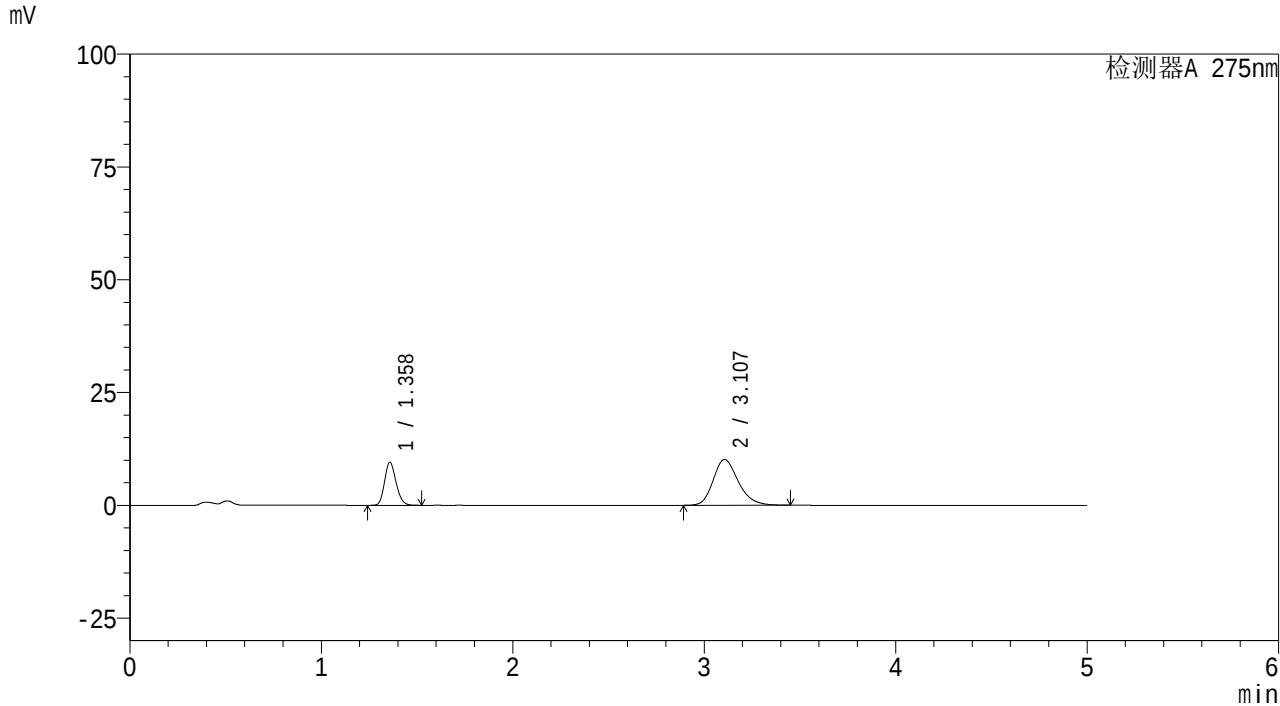

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	39749	30.084	9499	2449	1.183	--
2	3.107	92378	69.916	10143	2779	1.215	10.125
总计		132127	100.000	19642			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1028-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:13:13
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

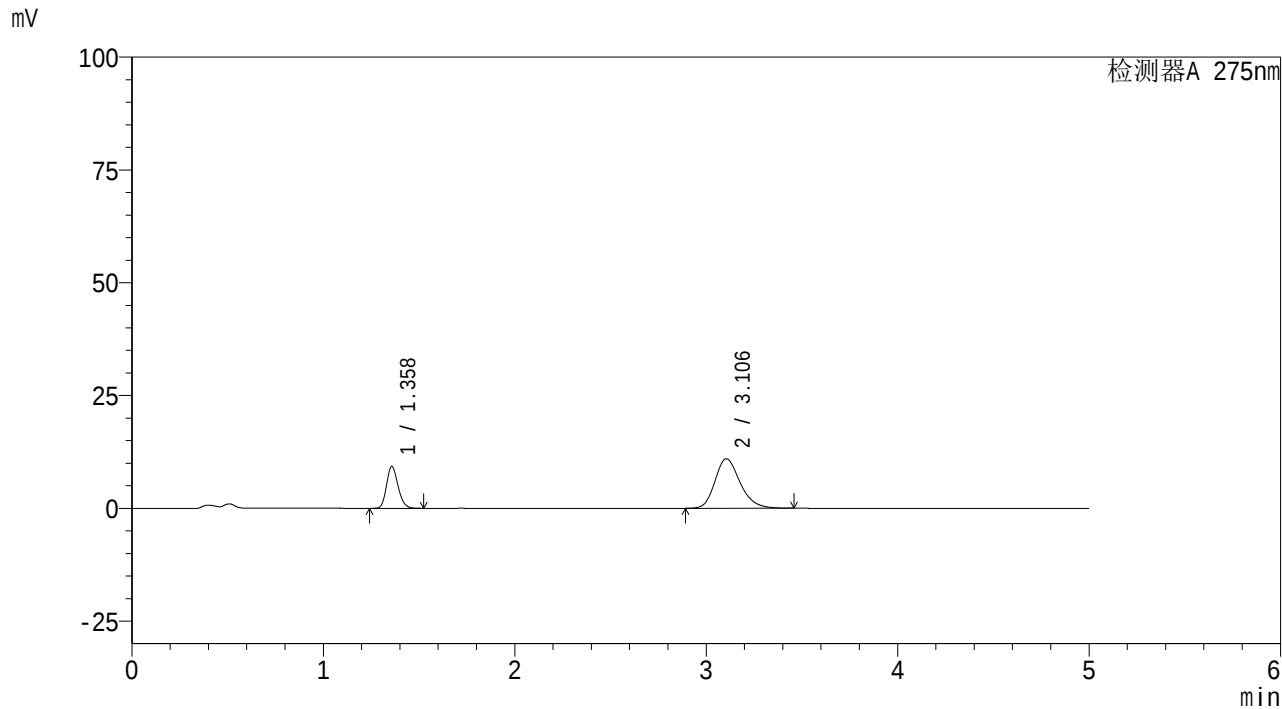

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	38704	27.916	9269	2454	1.182	--
2	3.106	99940	72.084	10977	2782	1.219	10.131
总计		138645	100.000	20246			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1029-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:18:35

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

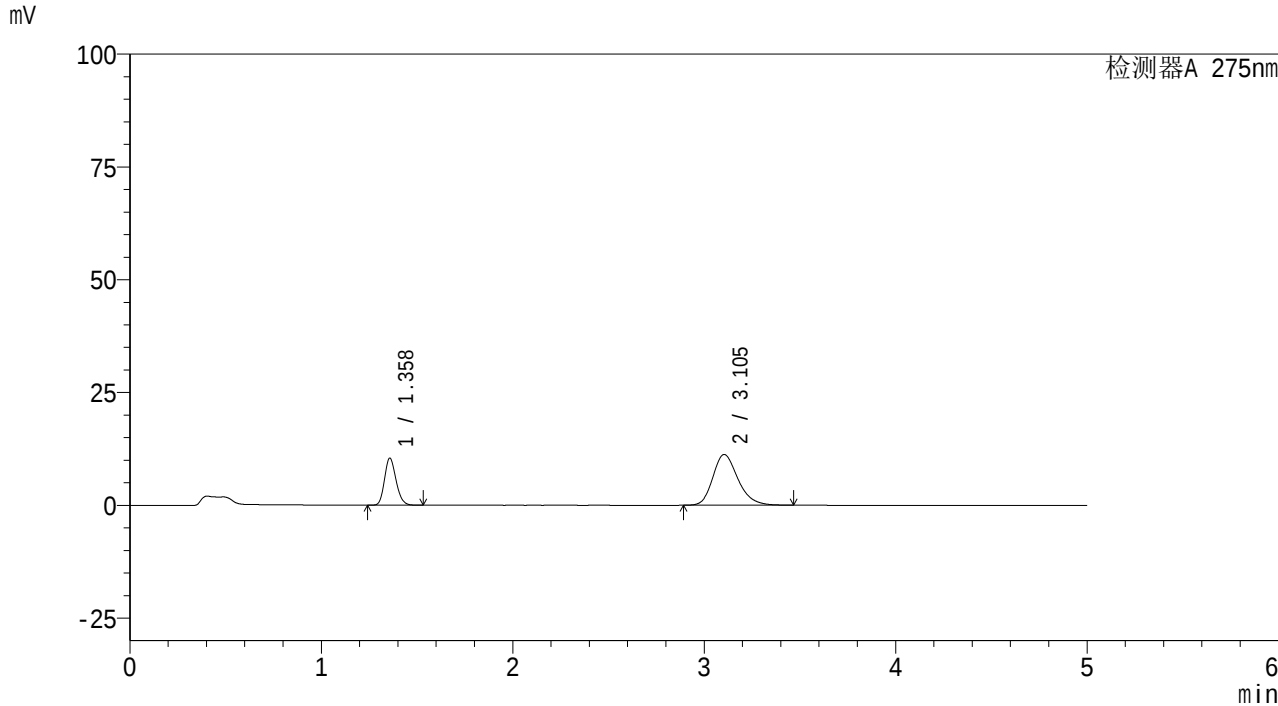

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	43430	29.790	10389	2451	1.182	--
2	3.105	102359	70.210	11252	2786	1.222	10.129
总计		145789	100.000	21641			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1030-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:23:58
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

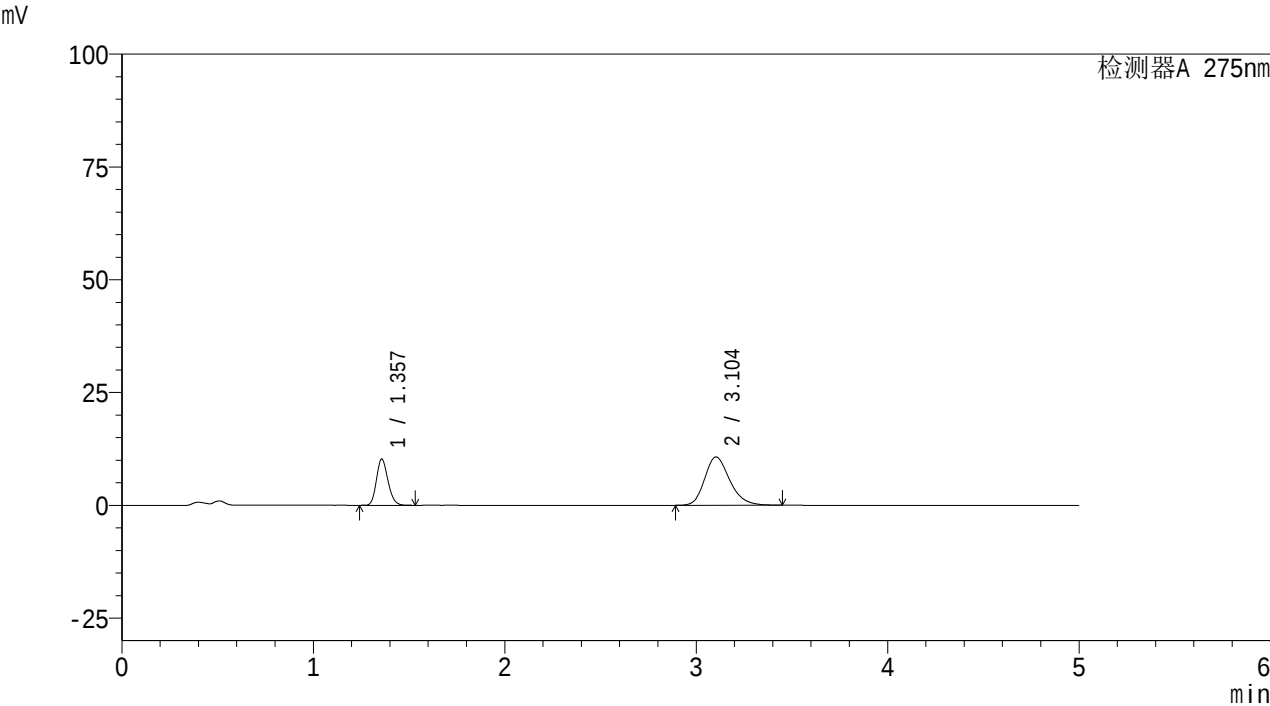

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	42679	30.516	10223	2450	1.183	--
2	3.104	97180	69.484	10701	2790	1.216	10.134
总计		139858	100.000	20924			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1031-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:29:20
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

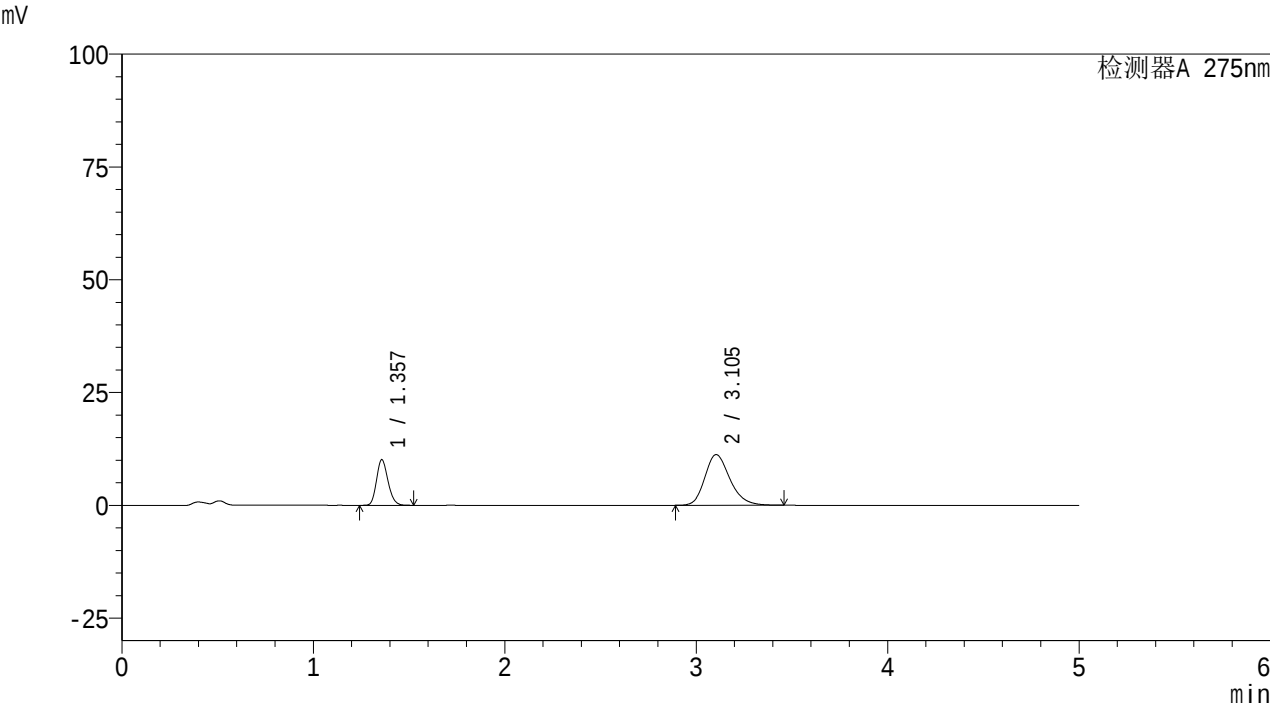

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	42065	29.174	10078	2452	1.182	--
2	3.105	102118	70.826	11229	2786	1.219	10.132
总计		144183	100.000	21307			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1032-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:34:42

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

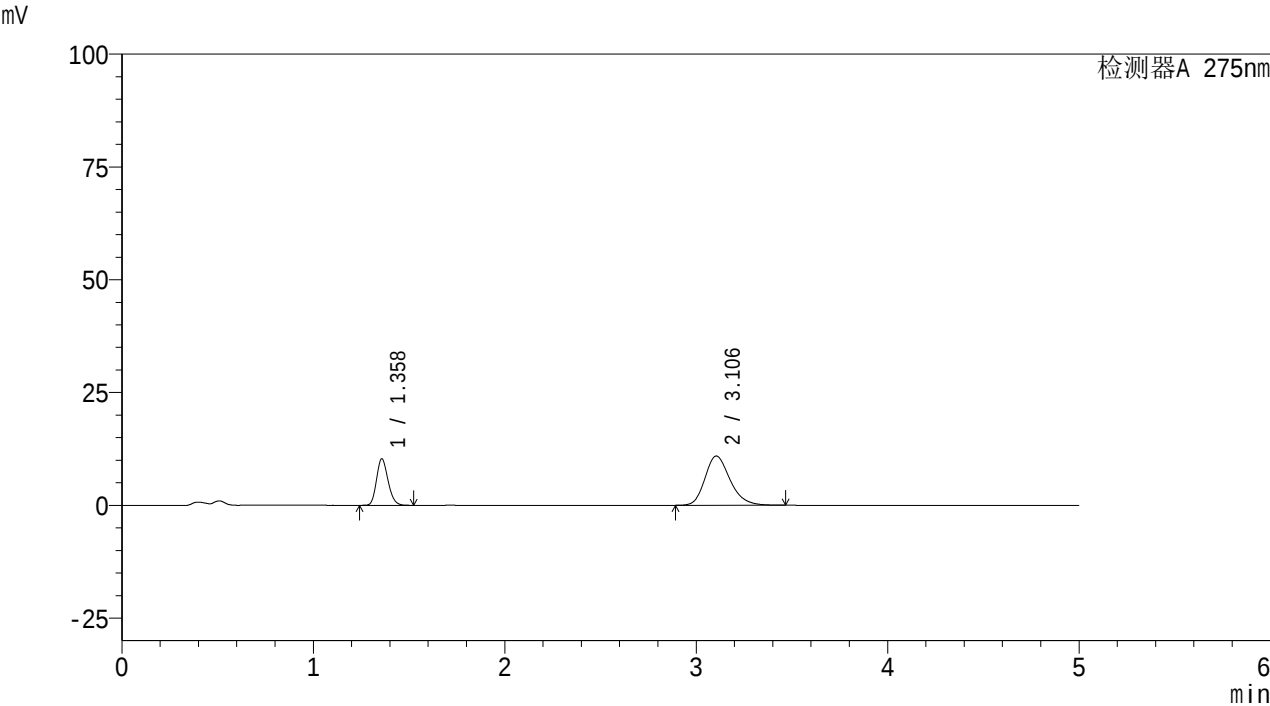

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	42932	30.190	10281	2456	1.183	--
2	3.106	99275	69.810	10920	2791	1.219	10.142
总计		142207	100.000	21201			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1033-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:40:03
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

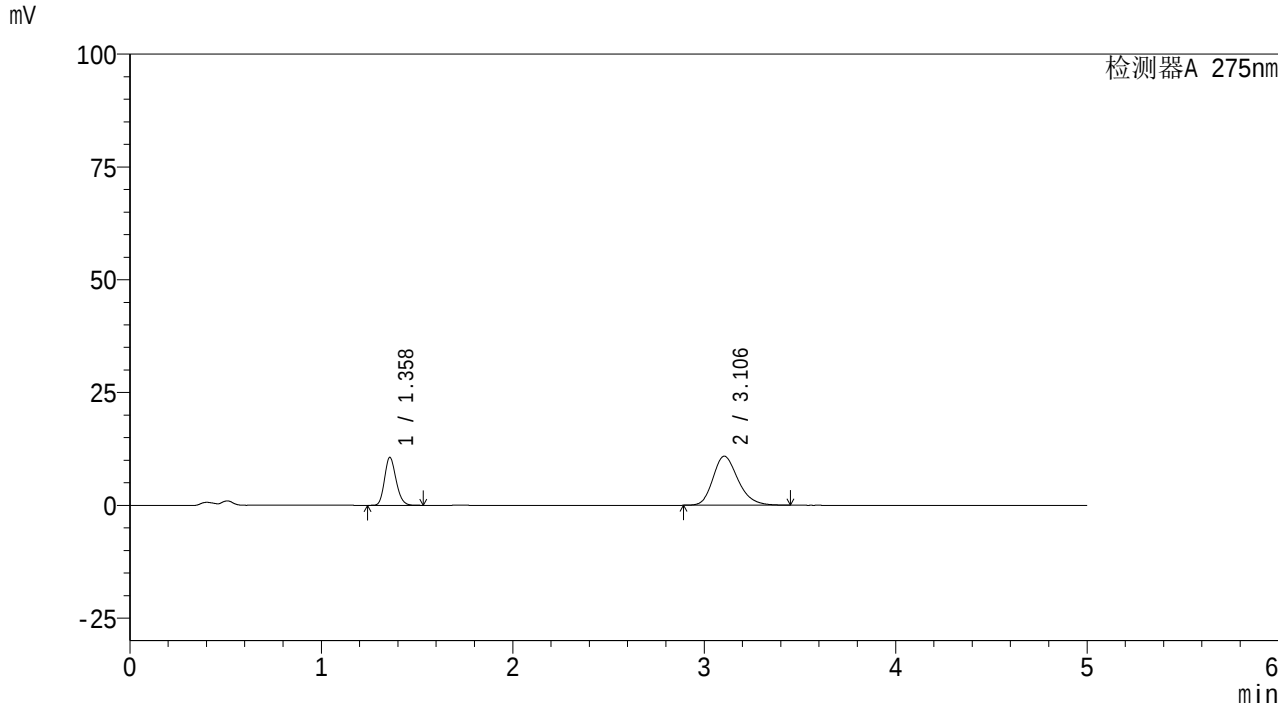

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	44222	30.905	10575	2453	1.182	--
2	3.106	98866	69.095	10881	2784	1.217	10.131
总计		143088	100.000	21456			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1034-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:45:25
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

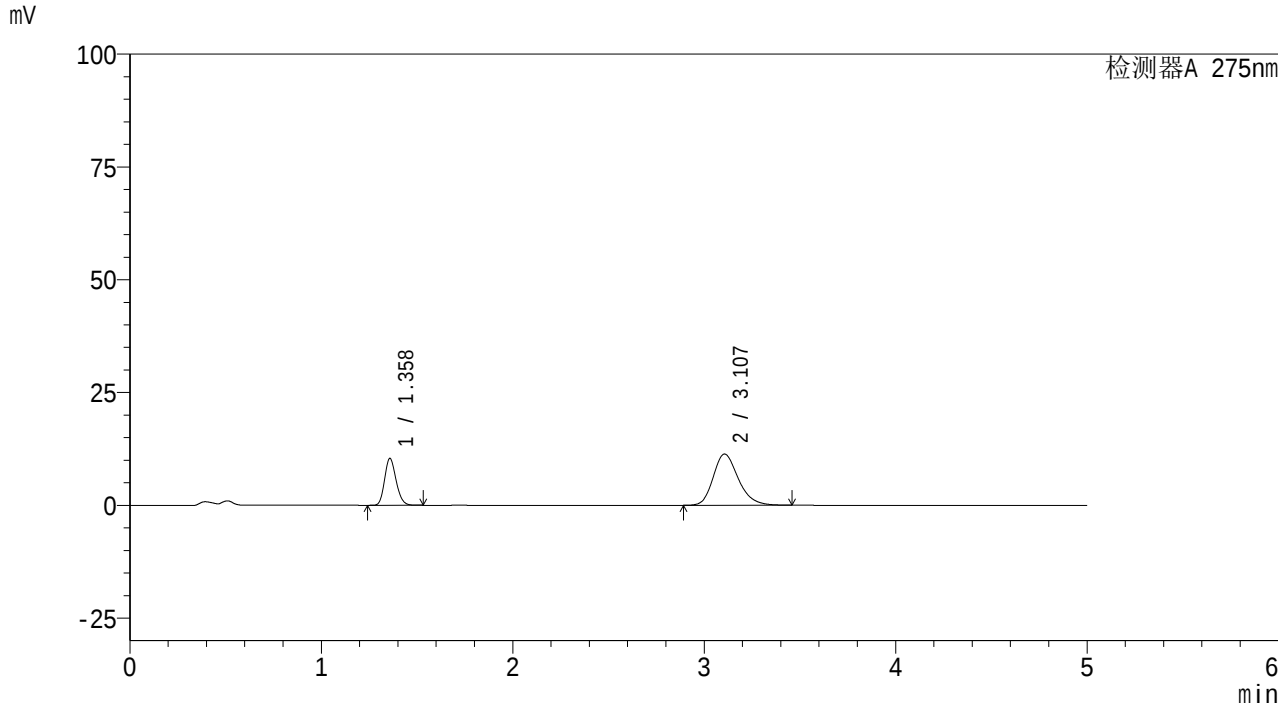

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	43224	29.507	10333	2454	1.181	--
2	3.107	103260	70.493	11346	2785	1.219	10.135
总计		146484	100.000	21679			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1035-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 11:50:46

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

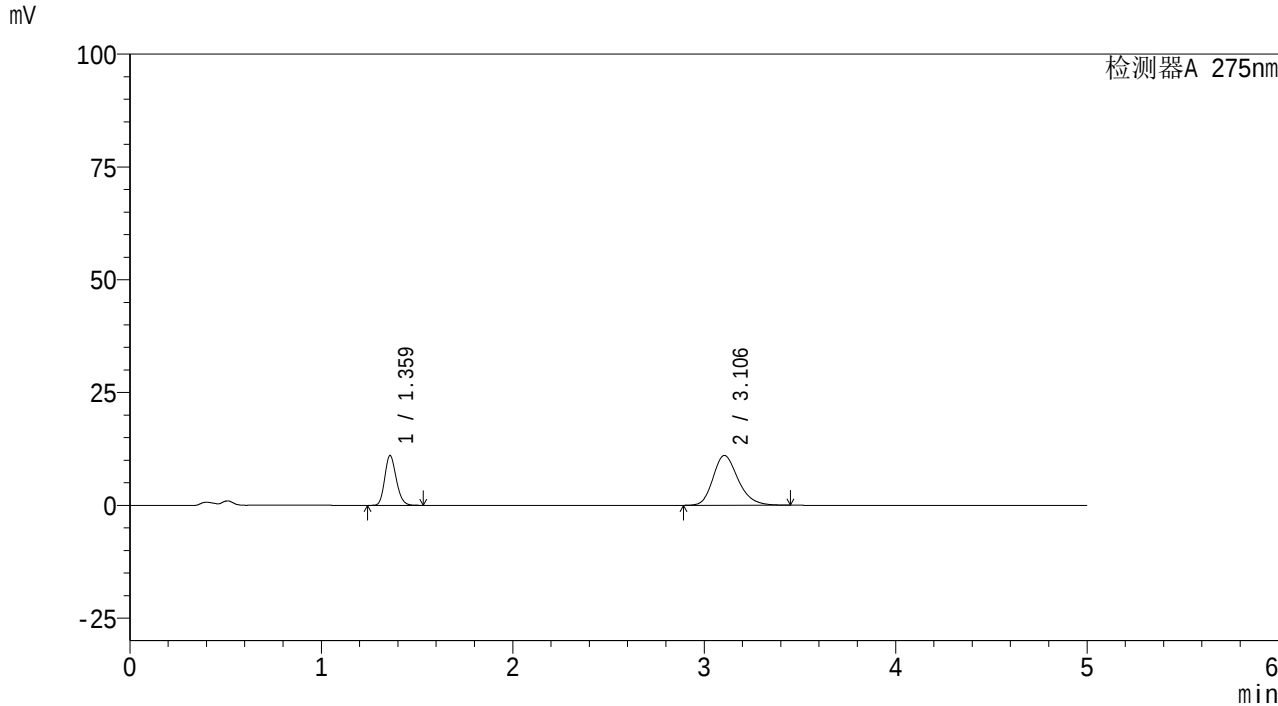

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	45945	31.391	10939	2458	1.183	--
2	3.106	100420	68.609	11047	2787	1.218	10.131
总计		146364	100.000	21986			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1036-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 11:56:07
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

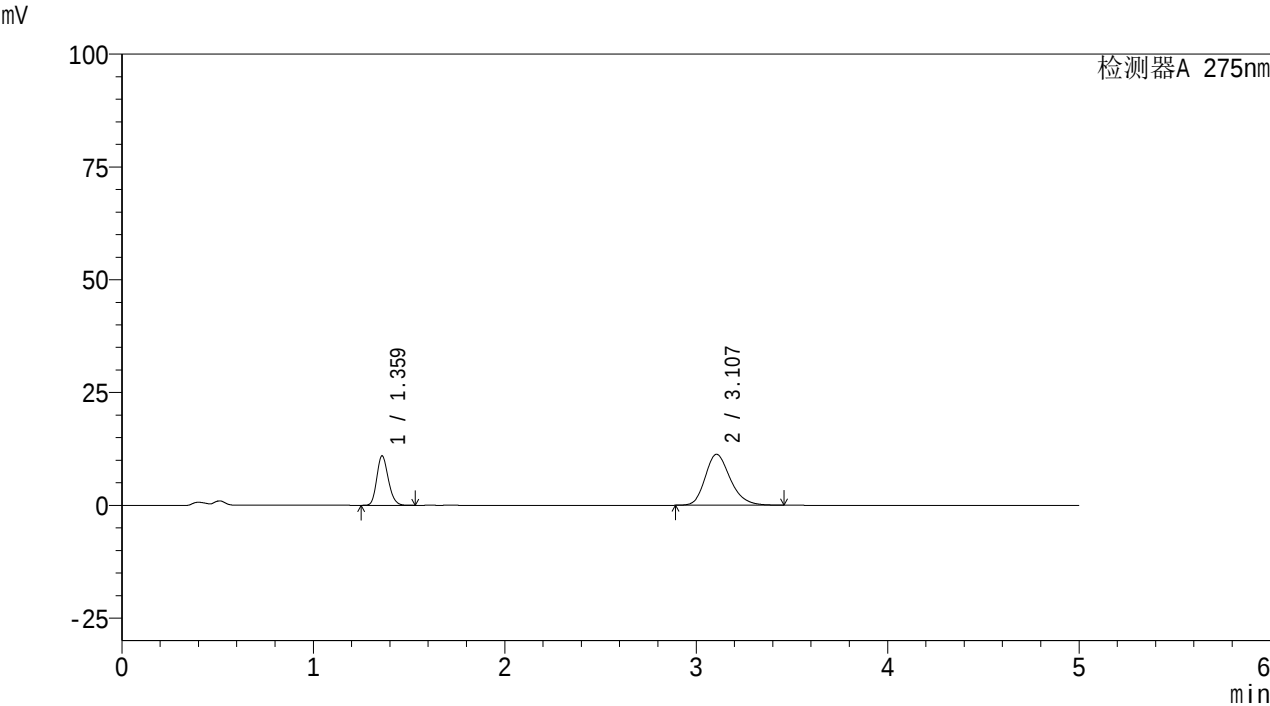

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	45652	30.778	10853	2455	1.184	--
2	3.107	102673	69.222	11293	2789	1.219	10.132
总计		148325	100.000	22146			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1037-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:01:29
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

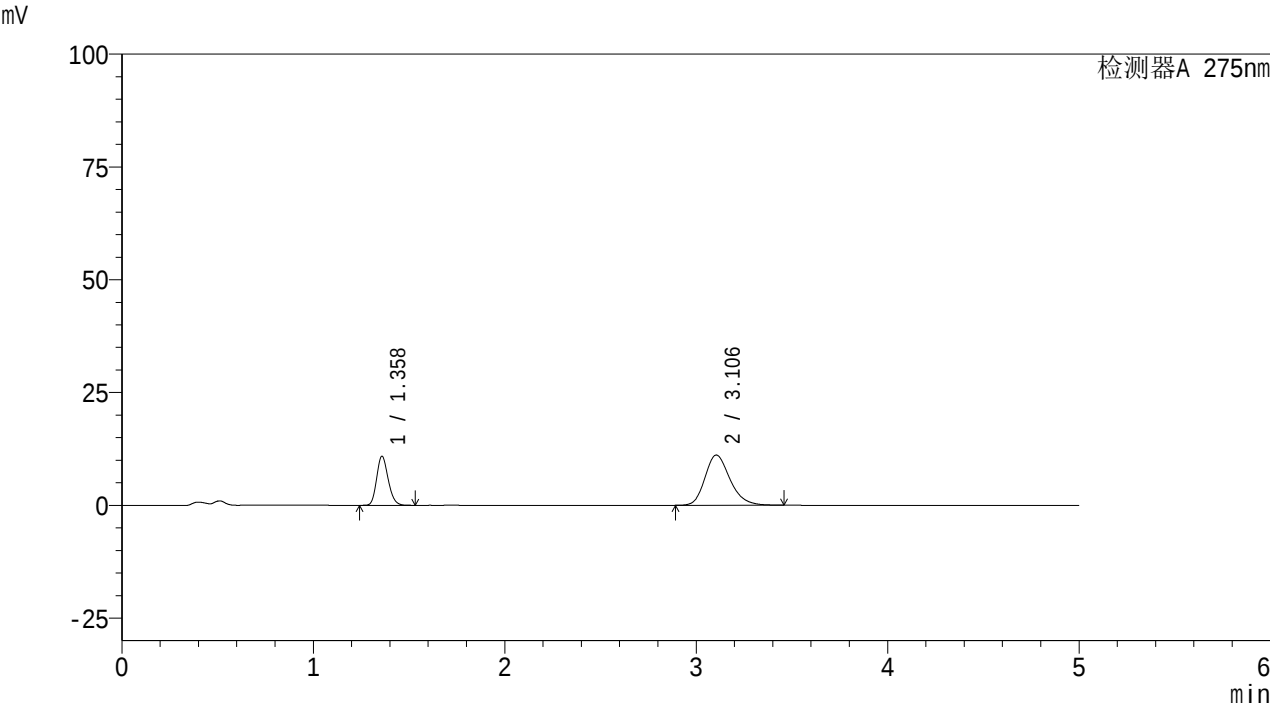

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	45280	30.984	10809	2460	1.182	--
2	3.106	100861	69.016	11129	2806	1.217	10.157
总计		146141	100.000	21938			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1038-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:06:50

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

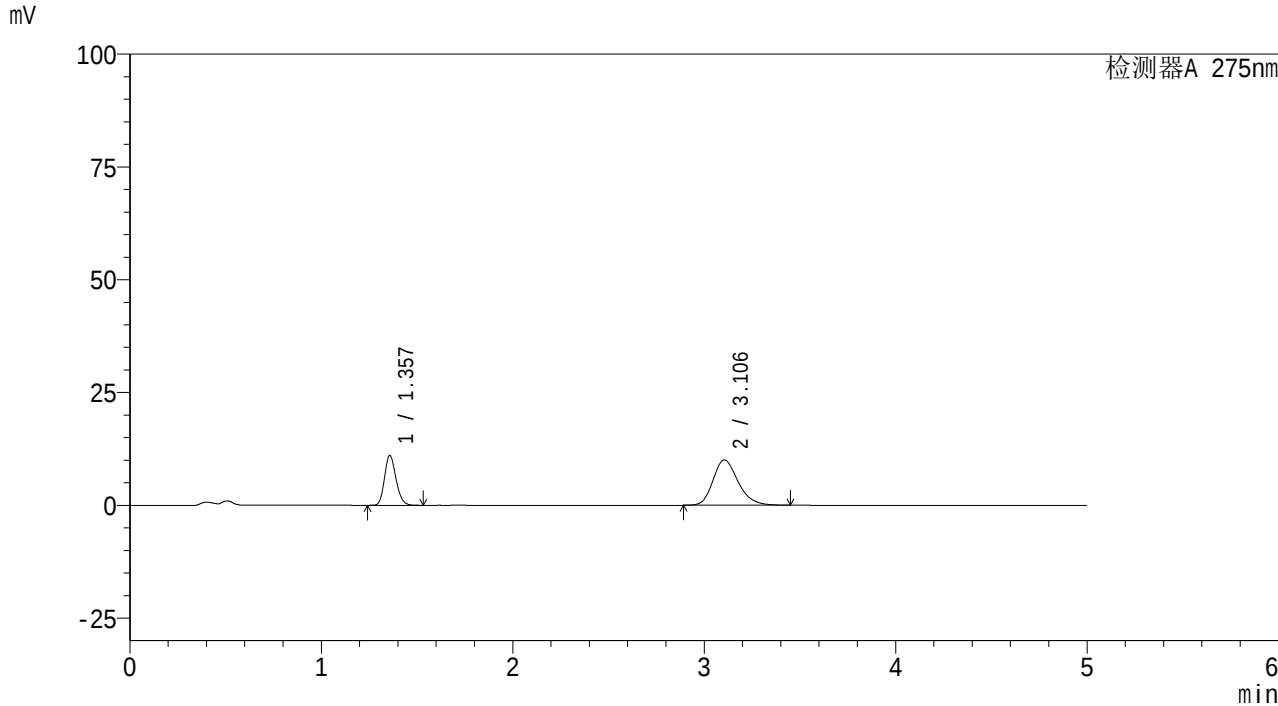

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	45958	33.446	10992	2449	1.183	--
2	3.106	91451	66.554	10061	2785	1.215	10.132
总计		137409	100.000	21053			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1039-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:12:12

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

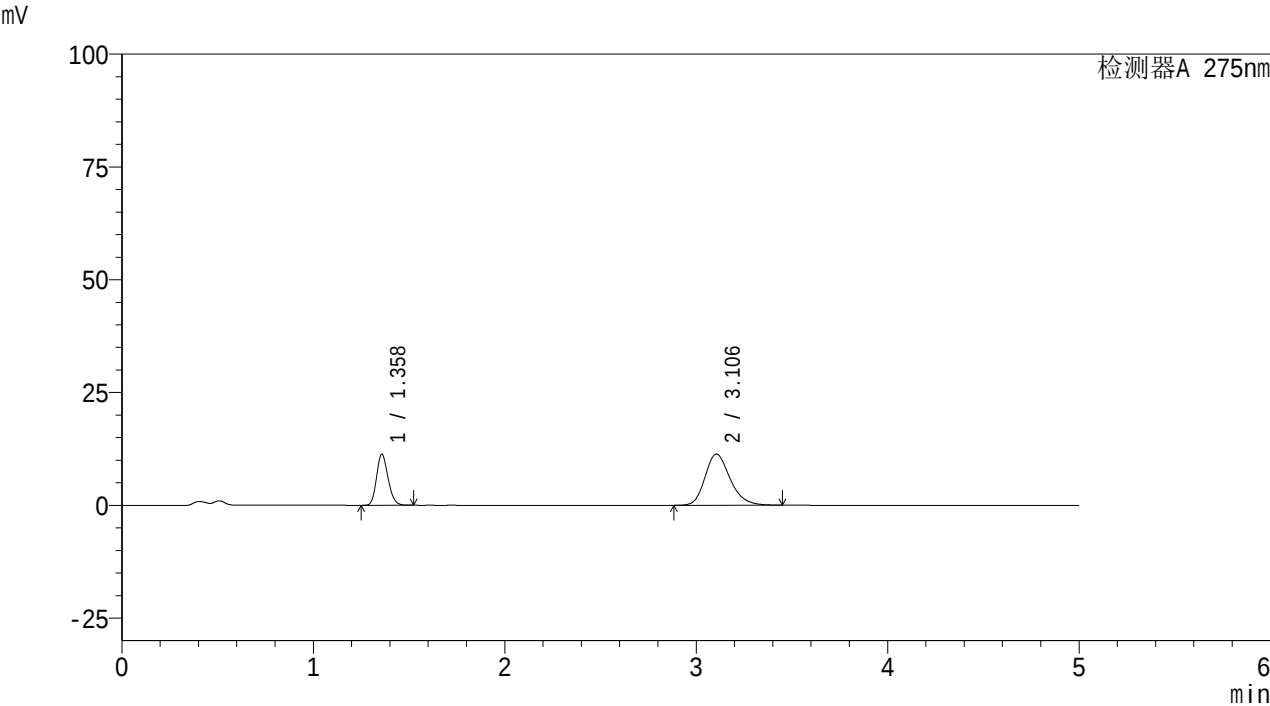

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	47093	31.388	11273	2455	1.181	--
2	3.106	102941	68.612	11338	2797	1.217	10.149
总计		150034	100.000	22611			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1040-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:17:34

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

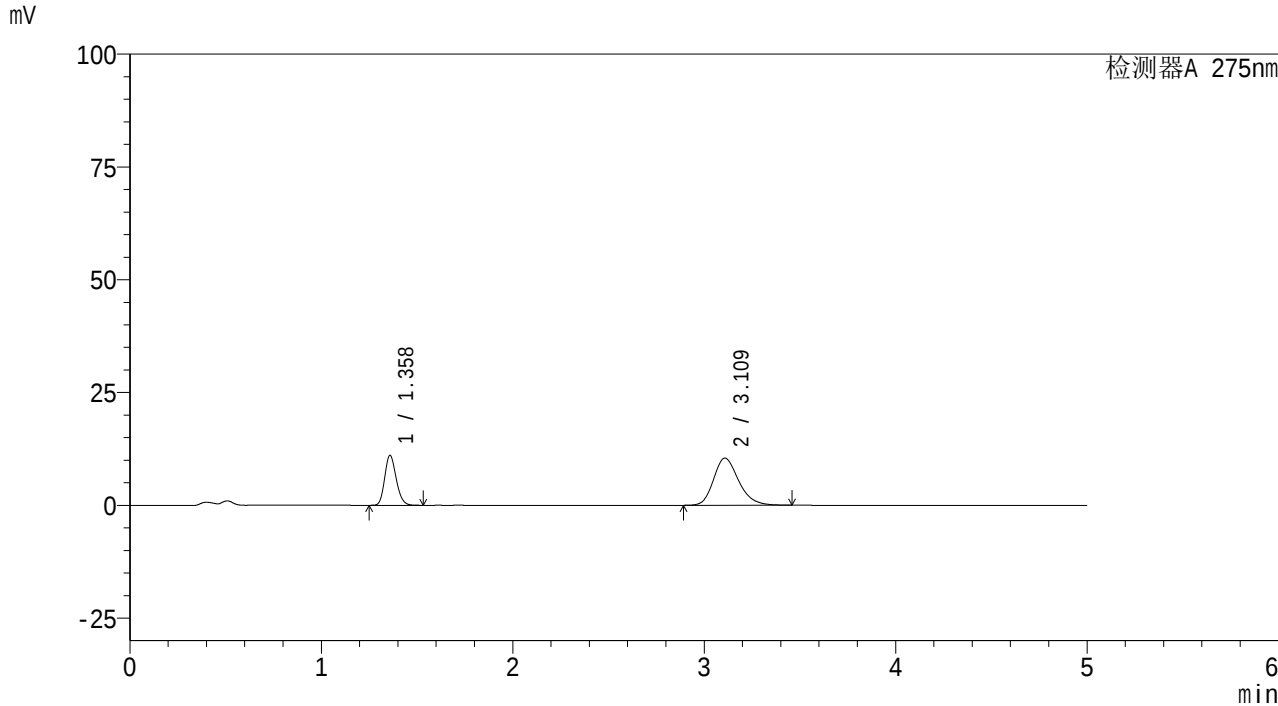

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	46157	32.670	10993	2454	1.183	--
2	3.109	95127	67.330	10437	2791	1.218	10.145
总计		141284	100.000	21429			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1041-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:22:56

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

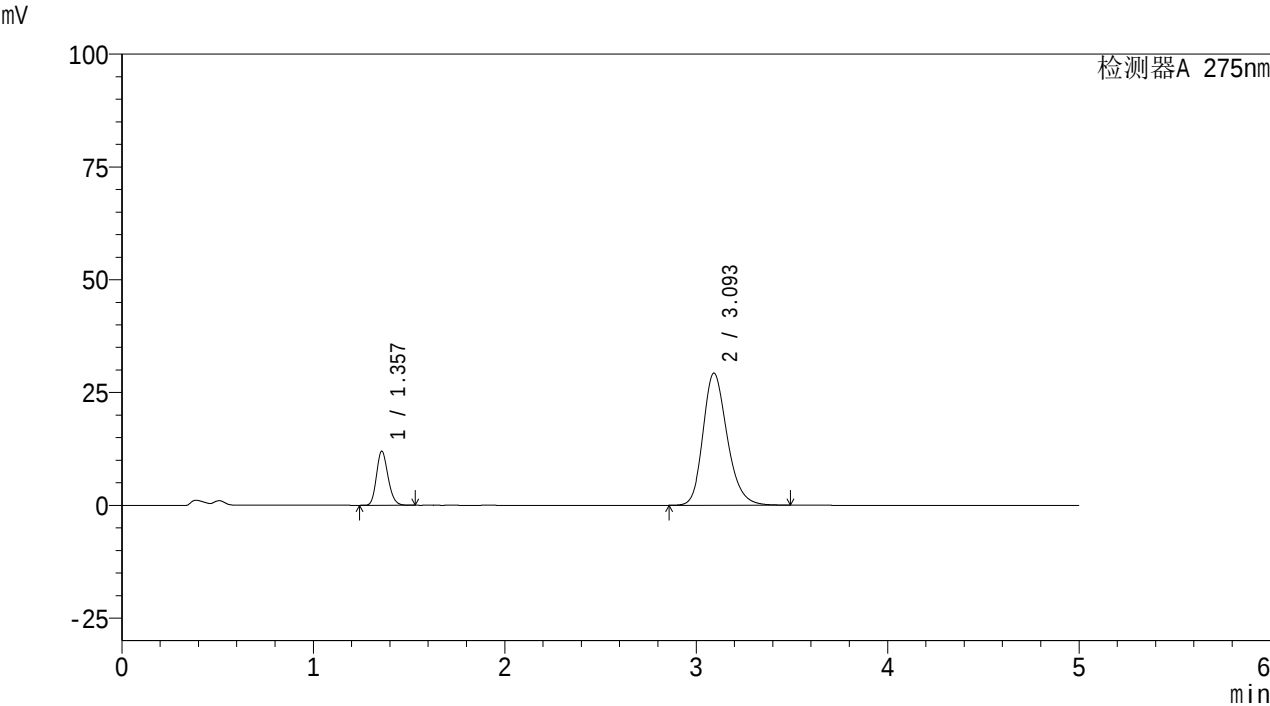

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.357	50015	16.285	11961	2450	1.184	--
2	3.093	257104	83.715	29227	2966	1.217	10.305
总计		307119	100.000	41189			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1042-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:28:19

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

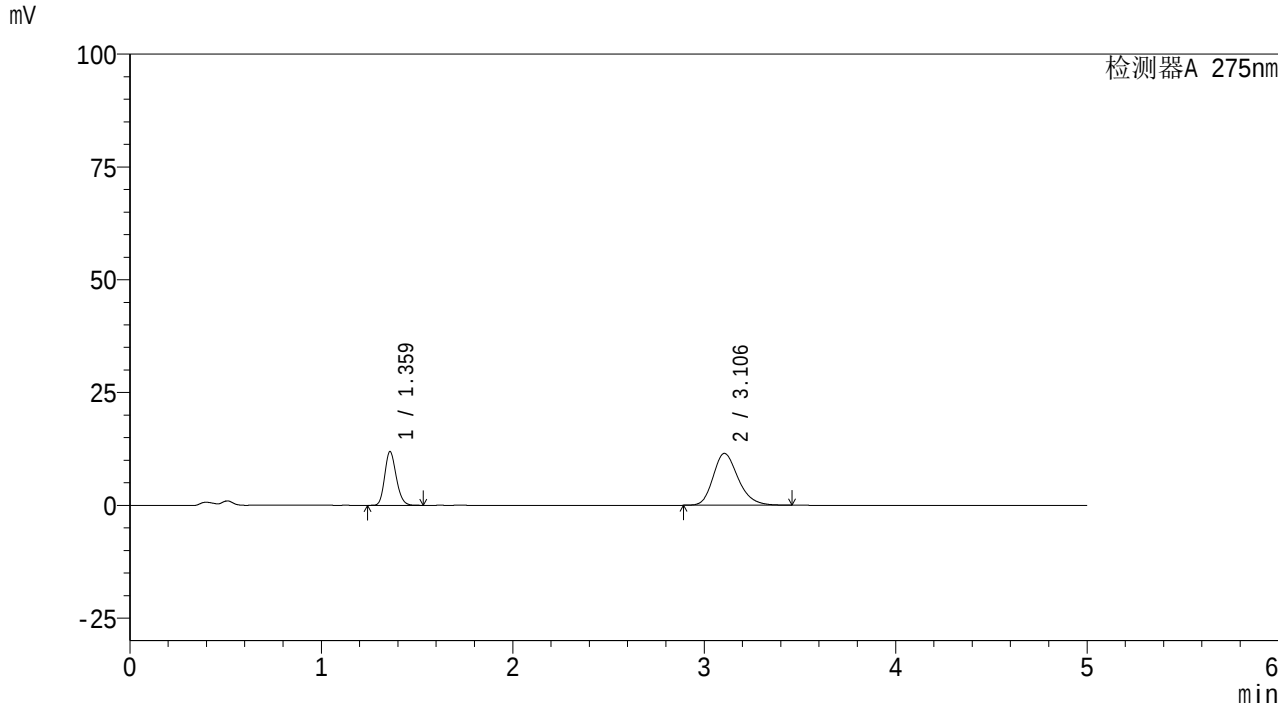

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	49577	32.218	11811	2455	1.182	--
2	3.106	104302	67.782	11493	2798	1.220	10.145
总计		153879	100.000	23304			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1043-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:33:41
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

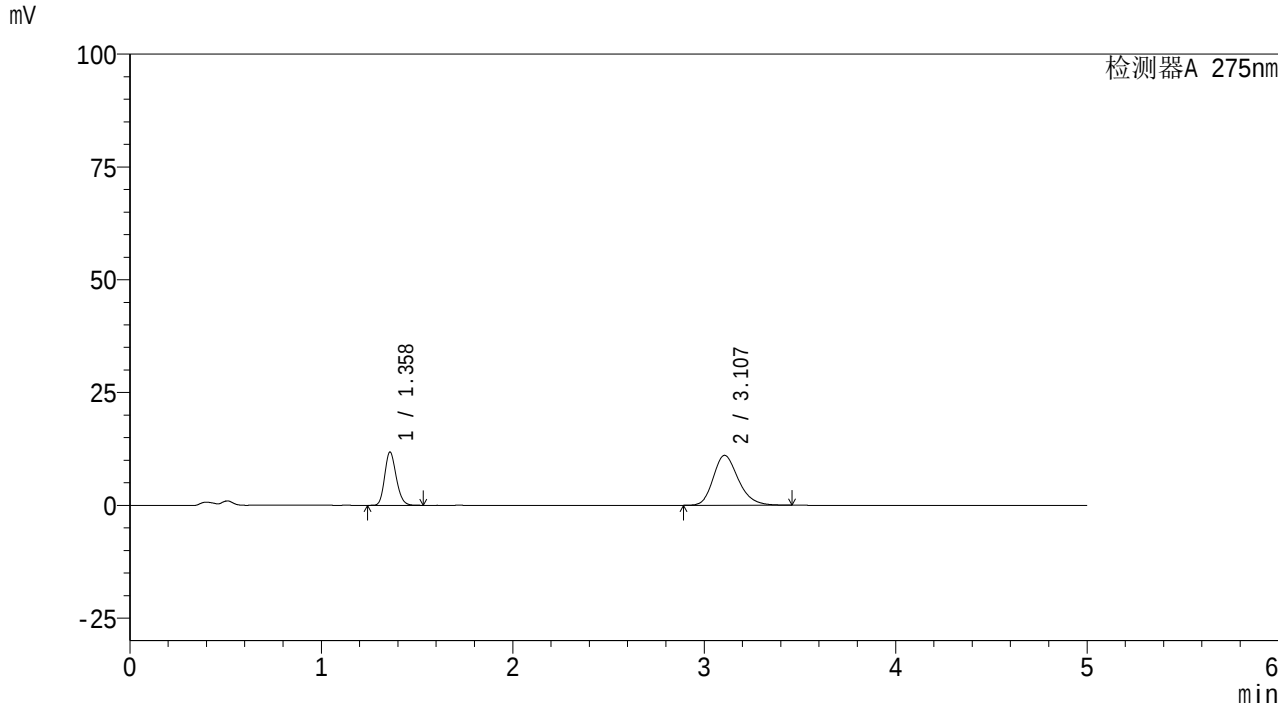

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	49203	32.866	11715	2454	1.182	--
2	3.107	100507	67.134	11058	2795	1.219	10.143
总计		149711	100.000	22773			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1044-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 12:39:04

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

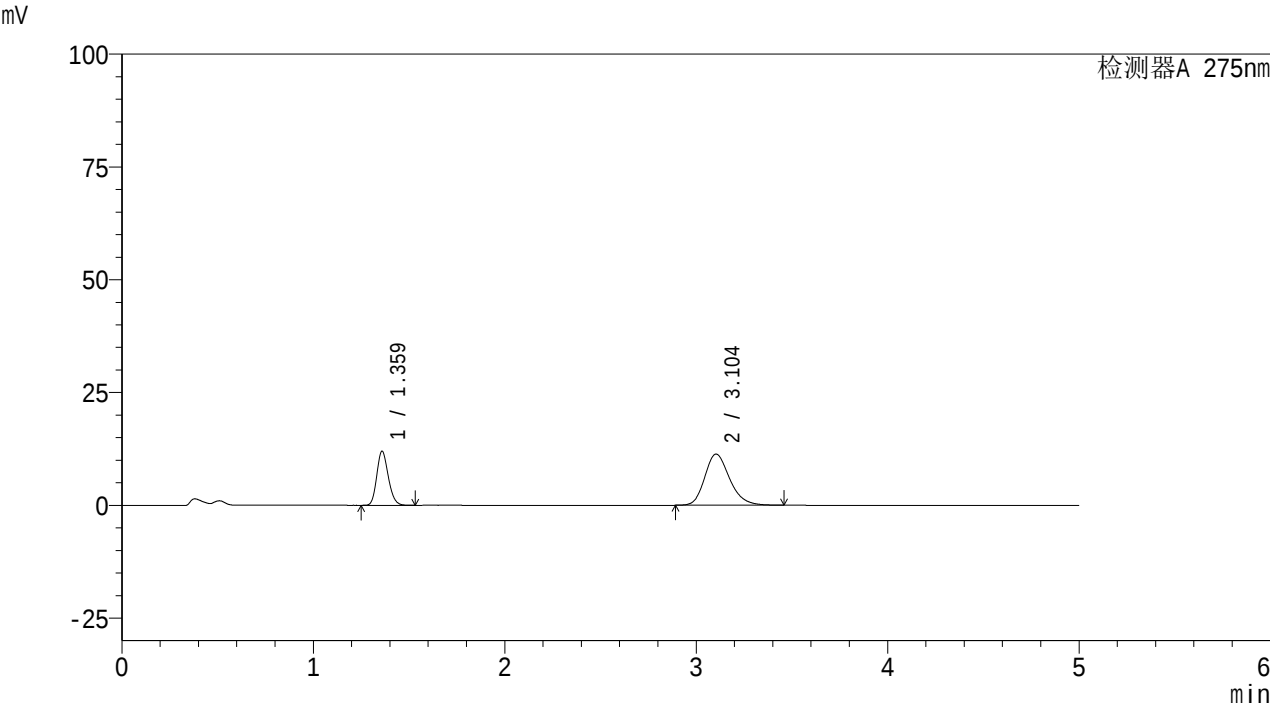

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	49921	32.788	11874	2459	1.183	--
2	3.104	102332	67.212	11346	2833	1.209	10.181
总计		152253	100.000	23220			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1045-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:44:26
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

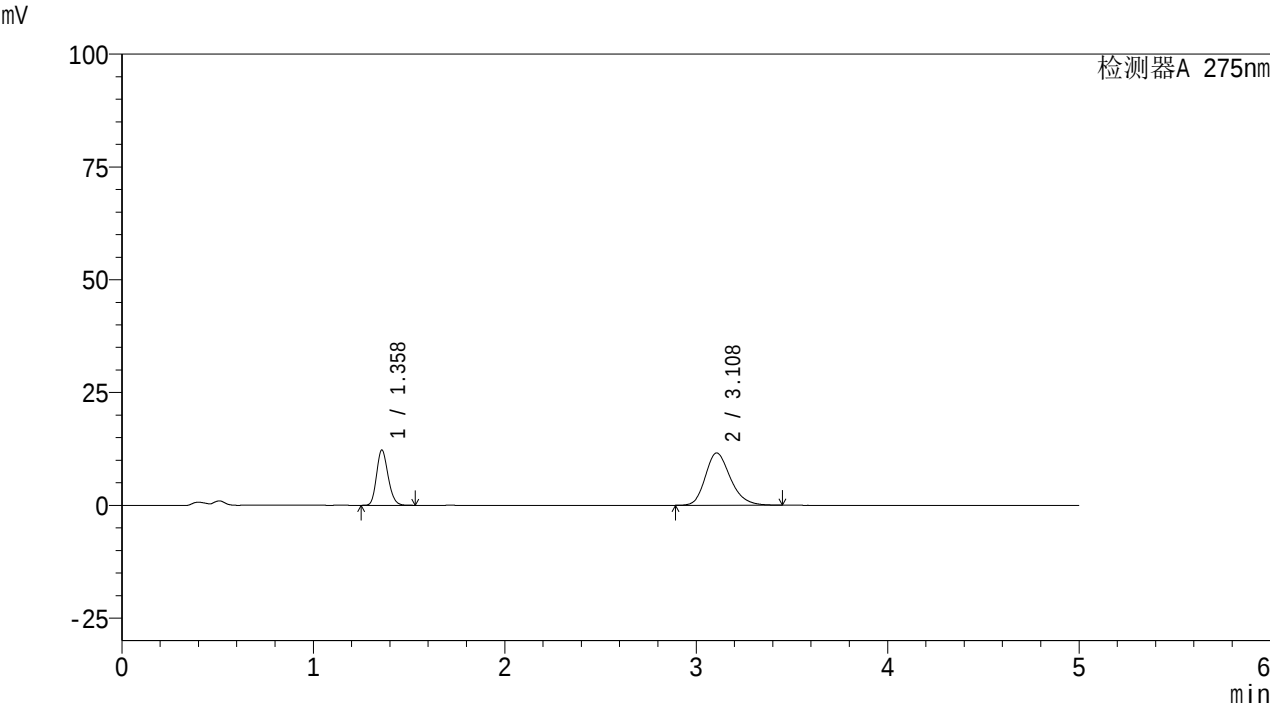

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	51027	32.639	12199	2453	1.182	--
2	3.108	105312	67.361	11587	2793	1.218	10.148
总计		156338	100.000	23787			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1046-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:49:49
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

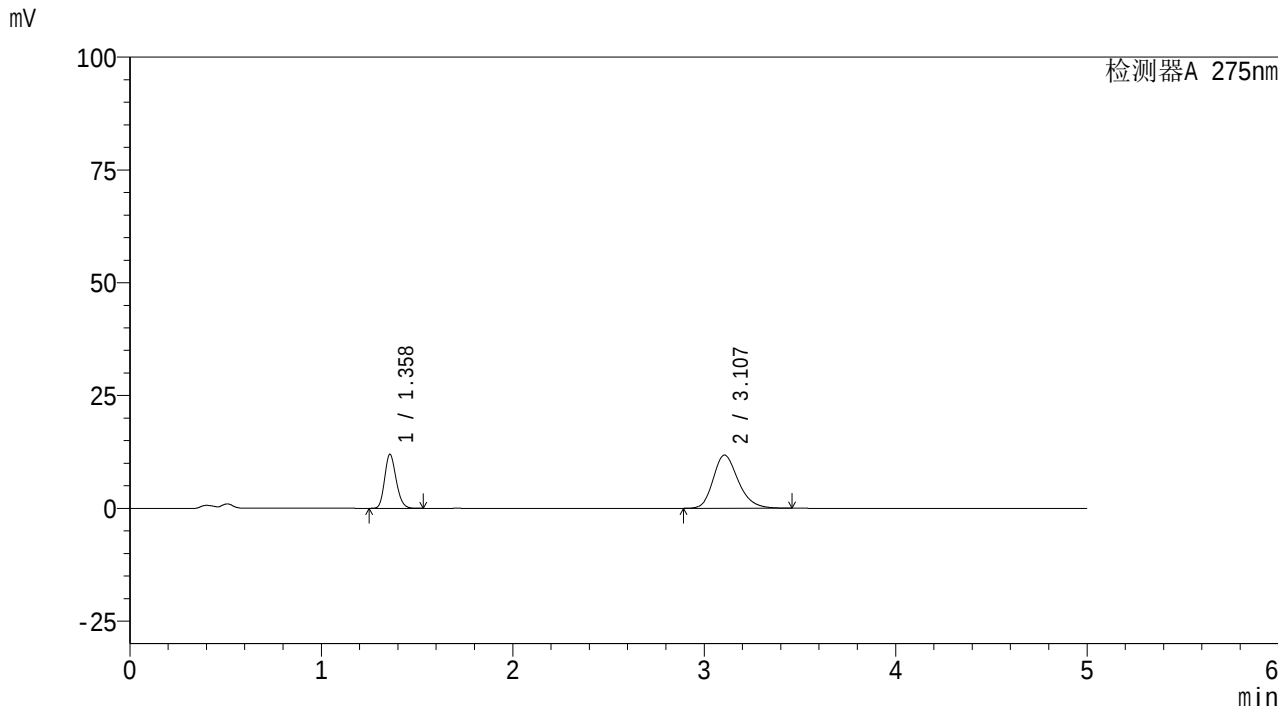

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	49779	31.746	11890	2458	1.182	--
2	3.107	107026	68.254	11784	2798	1.221	10.152
总计		156804	100.000	23674			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1047-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 12:55:13
处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

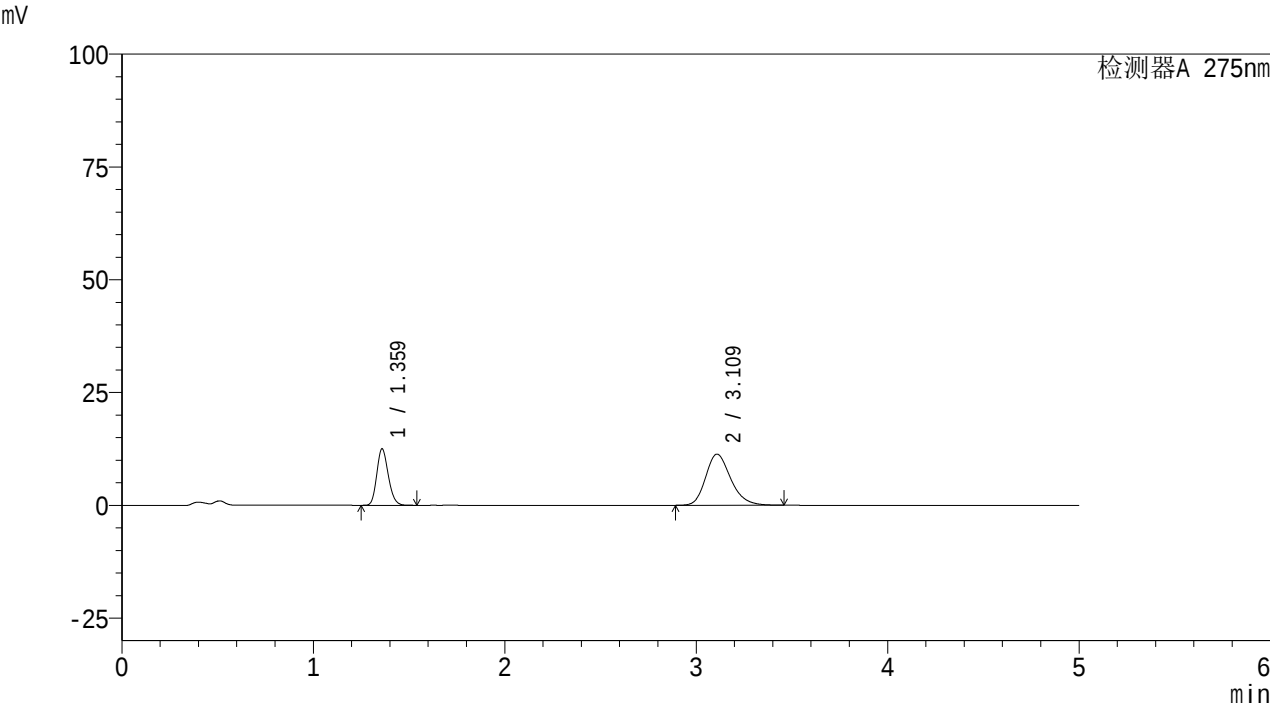

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	52155	33.617	12397	2458	1.183	--
2	3.109	102988	66.383	11305	2794	1.218	10.150
总计		155143	100.000	23702			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1048-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:00:36

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

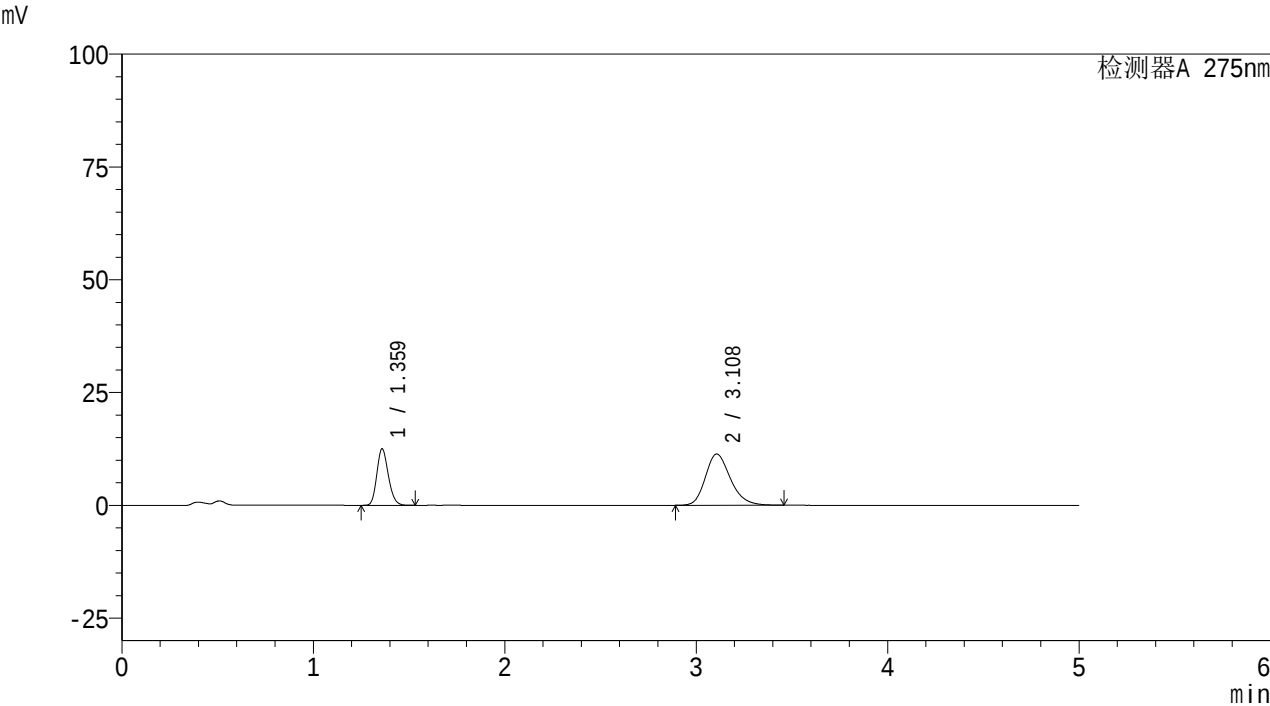

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	52102	33.585	12377	2459	1.183	--
2	3.108	103034	66.415	11346	2801	1.217	10.151
总计		155136	100.000	23723			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1049-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:06:00

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

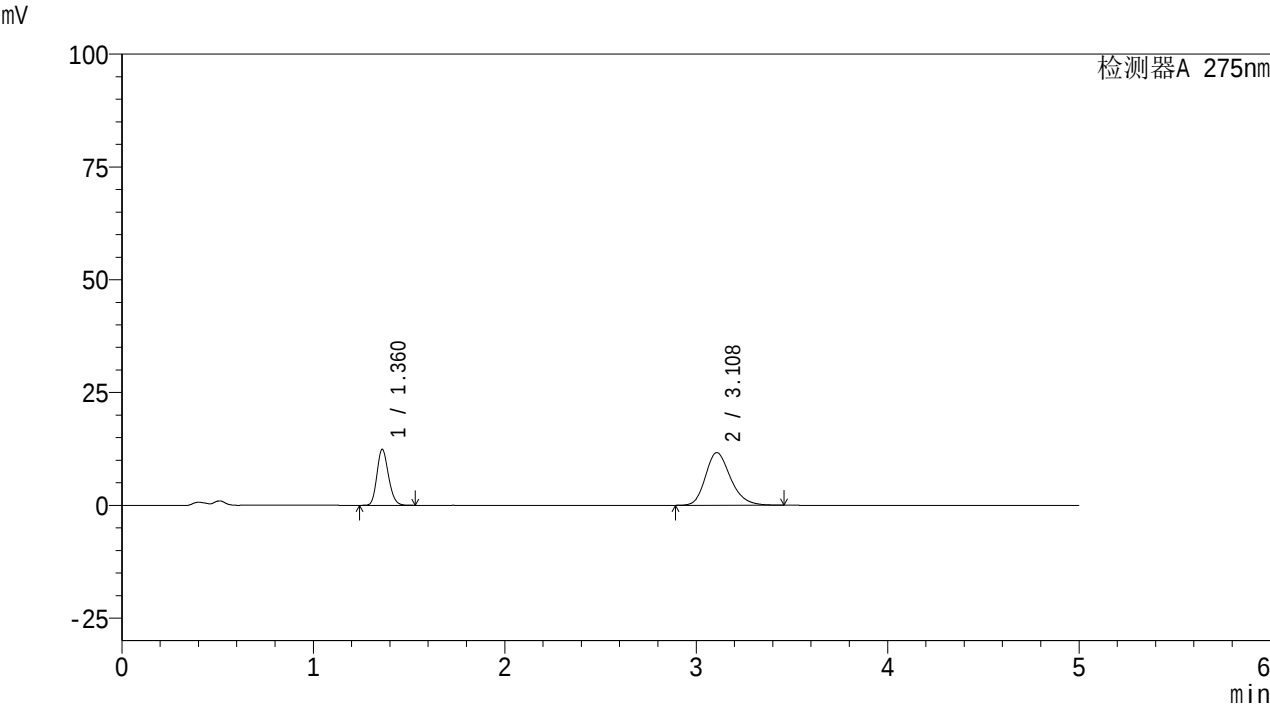

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.360	51690	32.776	12305	2460	1.181	--
2	3.108	106019	67.224	11656	2797	1.220	10.143
总计		157710	100.000	23961			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1050-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:11:24

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

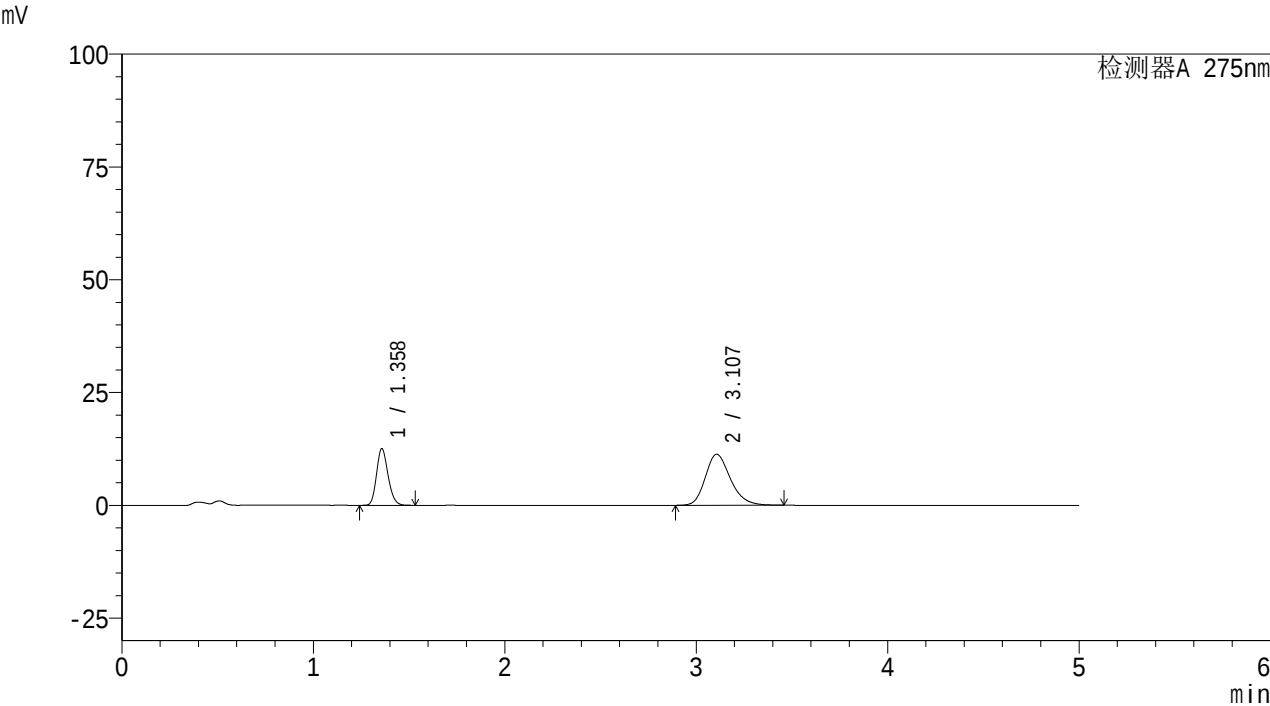

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52341	33.725	12518	2451	1.182	--
2	3.107	102857	66.275	11294	2785	1.219	10.138
总计		155199	100.000	23812			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1051-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/15 13:16:48

处理时间(V2): 2026/05/15 17:28:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

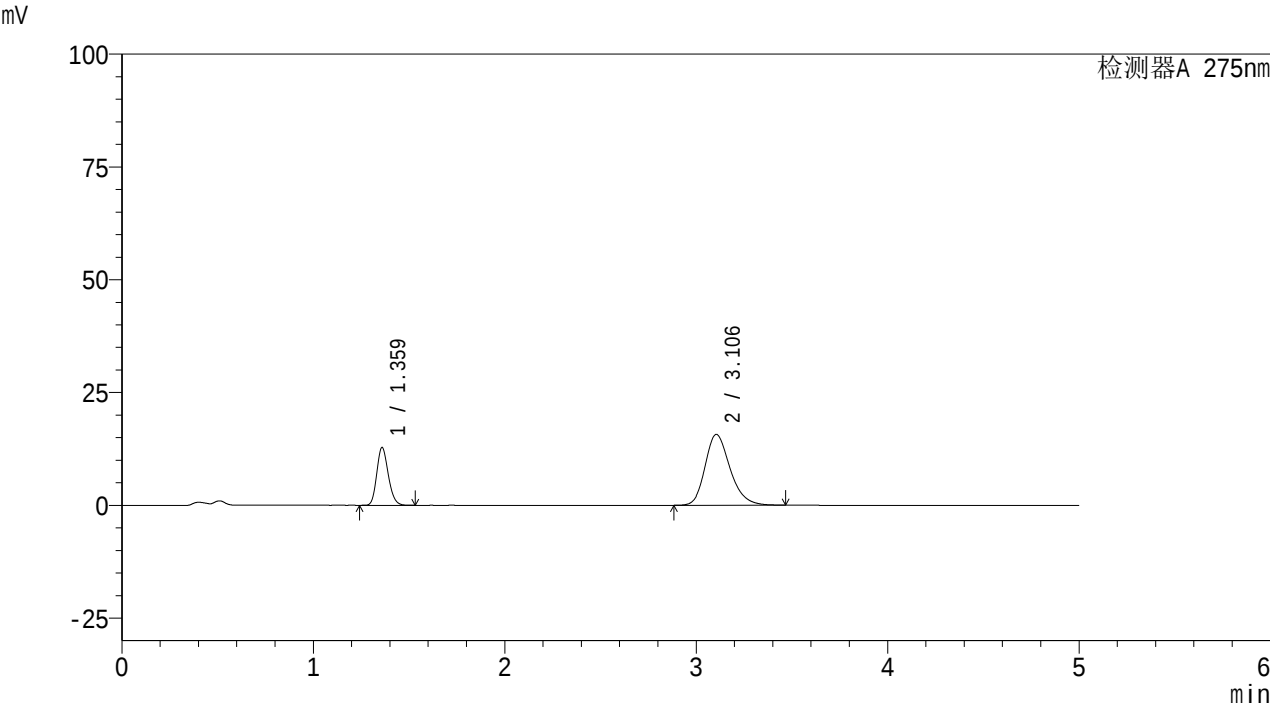

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	53345	27.269	12697	2459	1.184	--
2	3.106	142280	72.731	15708	2815	1.228	10.164
总计		195625	100.000	28405			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1052-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:22:11
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

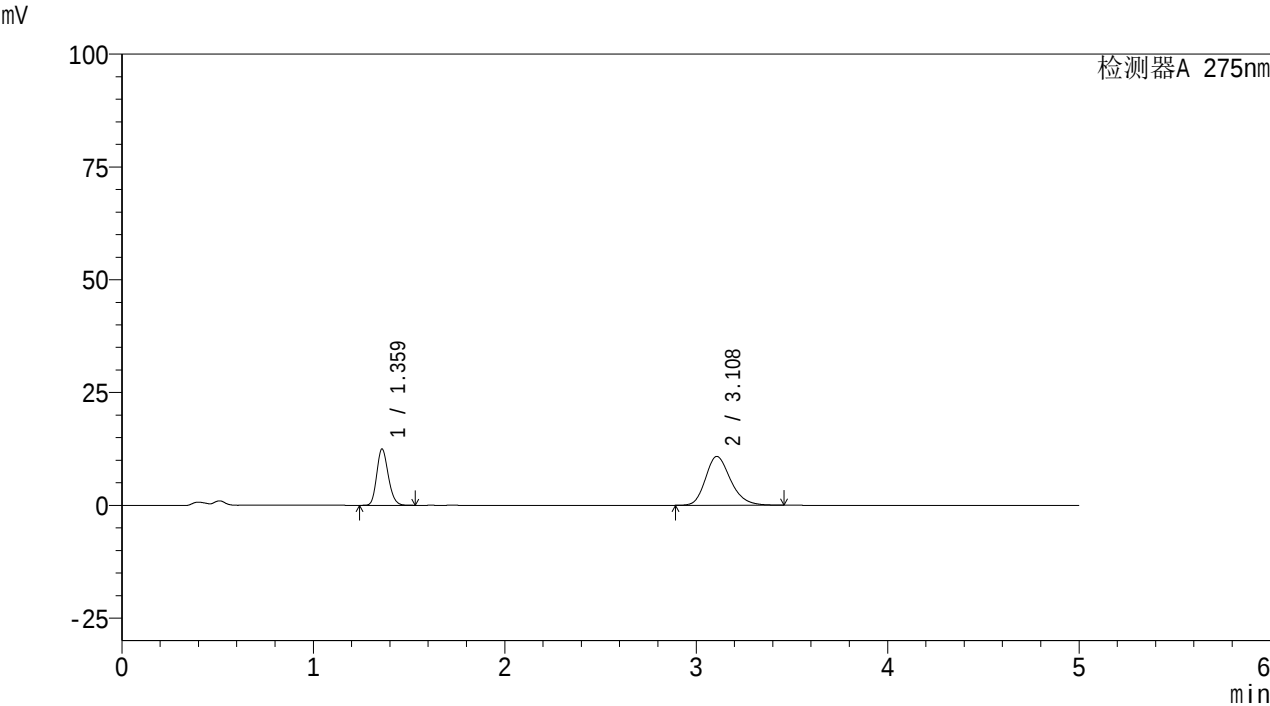

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	51996	34.592	12374	2456	1.183	--
2	3.108	98319	65.408	10803	2793	1.219	10.145
总计		150315	100.000	23177			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1053-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:27:35
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

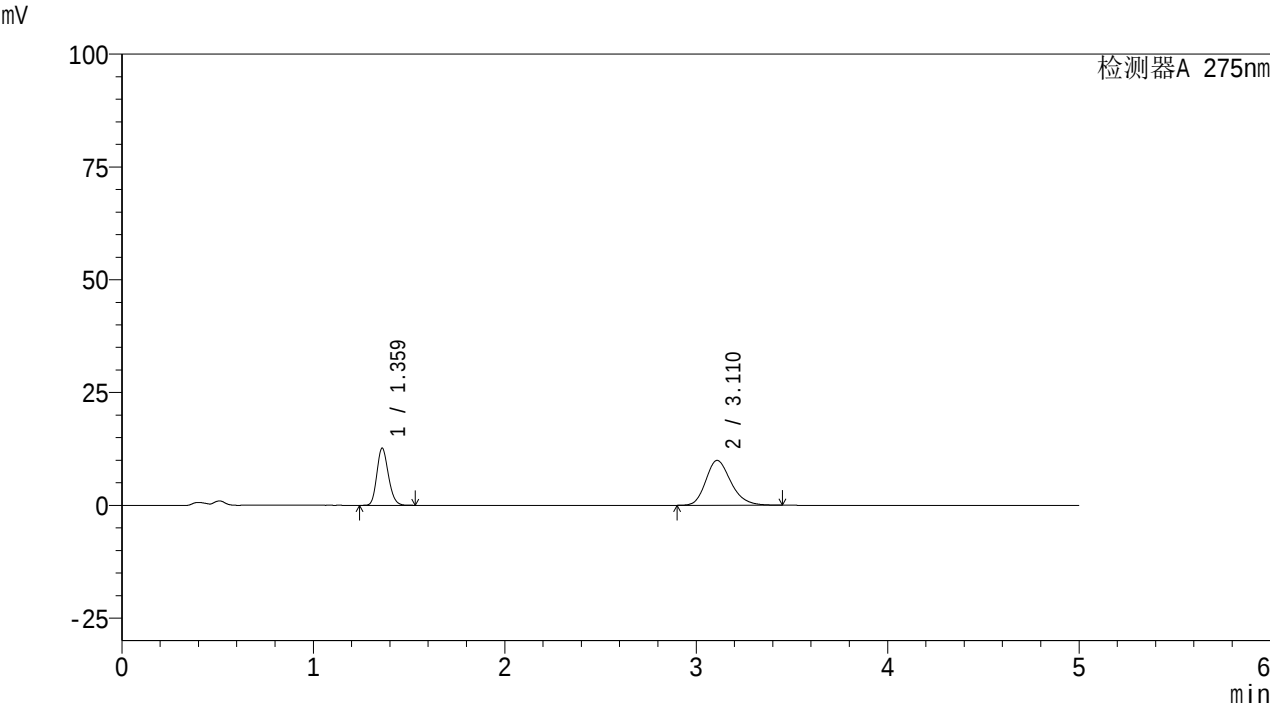

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	52723	36.847	12530	2458	1.182	--
2	3.110	90364	63.153	9928	2799	1.214	10.155
总计		143087	100.000	22458			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1054-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:32:59
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

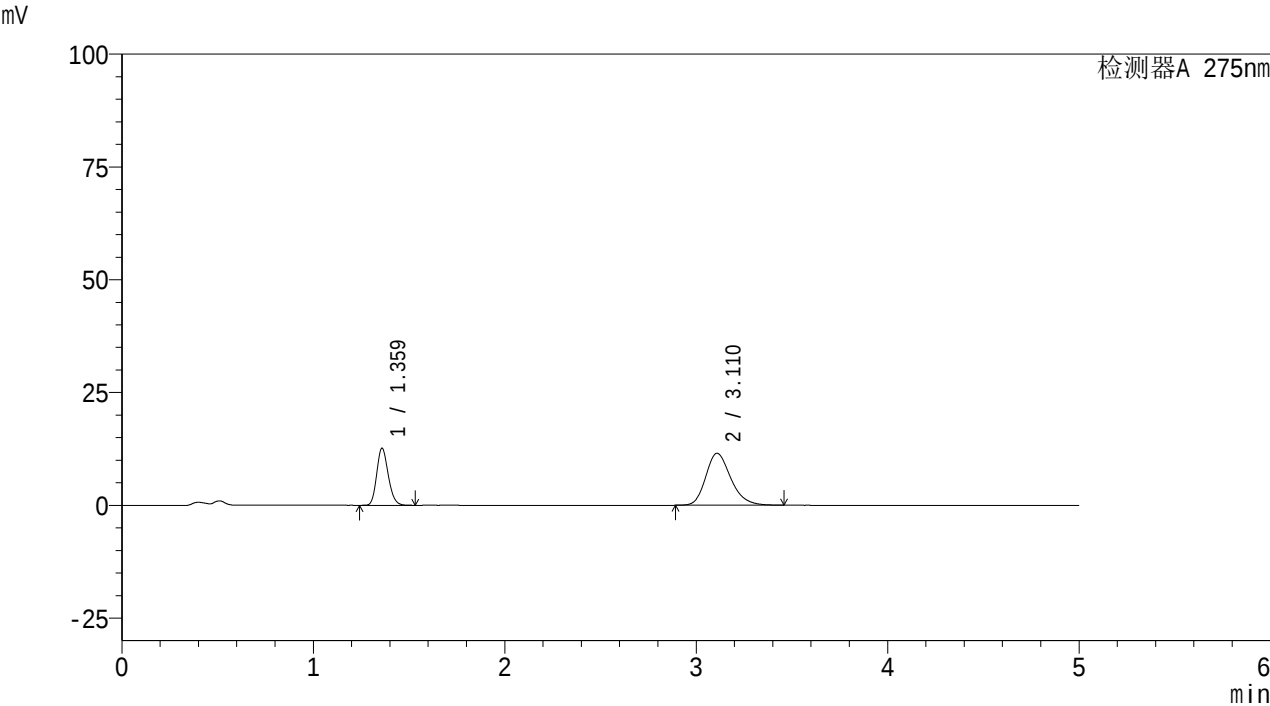

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.359	52772	33.534	12563	2456	1.183	--
2	3.110	104596	66.466	11494	2799	1.220	10.158
总计		157369	100.000	24057			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1055-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:38:23
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

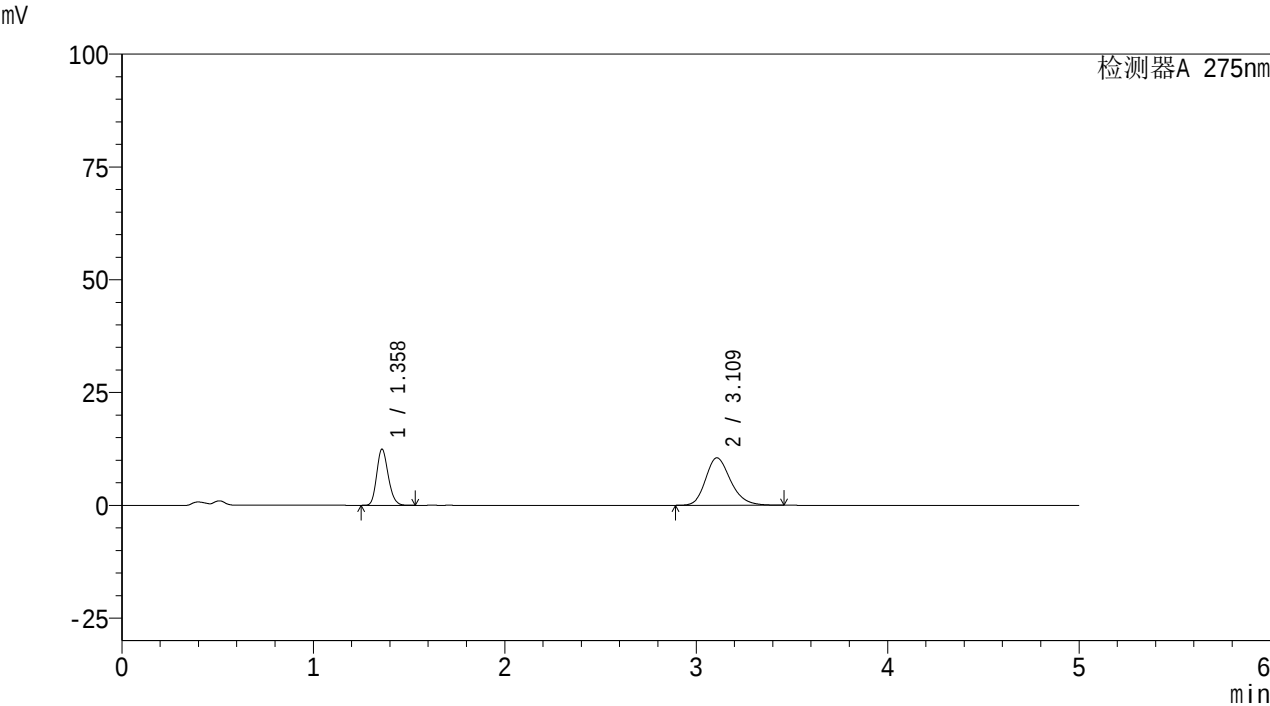

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	51826	35.179	12358	2461	1.182	--
2	3.109	95496	64.821	10501	2801	1.214	10.161
总计		147322	100.000	22859			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1056-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:43:47
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

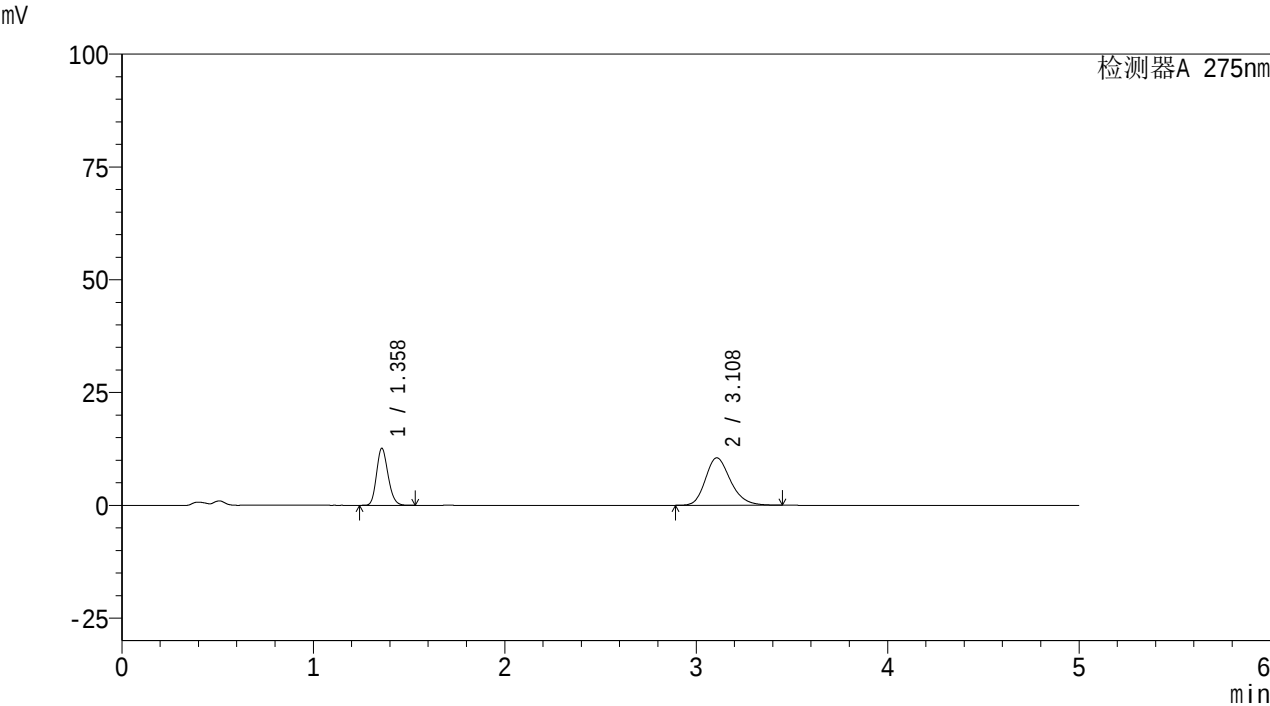

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52637	35.499	12594	2454	1.182	--
2	3.108	95642	64.501	10506	2789	1.216	10.147
总计		148279	100.000	23100			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1057-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:49:10
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

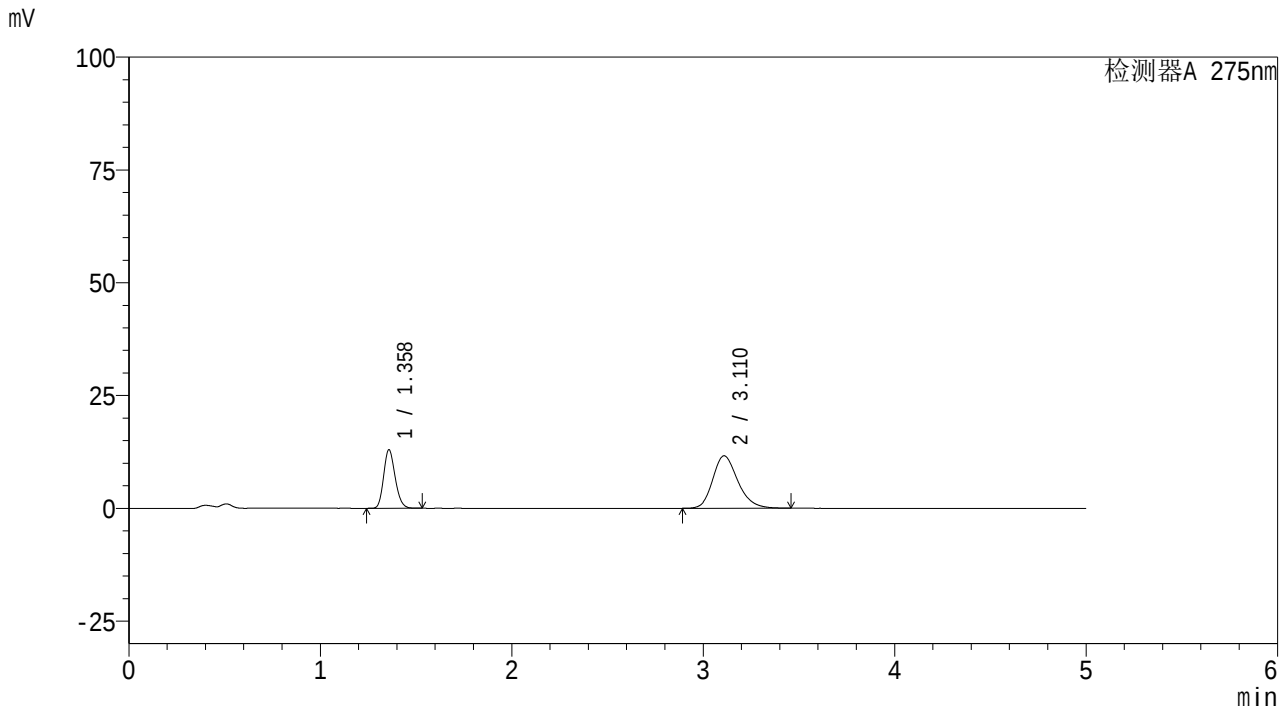

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	54035	33.788	12904	2457	1.182	--
2	3.110	105887	66.212	11608	2789	1.220	10.149
总计		159922	100.000	24512			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1058-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:54:34
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

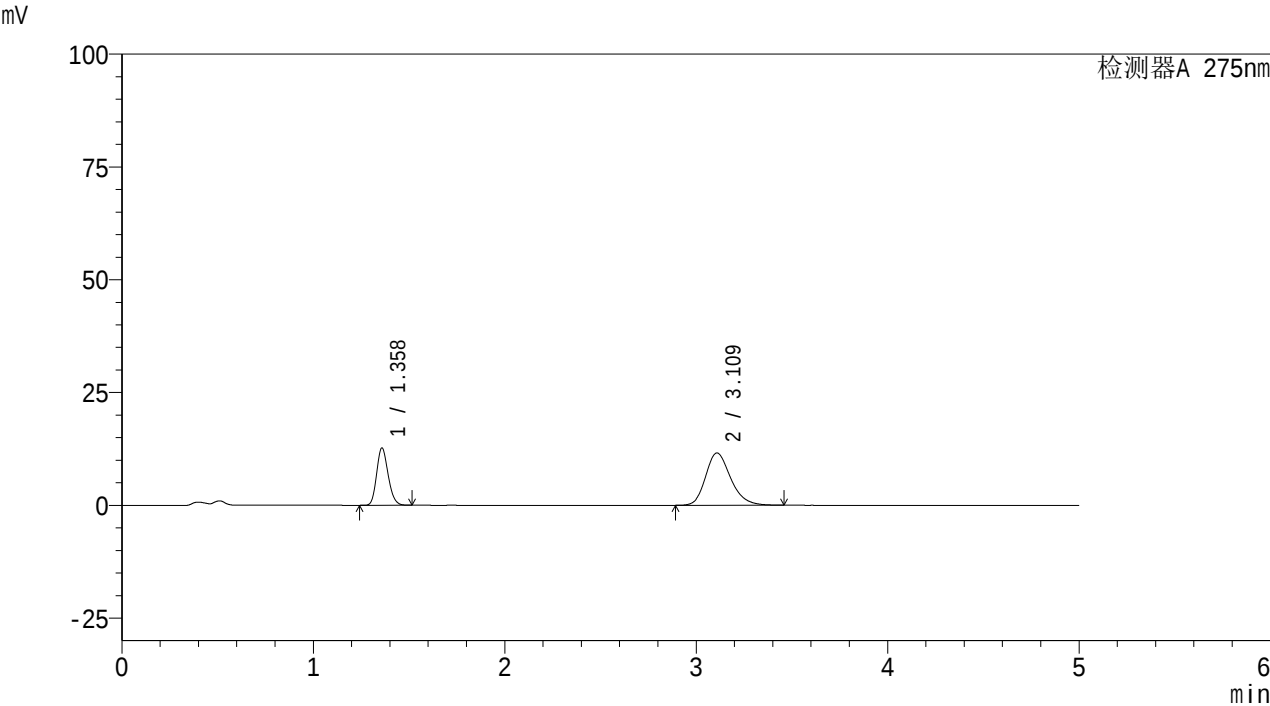

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.358	52811	33.409	12636	2462	1.182	--
2	3.109	105265	66.591	11565	2801	1.220	10.166
总计		158076	100.000	24202			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1059-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 13:59:57
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

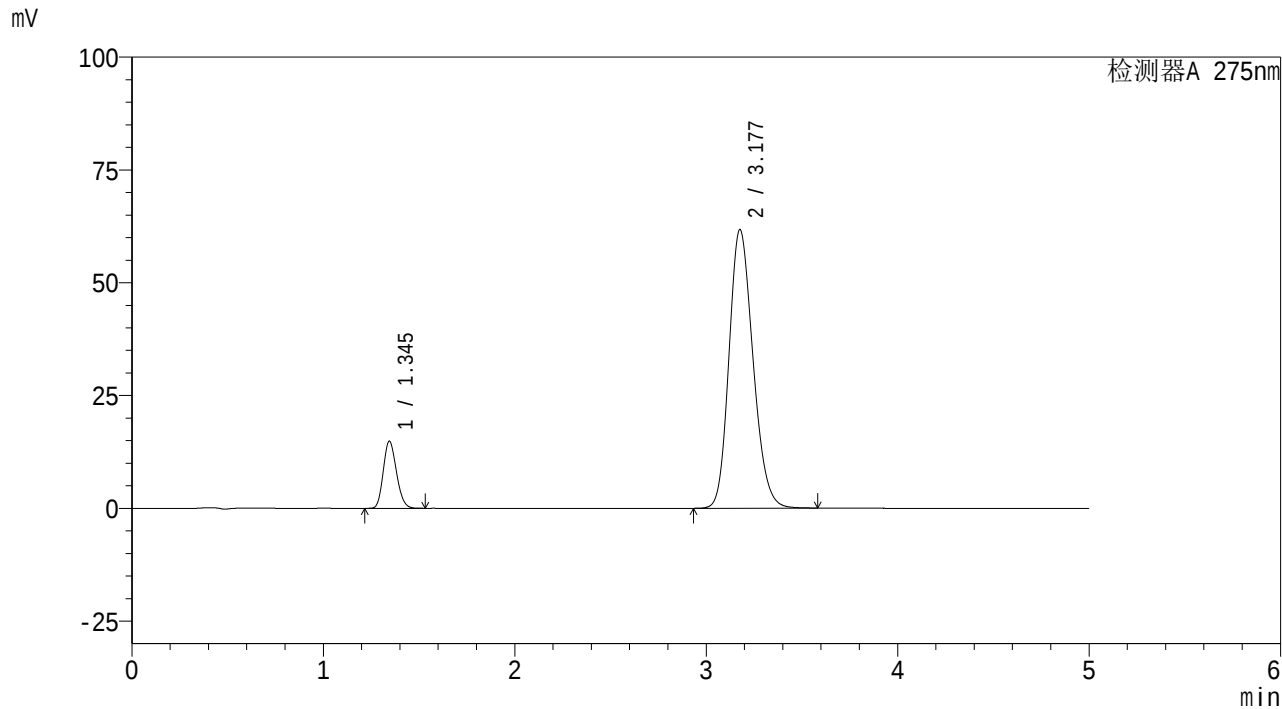

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	71064	11.716	14851	1813	1.171	--
2	3.177	535501	88.284	61658	3120	1.189	10.355
总计		606565	100.000	76509			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-35/27-1060-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260514-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/15 14:05:20
处理时间(V2): 2026/05/15 17:29:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

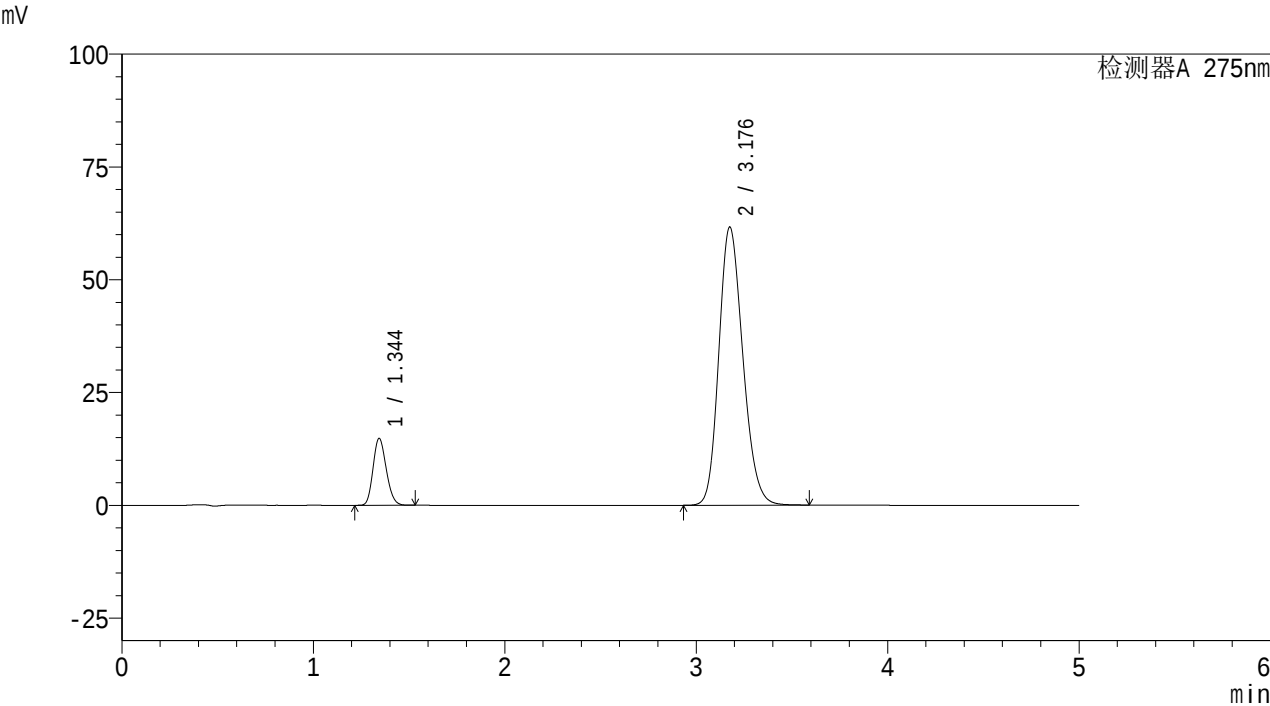

<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	70956	11.713	14777	1806	1.173	--
2	3.176	534837	88.287	61515	3118	1.189	10.351
总计		605794	100.000	76292			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2