



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	340811	340245	340238	339861	339739	340179	0.13
2	12.47	339139	338863				339001	0.06

单位质量响应值		RSD%	判断
27127.51	27185.32	0.16	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041211批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	315553	-	315553	81.182	86.38	3.74	81.18	86.38	3.74
	2	352547	-	352547	90.699			90.70		
	3	342496	-	342496	88.113			88.11		
	4	335241	-	335241	86.247			86.25		
	5	339142	-	339142	87.250			87.25		
	6	329621	-	329621	84.801			84.80		
10min	1	361145	-	361145	92.911	92.32	2.02	93.05	92.46	2.02
	2	367752	-	367752	94.611			94.76		
	3	357849	-	357849	92.063			92.21		
	4	359288	-	359288	92.433			92.58		
	5	361257	-	361257	92.940			93.09		
	6	345766	-	345766	88.955			89.10		
15min	1	368656	-	368656	94.843	93.74	2.07	95.13	94.04	2.07
	2	372503	-	372503	95.833			96.14		
	3	361272	-	361272	92.944			93.24		
	4	365468	-	365468	94.023			94.32		
	5	367373	-	367373	94.513			94.81		
	6	350954	-	350954	90.289			90.58		
20min	1	372497	-	372497	95.832	94.81	2.11	96.28	95.27	2.11
	2	376457	-	376457	96.850			97.32		
	3	367705	-	367705	94.599			95.05		
	4	369348	-	369348	95.021			95.48		
	5	371351	-	371351	95.537			95.99		
	6	353913	-	353913	91.050			91.49		
30min	1	377426	-	377426	97.100	96.08	2.08	97.71	96.69	2.08
	2	381251	-	381251	98.084			98.71		
	3	371997	-	371997	95.703			96.32		
	4	374247	-	374247	96.282			96.89		
	5	376833	-	376833	96.947			97.56		
	6	359000	-	359000	92.359			92.95		
45min	1	380105	-	380105	97.789	97.07	2.18	98.56	97.84	2.18
	2	386059	-	386059	99.321			100.11		
	3	377215	-	377215	97.045			97.82		
	4	377718	-	377718	97.175			97.95		
	5	380839	-	380839	97.978			98.76		
	6	361836	-	361836	93.089			93.83		
极限	1	384634	-	384634	98.954	98.24	1.89	99.89	99.17	1.90
	2	390828	-	390828	100.548			101.51		
	3	381892	-	381892	98.249			99.18		
	4	382062	-	382062	98.292			99.23		
	5	382917	-	382917	98.512			99.45		
	6	368799	-	368799	94.880			95.78		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	338403	338617	338381	338399	338716	338503	0.05
2	12.47	338402	338596				338499	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
26993.86				0.40	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041211批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	346887	-	346887	89.530	87.87	2.22	89.53	87.87	2.22
	2	343720	-	343720	88.713			88.71		
	3	328870	-	328870	84.880			84.88		
	4	346842	-	346842	89.519			89.52		
	5	333379	-	333379	86.044			86.04		
	6	343109	-	343109	88.555			88.56		
10min	1	361517	-	361517	93.306	92.27	1.55	93.46	92.42	1.55
	2	359799	-	359799	92.863			93.01		
	3	354293	-	354293	91.442			91.58		
	4	362520	-	362520	93.565			93.71		
	5	347848	-	347848	89.778			89.92		
	6	359129	-	359129	92.690			92.84		
15min	1	368118	-	368118	95.010	93.94	1.53	95.31	94.24	1.53
	2	364587	-	364587	94.098			94.40		
	3	360874	-	360874	93.140			93.43		
	4	369999	-	369999	95.495			95.80		
	5	354601	-	354601	91.521			91.81		
	6	365694	-	365694	94.384			94.69		
20min	1	372950	-	372950	96.257	94.94	1.50	96.72	95.39	1.50
	2	368670	-	368670	95.152			95.61		
	3	364694	-	364694	94.126			94.58		
	4	373468	-	373468	96.391			96.85		
	5	358769	-	358769	92.597			93.04		
	6	368478	-	368478	95.103			95.56		
30min	1	377067	-	377067	97.320	95.99	1.52	97.94	96.61	1.52
	2	372820	-	372820	96.223			96.84		
	3	368051	-	368051	94.993			95.60		
	4	377811	-	377811	97.512			98.14		
	5	362883	-	362883	93.659			94.26		
	6	372878	-	372878	96.238			96.86		
45min	1	382307	-	382307	98.672	97.11	1.42	99.46	97.88	1.42
	2	377604	-	377604	97.458			98.24		
	3	372224	-	372224	96.070			96.83		
	4	380671	-	380671	98.250			99.04		
	5	368081	-	368081	95.000			95.76		
	6	376597	-	376597	97.198			97.98		
极限	1	386293	-	386293	99.701	98.21	1.72	100.65	99.15	1.72
	2	382242	-	382242	98.655			99.60		
	3	374629	-	374629	96.690			97.61		
	4	386725	-	386725	99.812			100.76		
	5	370531	-	370531	95.633			96.55		
	6	382726	-	382726	98.780			99.72		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	339624	339671	339570	339624	339533	339604	0.02
2	12.47	339946	339593				339770	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
27081.66				0.44	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041211批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	321148	-	321148	82.598	86.18	8.87	82.60	86.18	8.87
	2	356666	-	356666	91.733			91.73		
	3	373555	-	373555	96.077			96.08		
	4	300401	-	300401	77.262			77.26		
	5	351763	-	351763	90.472			90.47		
	6	306924	-	306924	78.939			78.94		
10min	1	364225	-	364225	93.677	94.79	2.88	93.81	94.93	2.89
	2	369998	-	369998	95.162			95.31		
	3	382008	-	382008	98.251			98.41		
	4	357954	-	357954	92.064			92.19		
	5	379673	-	379673	97.650			97.80		
	6	357491	-	357491	91.945			92.08		
15min	1	365310	-	365310	93.956	96.70	1.80	94.25	97.00	1.80
	2	370222	-	370222	95.219			95.53		
	3	382463	-	382463	98.368			98.69		
	4	378954	-	378954	97.465			97.75		
	5	381280	-	381280	98.063			98.38		
	6	377628	-	377628	97.124			97.41		
20min	1	366166	-	366166	94.176	96.81	1.73	94.63	97.28	1.73
	2	371449	-	371449	95.535			96.01		
	3	382616	-	382616	98.407			98.89		
	4	380221	-	380221	97.791			98.24		
	5	381815	-	381815	98.201			98.68		
	6	376212	-	376212	96.760			97.21		
30min	1	367584	-	367584	94.541	96.85	1.56	95.15	97.47	1.56
	2	372047	-	372047	95.689			96.32		
	3	383057	-	383057	98.520			99.17		
	4	378309	-	378309	97.299			97.91		
	5	381670	-	381670	98.164			98.80		
	6	376646	-	376646	96.872			97.48		
45min	1	368657	-	368657	94.817	97.37	1.65	95.58	98.15	1.66
	2	373277	-	373277	96.005			96.79		
	3	384576	-	384576	98.911			99.73		
	4	381746	-	381746	98.183			98.95		
	5	383042	-	383042	98.517			99.32		
	6	380199	-	380199	97.785			98.55		
极限	1	372354	-	372354	95.768	98.46	1.79	96.69	99.40	1.79
	2	376803	-	376803	96.912			97.86		
	3	389544	-	389544	100.189			101.17		
	4	386464	-	386464	99.397			100.33		
	5	388269	-	388269	99.861			100.83		
	6	383430	-	383430	98.616			99.55		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202302	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.54	337183	336986	337438	336919	336766	337058	0.08
2	12.47	339312	339415				339364	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
26878.63				0.88	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2025041211批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	345426	-	345426	89.231	84.82	5.39	89.23	84.82	5.39
	2	347094	-	347094	89.662			89.66		
	3	328109	-	328109	84.758			84.76		
	4	324477	-	324477	83.820			83.82		
	5	326805	-	326805	84.421			84.42		
	6	298278	-	298278	77.052			77.05		
10min	1	375726	-	375726	97.059	94.55	2.31	97.21	94.69	2.31
	2	363930	-	363930	94.011			94.16		
	3	369983	-	369983	95.575			95.72		
	4	358195	-	358195	92.530			92.67		
	5	373388	-	373388	96.455			96.60		
	6	354864	-	354864	91.669			91.80		
15min	1	376620	-	376620	97.290	95.66	2.95	97.60	95.96	2.94
	2	364501	-	364501	94.159			94.47		
	3	371897	-	371897	96.070			96.37		
	4	359904	-	359904	92.971			93.27		
	5	388161	-	388161	100.271			100.57		
	6	360820	-	360820	93.208			93.49		
20min	1	376858	-	376858	97.351	96.04	3.45	97.82	96.50	3.44
	2	365080	-	365080	94.309			94.77		
	3	371978	-	371978	96.090			96.55		
	4	360615	-	360615	93.155			93.60		
	5	394638	-	394638	101.944			102.41		
	6	361597	-	361597	93.409			93.85		
30min	1	376582	-	376582	97.280	96.18	3.95	97.91	96.80	3.94
	2	365336	-	365336	94.375			94.99		
	3	372169	-	372169	96.140			96.76		
	4	360543	-	360543	93.137			93.74		
	5	399195	-	399195	103.121			103.76		
	6	360088	-	360088	93.019			93.61		
45min	1	378064	-	378064	97.663	96.47	3.79	98.46	97.25	3.78
	2	366538	-	366538	94.685			95.46		
	3	372733	-	372733	96.285			97.07		
	4	361669	-	361669	93.427			94.19		
	5	399298	-	399298	103.148			103.96		
	6	362388	-	362388	93.613			94.36		
极限	1	383679	-	383679	99.113	97.66	4.22	100.07	98.60	4.20
	2	371318	-	371318	95.920			96.86		
	3	375382	-	375382	96.970			97.91		
	4	365558	-	365558	94.432			95.35		
	5	407358	-	407358	105.230			106.21		
	6	365023	-	365023	94.294			95.20		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-116-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:40:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

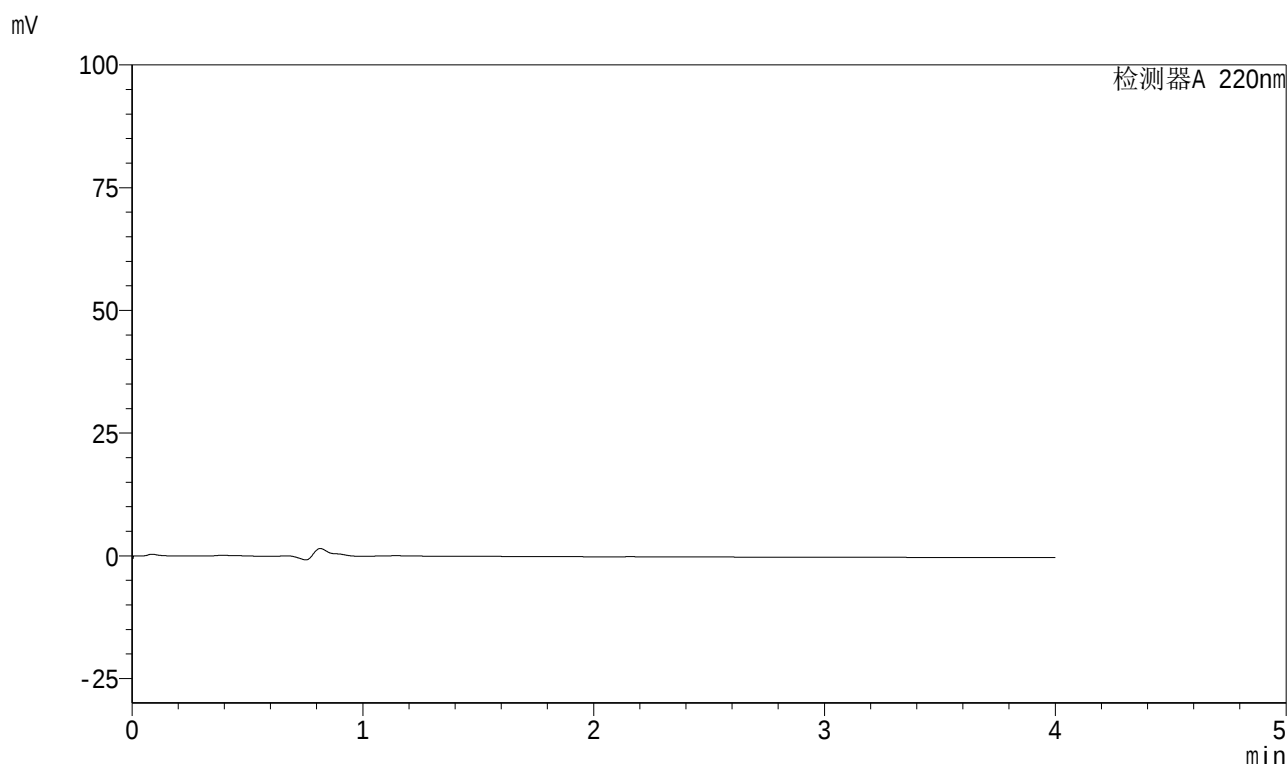

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-117-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 16:44:36 版本号:6.115
处理时间(V2): 2026/05/26 10:52:38 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

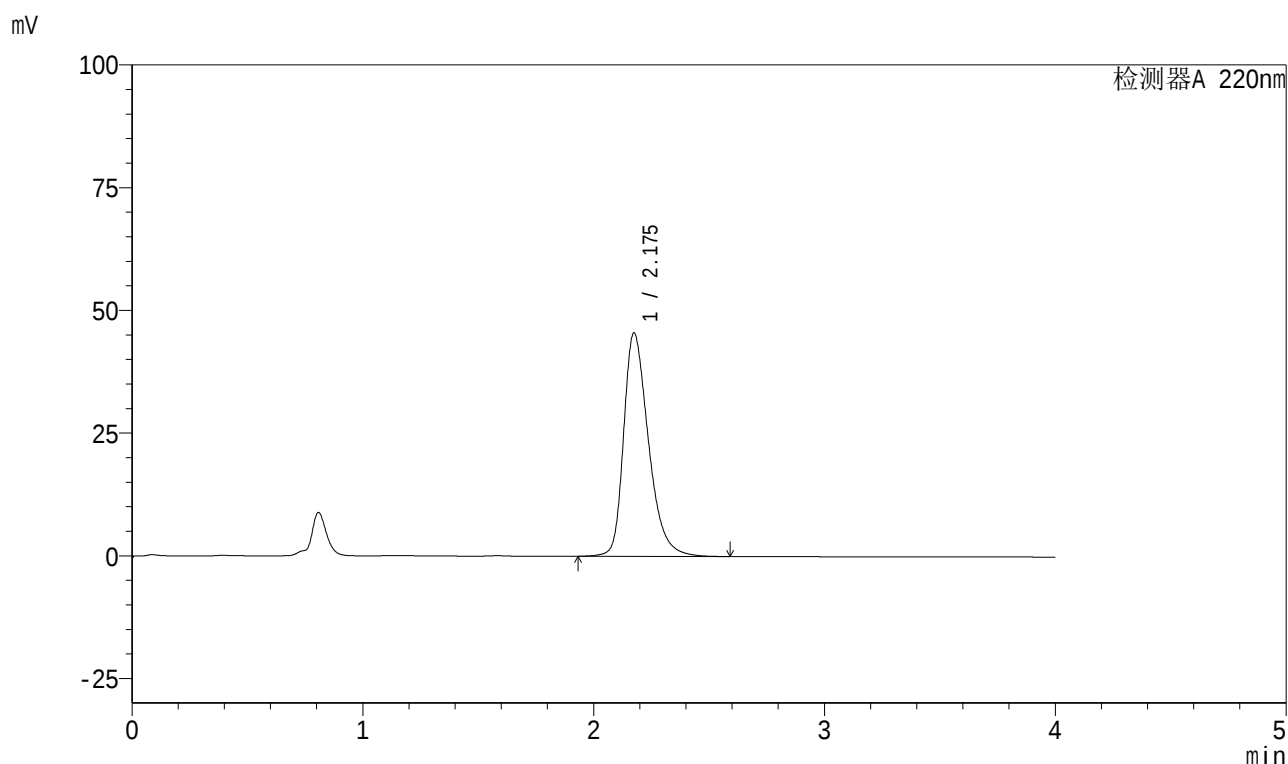

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	340811	100.000	45420	2056	1.352	--
总计		340811	100.000	45420			

图2 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-118-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 16:48:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

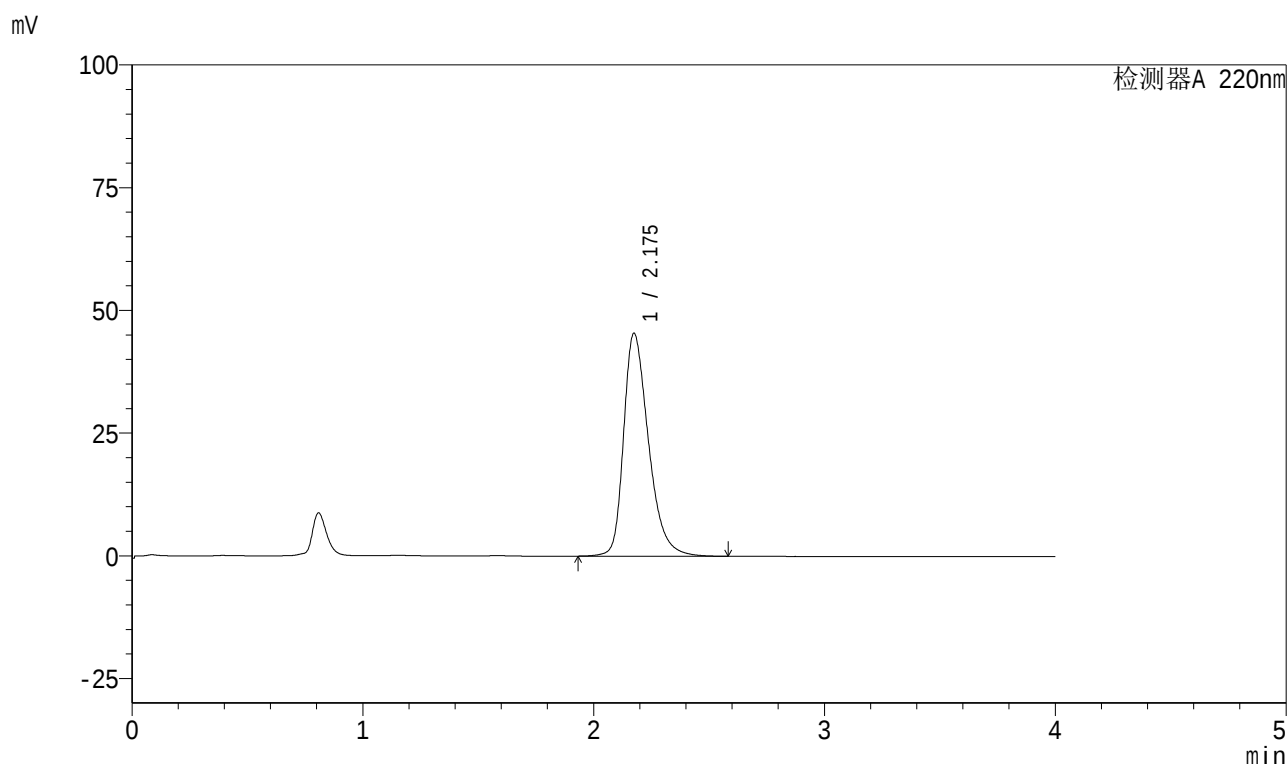

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	340245	100.000	45325	2054	1.353	--
总计		340245	100.000	45325			

图3 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-119-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 16:53:22 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:44 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

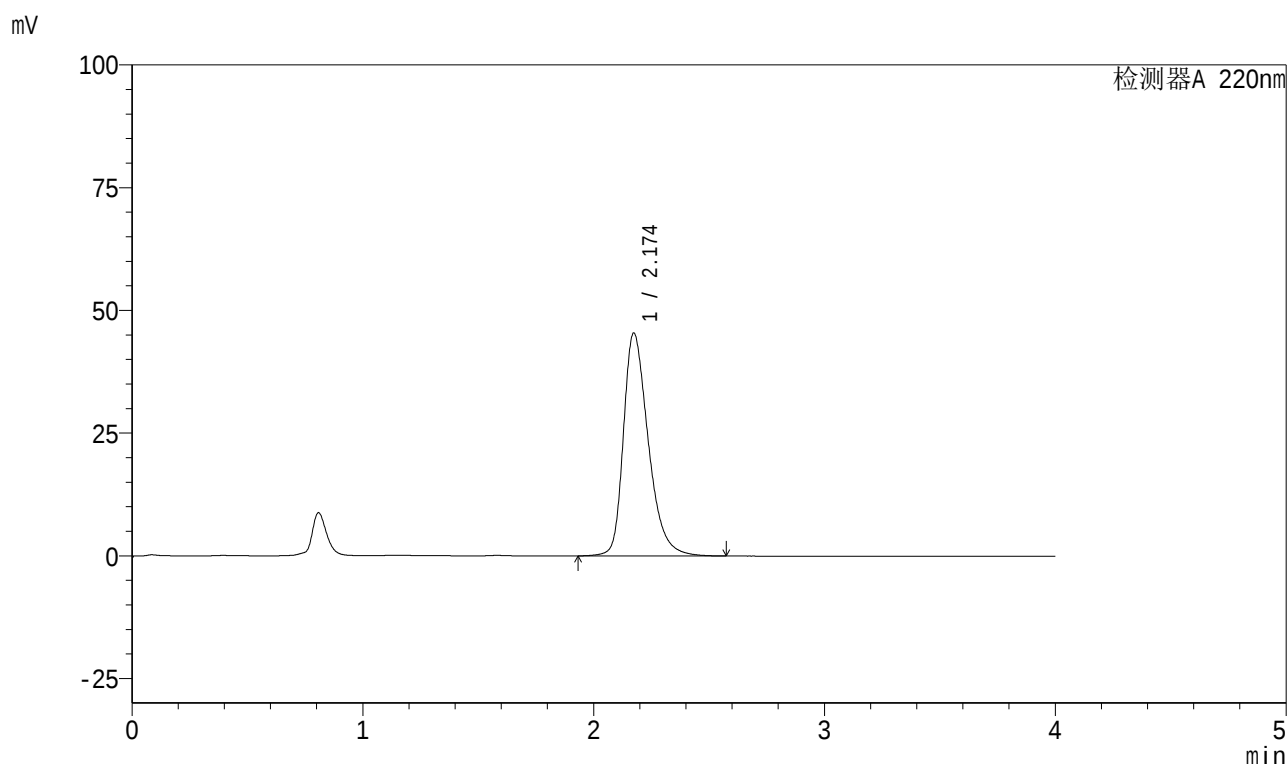

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	340238	100.000	45382	2054	1.352	--
总计		340238	100.000	45382			

图4 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-1-3



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-120-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 16:57:45
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

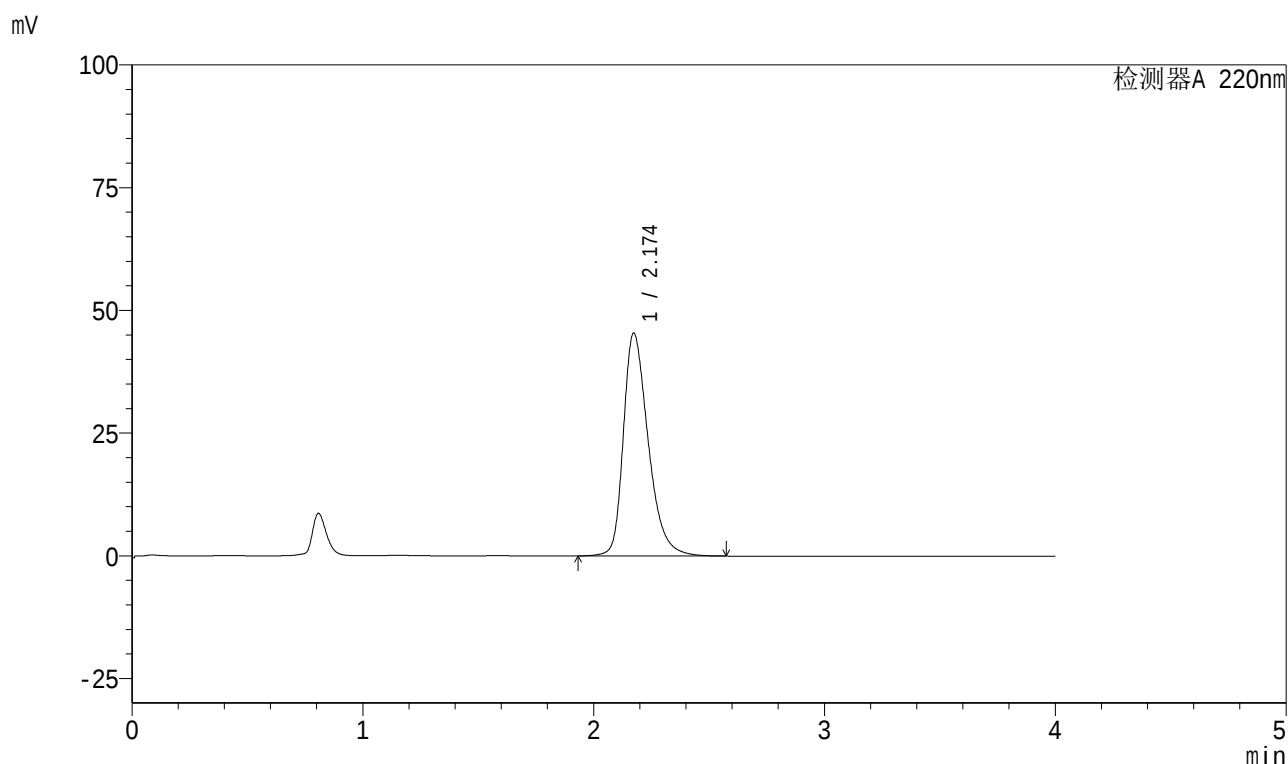

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	339861	100.000	45384	2057	1.351	--
总计		339861	100.000	45384			

图5 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-1-4



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-121-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 17:02:08
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

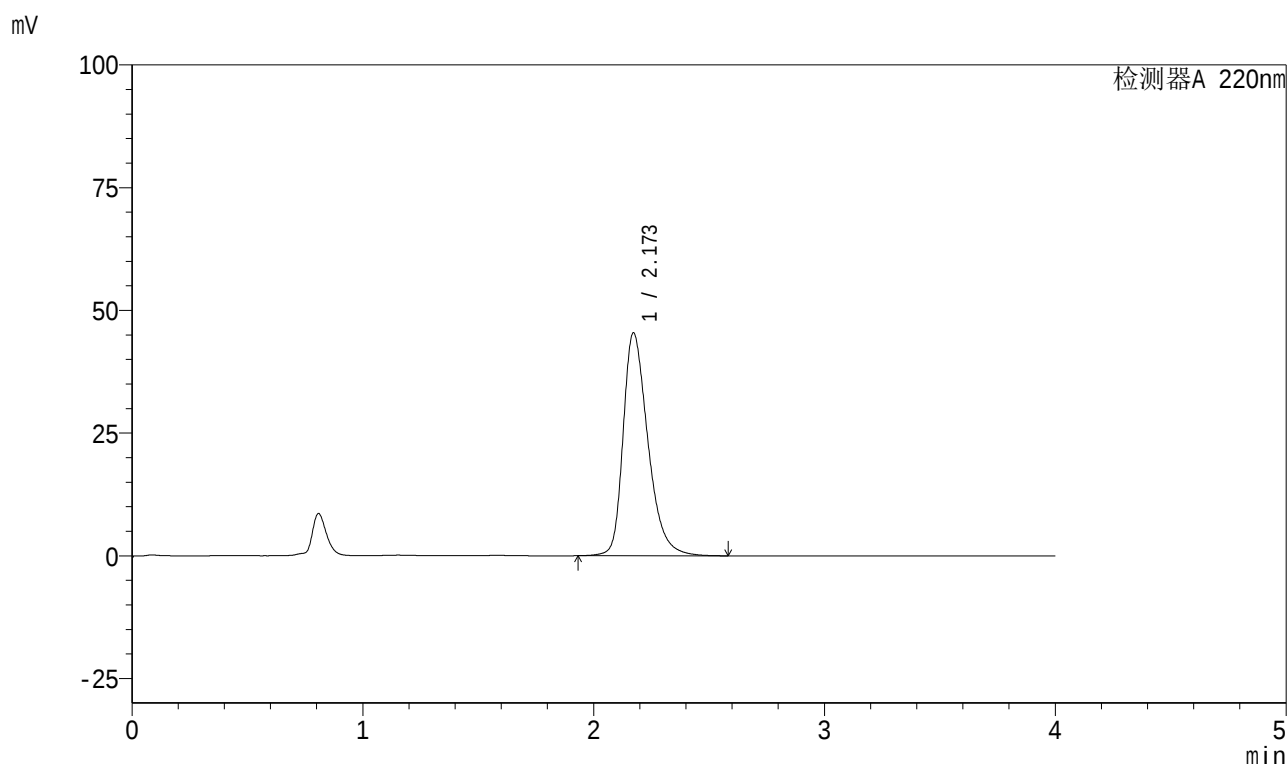

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	339739	100.000	45418	2057	1.351	--
总计		339739	100.000	45418			

图6 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-1-5




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-122-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-5min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb	
样品瓶号: 1-1	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 17:06:30	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)	

<色谱图>

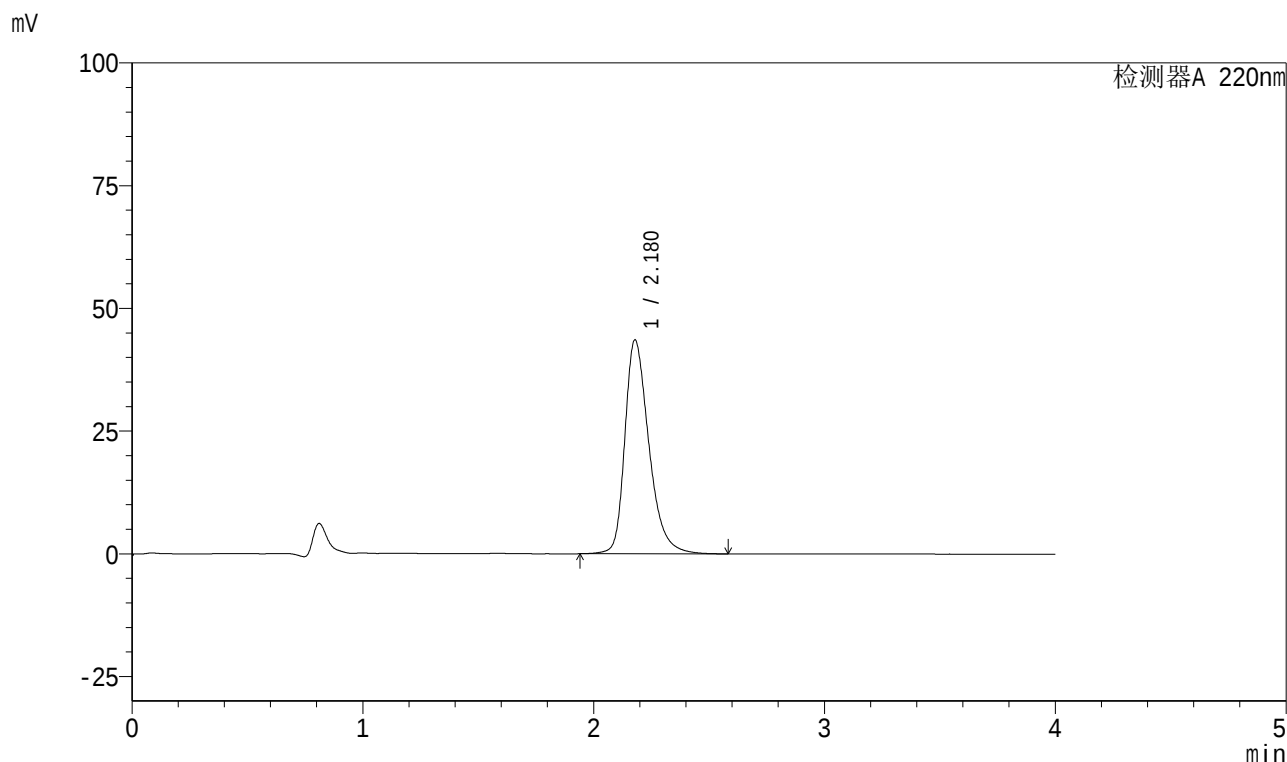

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	315553	100.000	43588	2226	1.341	--
总计		315553	100.000	43588			

图7 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-5min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-123-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 17:10:52 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:54 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

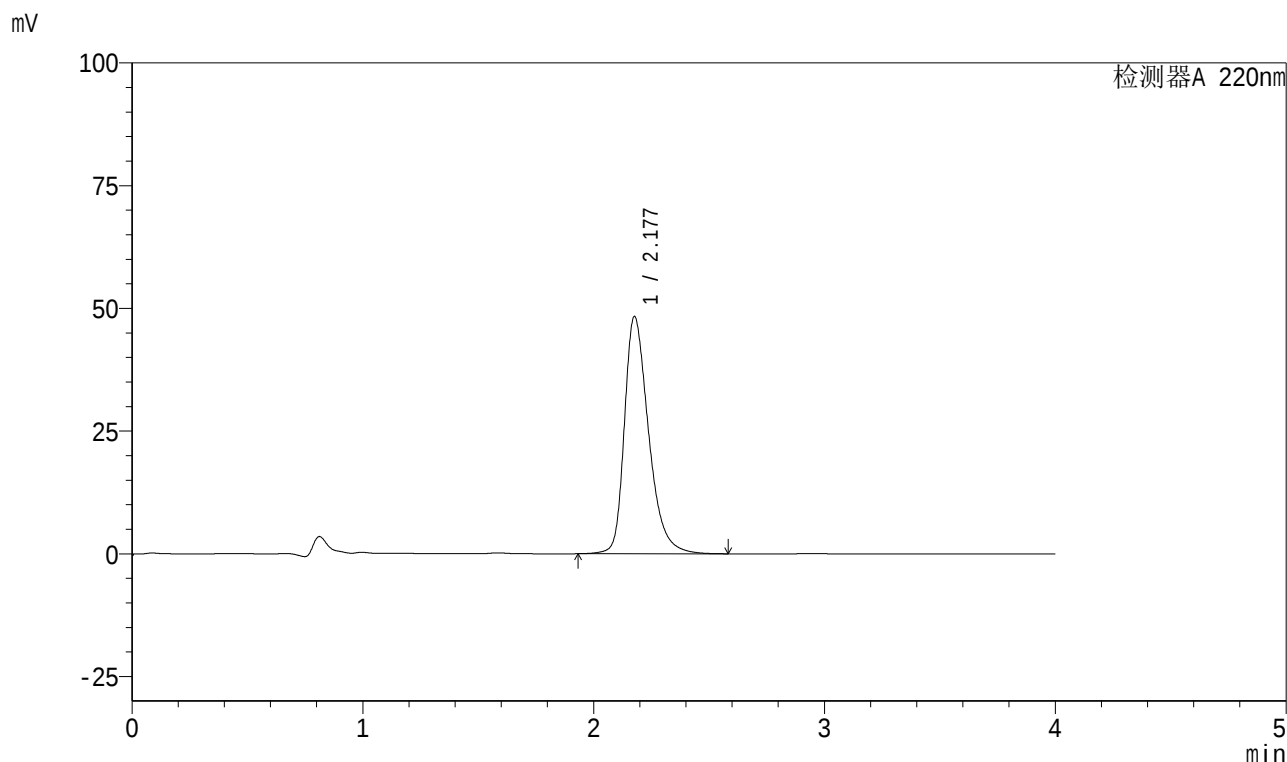

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	352547	100.000	48275	2187	1.362	--
总计		352547	100.000	48275			

图8 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-5min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-124-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 17:15:13
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

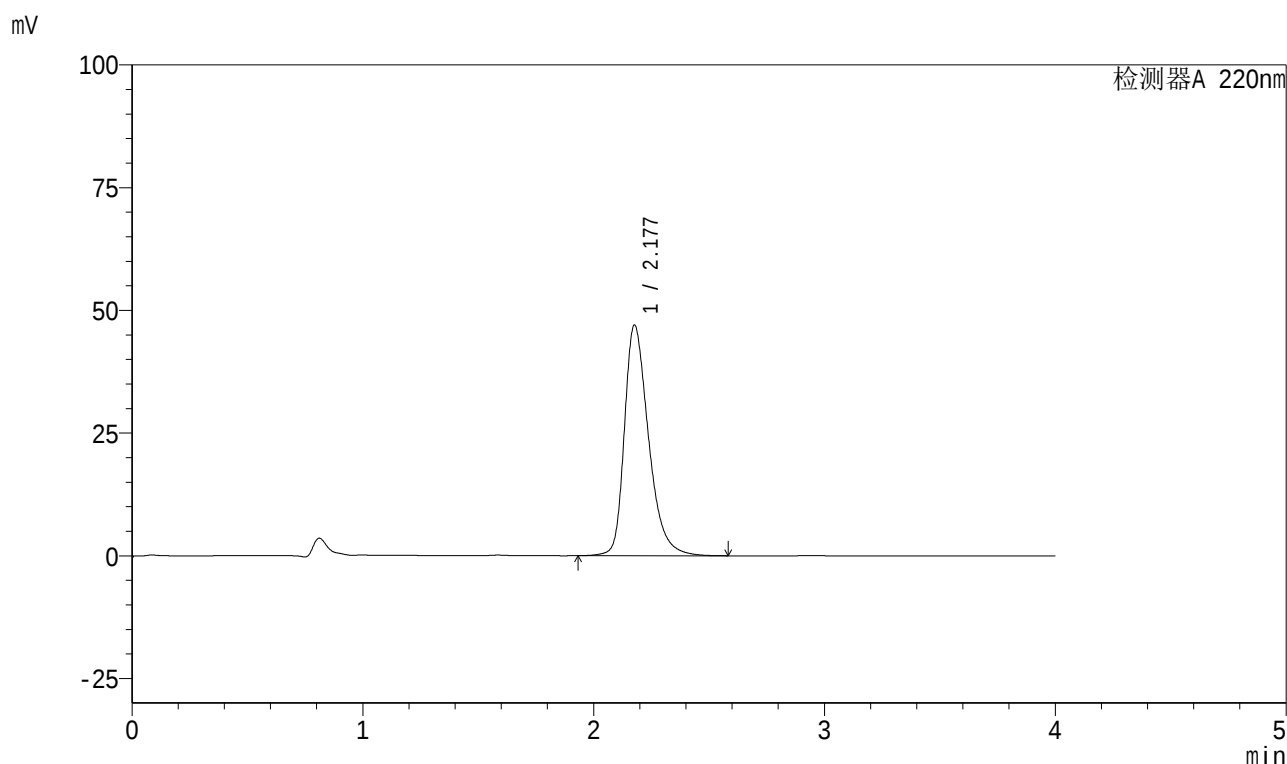

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	342496	100.000	46931	2192	1.358	--
总计		342496	100.000	46931			

图9 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-5min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-125-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 17:19:34
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:52:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

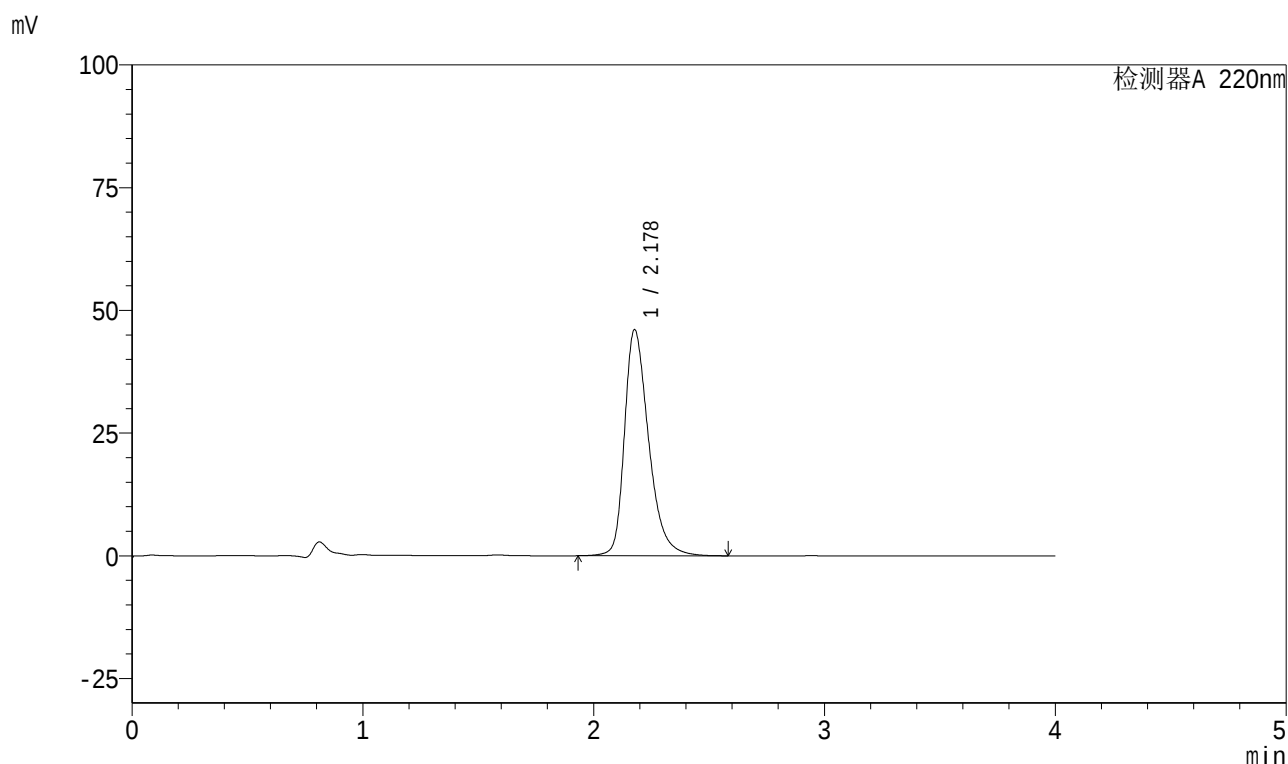

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	335241	100.000	46035	2199	1.353	--
总计		335241	100.000	46035			

图10 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-5min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-126-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:23:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

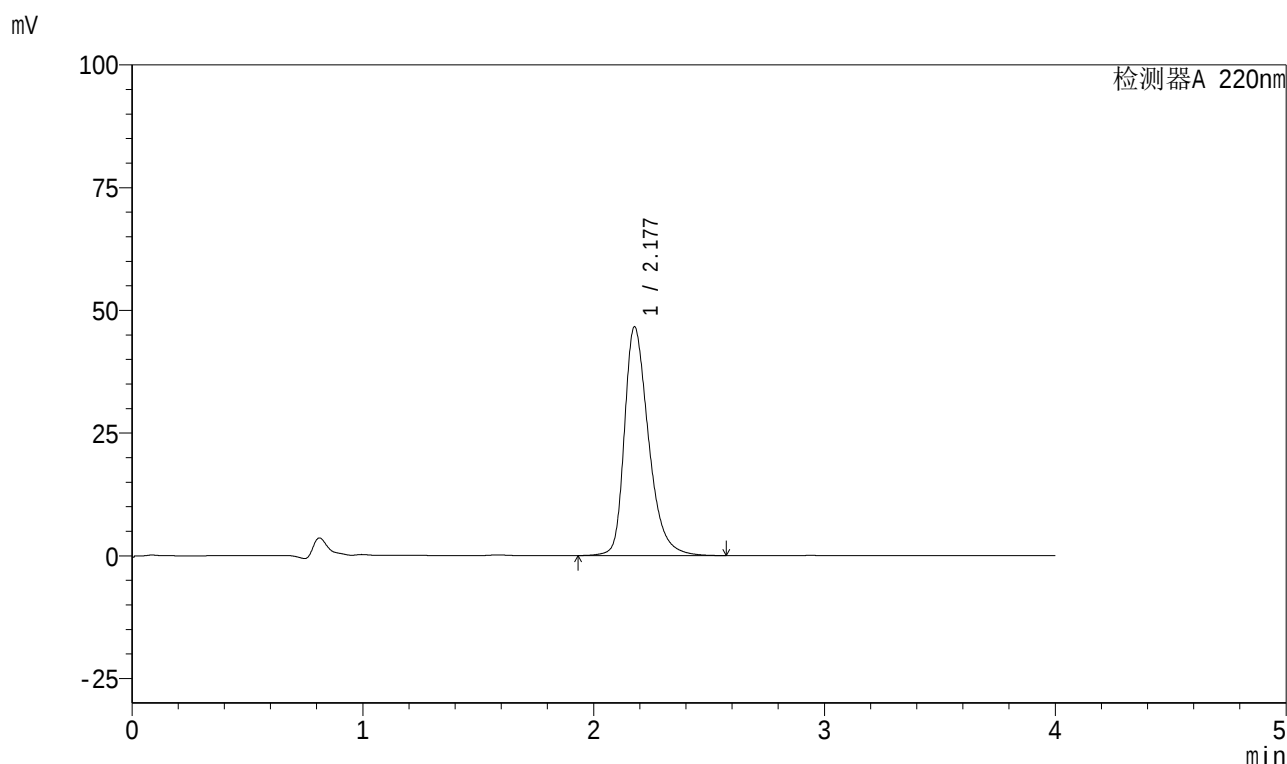

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	339142	100.000	46552	2198	1.354	--
总计		339142	100.000	46552			

图11 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-127-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:28:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

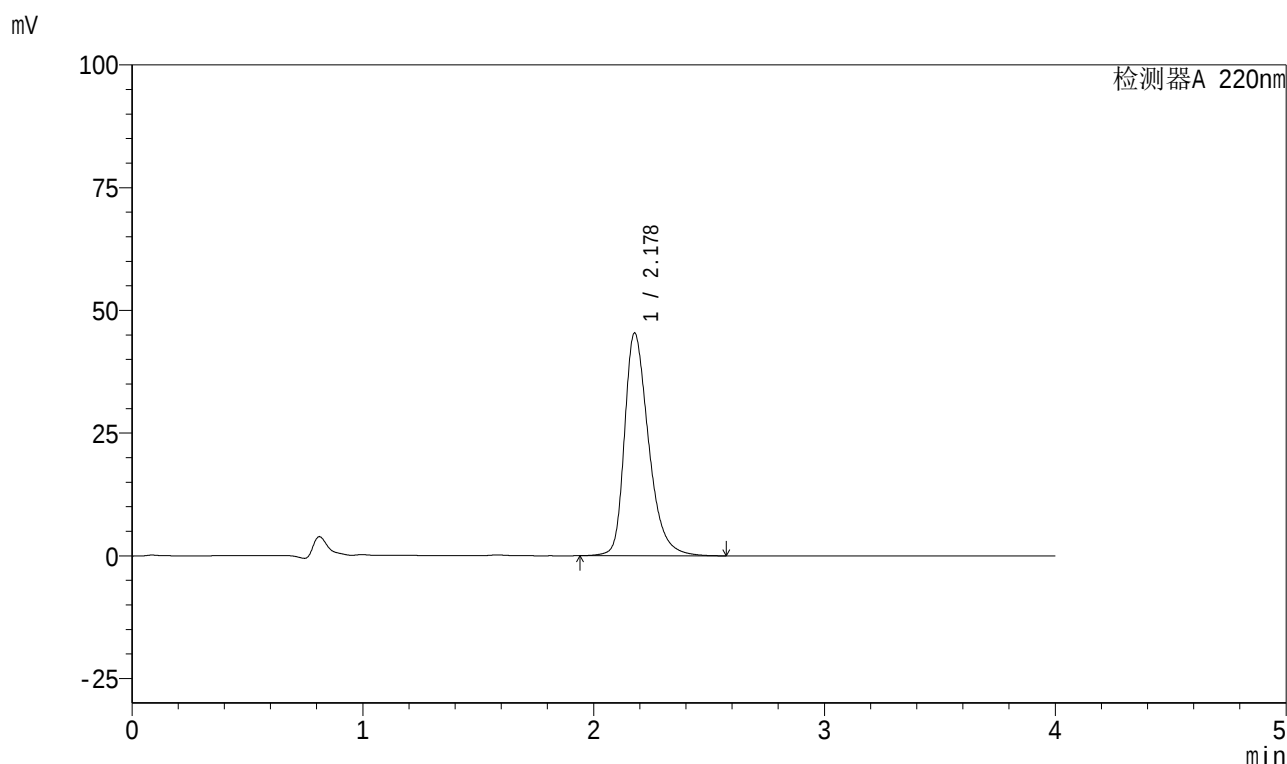

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	329621	100.000	45347	2205	1.349	--
总计		329621	100.000	45347			

图12 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-128-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:32:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

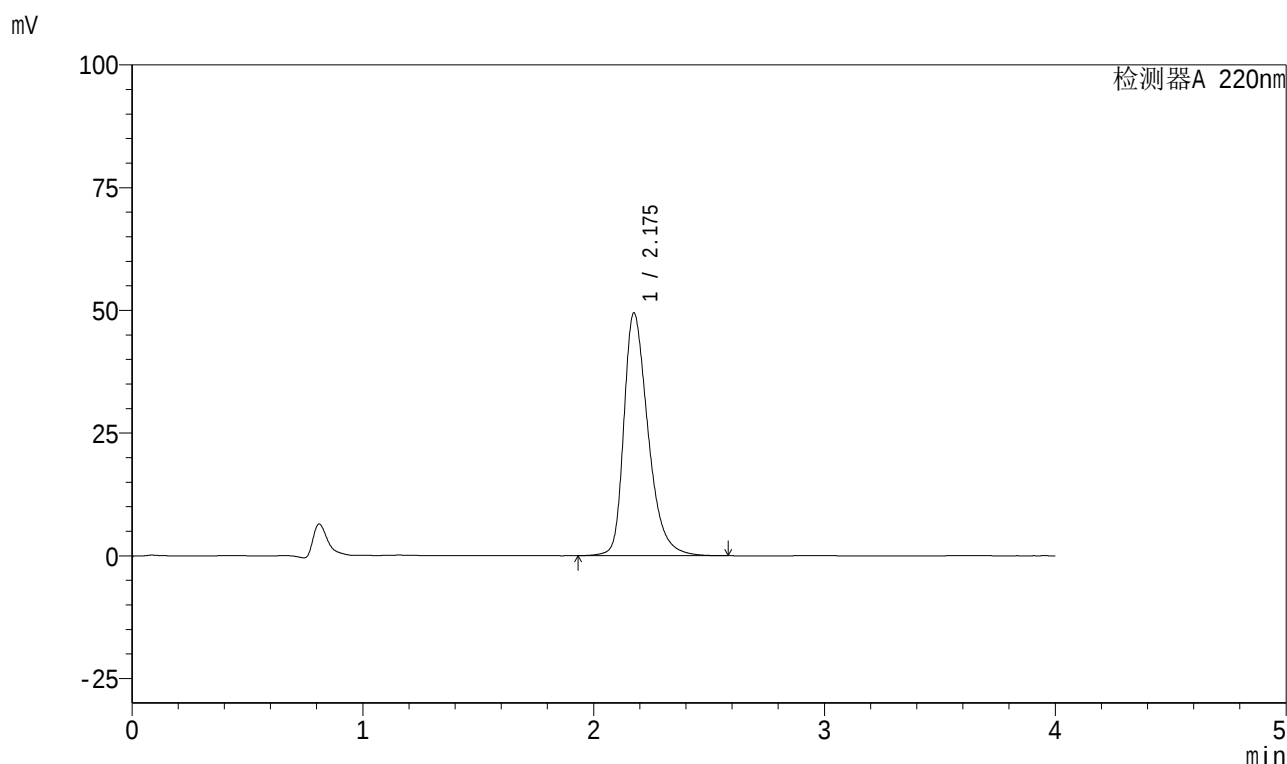

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	361145	100.000	49372	2174	1.367	--
总计		361145	100.000	49372			

图13 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-10min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-129-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 17:37:03 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:09 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

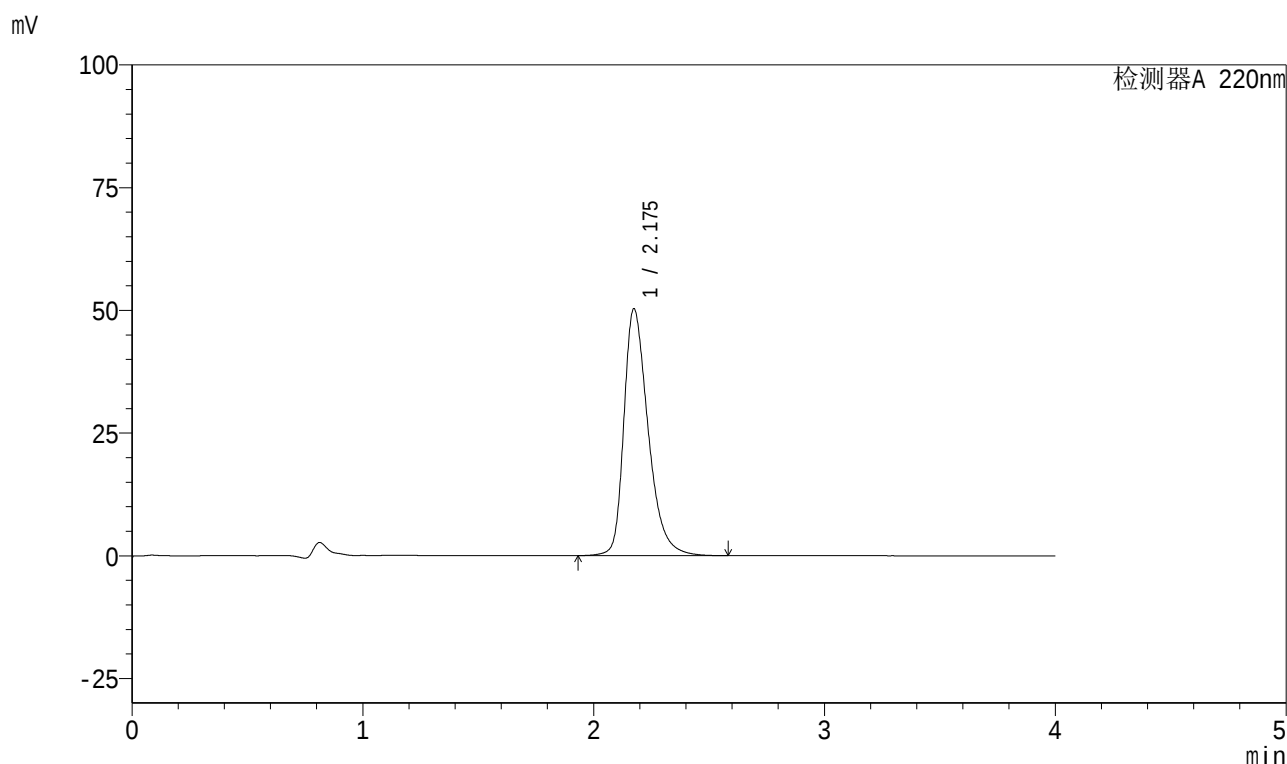

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	367752	100.000	50205	2168	1.370	--
总计		367752	100.000	50205			

图14 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-130-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:41:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

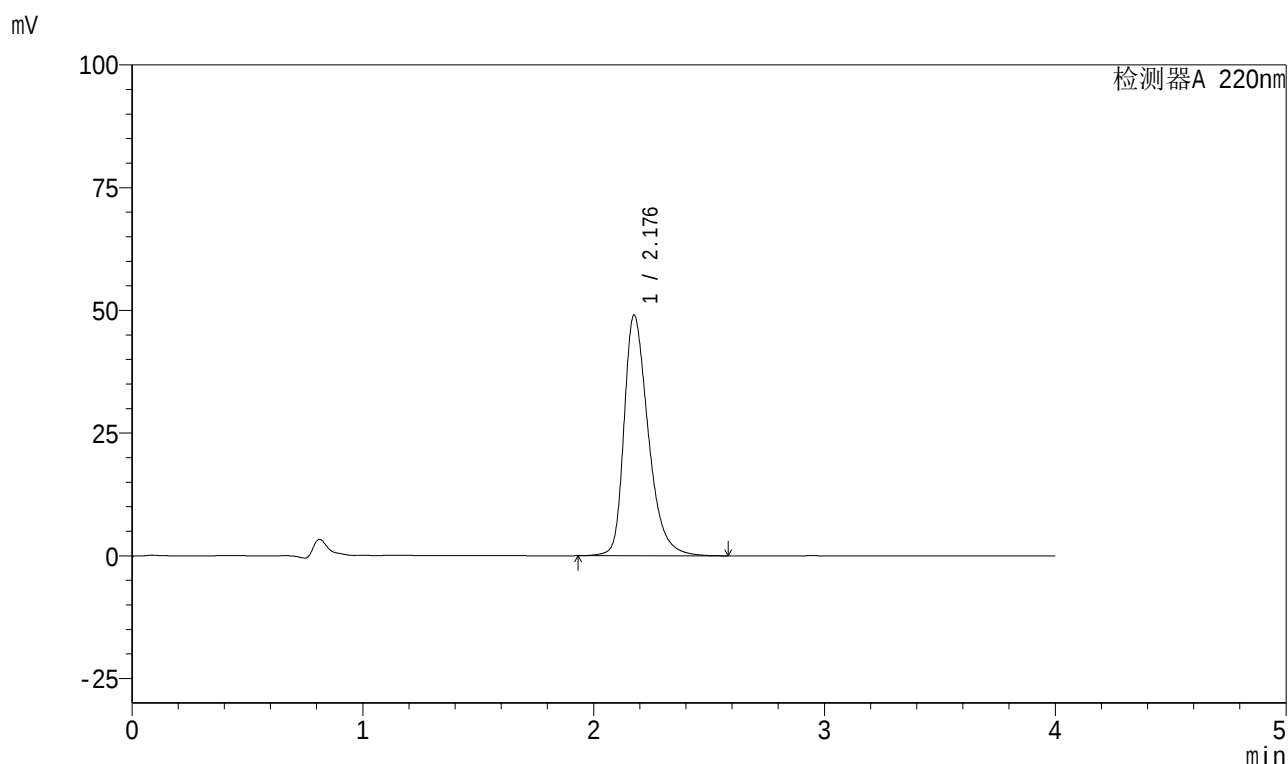

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	357849	100.000	48879	2178	1.365	--
总计		357849	100.000	48879			

图15 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-131-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:45:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

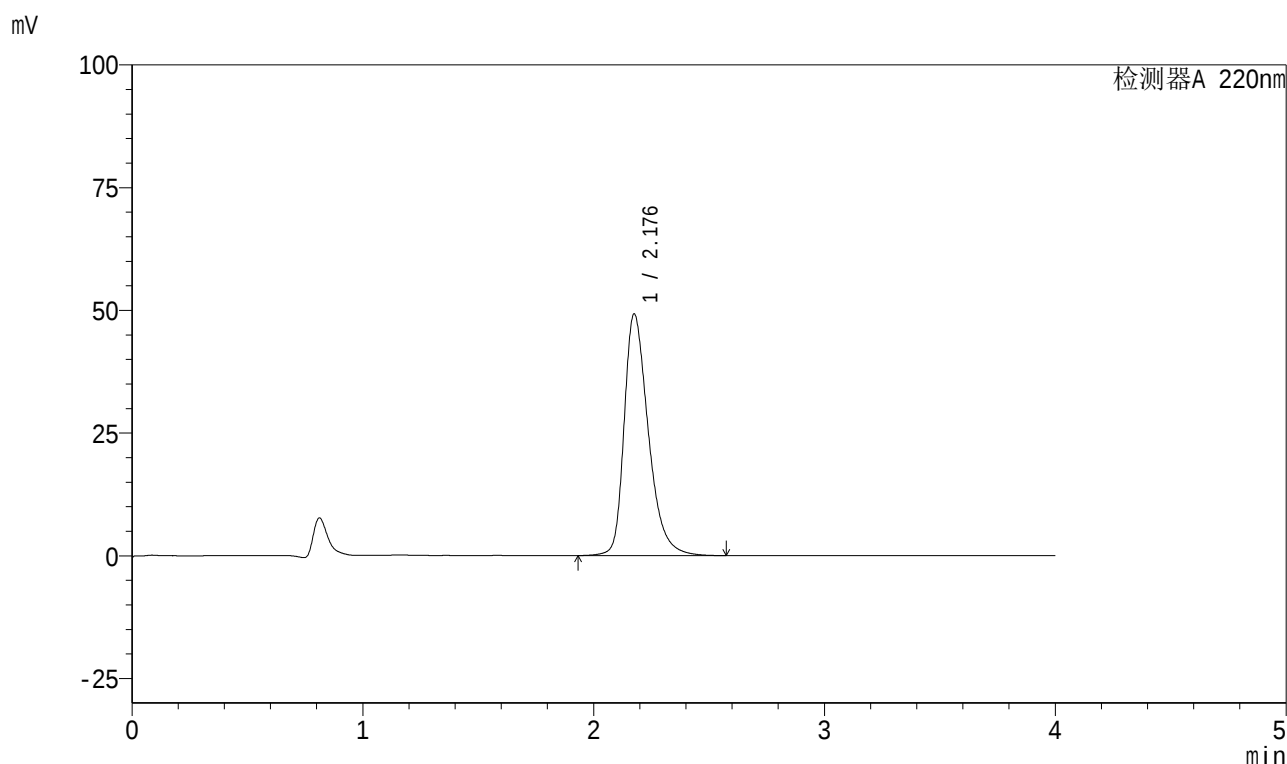

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	359288	100.000	49075	2178	1.366	--
总计		359288	100.000	49075			

图16 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-132-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:50:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

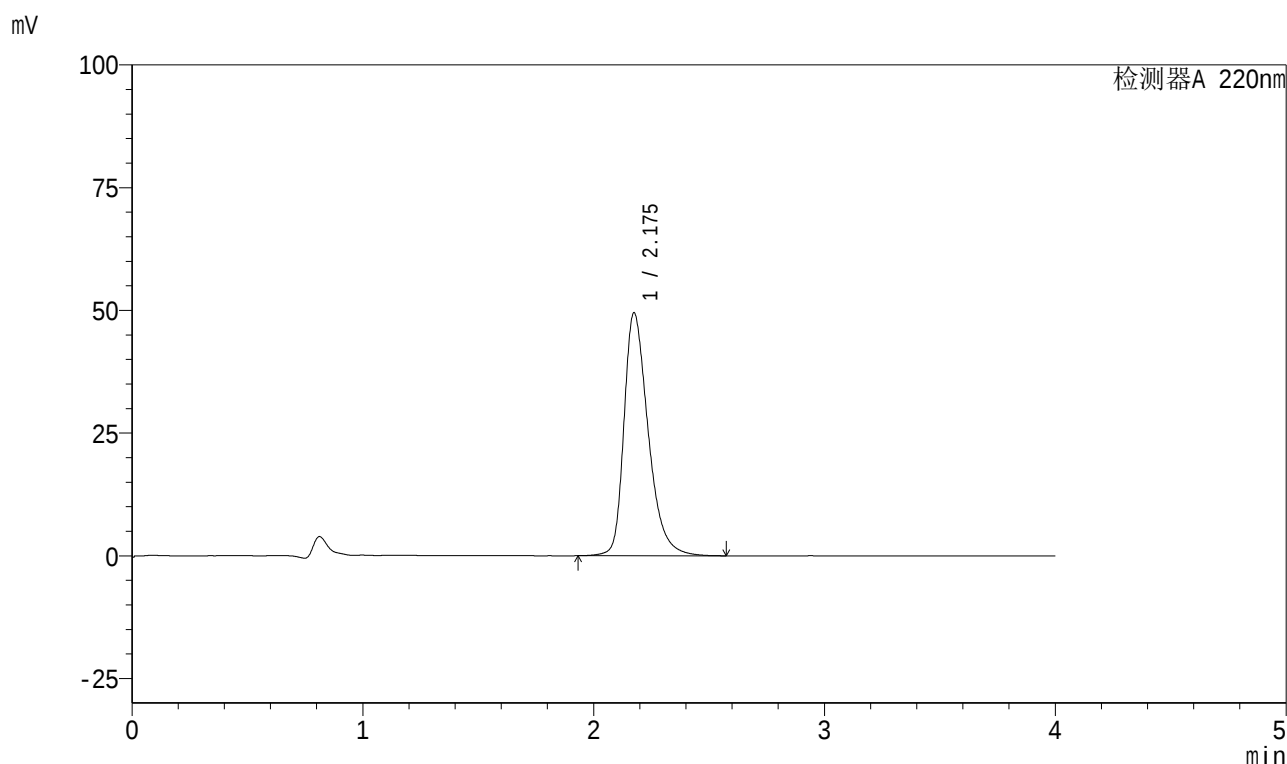

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	361257	100.000	49369	2175	1.366	--
总计		361257	100.000	49369			

图17 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-133-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:54:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

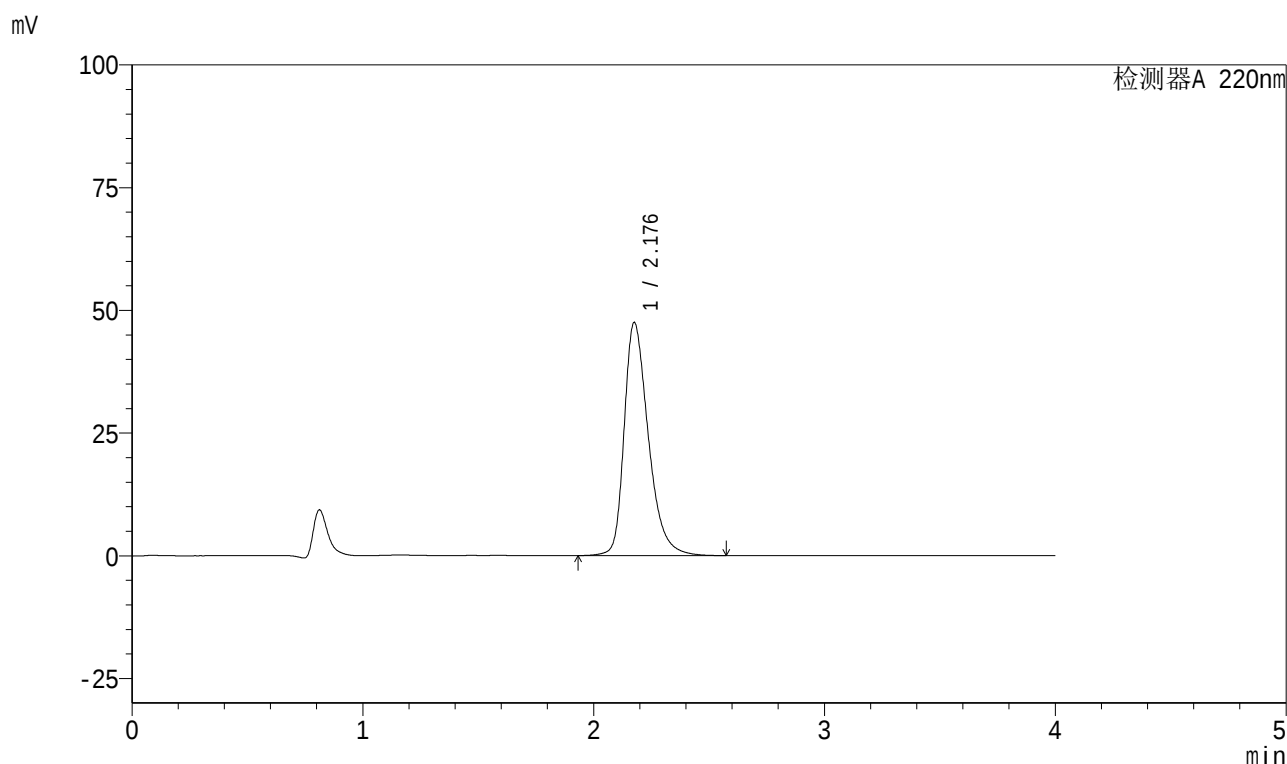

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	345766	100.000	47355	2191	1.359	--
总计		345766	100.000	47355			

图18 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-10min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-134-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 17:58:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

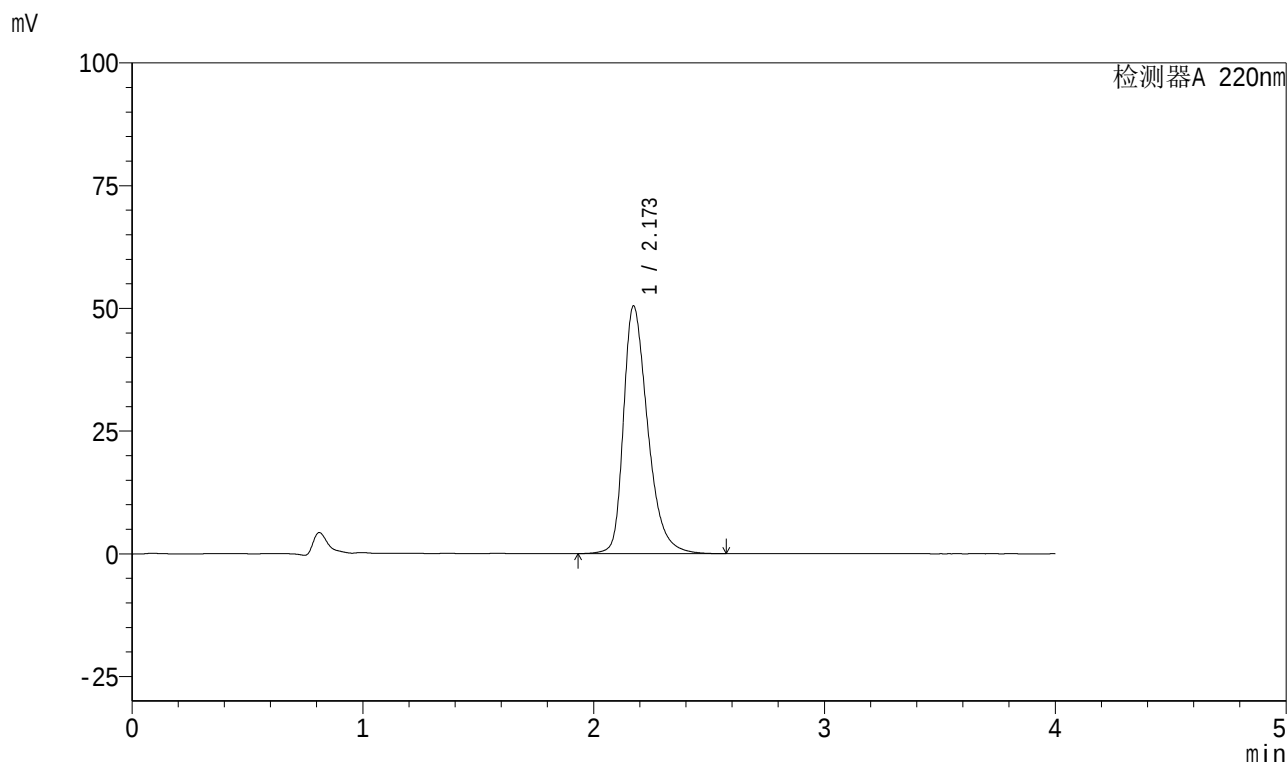

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	368656	100.000	50463	2167	1.369	--
总计		368656	100.000	50463			

图19 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-135-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:03:15 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:23 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

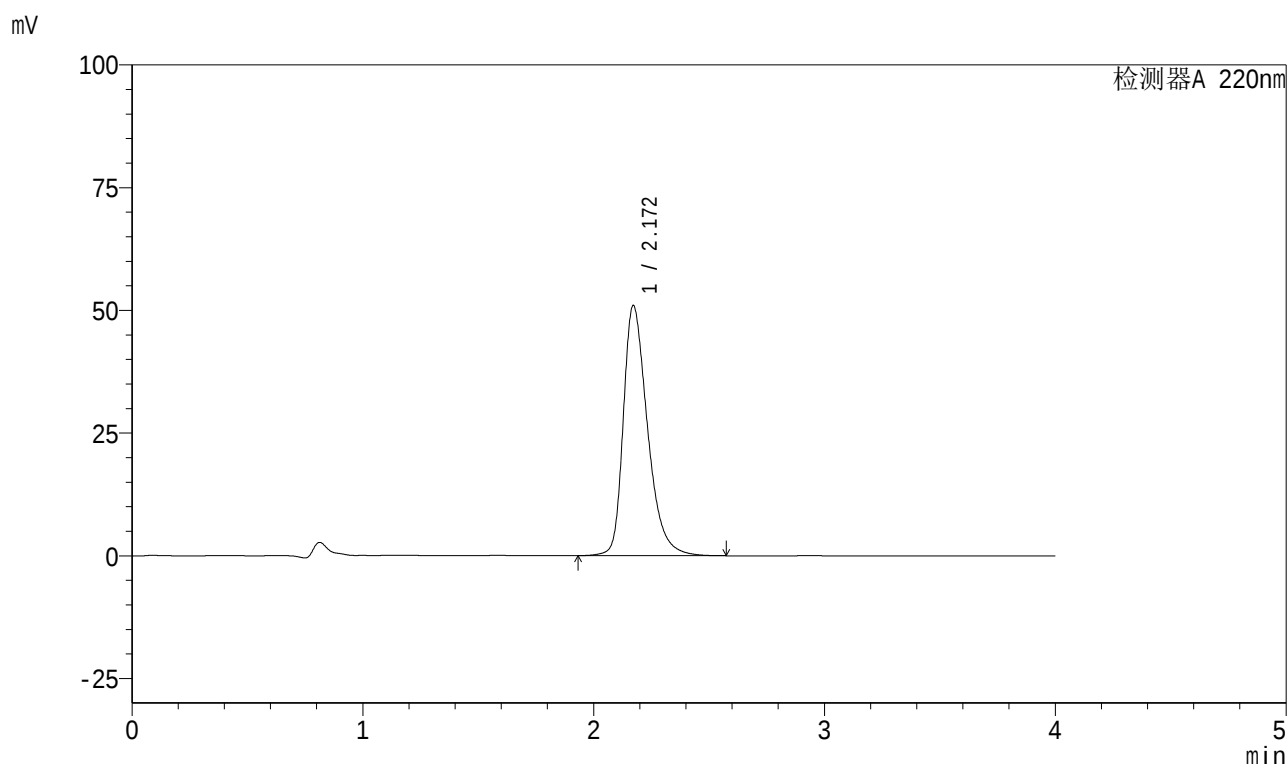

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	372503	100.000	51003	2163	1.371	--
总计		372503	100.000	51003			

图20 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-15min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-136-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:07:37
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

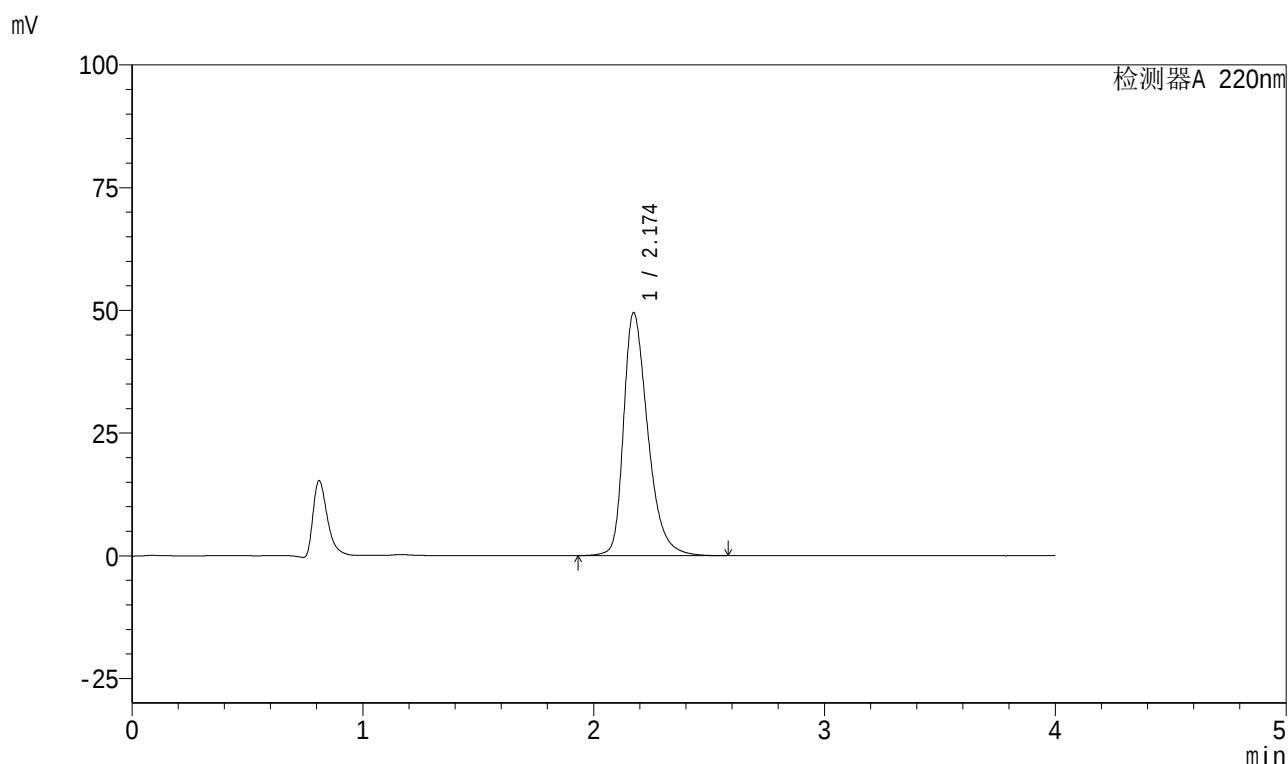

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	361272	100.000	49508	2174	1.365	--
总计		361272	100.000	49508			

图21 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-137-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-30 版本号:6.115
进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 18:11:59 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

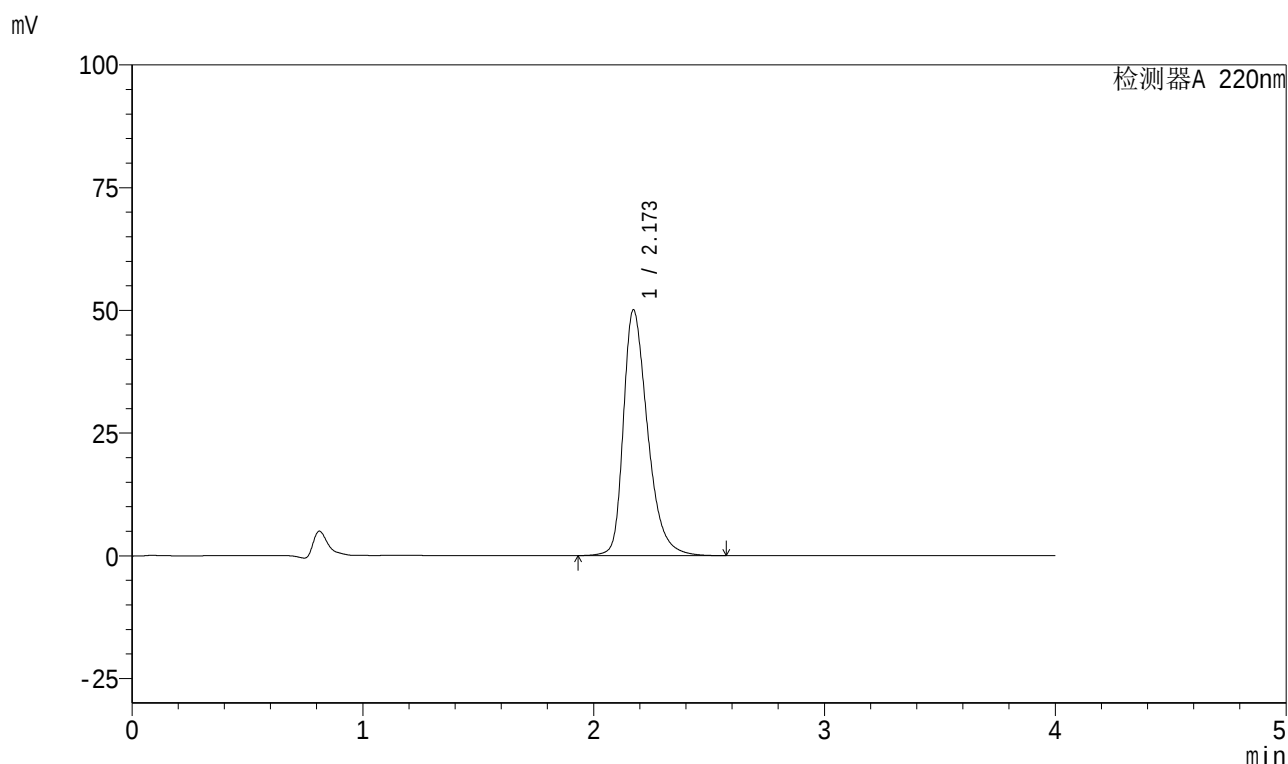

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	365468	100.000	50082	2167	1.366	--
总计		365468	100.000	50082			

图22 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-138-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:16:21 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:31 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

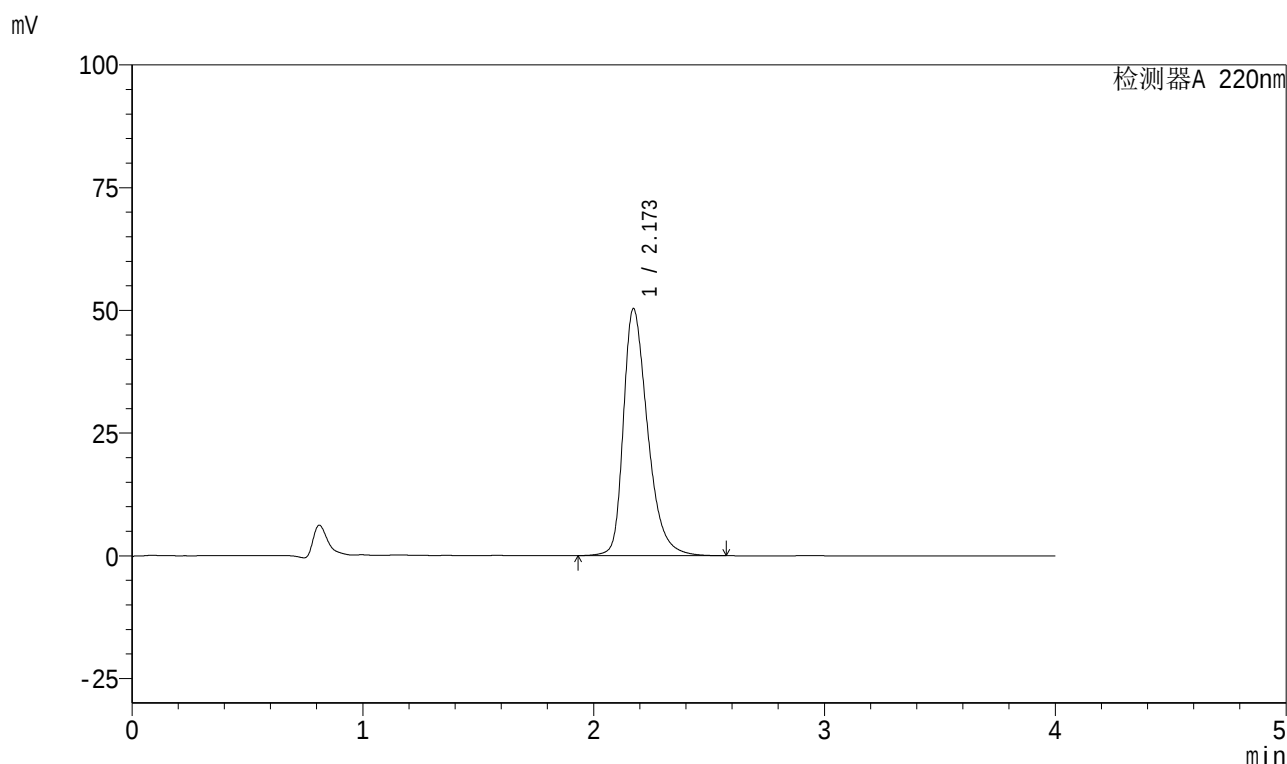

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	367373	100.000	50330	2166	1.367	--
总计		367373	100.000	50330			

图23 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-139-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:20:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

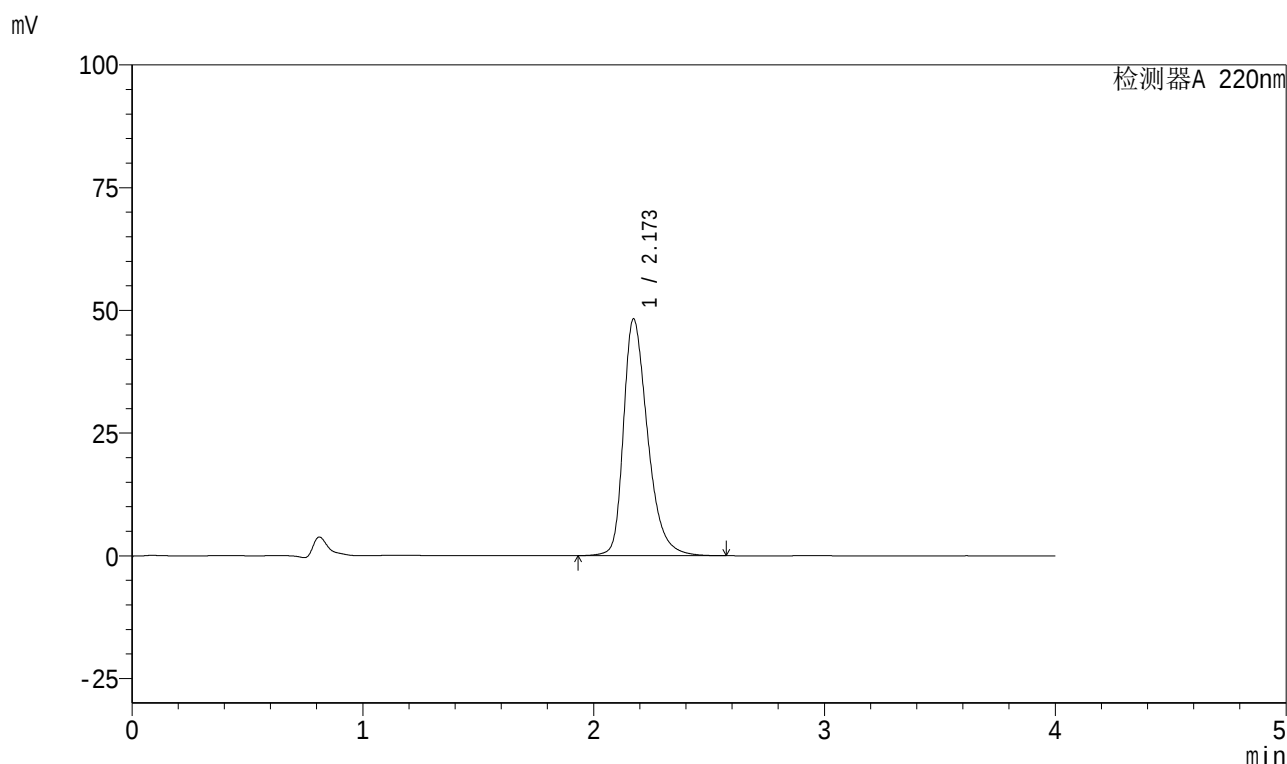

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	350954	100.000	48247	2187	1.359	--
总计		350954	100.000	48247			

图24 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-140-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:25:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

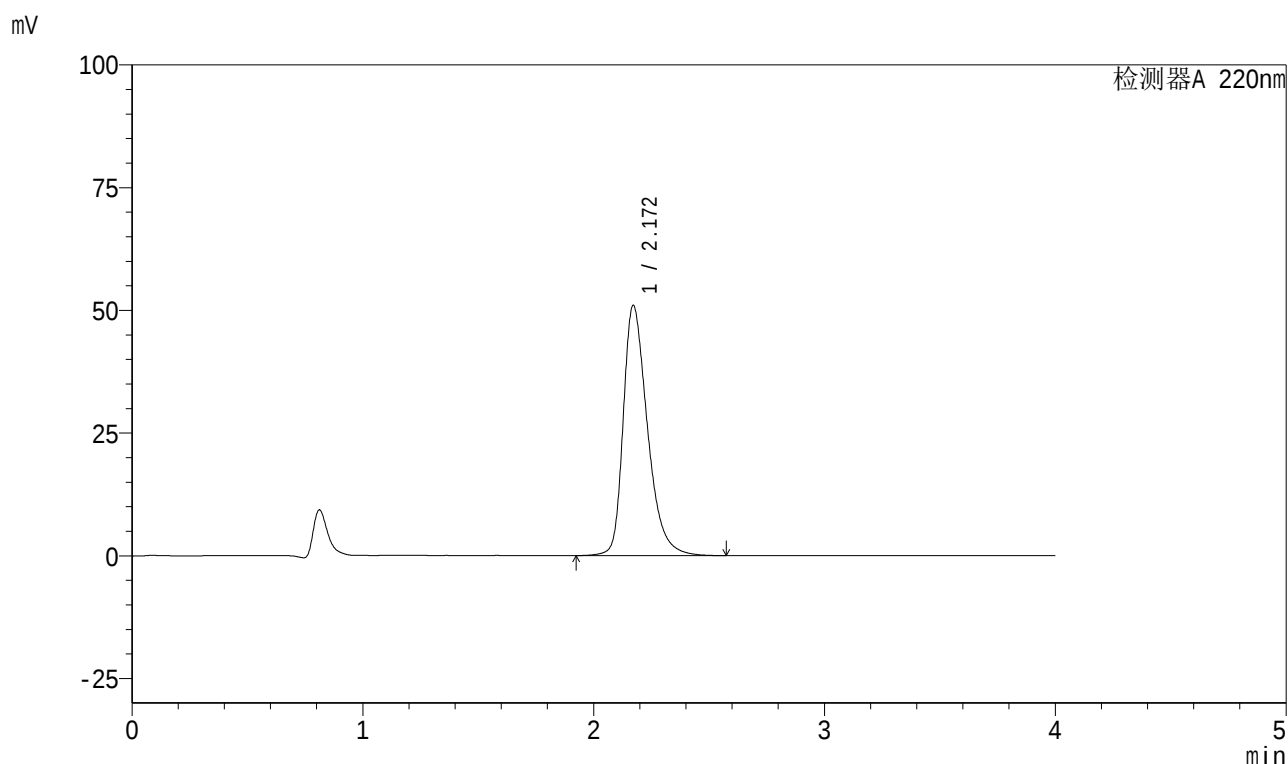

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	372497	100.000	51013	2164	1.370	--
总计		372497	100.000	51013			

图25 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-20min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-141-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:29:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

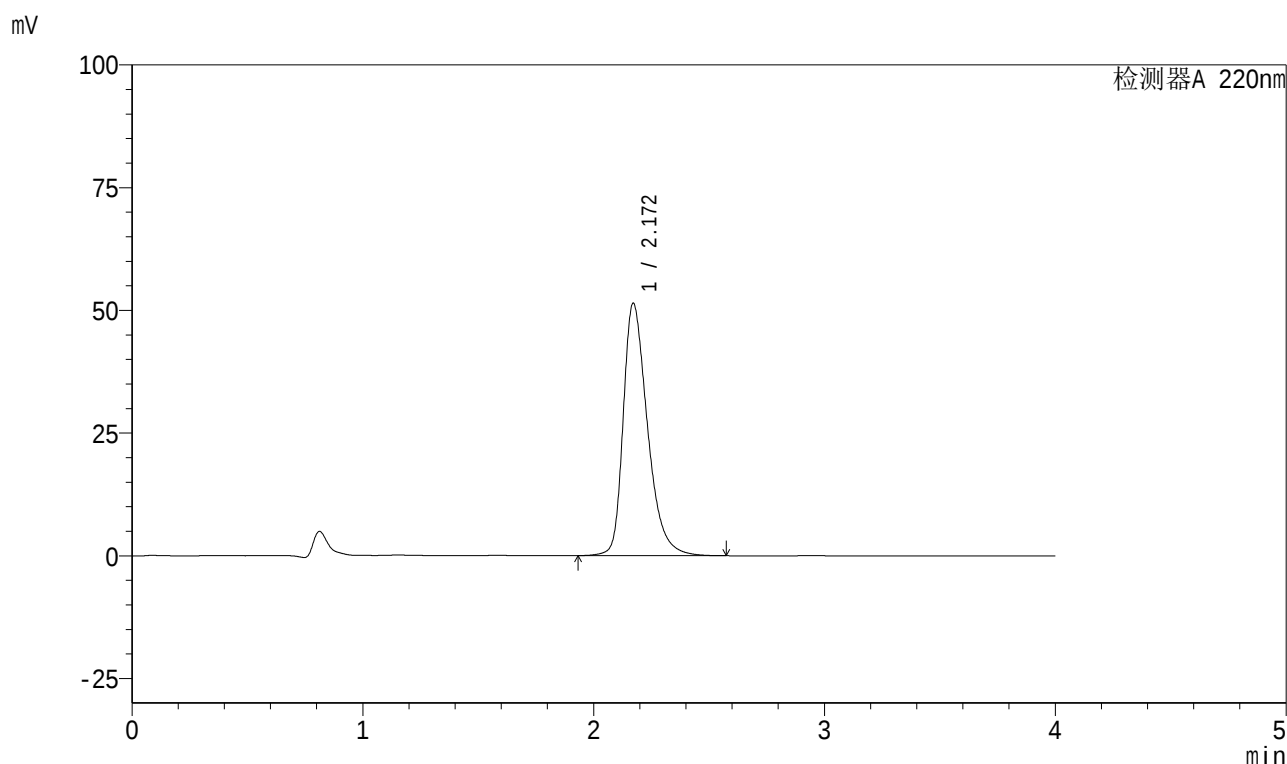

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	376457	100.000	51463	2154	1.373	--
总计		376457	100.000	51463			

图26 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-142-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-22 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 18:33:49 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

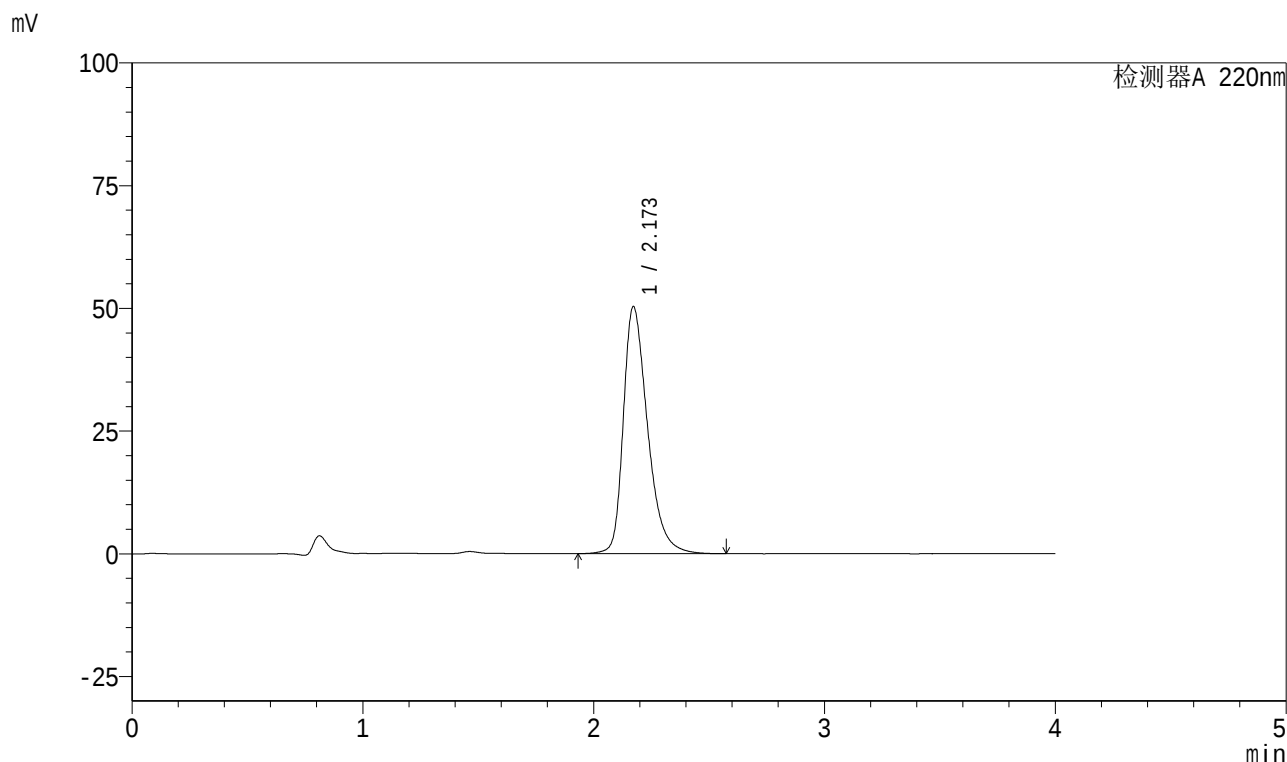

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	367705	100.000	50356	2164	1.369	--
总计		367705	100.000	50356			

图27 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-20min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-143-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:38:11
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

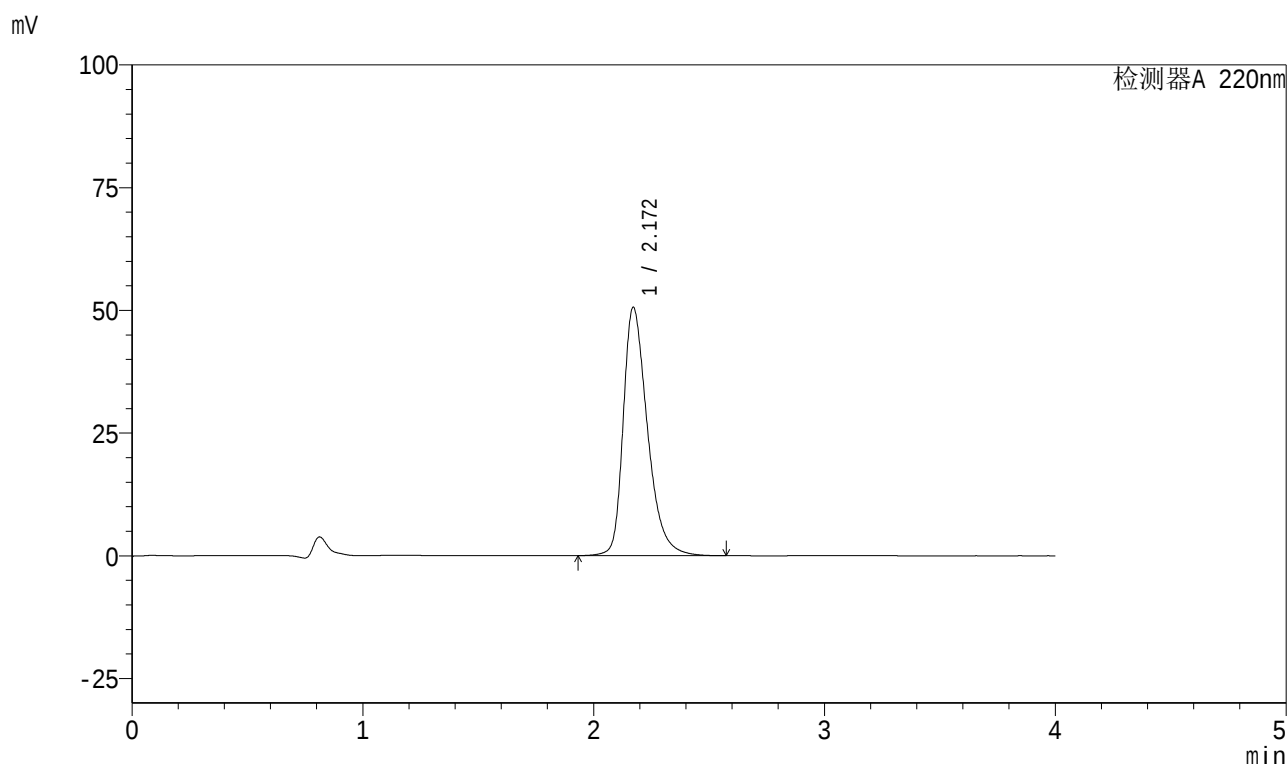

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	369348	100.000	50630	2166	1.368	--
总计		369348	100.000	50630			

图28 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-20min-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-144-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:42:33
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

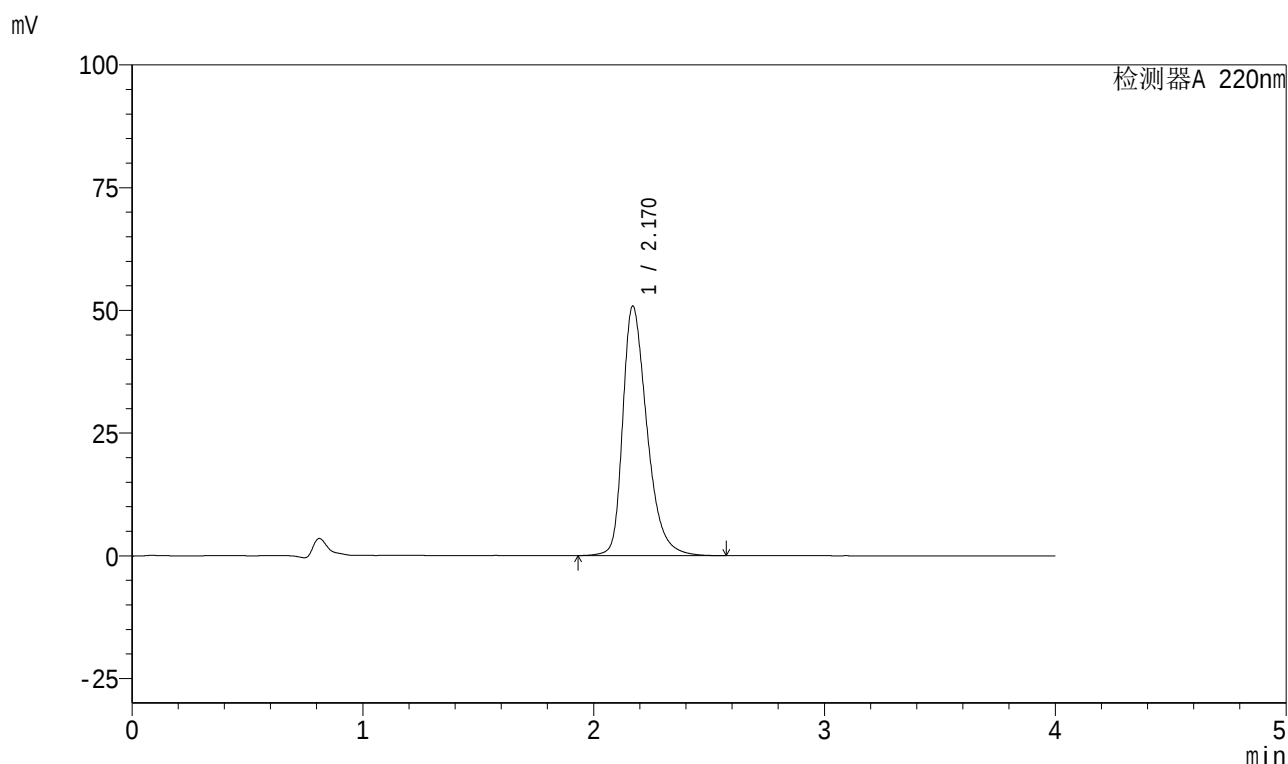

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	371351	100.000	50824	2160	1.370	--
总计		371351	100.000	50824			

图29 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-145-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:46:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

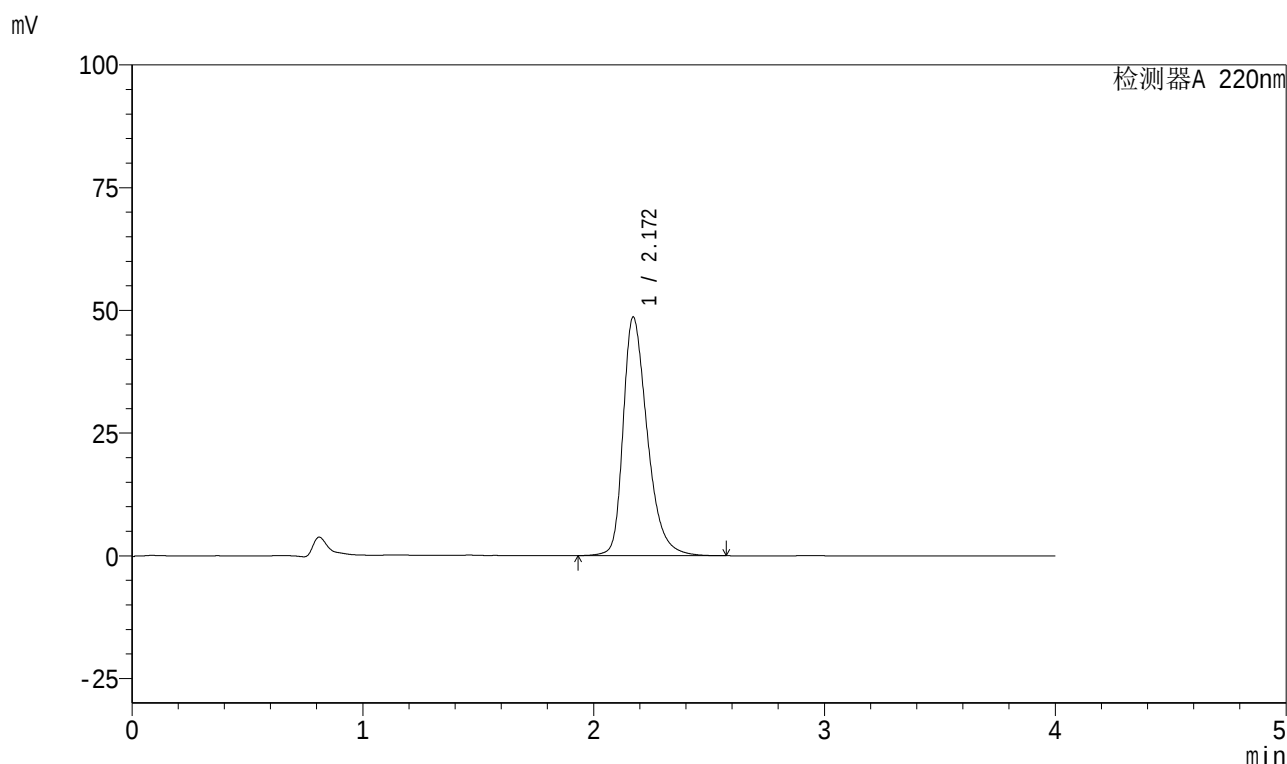

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	353913	100.000	48642	2179	1.360	--
总计		353913	100.000	48642			

图30 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-146-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 18:51:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

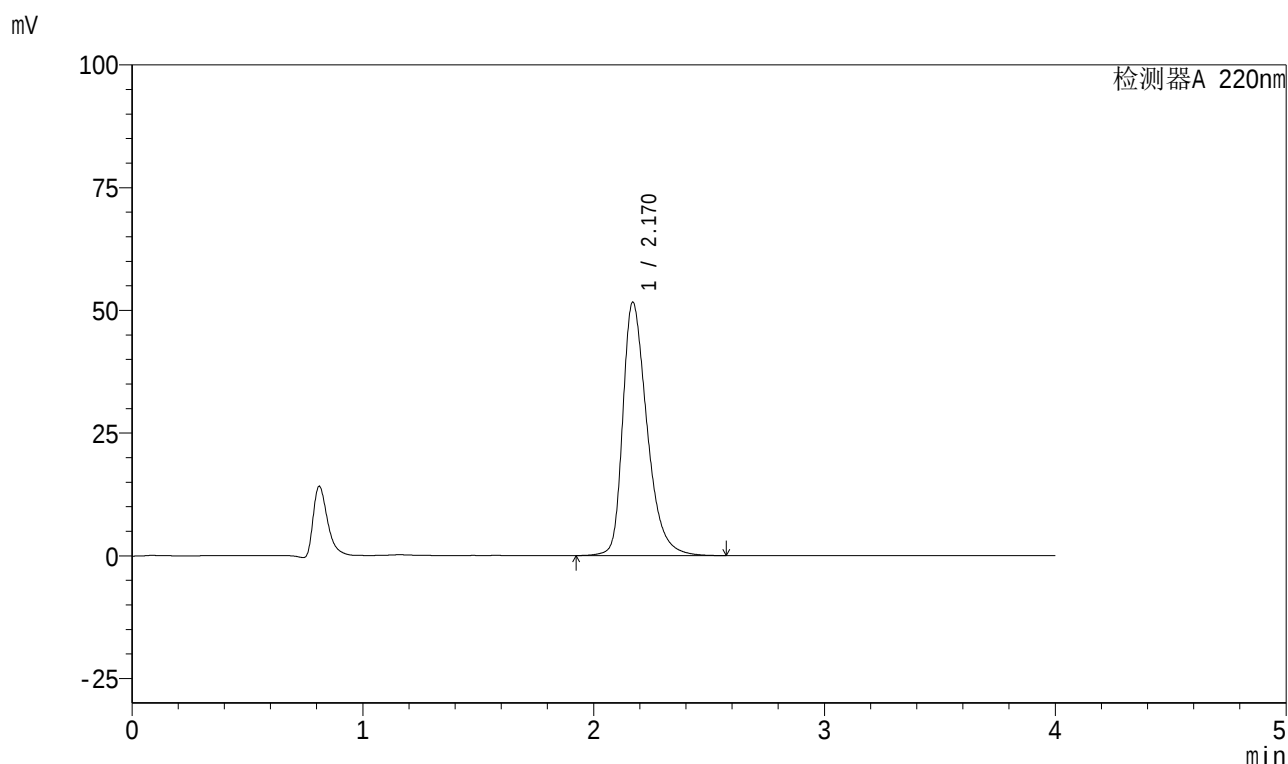

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	377426	100.000	51614	2156	1.372	--
总计		377426	100.000	51614			

图31 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-30min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-147-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 18:55:39
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

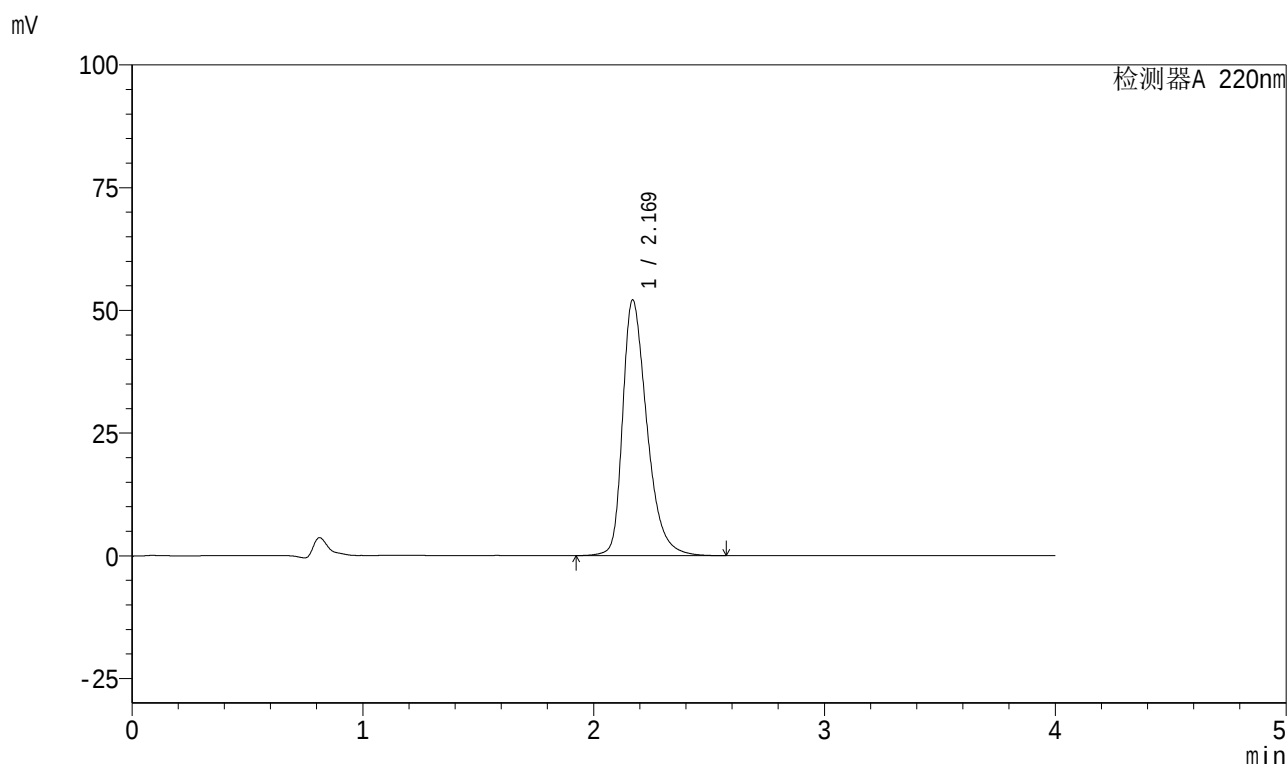

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	381251	100.000	52052	2148	1.376	--
总计		381251	100.000	52052			

图32 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-30min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-148-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:00:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:53:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

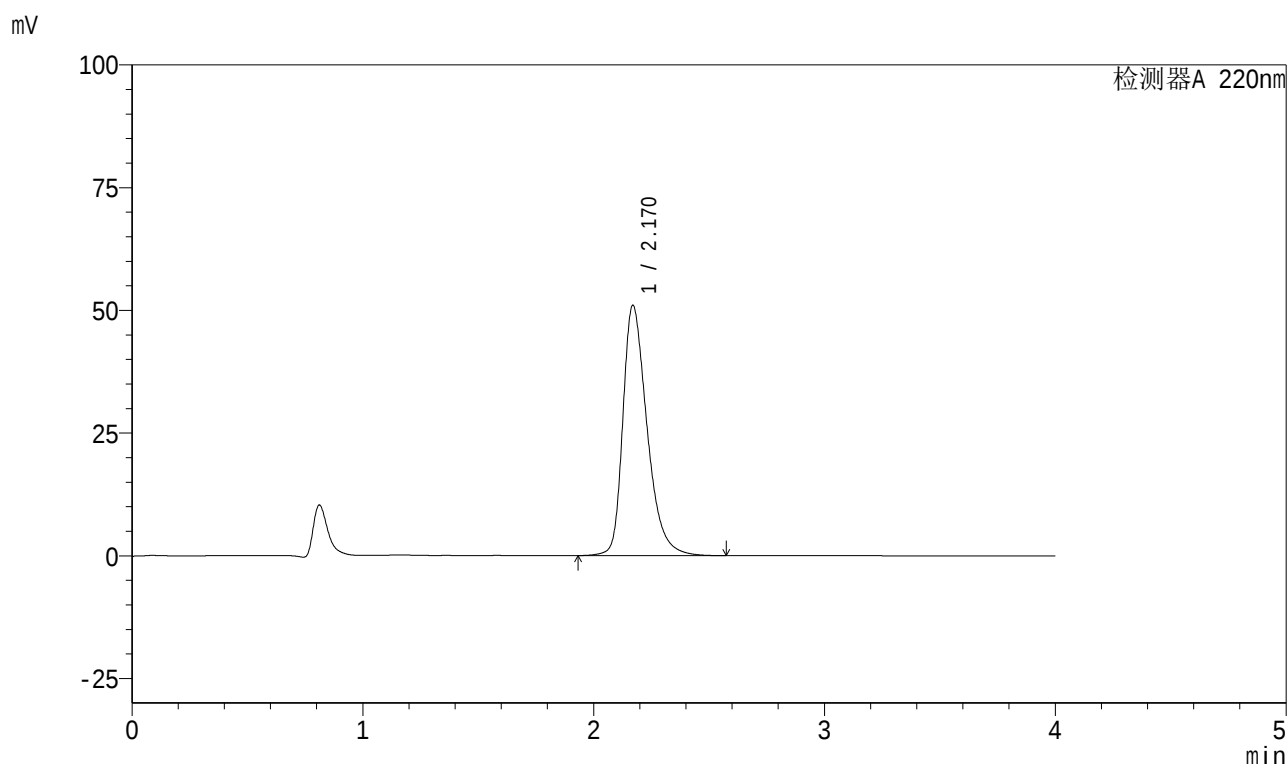

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	371997	100.000	50990	2165	1.370	--
总计		371997	100.000	50990			

图33 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-149-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:04:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

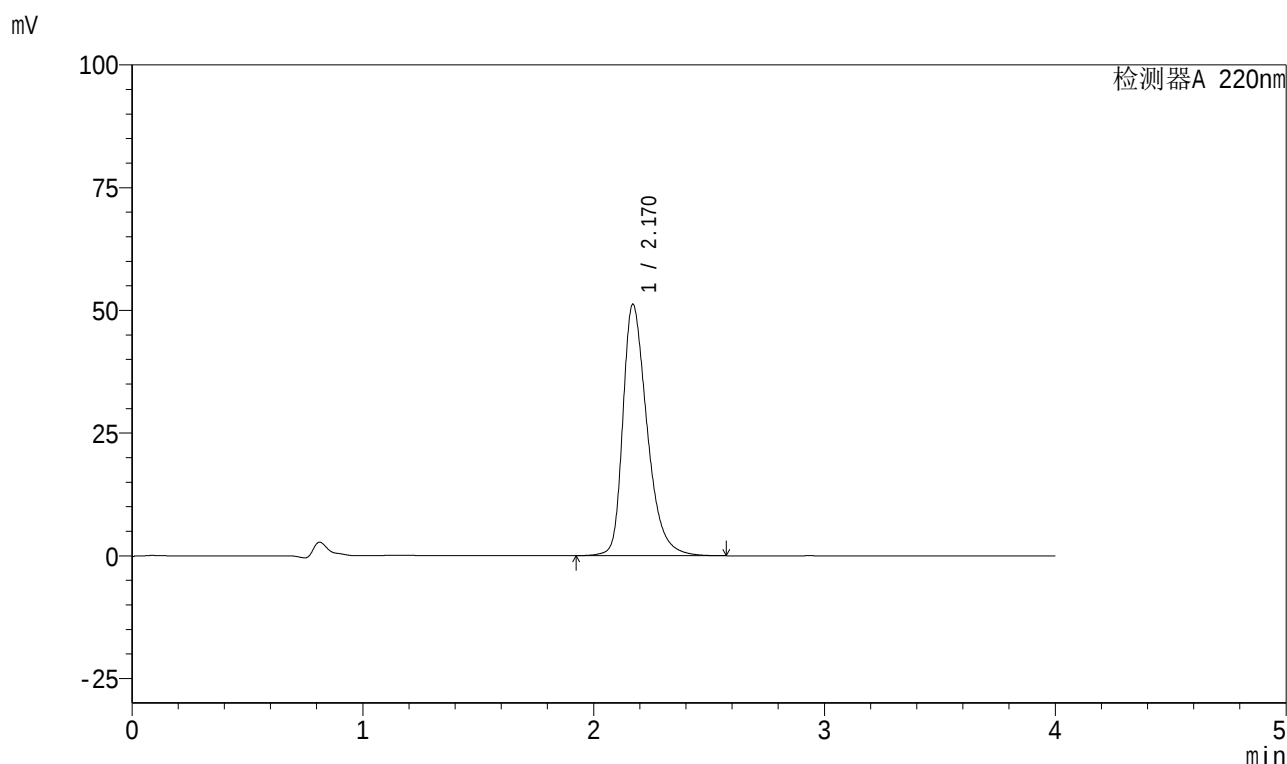

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	374247	100.000	51234	2160	1.371	--
总计		374247	100.000	51234			

图34 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-150-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 19:08:45 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:03 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

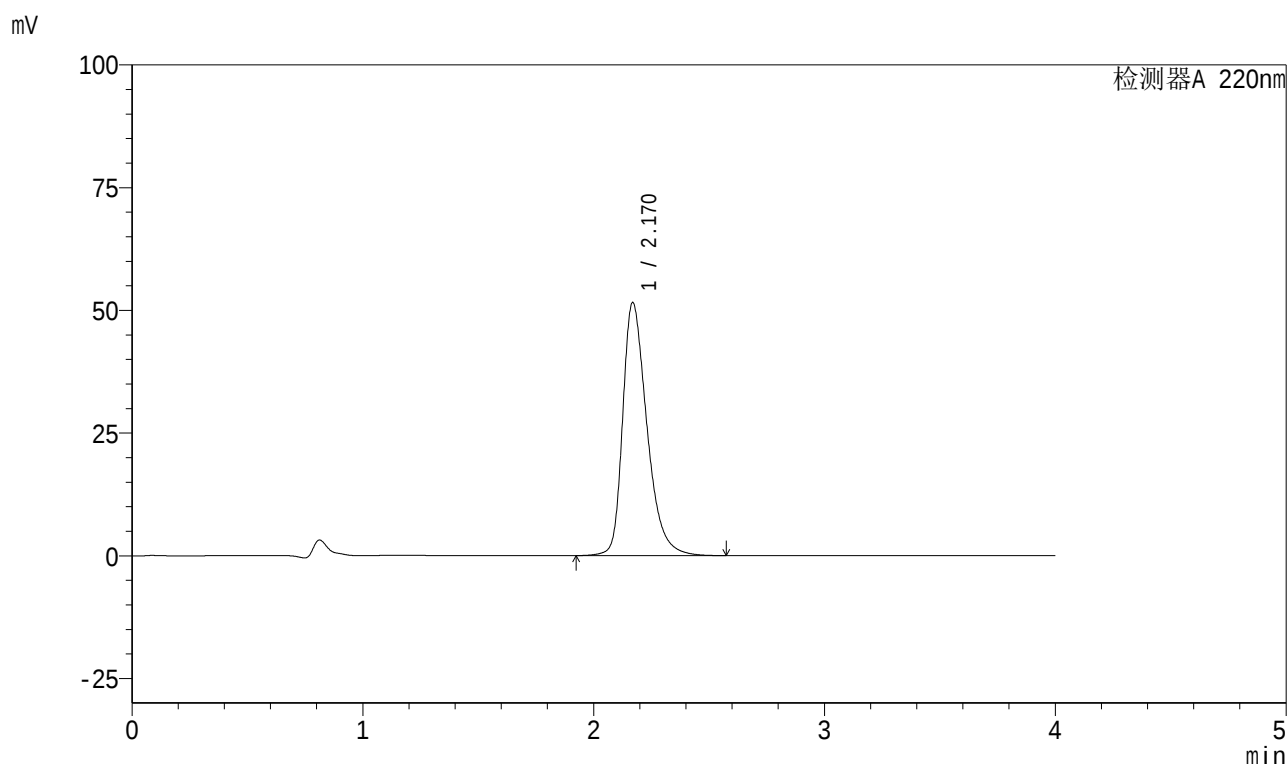

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	376833	100.000	51534	2157	1.373	--
总计		376833	100.000	51534			

图35 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-151-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:13:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

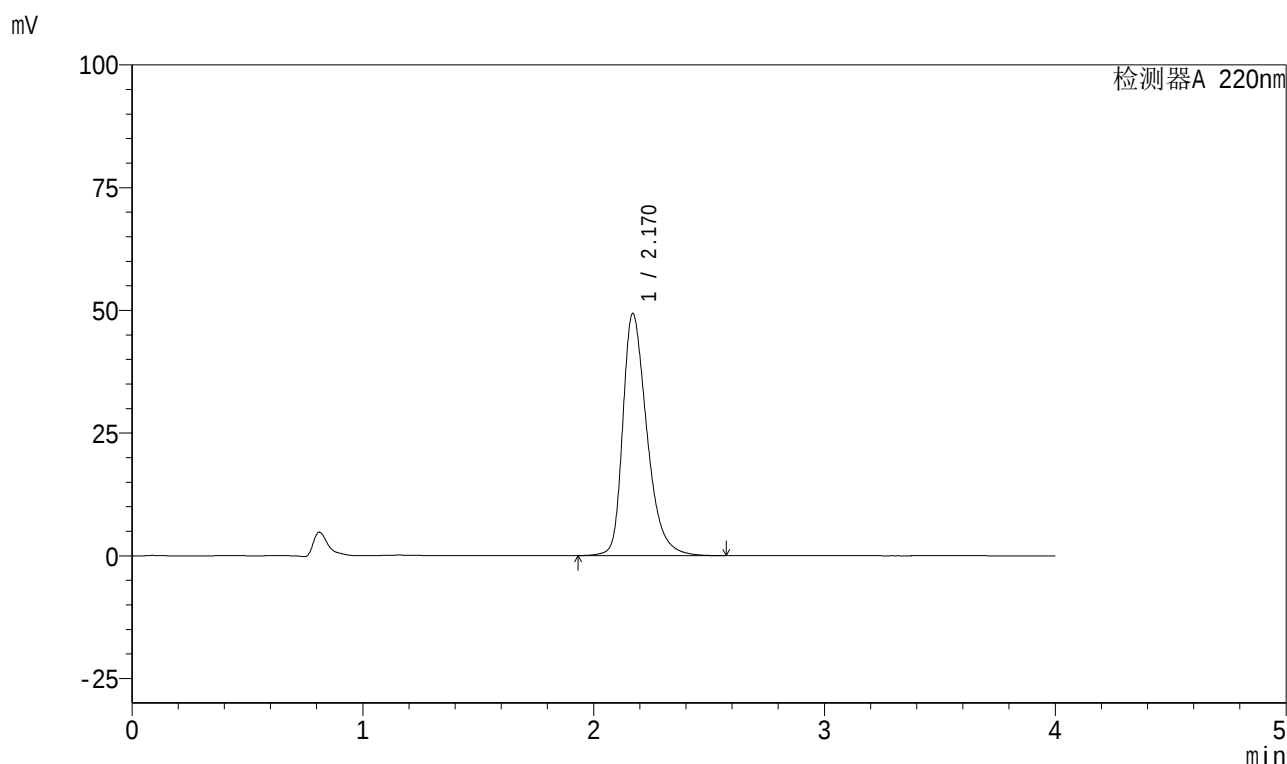

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	359000	100.000	49325	2176	1.363	--
总计		359000	100.000	49325			

图36 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-152-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:17:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

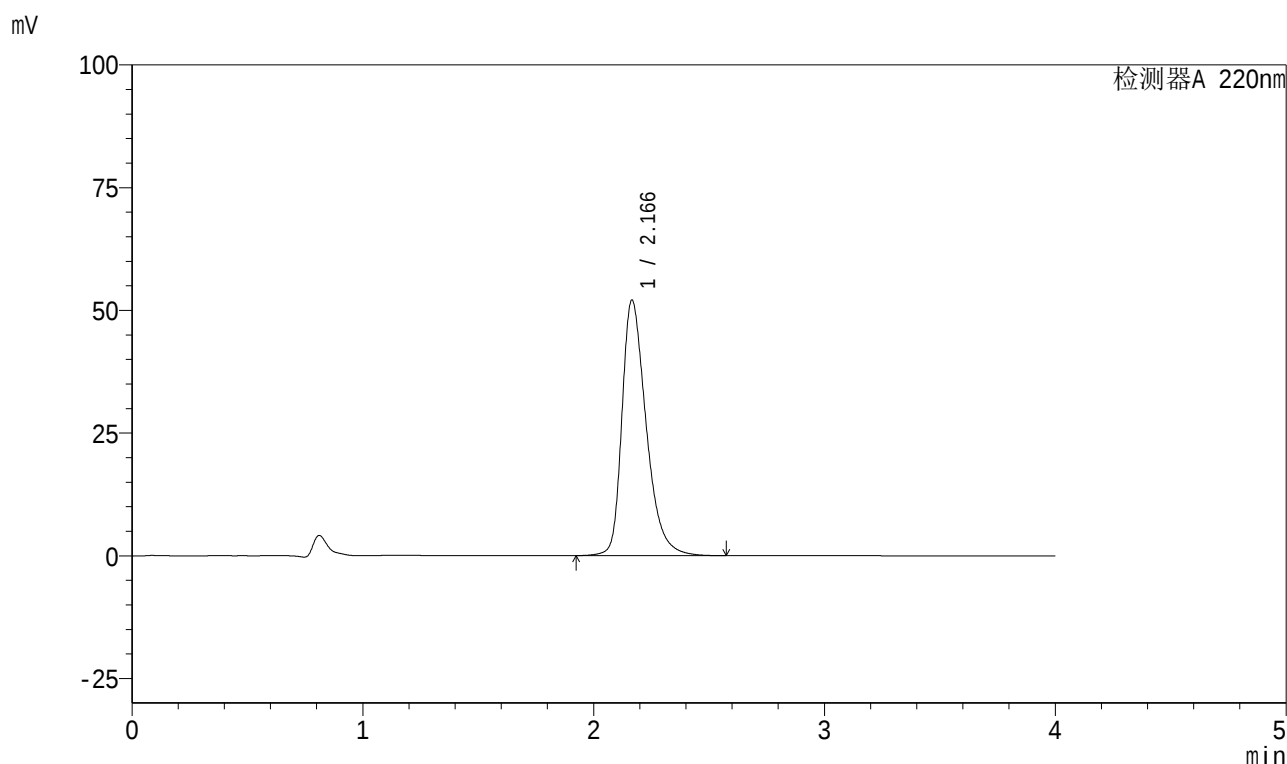

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	380105	100.000	51984	2153	1.376	--
总计		380105	100.000	51984			

图37 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-153-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 19:21:51 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:11 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

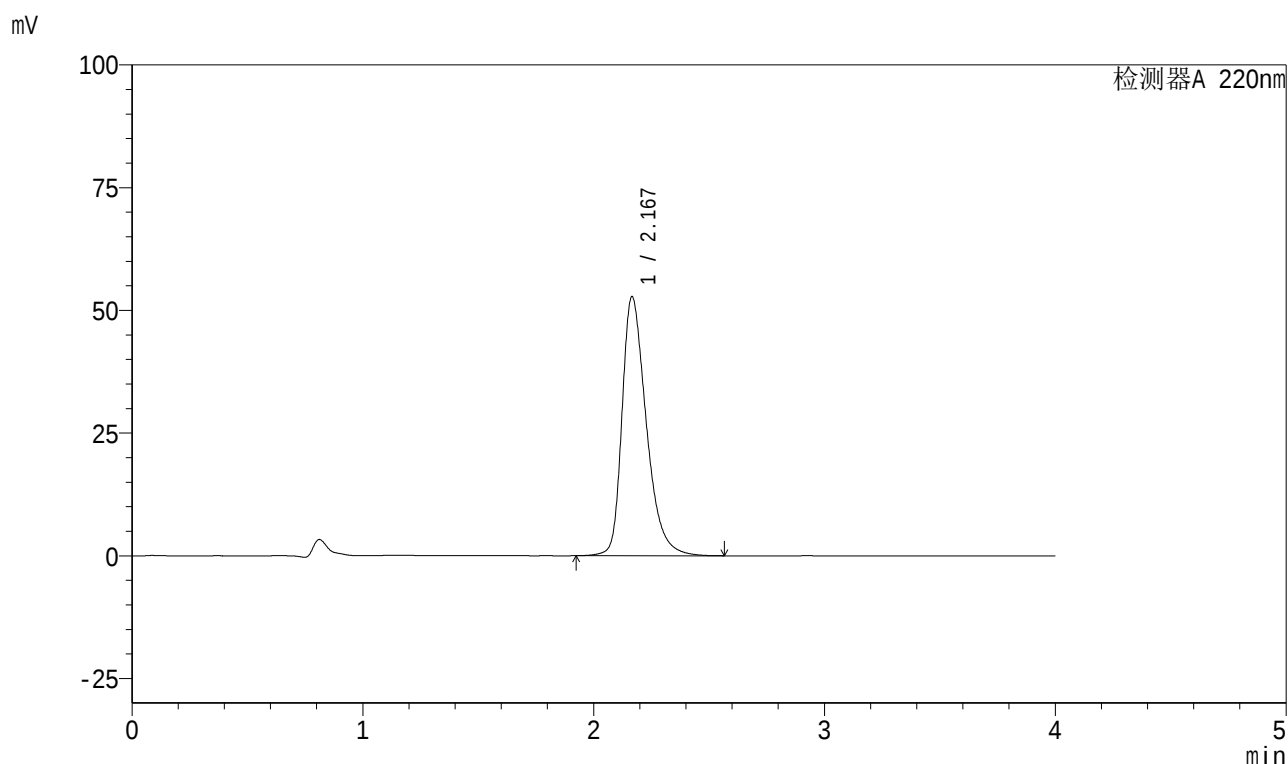

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	386059	100.000	52676	2144	1.378	--
总计		386059	100.000	52676			

图38 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-45min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-154-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:26:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

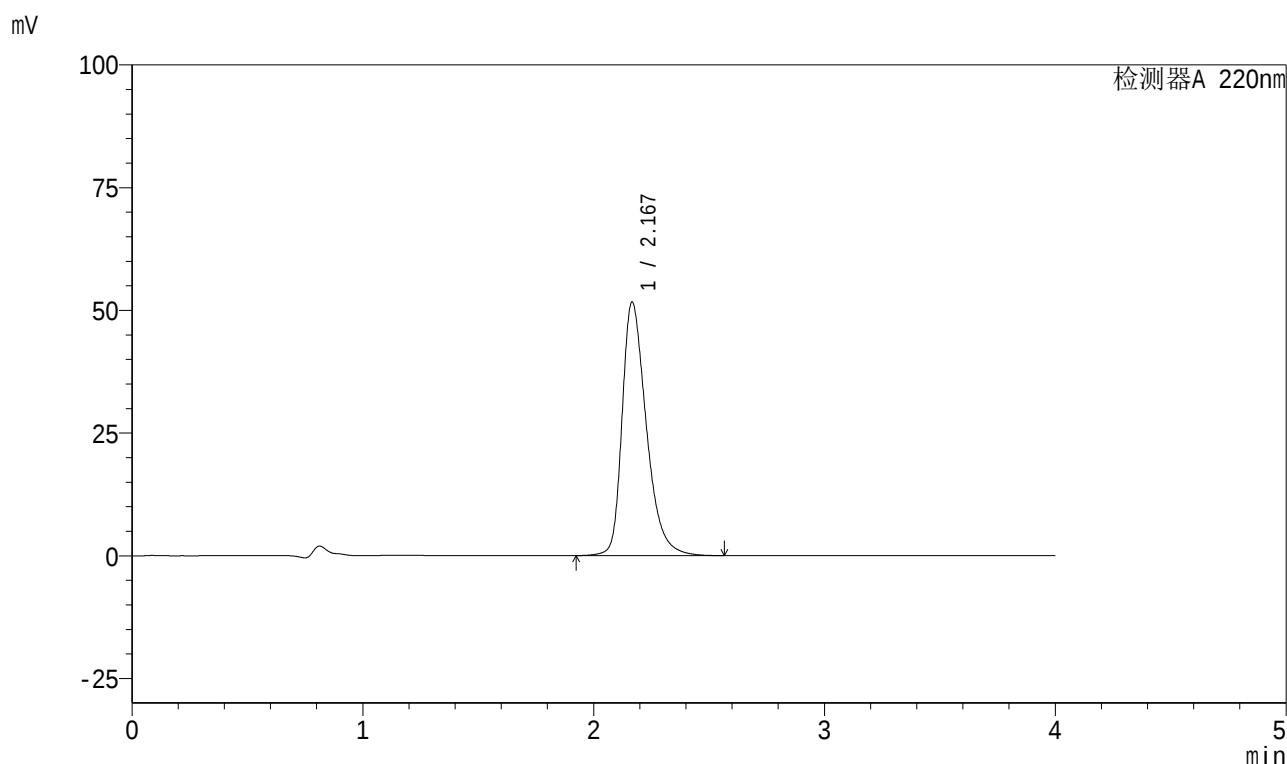

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	377215	100.000	51526	2154	1.375	--
总计		377215	100.000	51526			

图39 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-155-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-45min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb	
样品瓶号: 1-33	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 19:30:35	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:16	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)	

<色谱图>

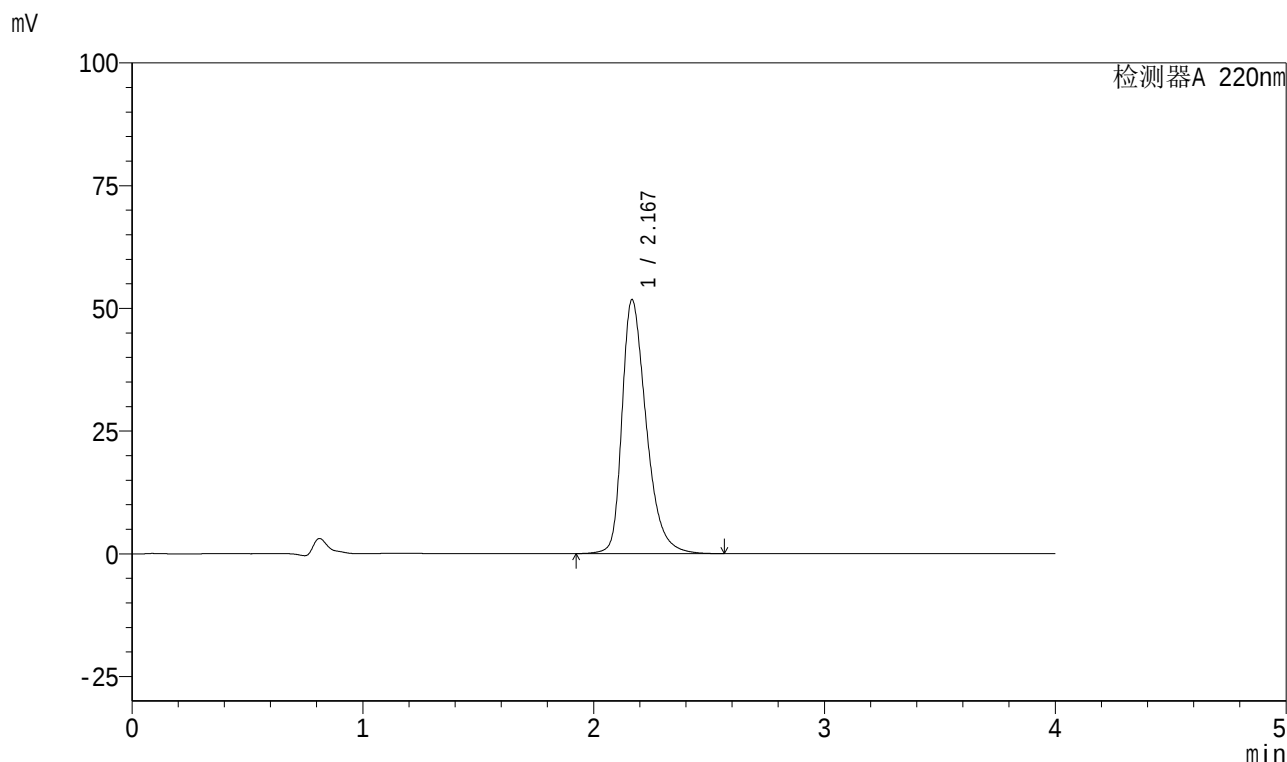

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	377718	100.000	51630	2153	1.374	--
总计		377718	100.000	51630			

图40 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-45min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-156-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:34:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

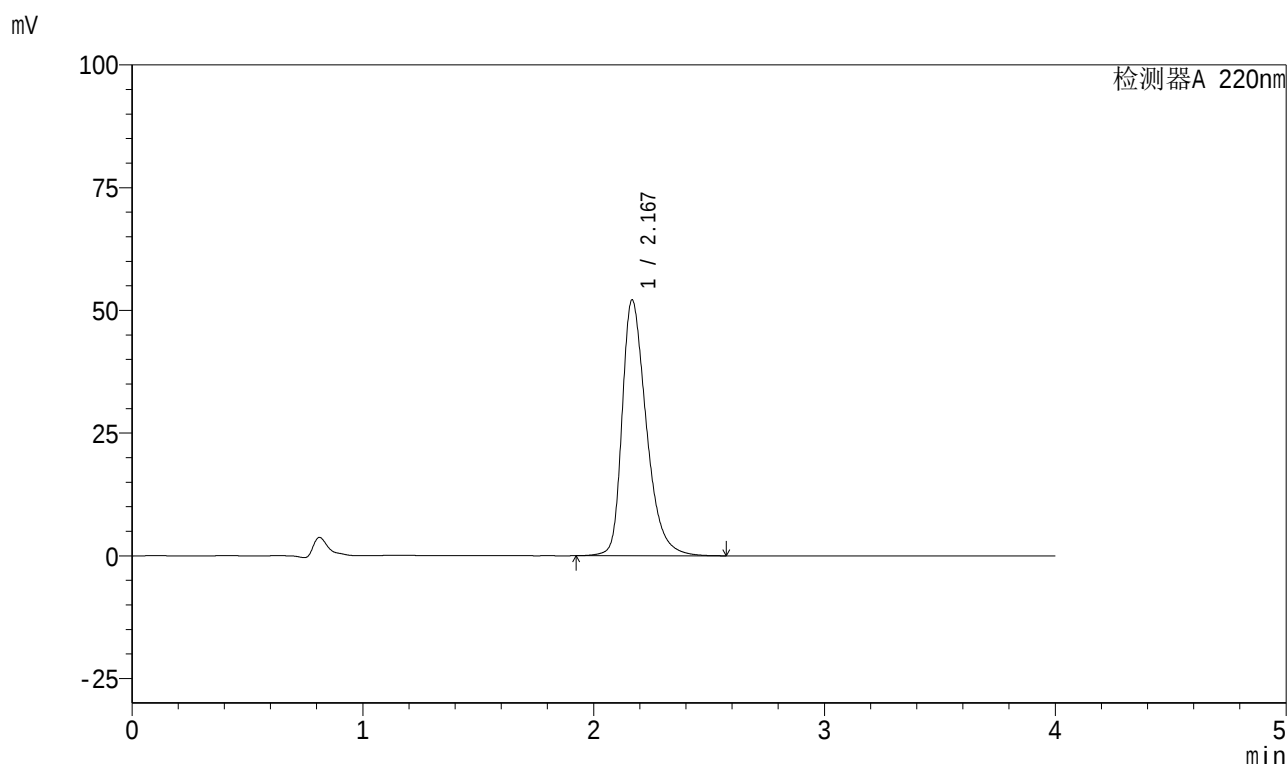

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	380839	100.000	51987	2150	1.377	--
总计		380839	100.000	51987			

图41 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-157-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:39:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

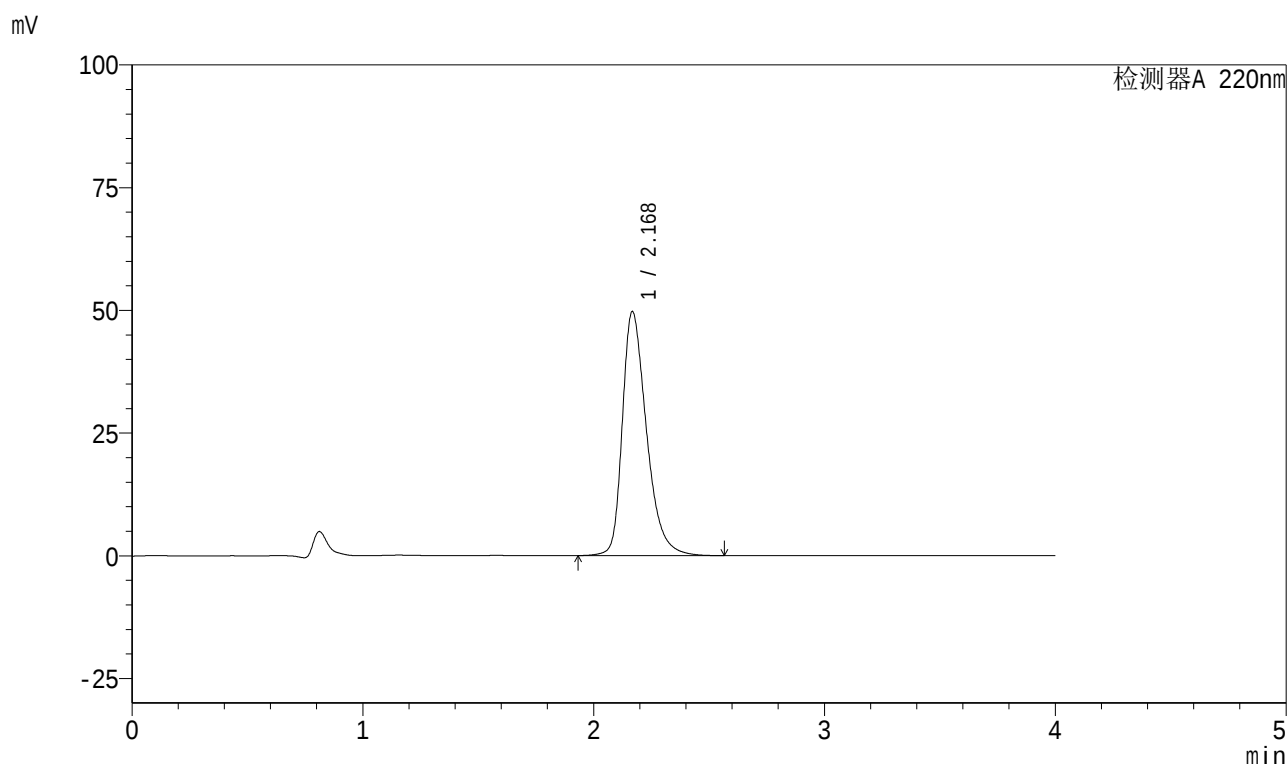

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	361836	100.000	49586	2171	1.366	--
总计		361836	100.000	49586			

图42 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-45min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-158-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:43:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

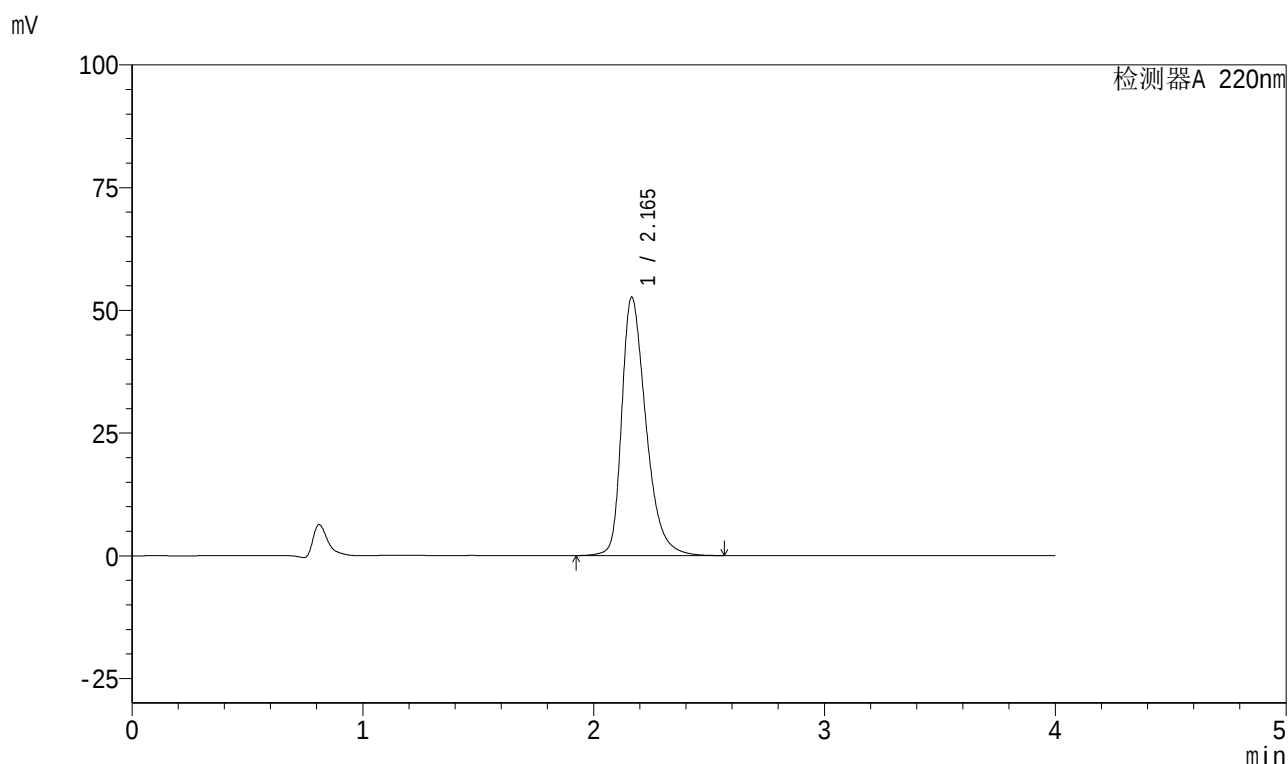

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	384634	100.000	52615	2146	1.377	--
总计		384634	100.000	52615			

图43 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-159-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 19:48:03
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min

波长:220nm


版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV

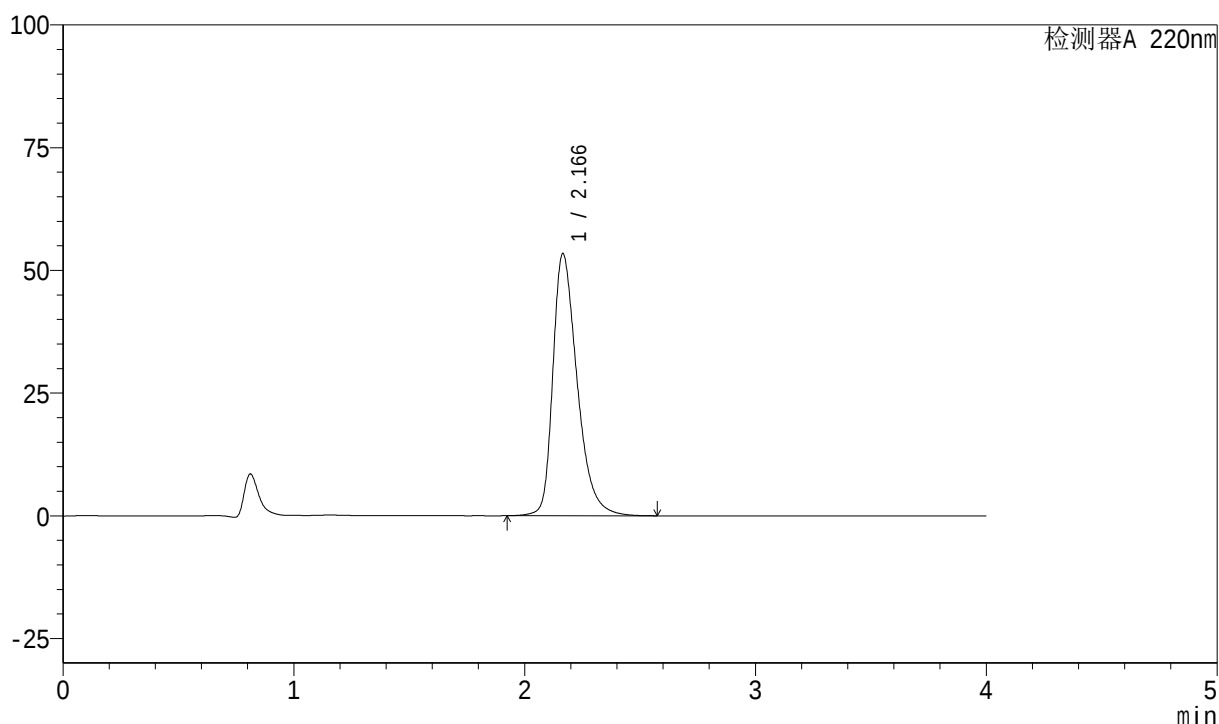

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	390828	100.000	53341	2139	1.381	--
总计		390828	100.000	53341			

图44 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-160-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 19:52:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

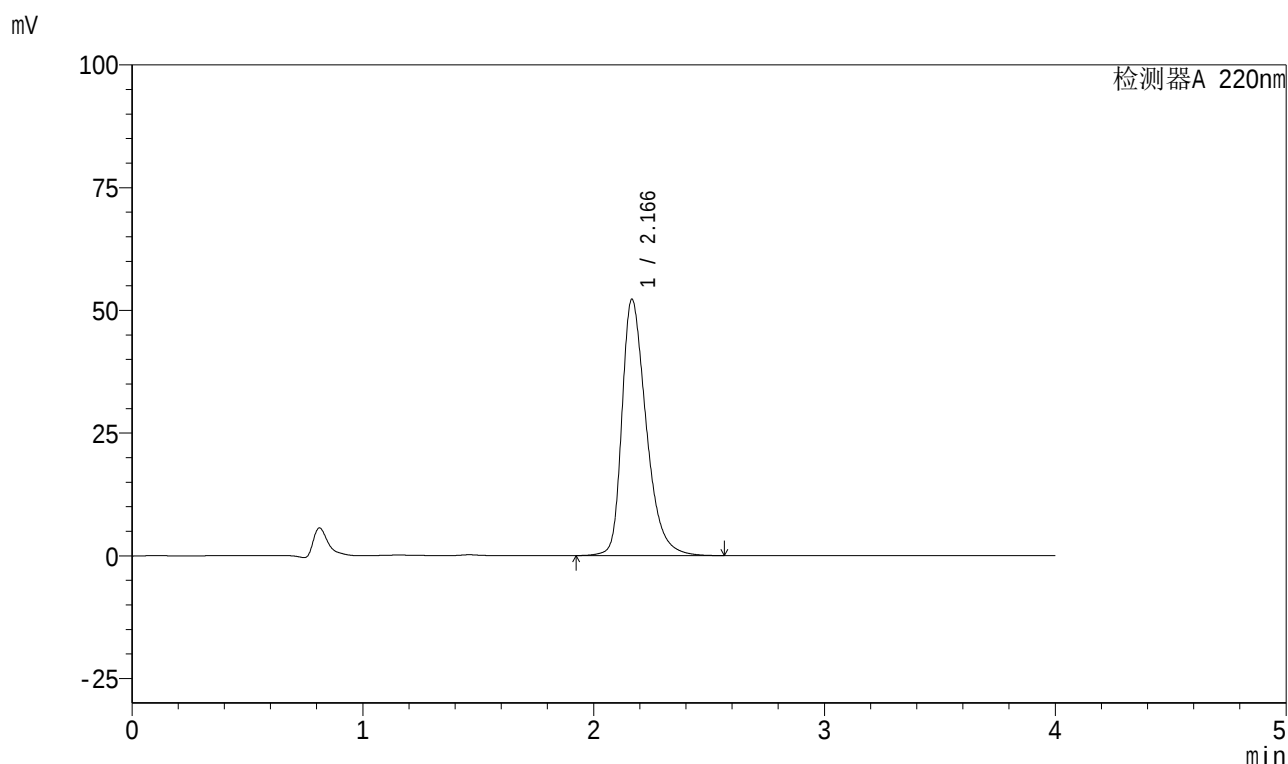

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	381892	100.000	52151	2145	1.377	--
总计		381892	100.000	52151			

图45 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-161-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 19:56:46 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:31 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

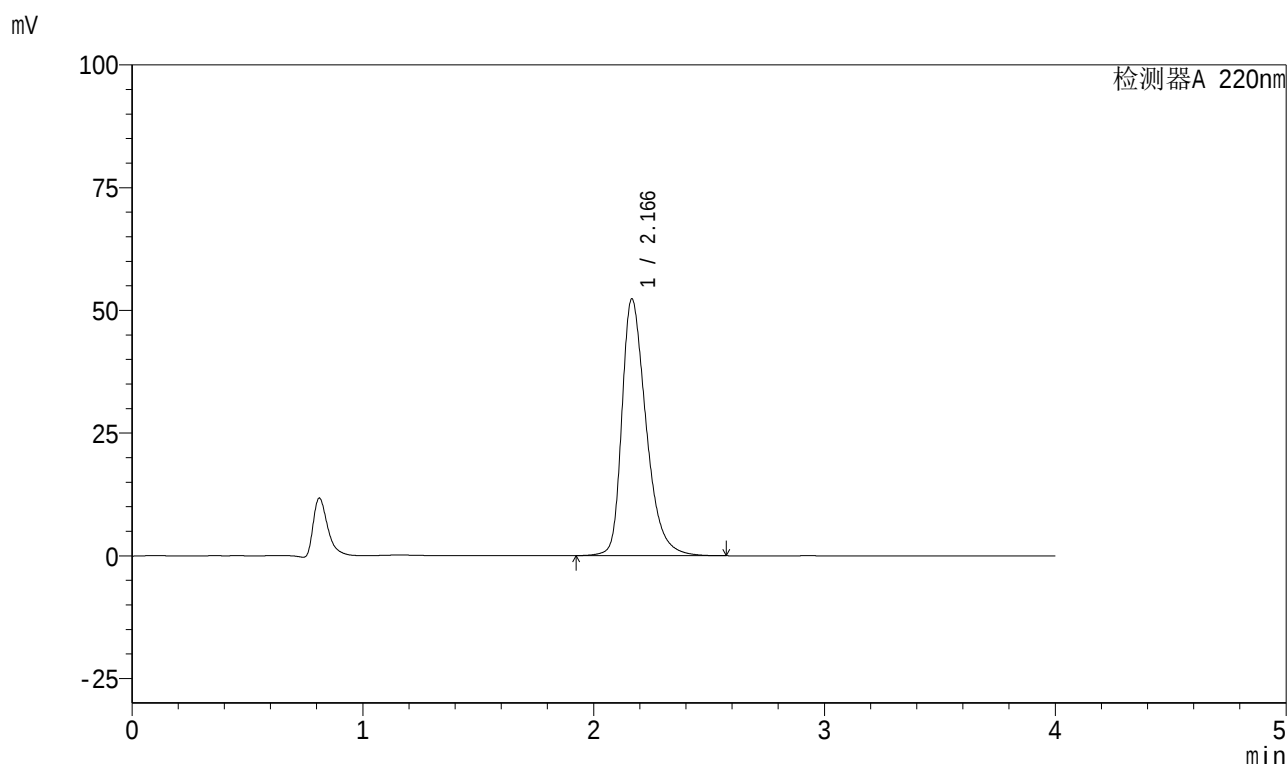

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	382062	100.000	52236	2147	1.376	--
总计		382062	100.000	52236			

图46 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-162-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:01:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

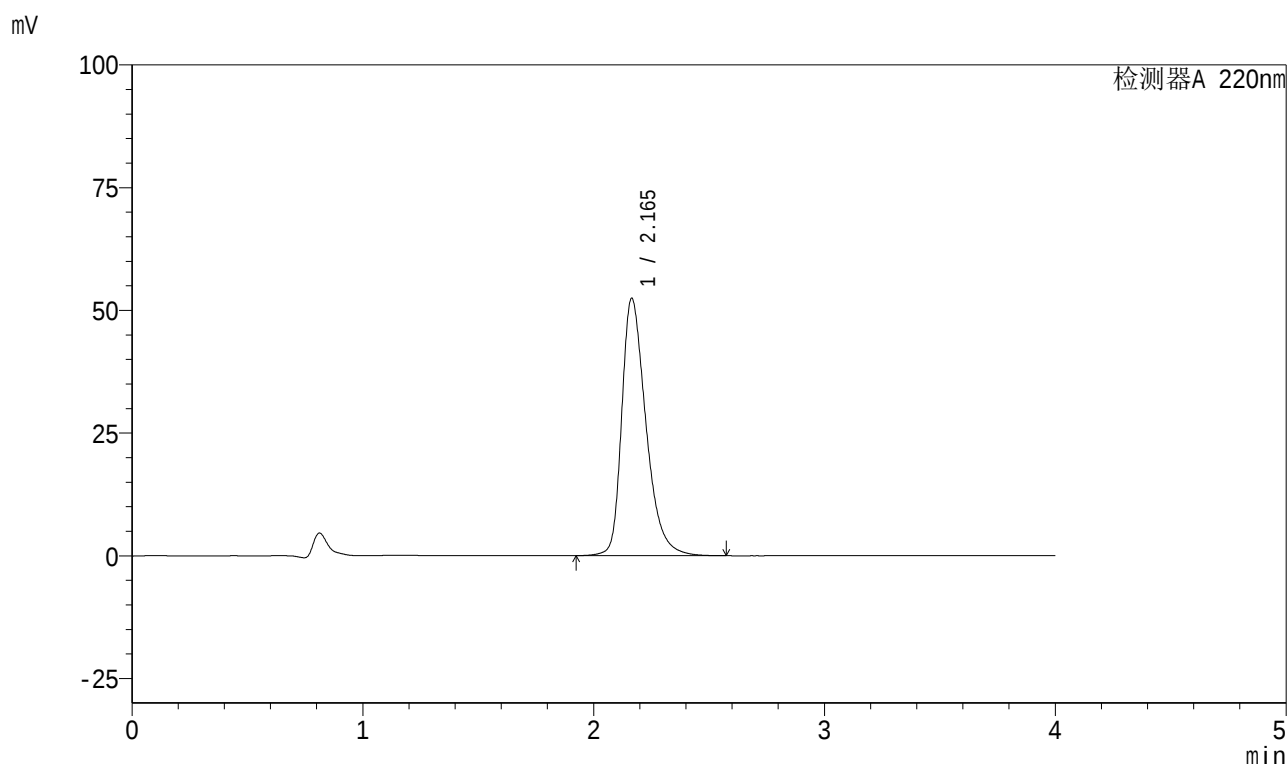

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	382917	100.000	52412	2149	1.376	--
总计		382917	100.000	52412			

图47 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-163-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 20:05:28
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

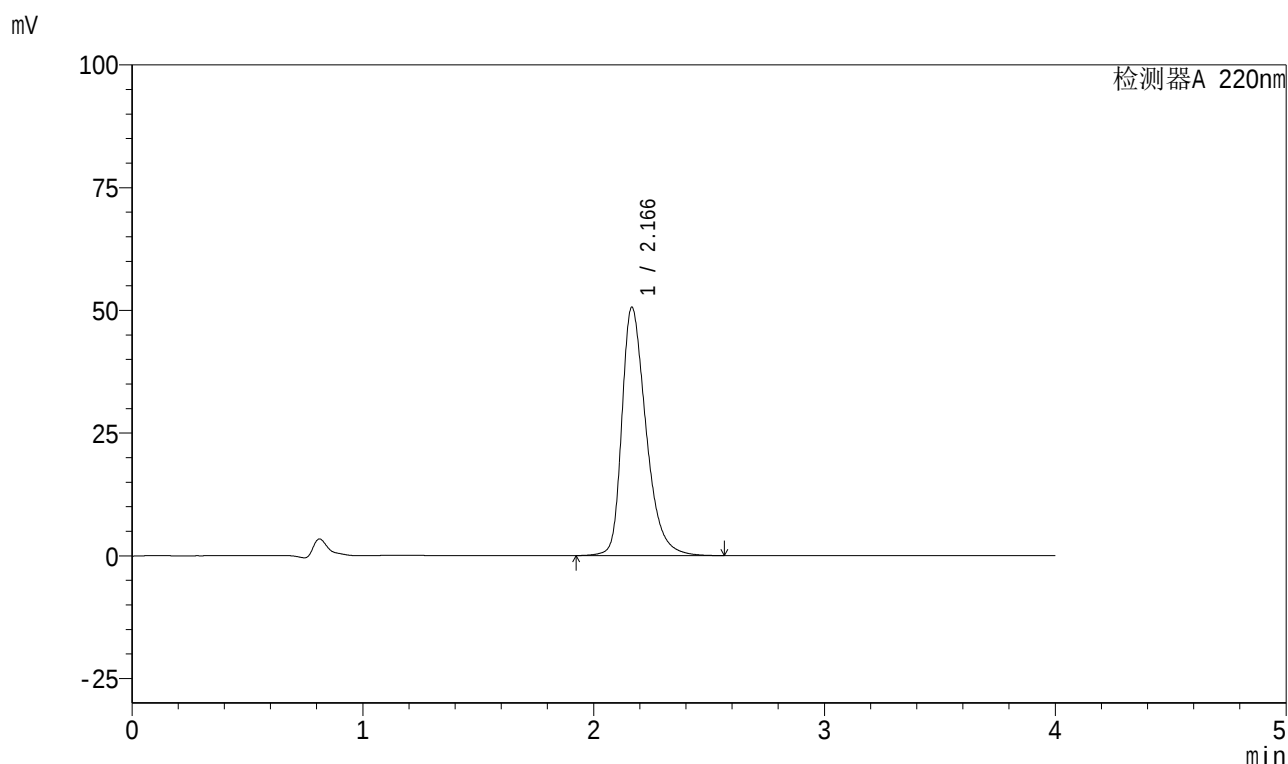

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	368799	100.000	50555	2162	1.369	--
总计		368799	100.000	50555			

图48 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-164-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 20:09:50
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

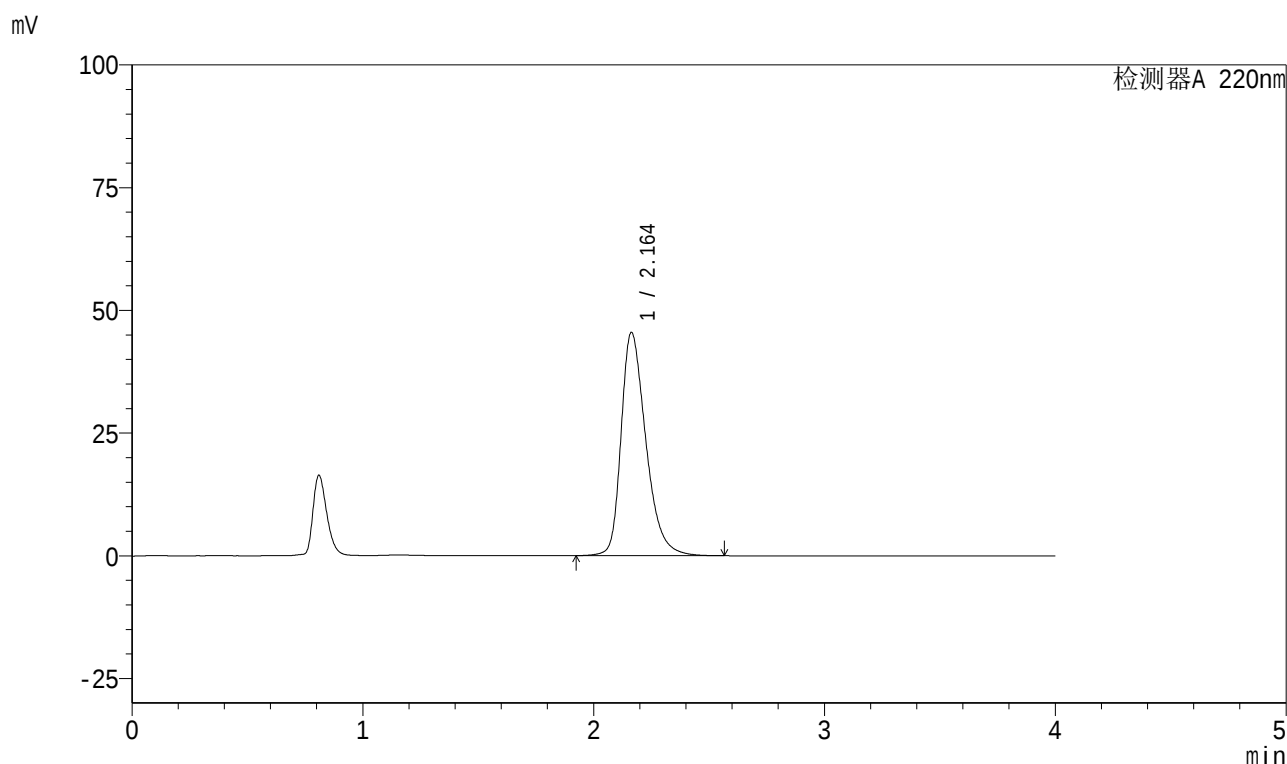

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	339139	100.000	45510	2051	1.348	--
总计		339139	100.000	45510			

图49 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-2-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-165-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 20:14:13
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

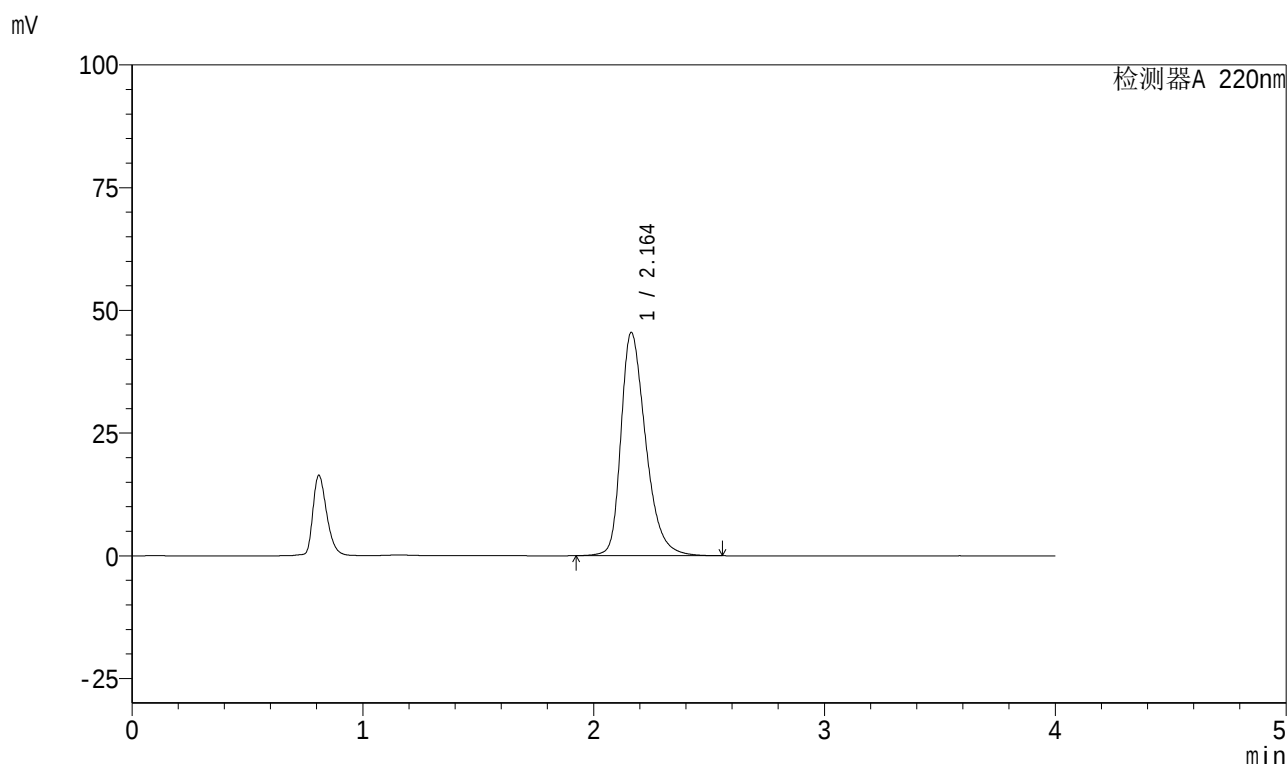

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	338863	100.000	45510	2050	1.348	--
总计		338863	100.000	45510			

图50 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-水介质
对照品溶液-2-2



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-166-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 20:18:37
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

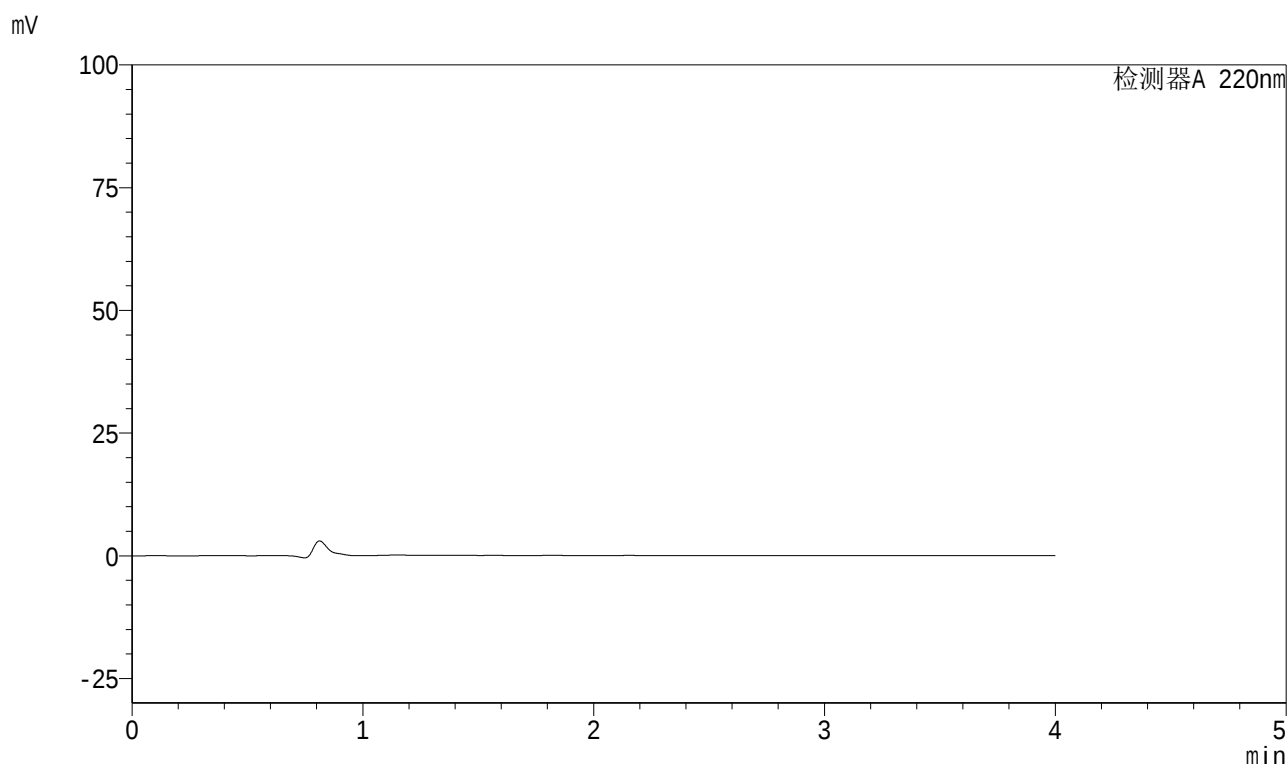

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-167-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:23:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

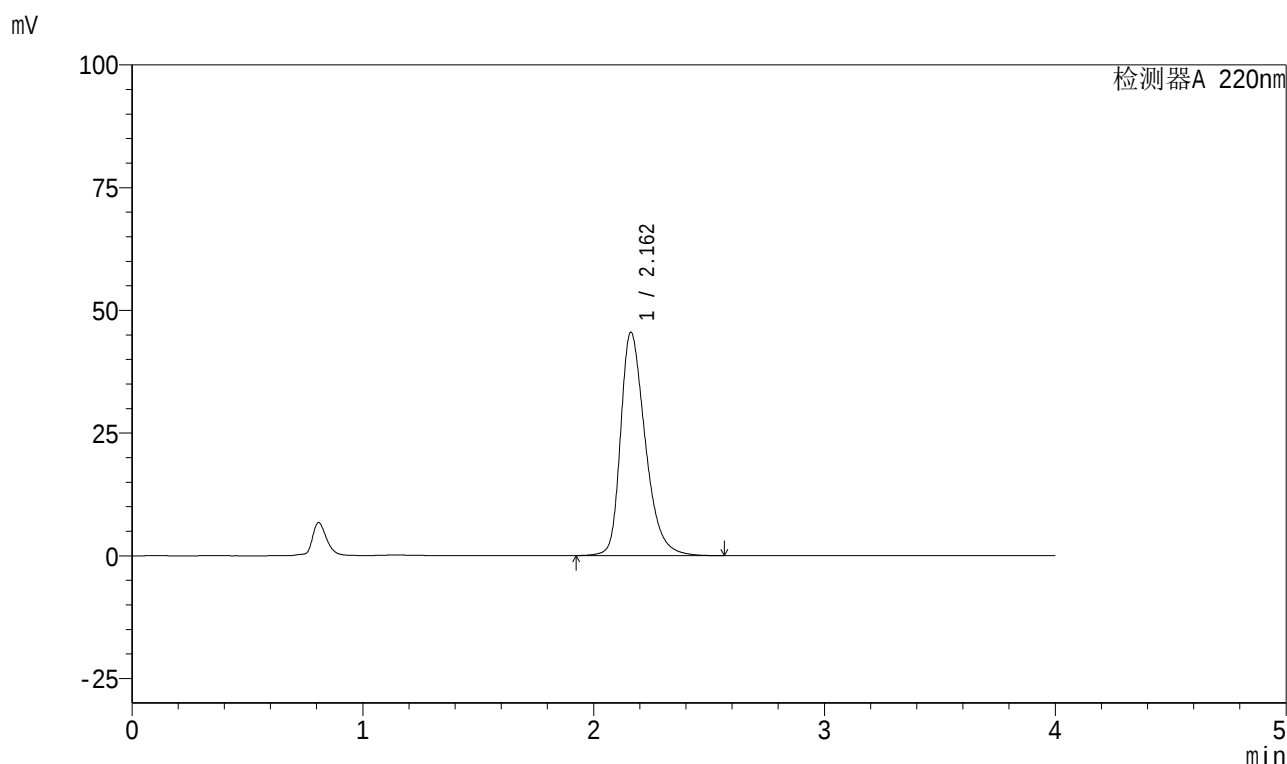

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	338403	100.000	45495	2055	1.346	--
总计		338403	100.000	45495			

图52 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-1-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-168-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 20:27:24
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

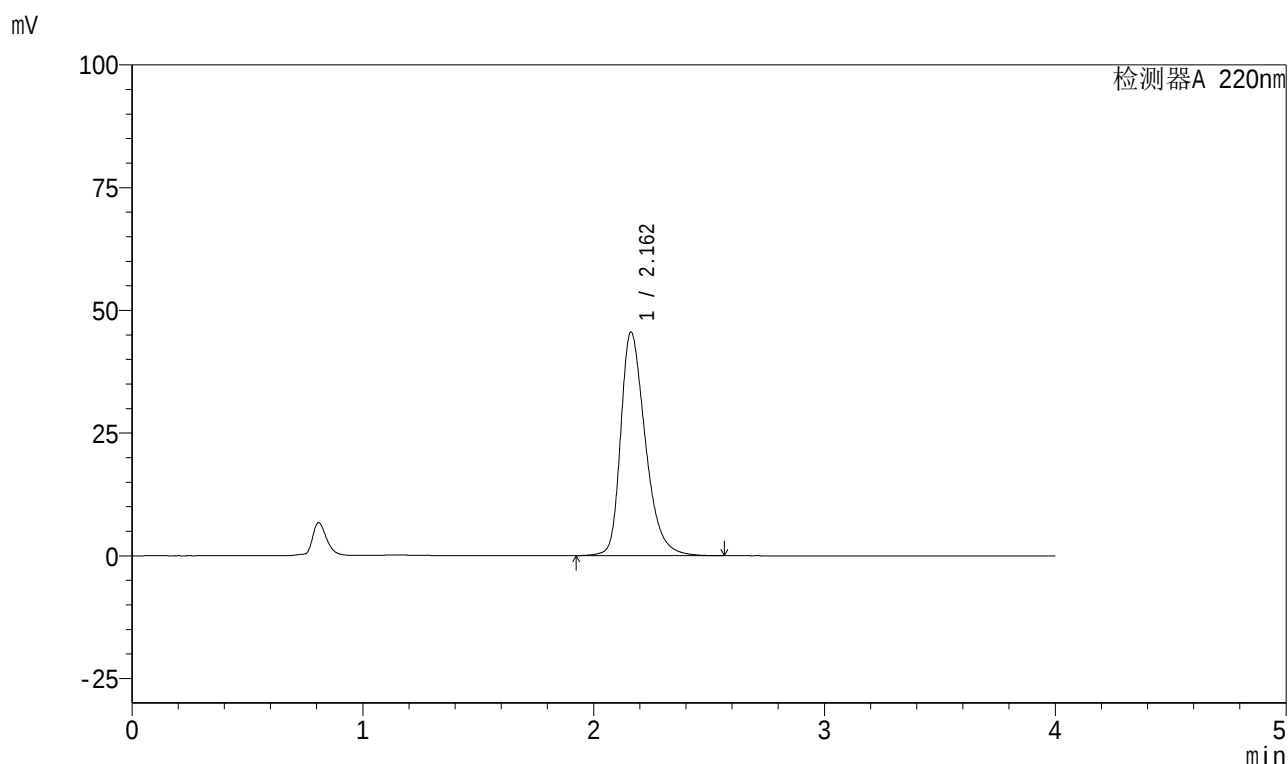

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	338617	100.000	45550	2056	1.346	--
总计		338617	100.000	45550			

图53 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-169-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:31:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

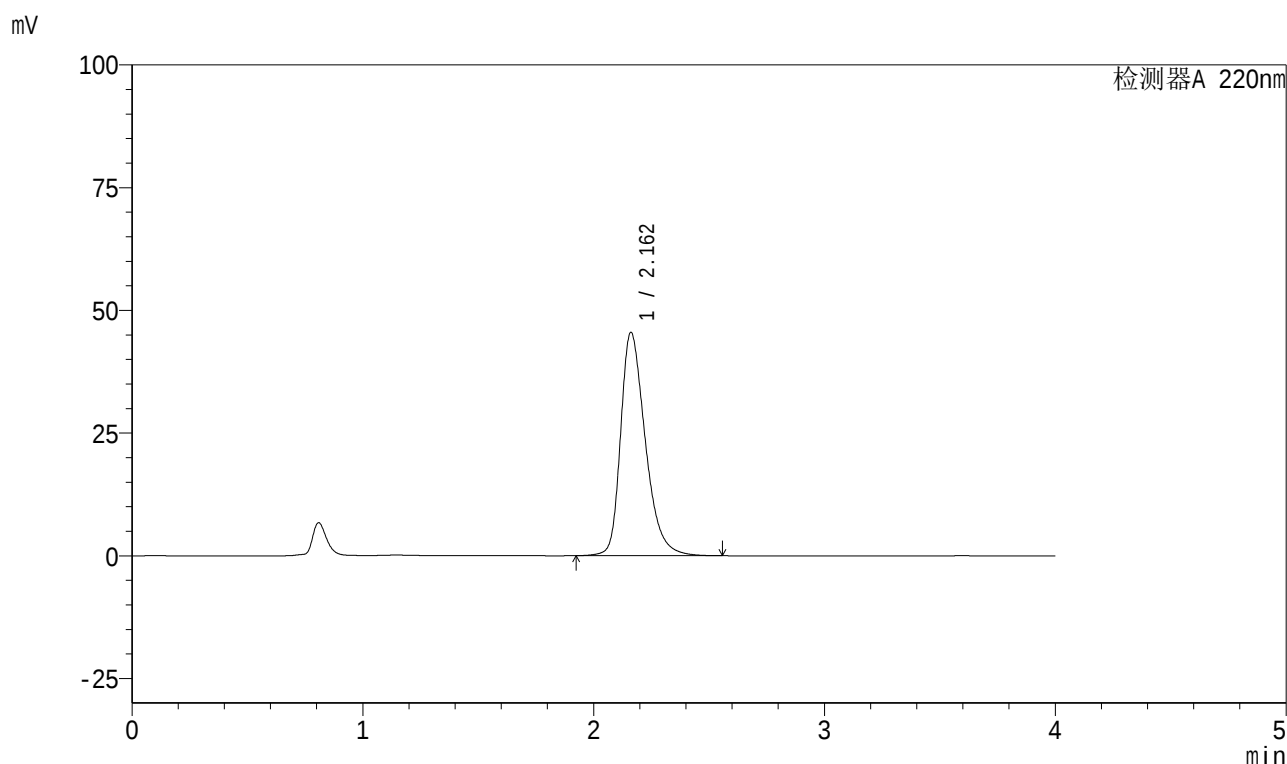

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	338381	100.000	45494	2054	1.345	--
总计		338381	100.000	45494			

图54 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-170-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:36:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

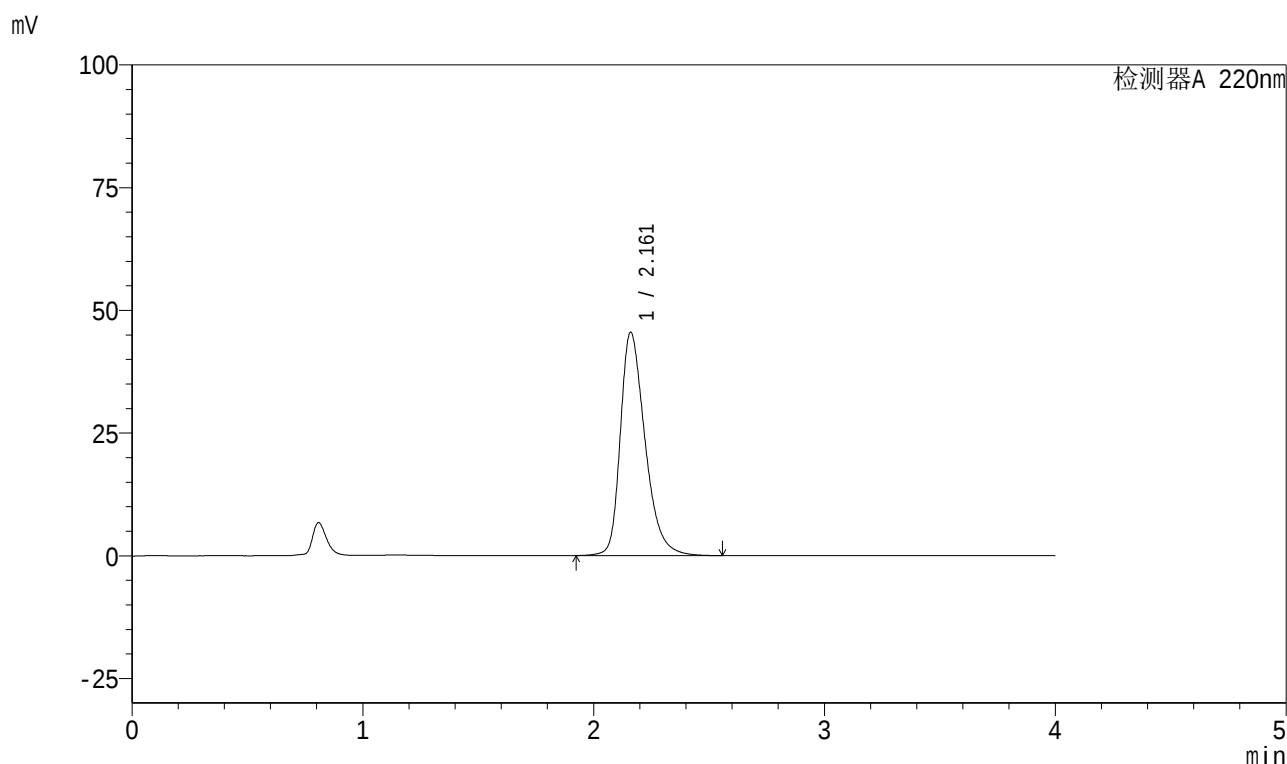

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	338399	100.000	45437	2052	1.347	--
总计		338399	100.000	45437			

图55 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-171-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:40:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

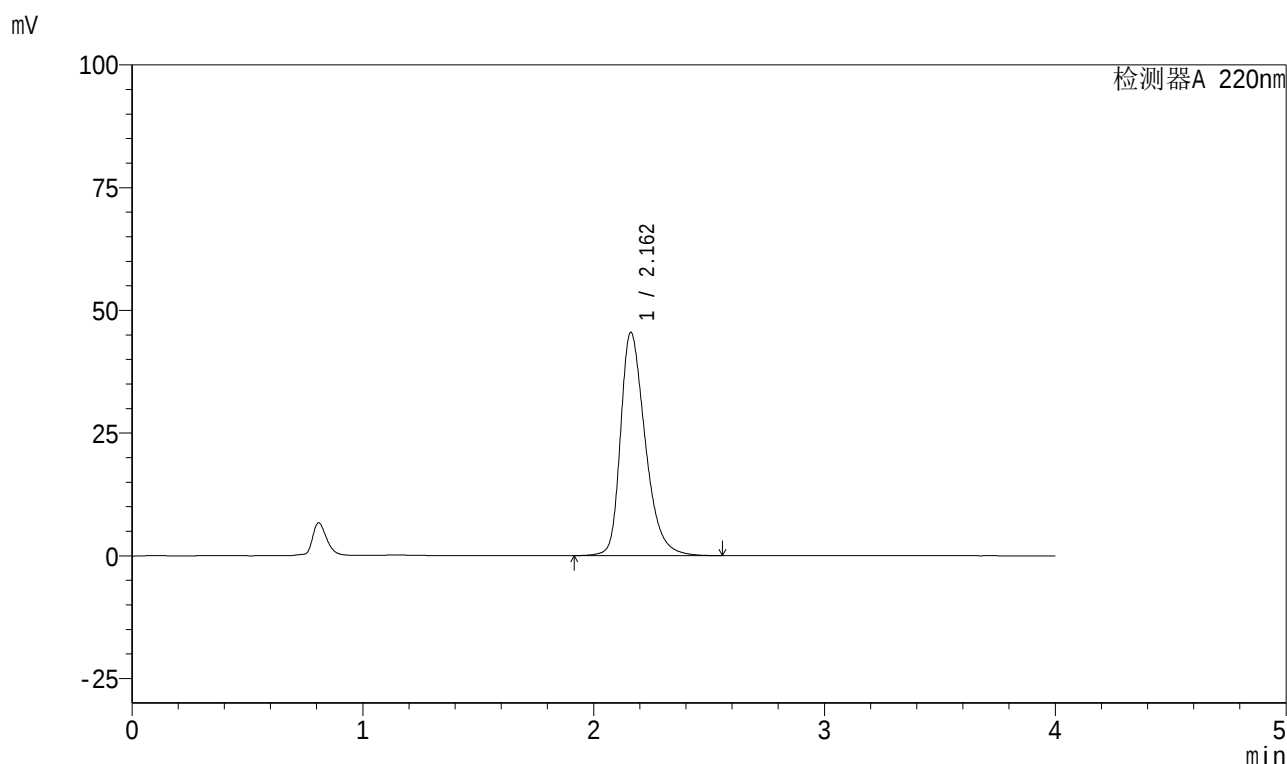

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	338716	100.000	45469	2051	1.348	--
总计		338716	100.000	45469			

图56 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-1-5




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-172-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:44:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:54:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

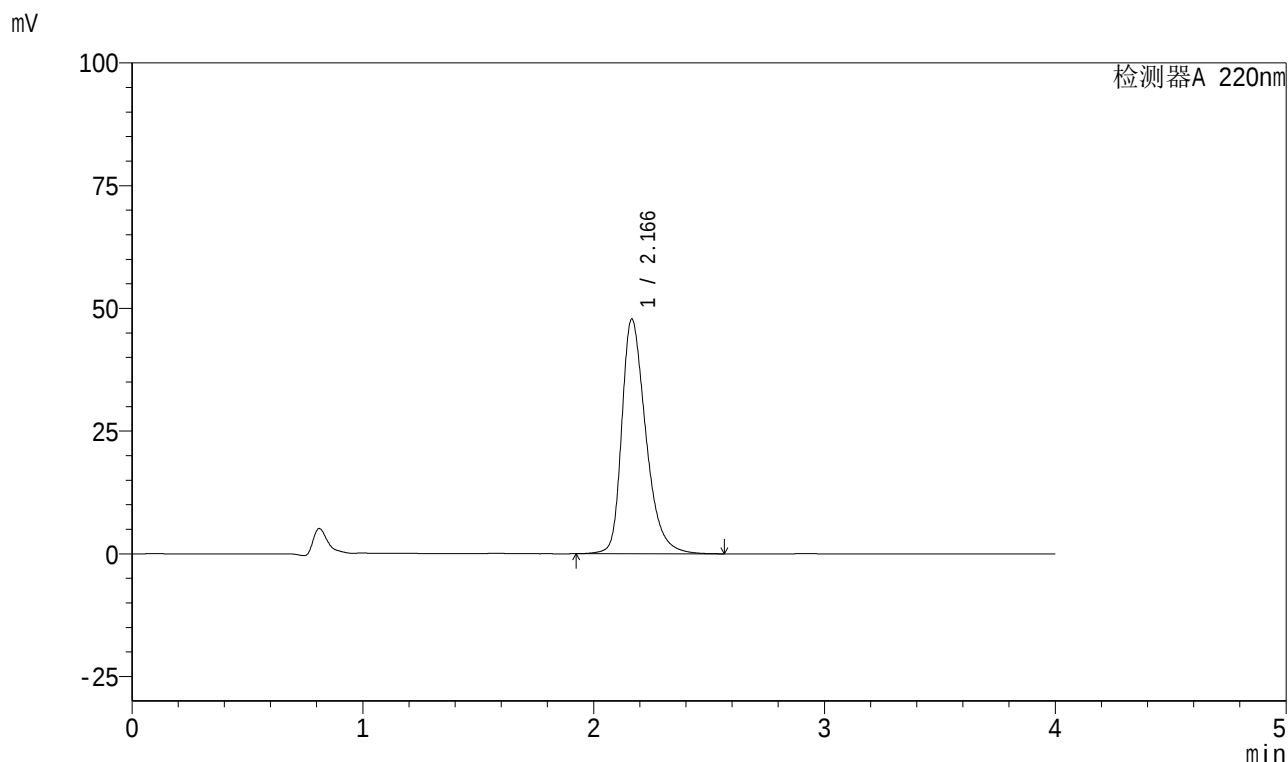

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	346887	100.000	47784	2183	1.356	--
总计		346887	100.000	47784			

图57 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-5min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-173-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 20:49:22 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:01 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

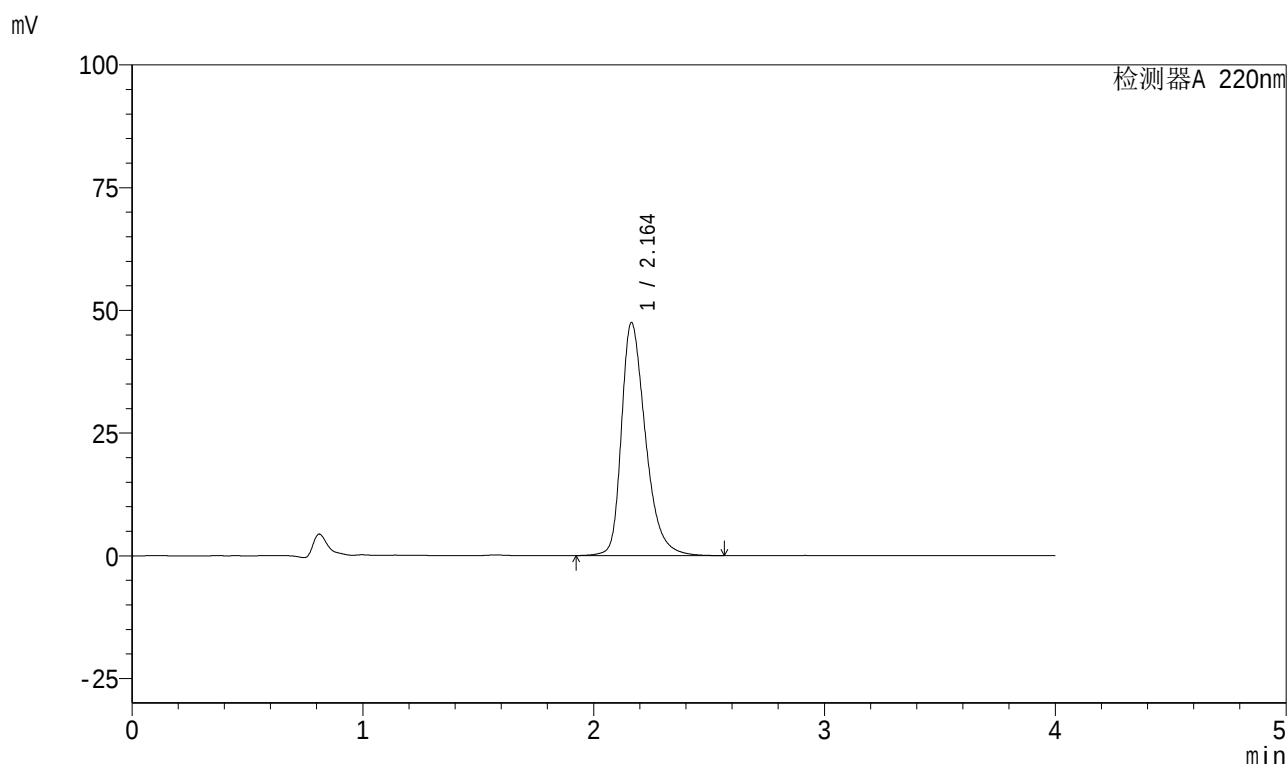

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	343720	100.000	47481	2188	1.355	--
总计		343720	100.000	47481			

图58 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-5min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-174-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:53:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

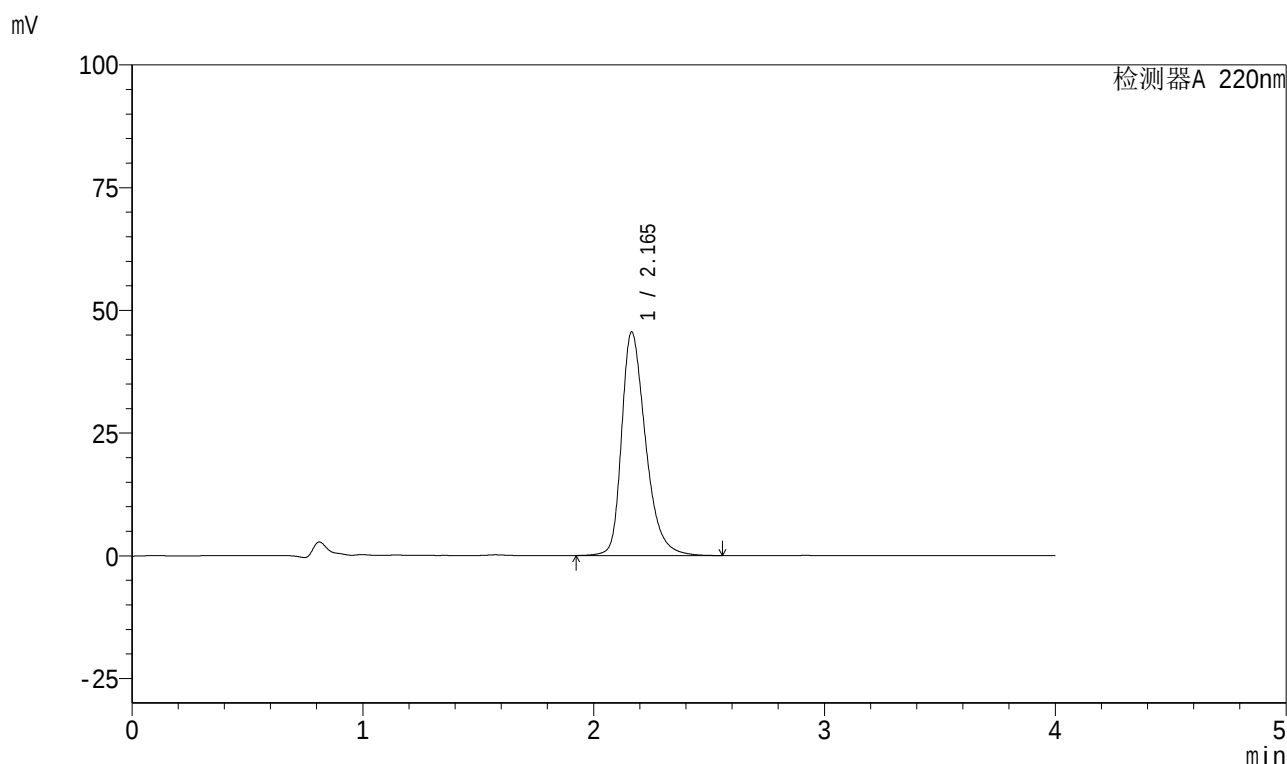

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	328870	100.000	45536	2204	1.347	--
总计		328870	100.000	45536			

图59 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-5min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-175-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 20:58:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

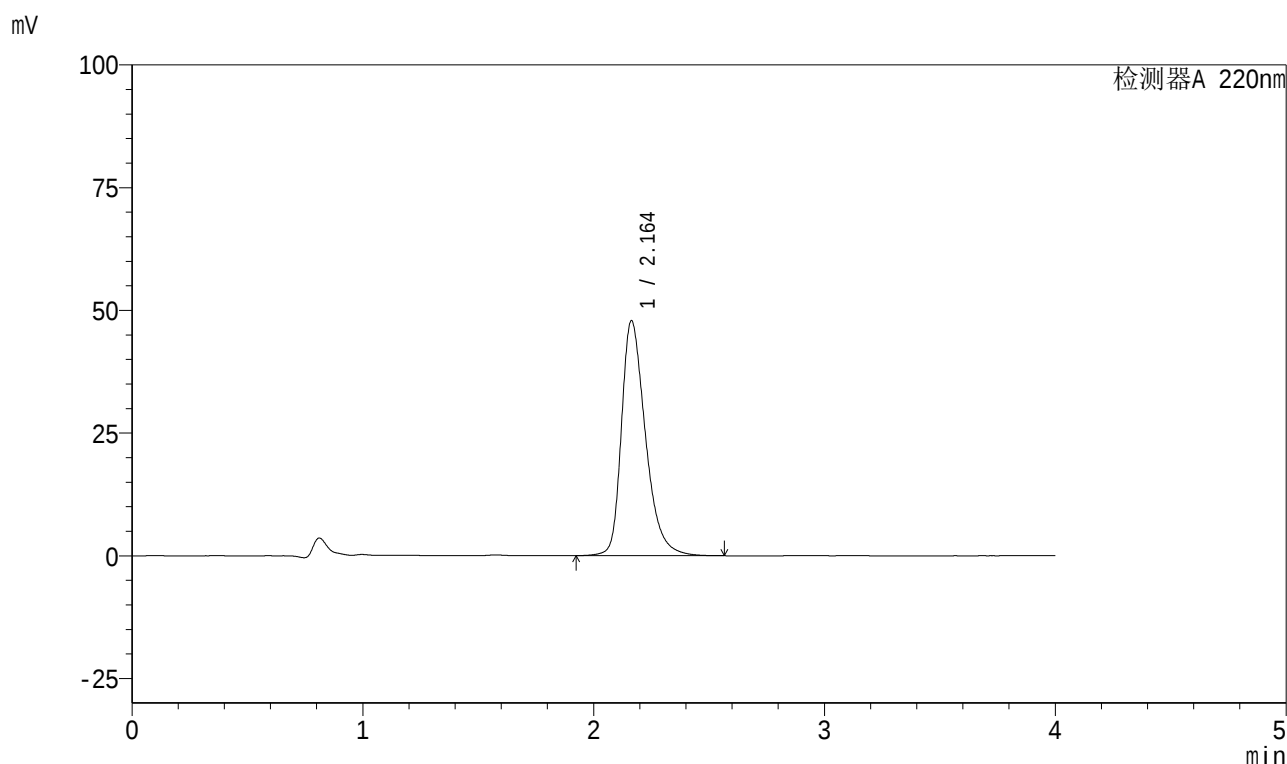

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	346842	100.000	47882	2184	1.356	--
总计		346842	100.000	47882			

图60 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-5min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-176-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 21:02:31 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:09 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

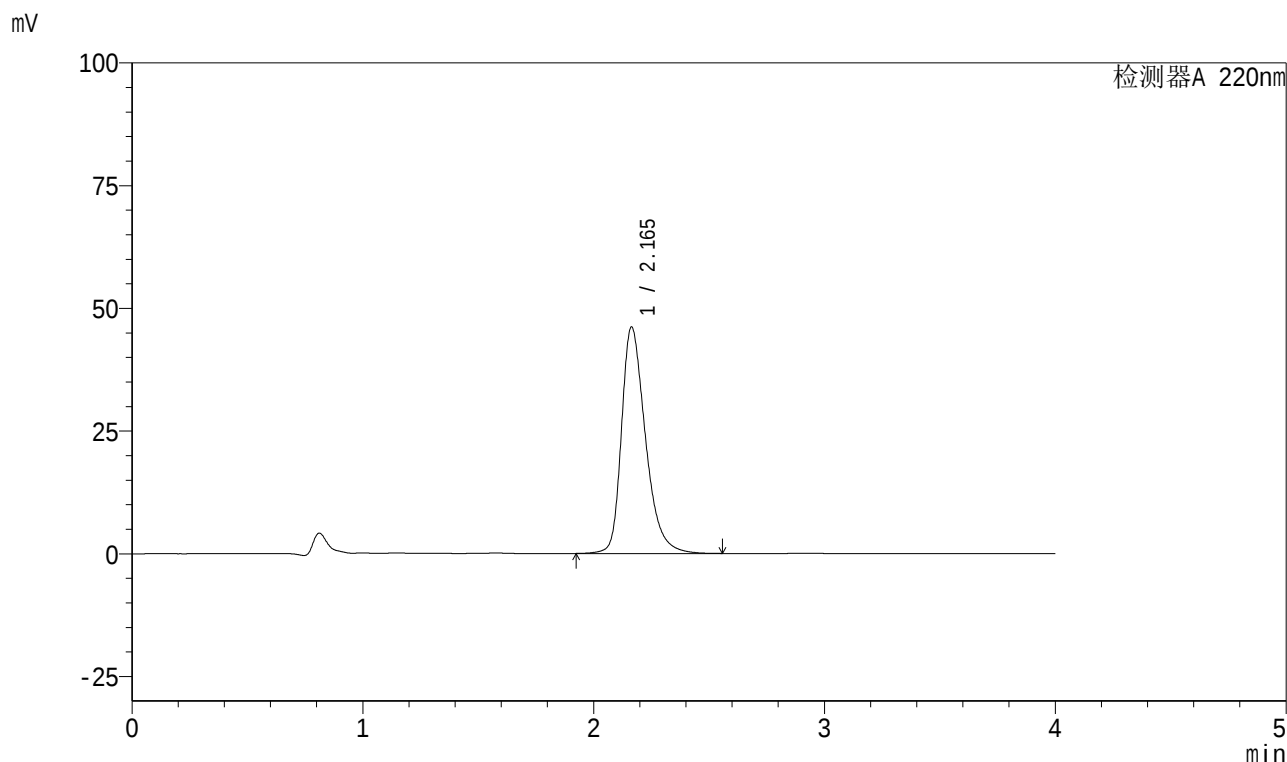

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	333379	100.000	46148	2199	1.350	--
总计		333379	100.000	46148			

图61 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-177-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:06:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

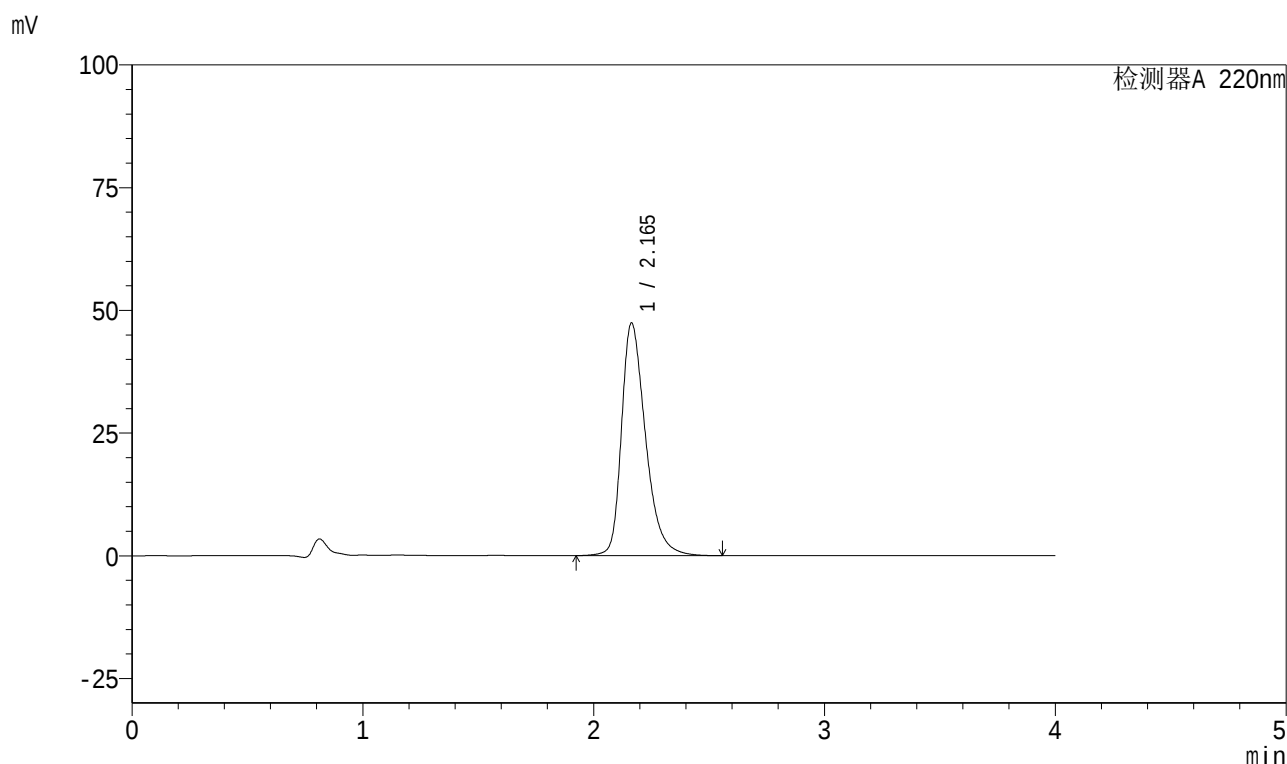

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	343109	100.000	47403	2190	1.355	--
总计		343109	100.000	47403			

图62 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-178-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:11:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

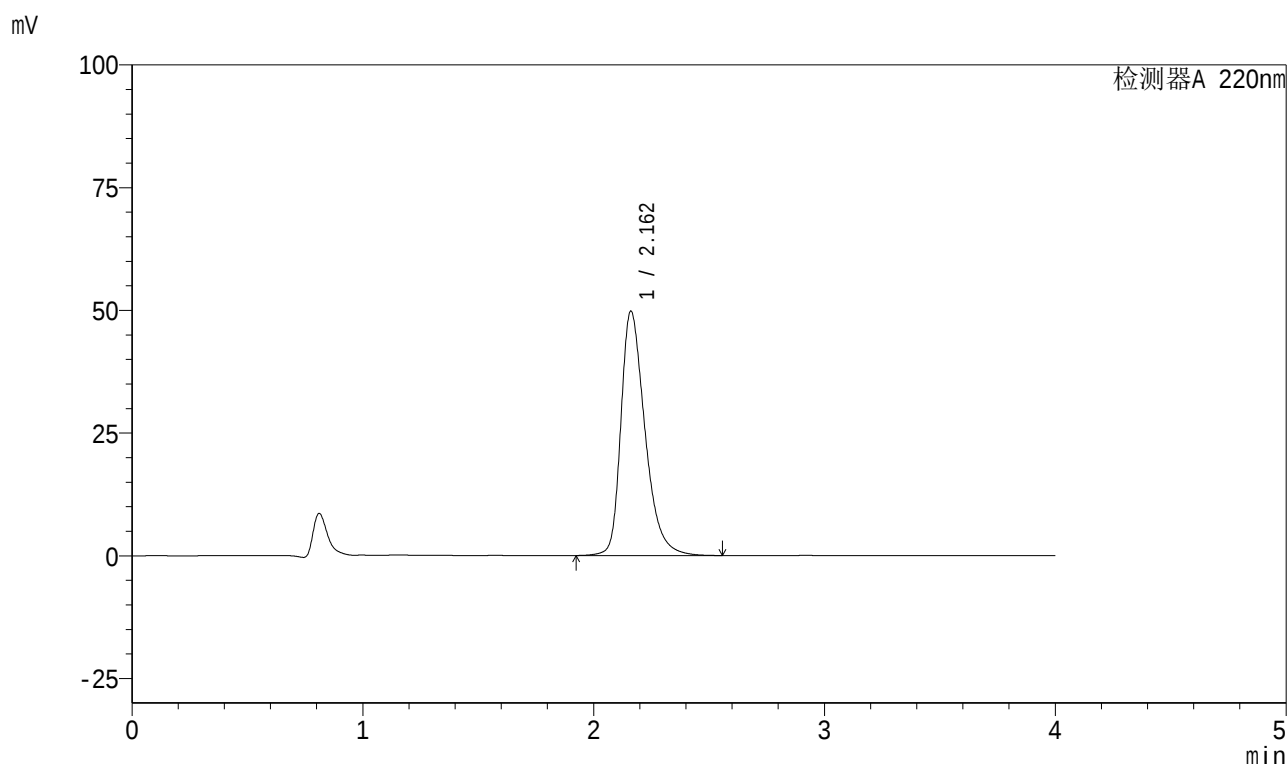

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	361517	100.000	49779	2169	1.365	--
总计		361517	100.000	49779			

图63 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-10min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-179-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 21:15:41 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:17 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

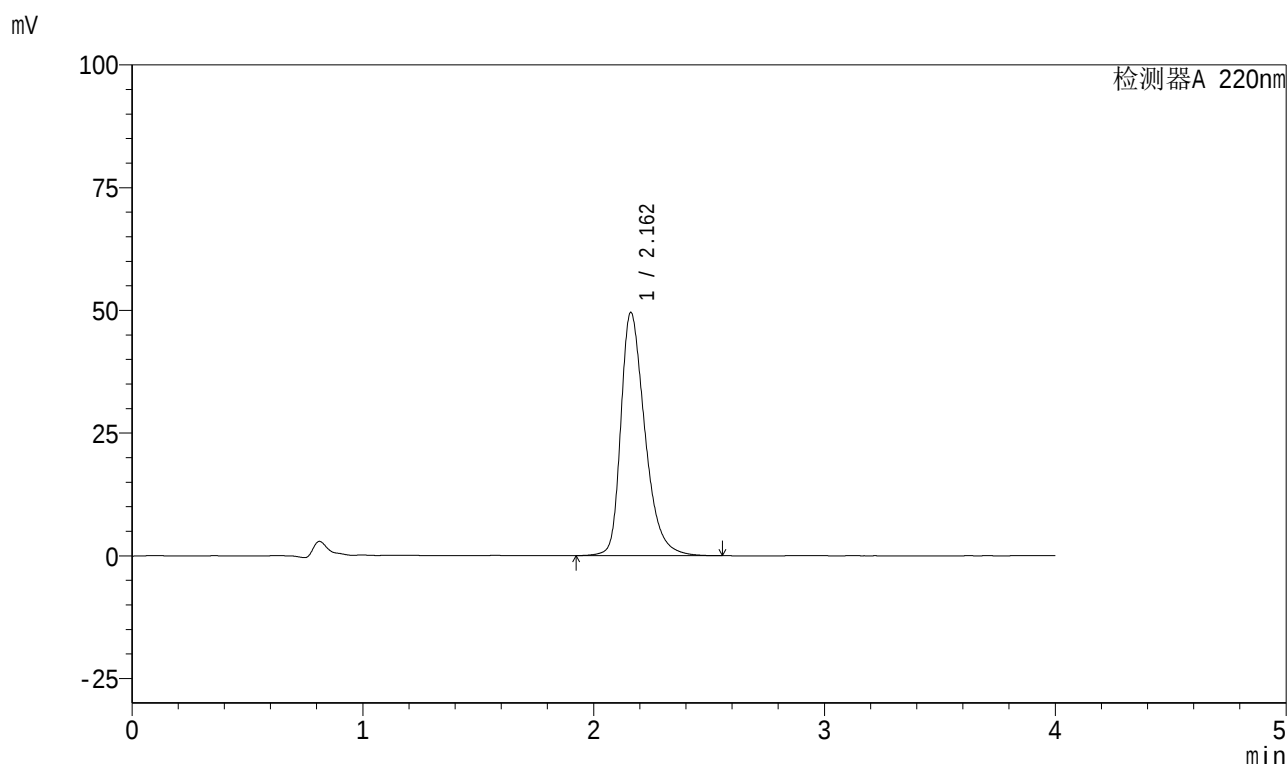

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	359799	100.000	49539	2170	1.365	--
总计		359799	100.000	49539			

图64 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-180-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 21:20:04
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

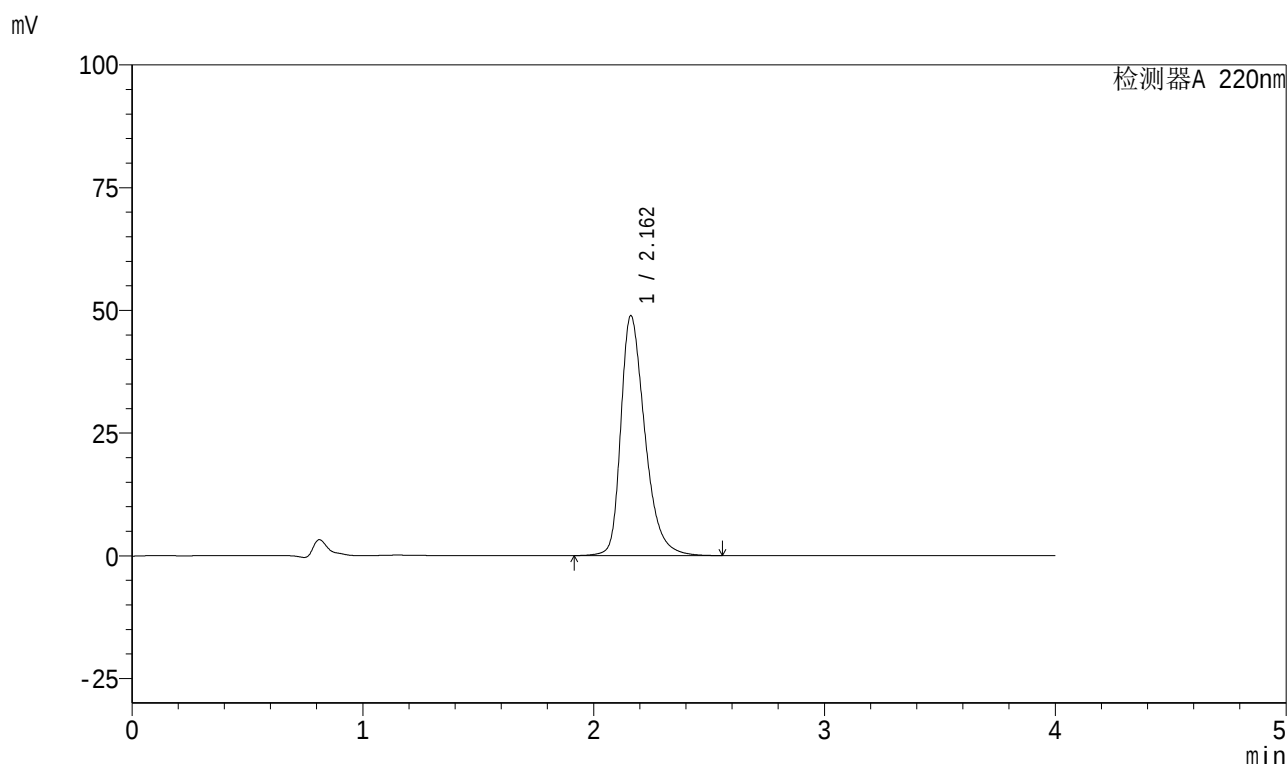

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	354293	100.000	48849	2176	1.362	--
总计		354293	100.000	48849			

图65 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-181-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:24:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

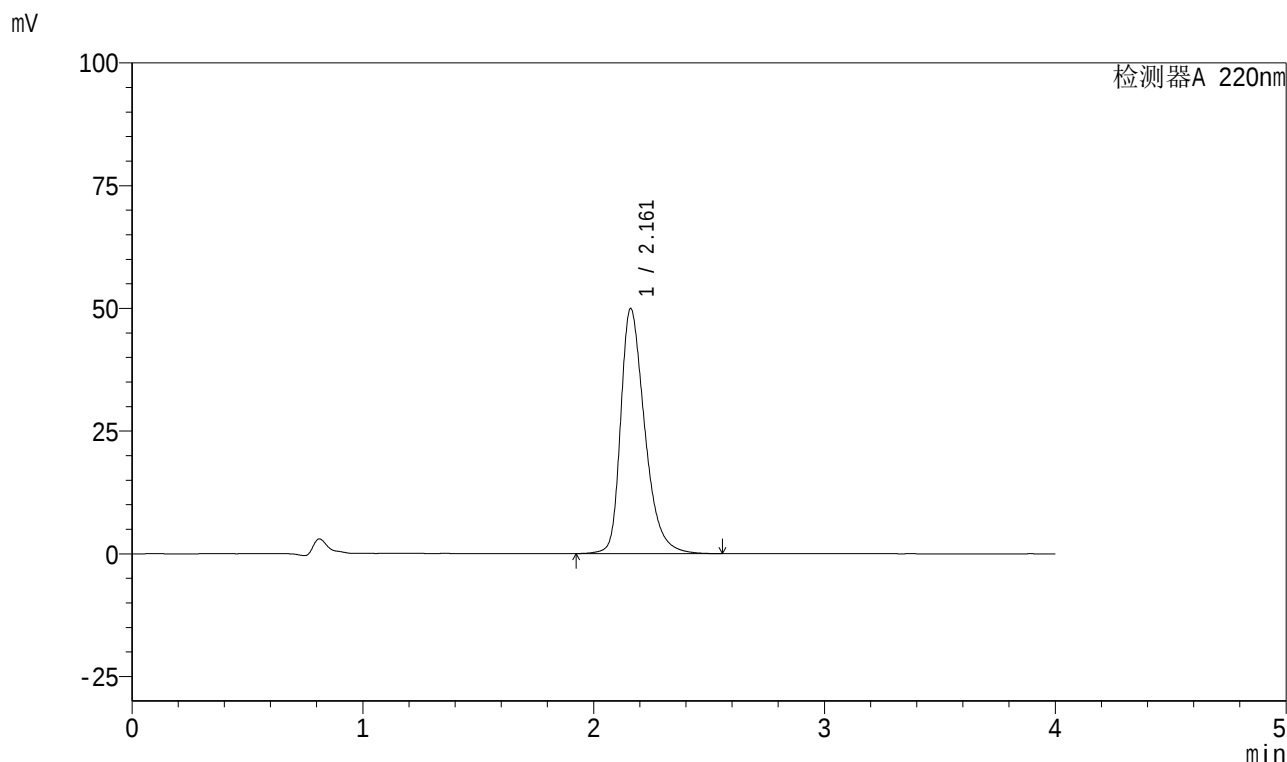

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	362520	100.000	49856	2166	1.367	--
总计		362520	100.000	49856			

图66 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-182-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:28:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

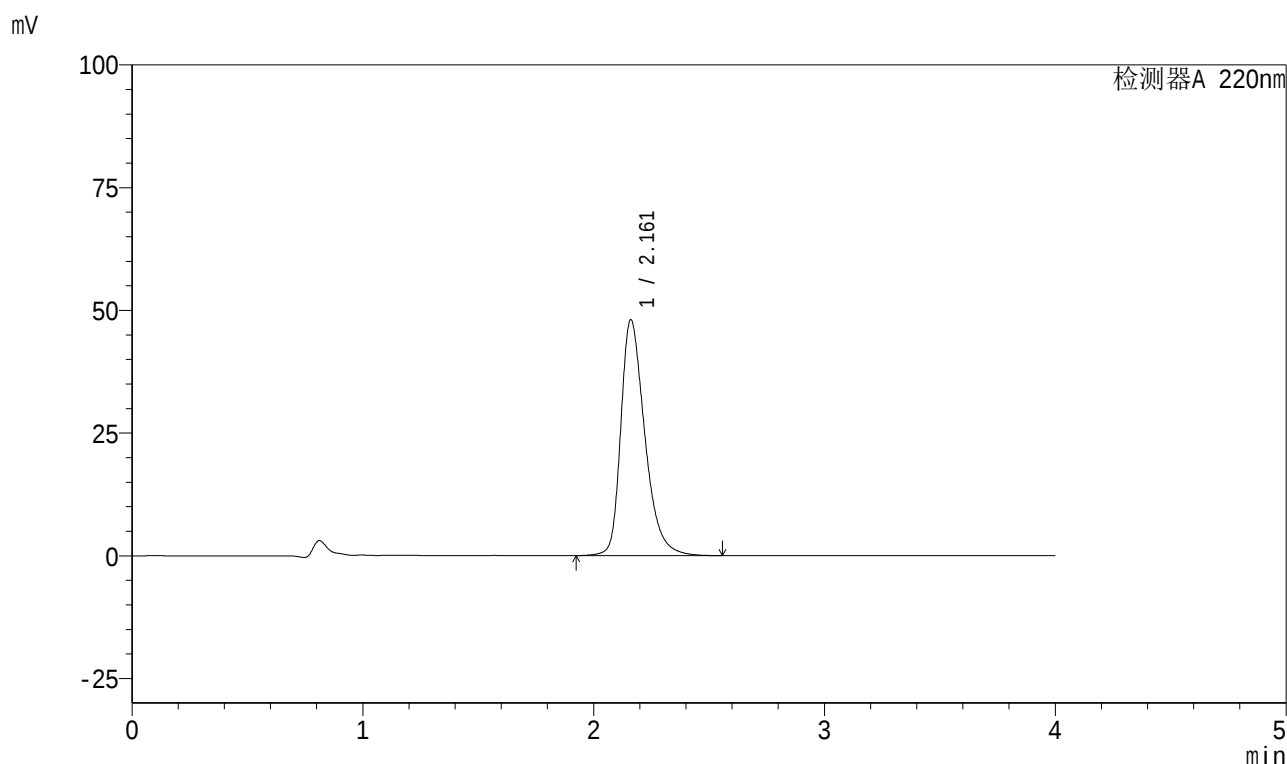

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	347848	100.000	48041	2186	1.359	--
总计		347848	100.000	48041			

图67 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-183-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:33:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

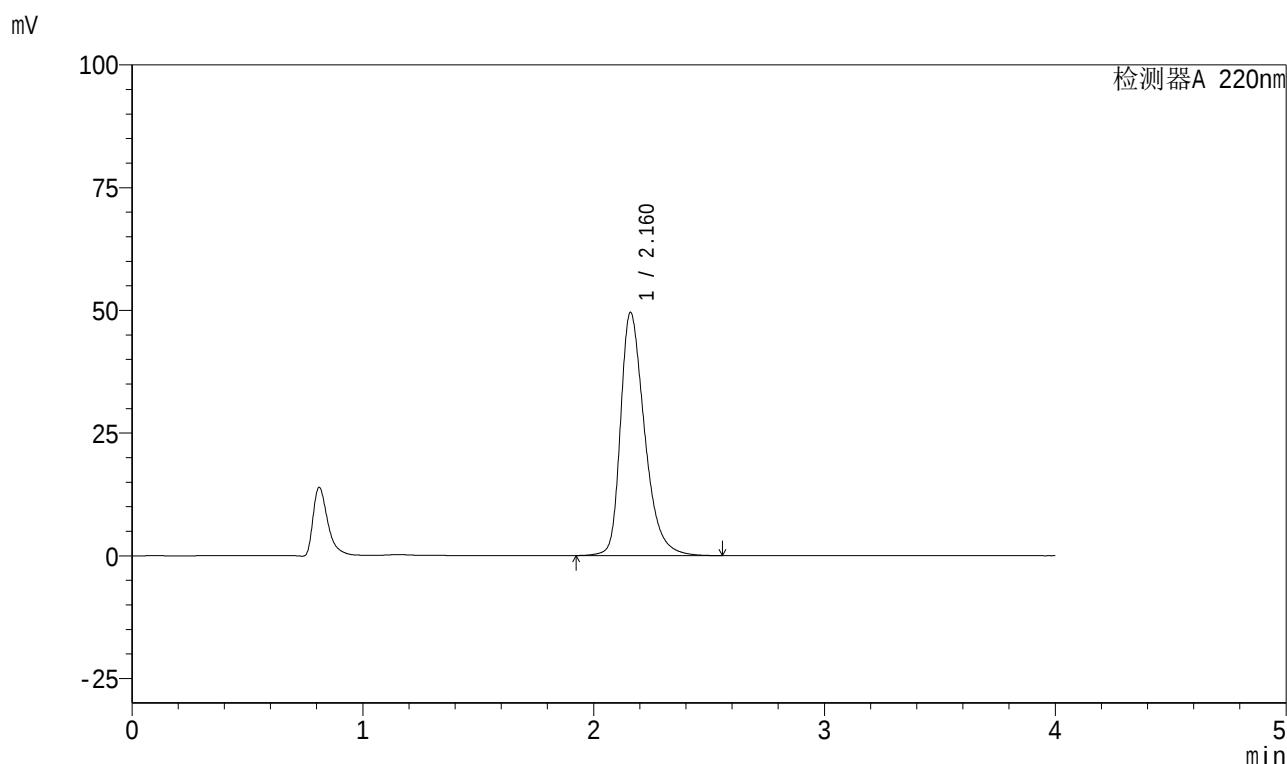

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	359129	100.000	49425	2172	1.366	--
总计		359129	100.000	49425			

图68 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-10min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-184-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:37:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

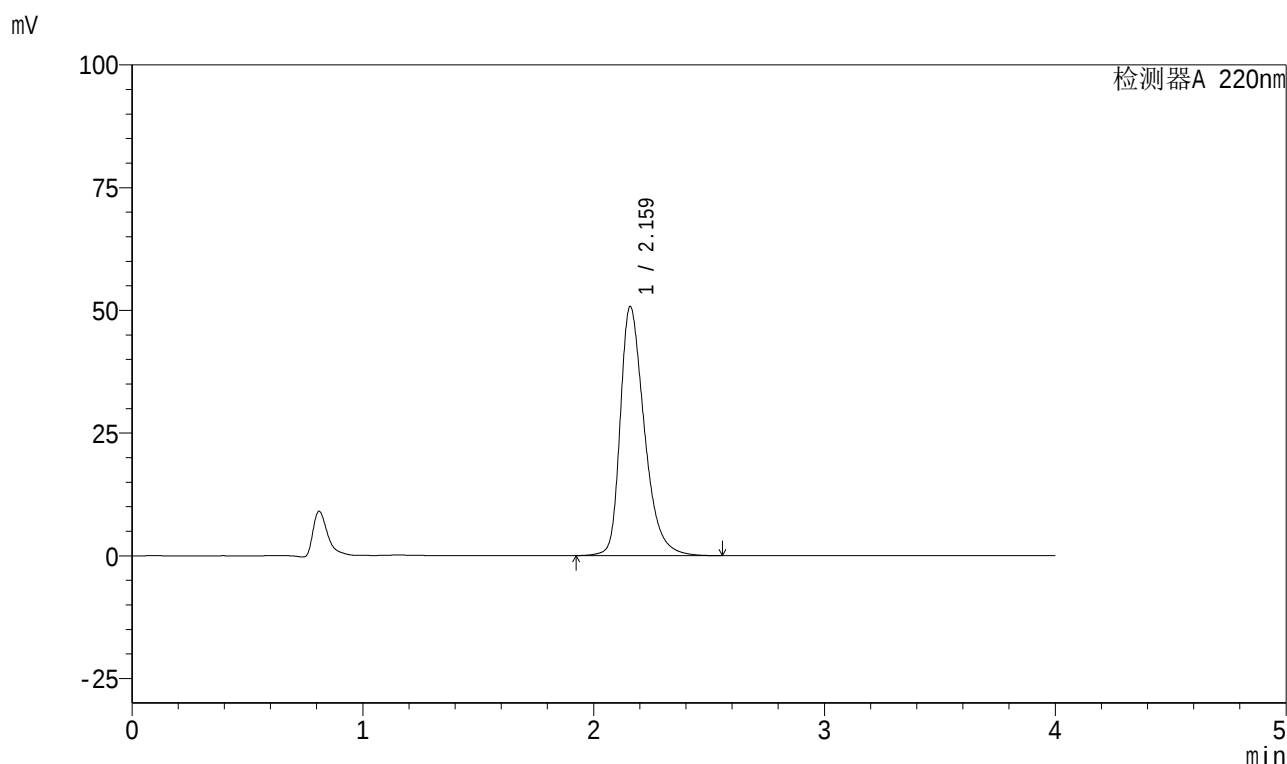

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	368118	100.000	50581	2163	1.372	--
总计		368118	100.000	50581			

图69 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-185-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-12 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 21:41:59 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

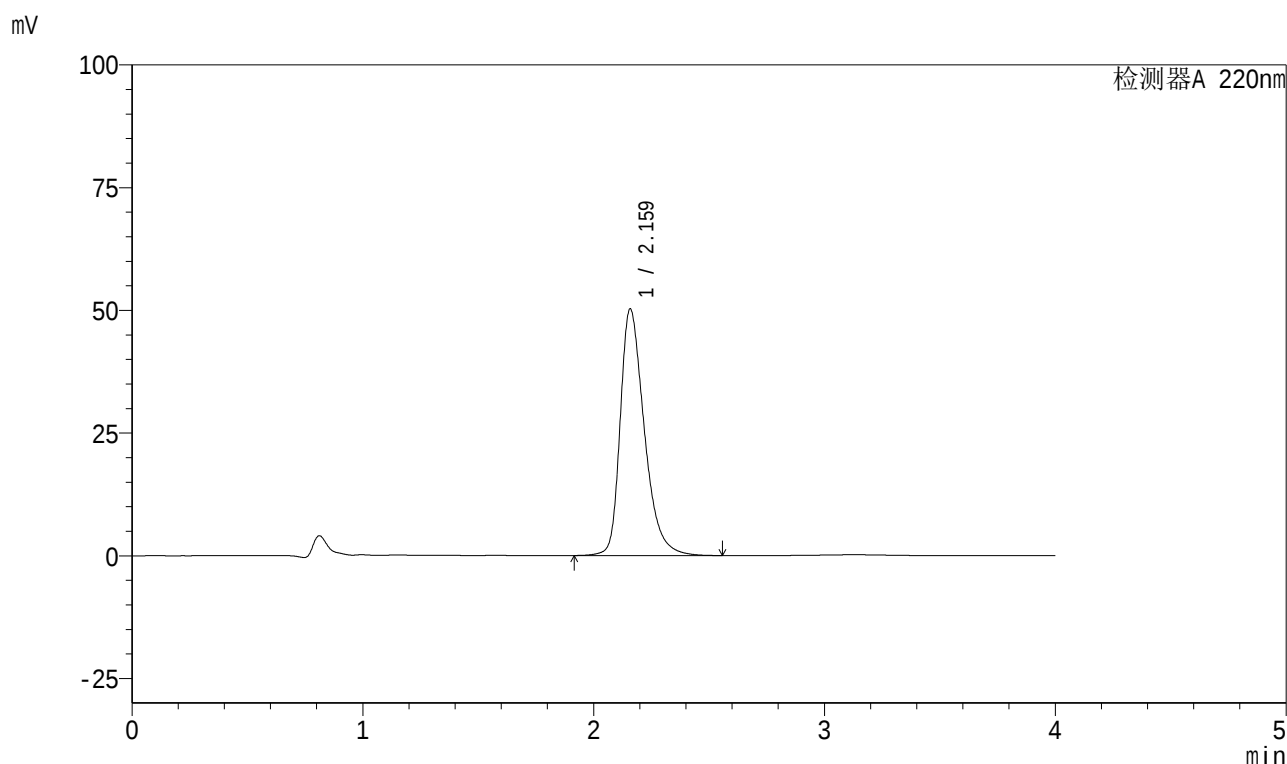

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	364587	100.000	50108	2166	1.369	--
总计		364587	100.000	50108			

图70 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-15min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-186-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 21:46:22
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

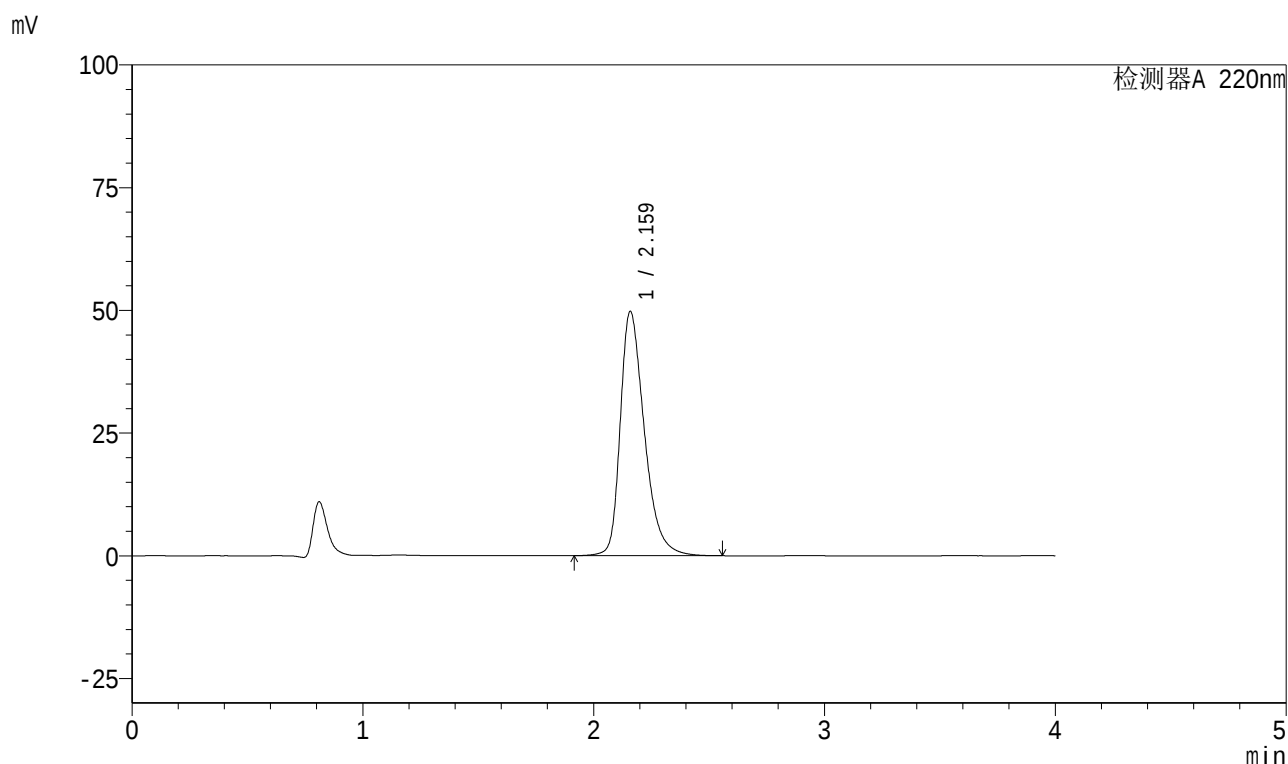

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	360874	100.000	49612	2171	1.368	--
总计		360874	100.000	49612			

图71 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-187-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:50:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

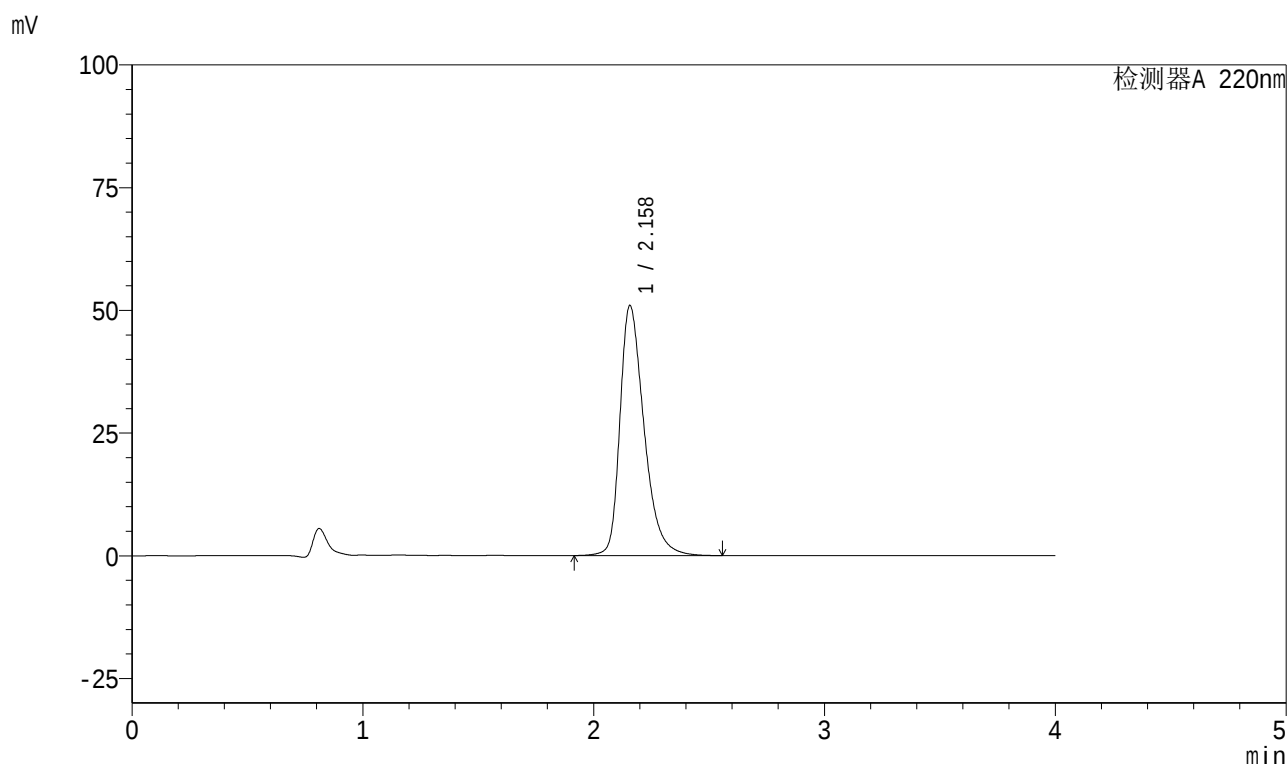

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	369999	100.000	50897	2159	1.372	--
总计		369999	100.000	50897			

图72 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-188-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:55:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

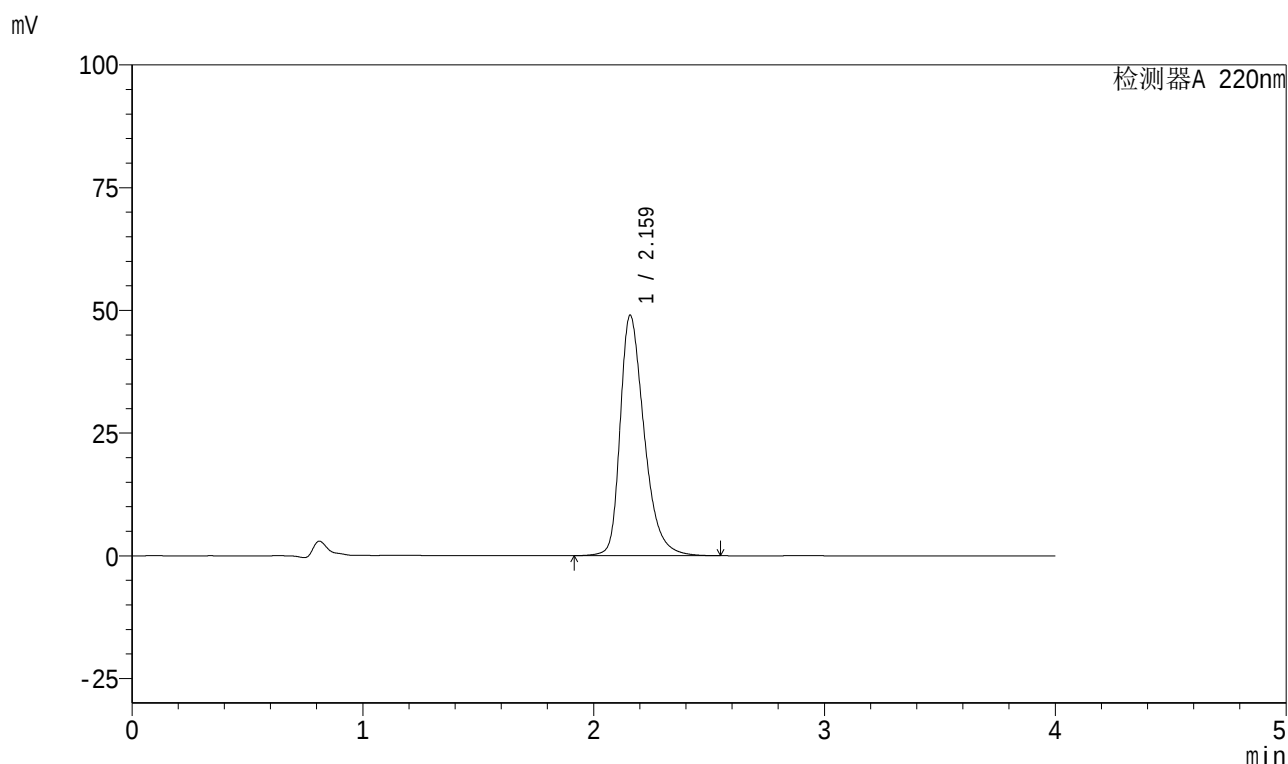

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	354601	100.000	48861	2176	1.364	--
总计		354601	100.000	48861			

图73 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-189-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 21:59:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

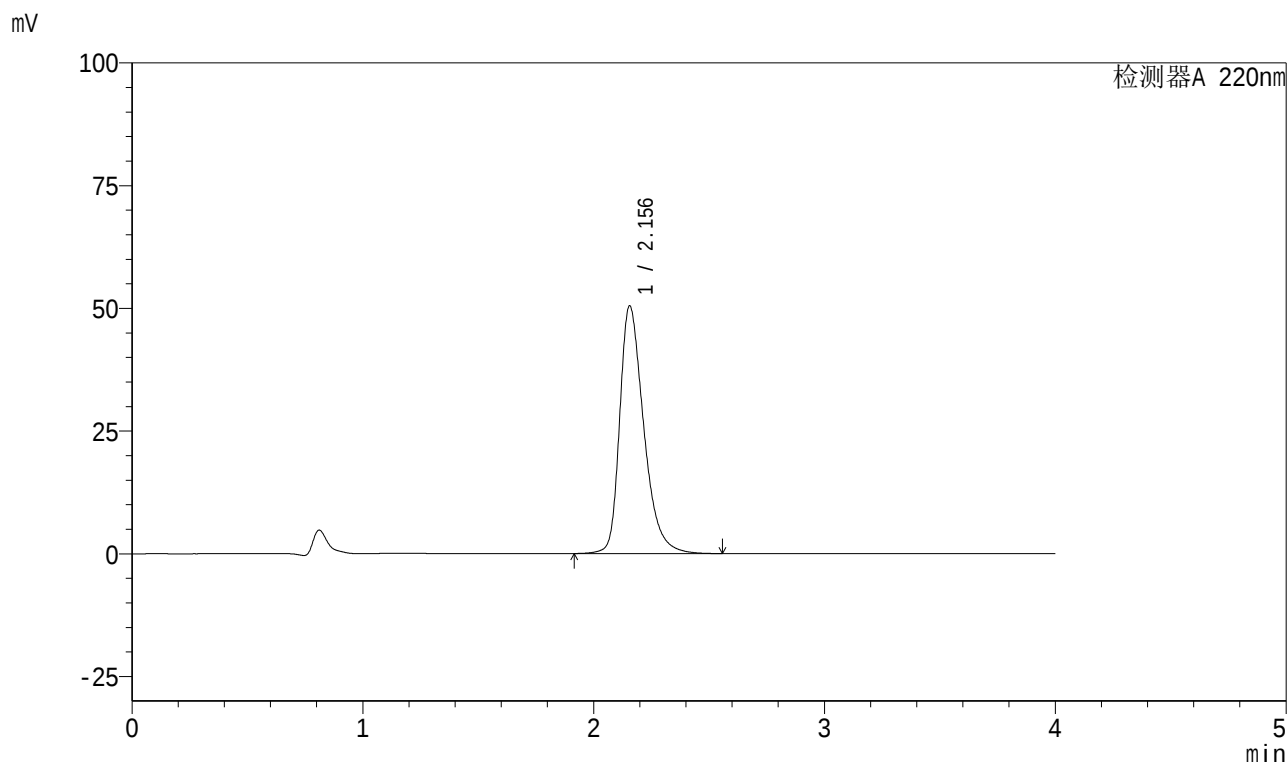

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	365694	100.000	50465	2168	1.369	--
总计		365694	100.000	50465			

图74 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-190-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:03:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

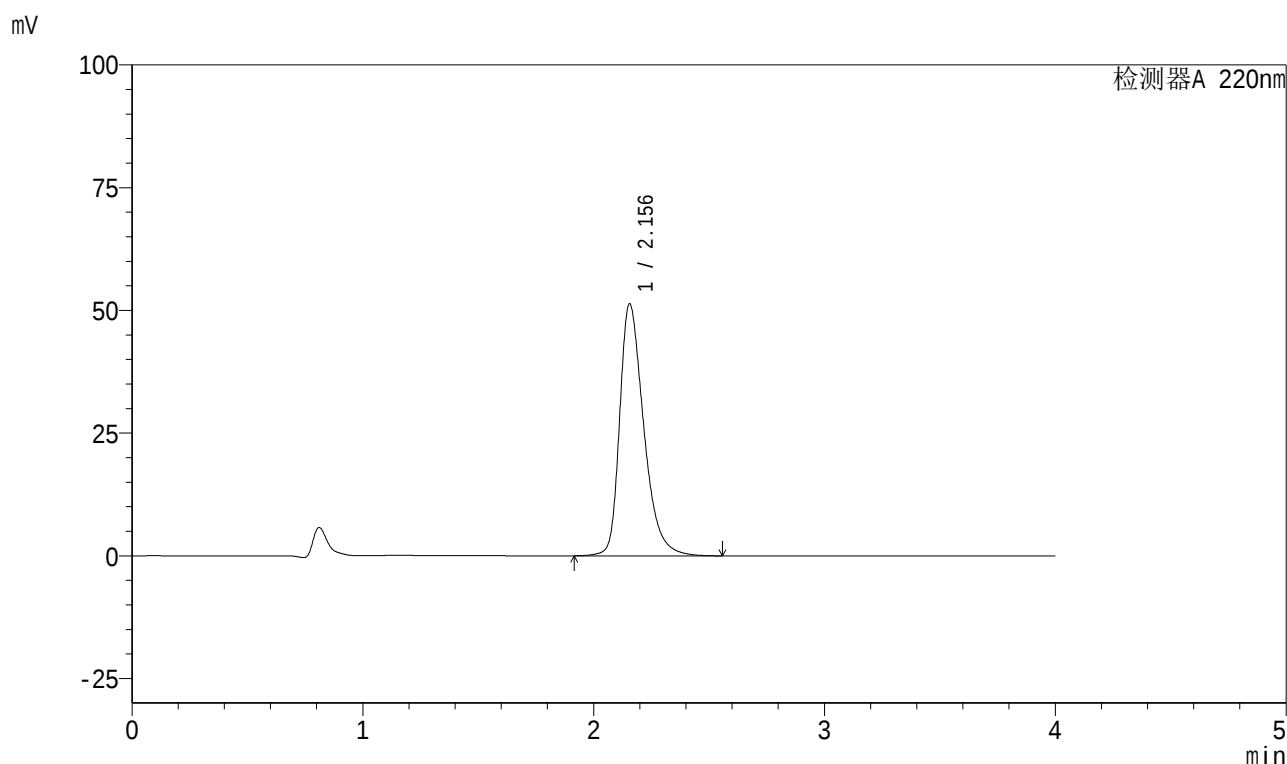

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	372950	100.000	51354	2157	1.372	--
总计		372950	100.000	51354			

图75 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-20min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-191-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:08:19
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

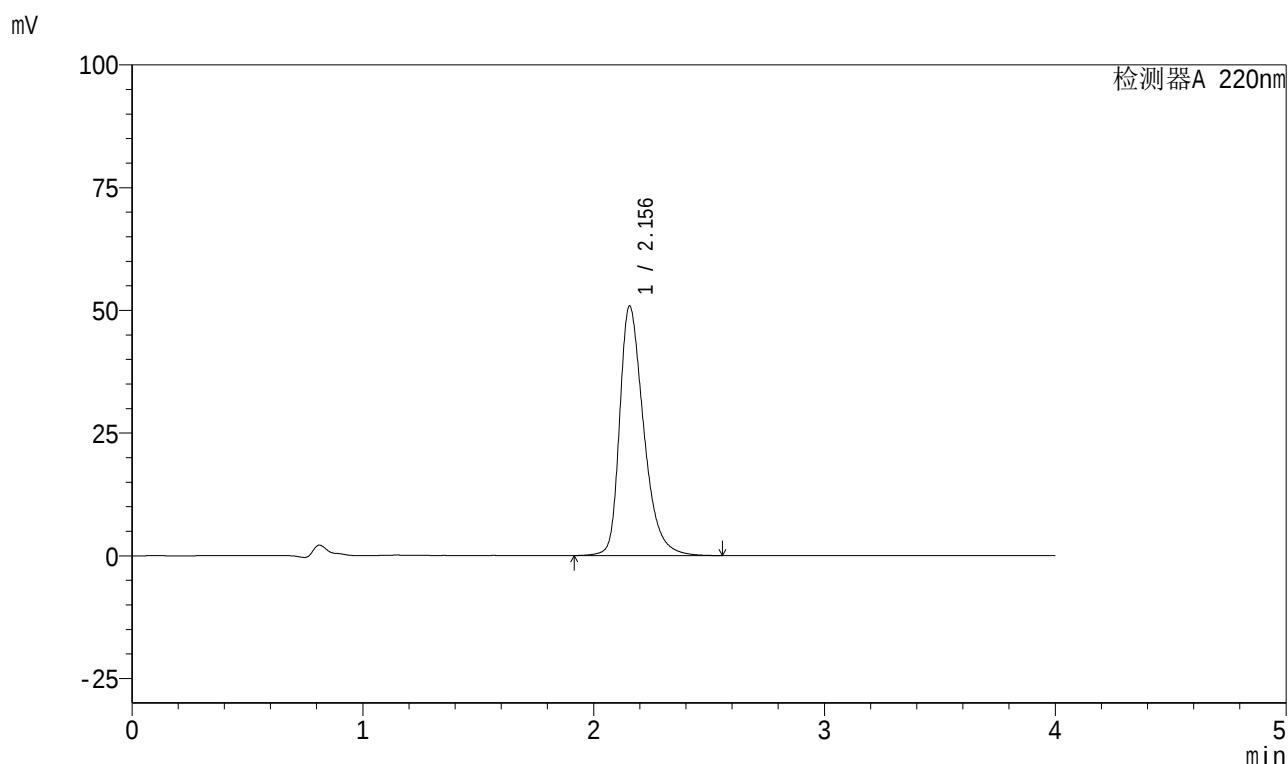

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	368670	100.000	50840	2164	1.370	--
总计		368670	100.000	50840			

图76 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-192-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:12:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

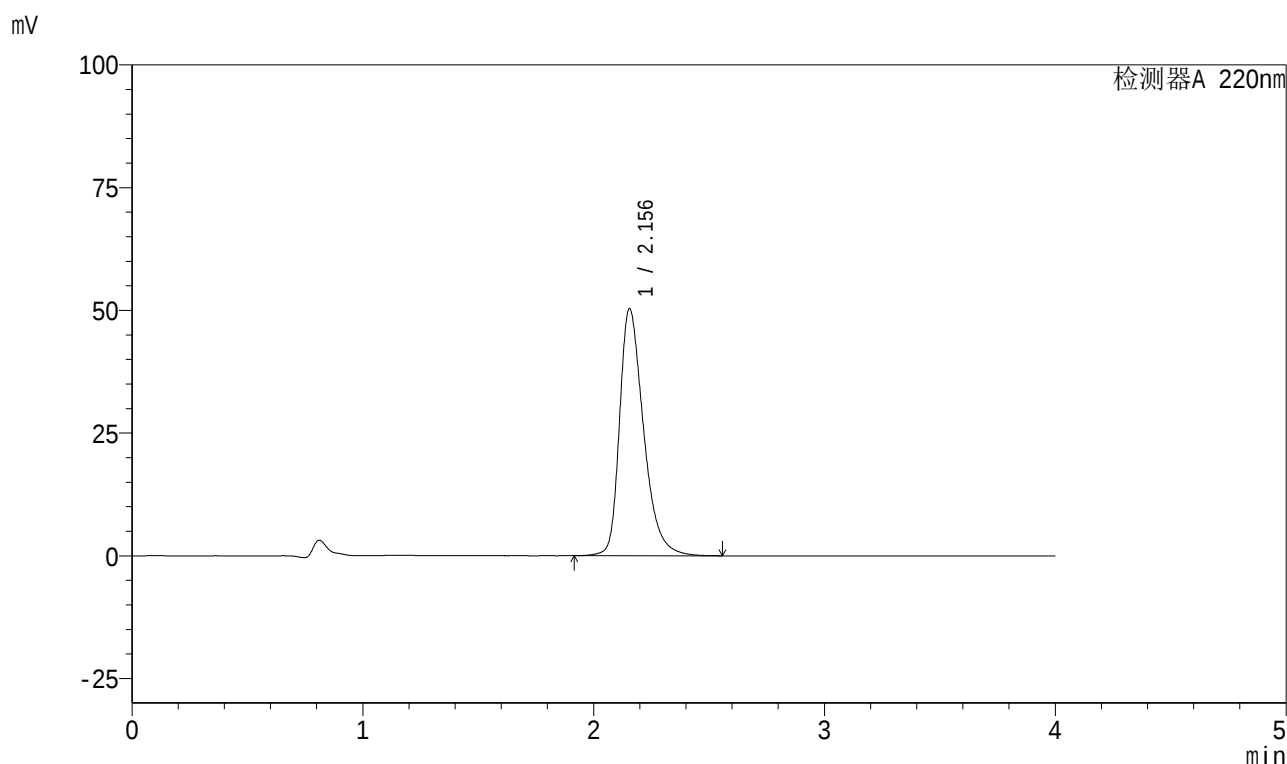

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	364694	100.000	50367	2170	1.369	--
总计		364694	100.000	50367			

图77 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-20min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-193-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:17:06
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

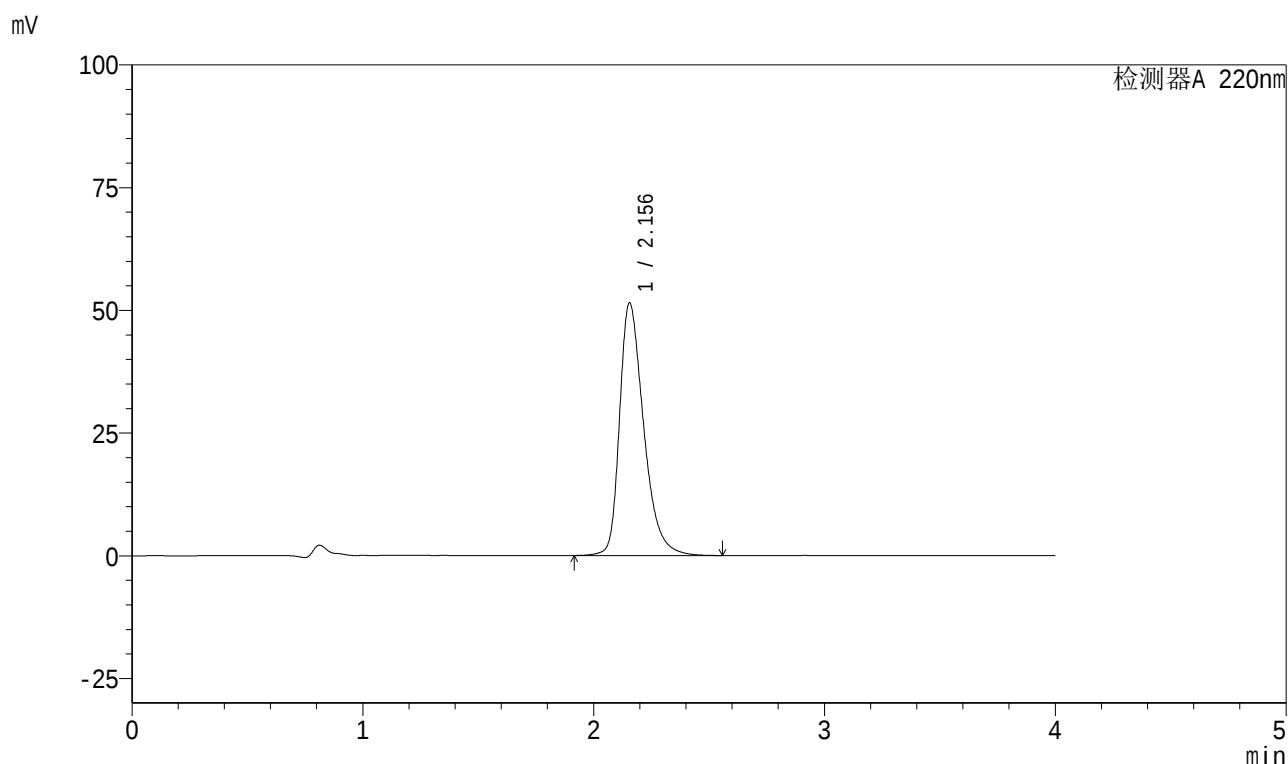

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	373468	100.000	51478	2159	1.373	--
总计		373468	100.000	51478			

图78 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-20min-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-194-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:21:29
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

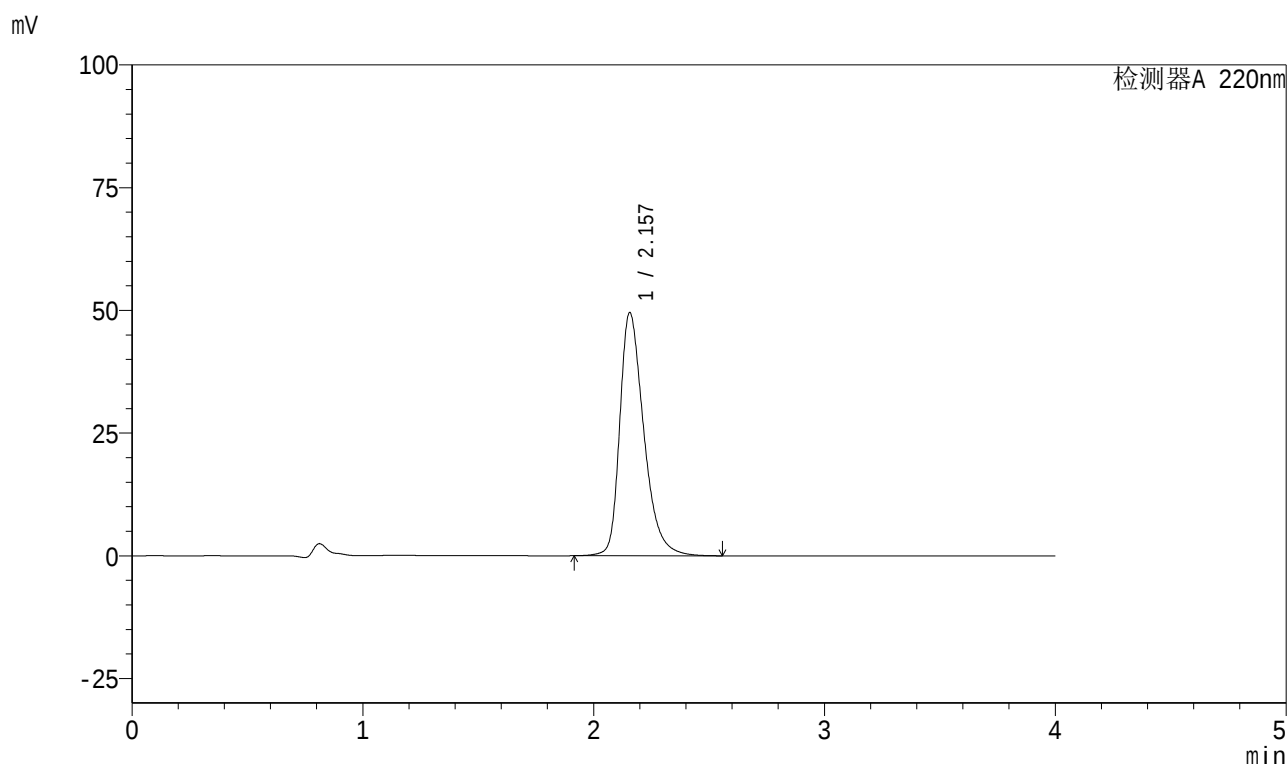

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	358769	100.000	49531	2172	1.366	--
总计		358769	100.000	49531			

图79 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-20min-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-195-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:25:52
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:55:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

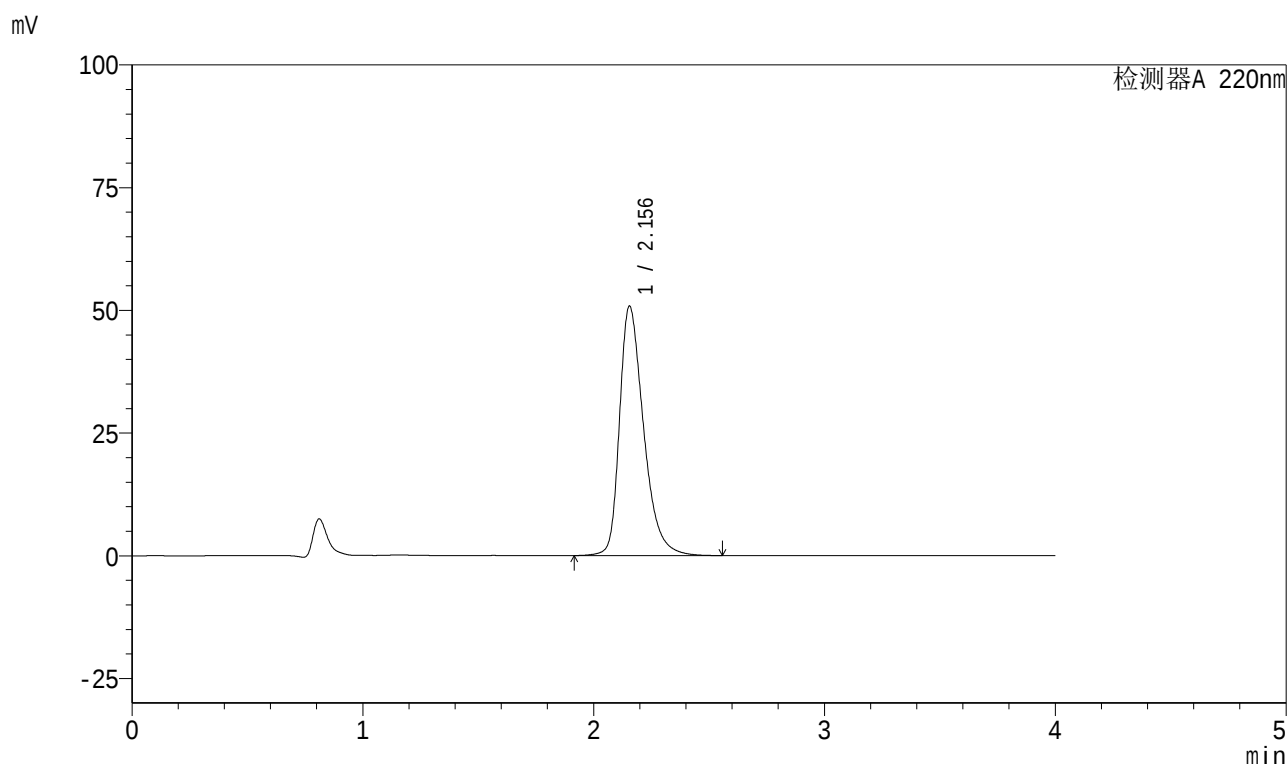

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	368478	100.000	50837	2163	1.371	--
总计		368478	100.000	50837			

图80 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-196-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:30:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

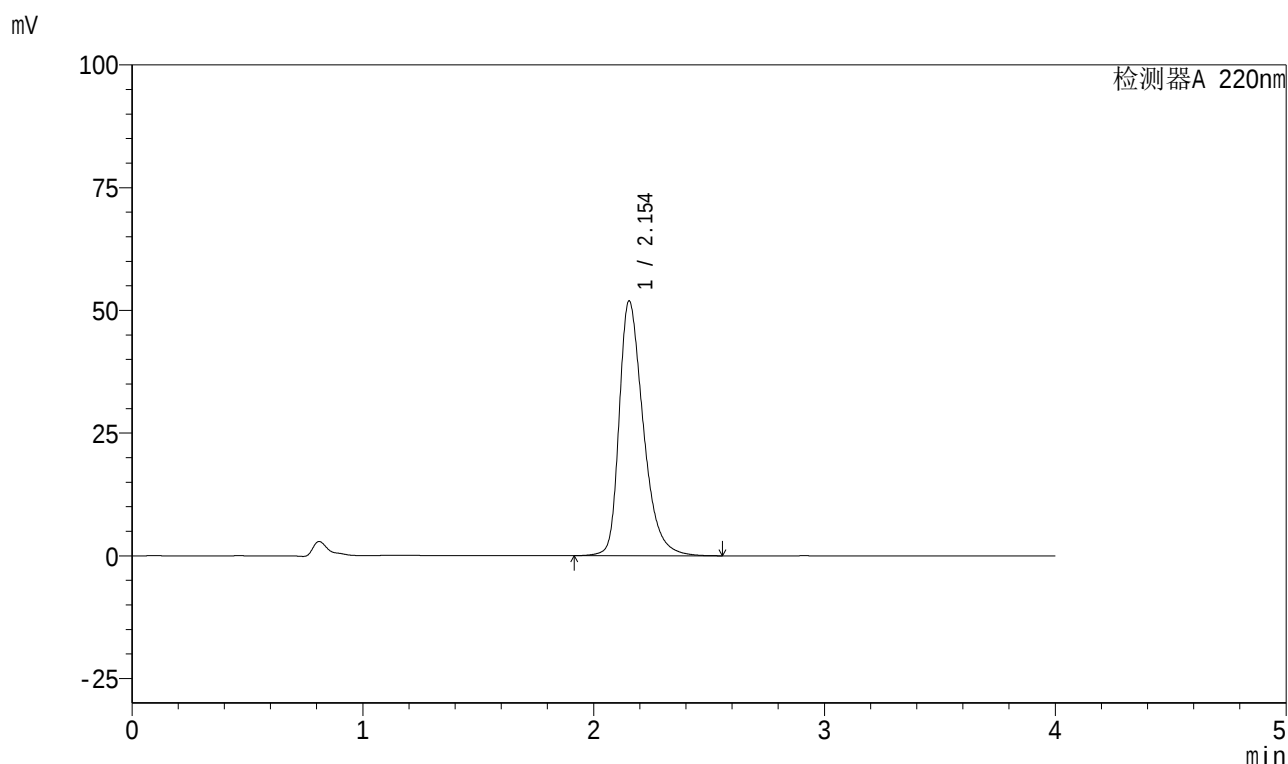

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	377067	100.000	51922	2150	1.375	--
总计		377067	100.000	51922			

图81 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-30min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-197-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:34:38
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

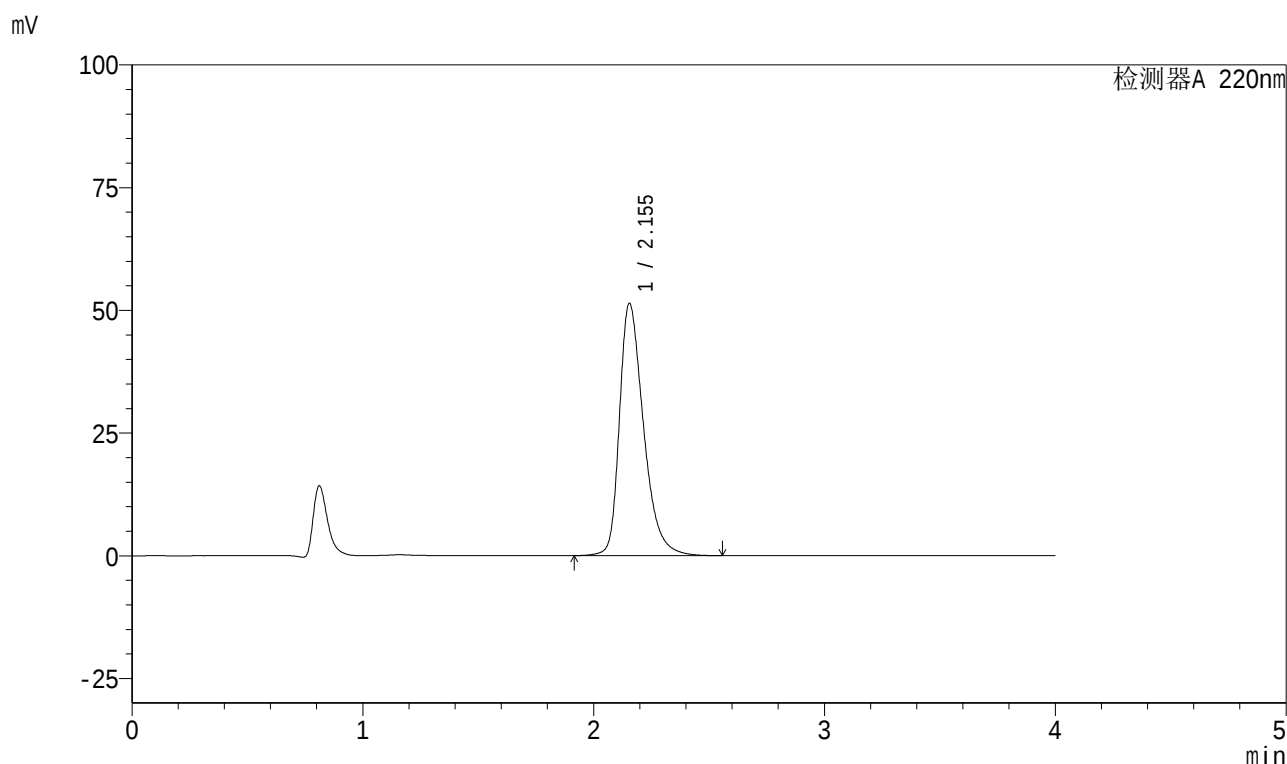

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	372820	100.000	51431	2163	1.373	--
总计		372820	100.000	51431			

图82 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-30min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-198-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:39:02
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

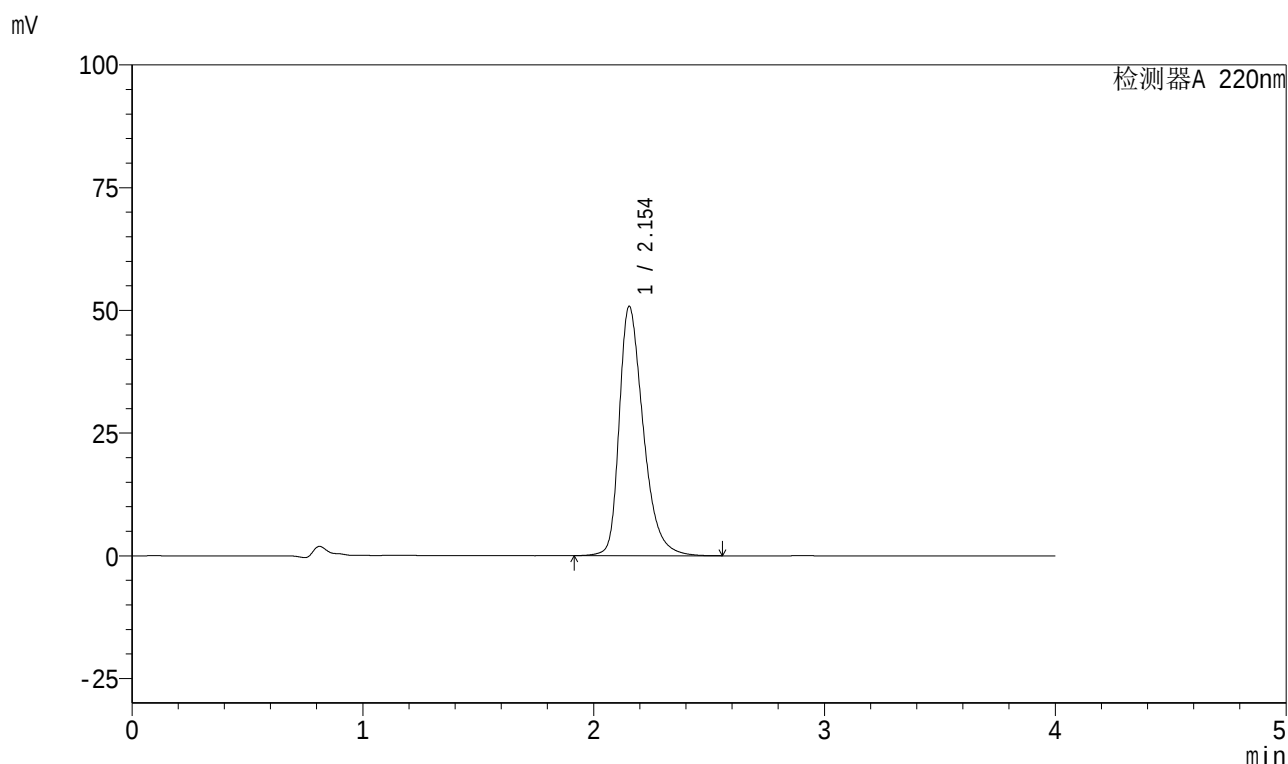

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	368051	100.000	50815	2165	1.370	--
总计		368051	100.000	50815			

图83 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-30min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-199-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:43:25
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

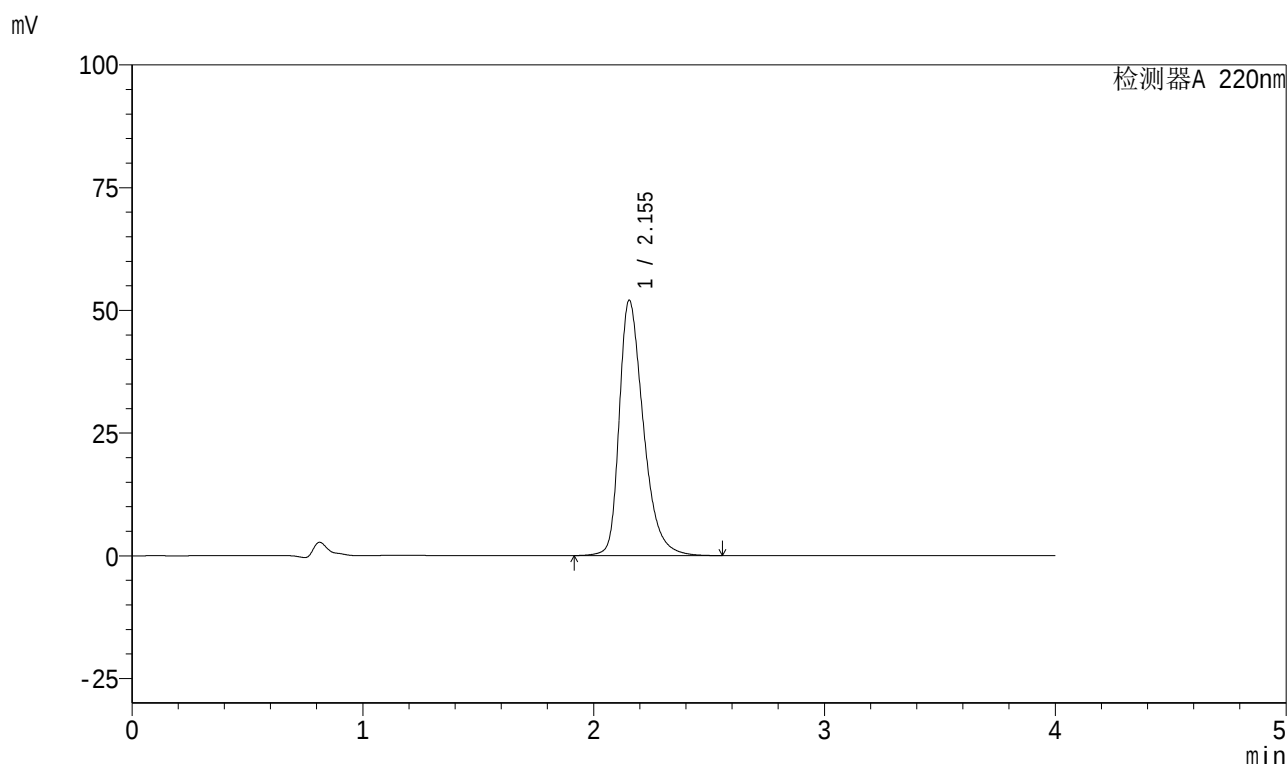

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	377811	100.000	52046	2154	1.375	--
总计		377811	100.000	52046			

图84 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-200-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 22:47:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

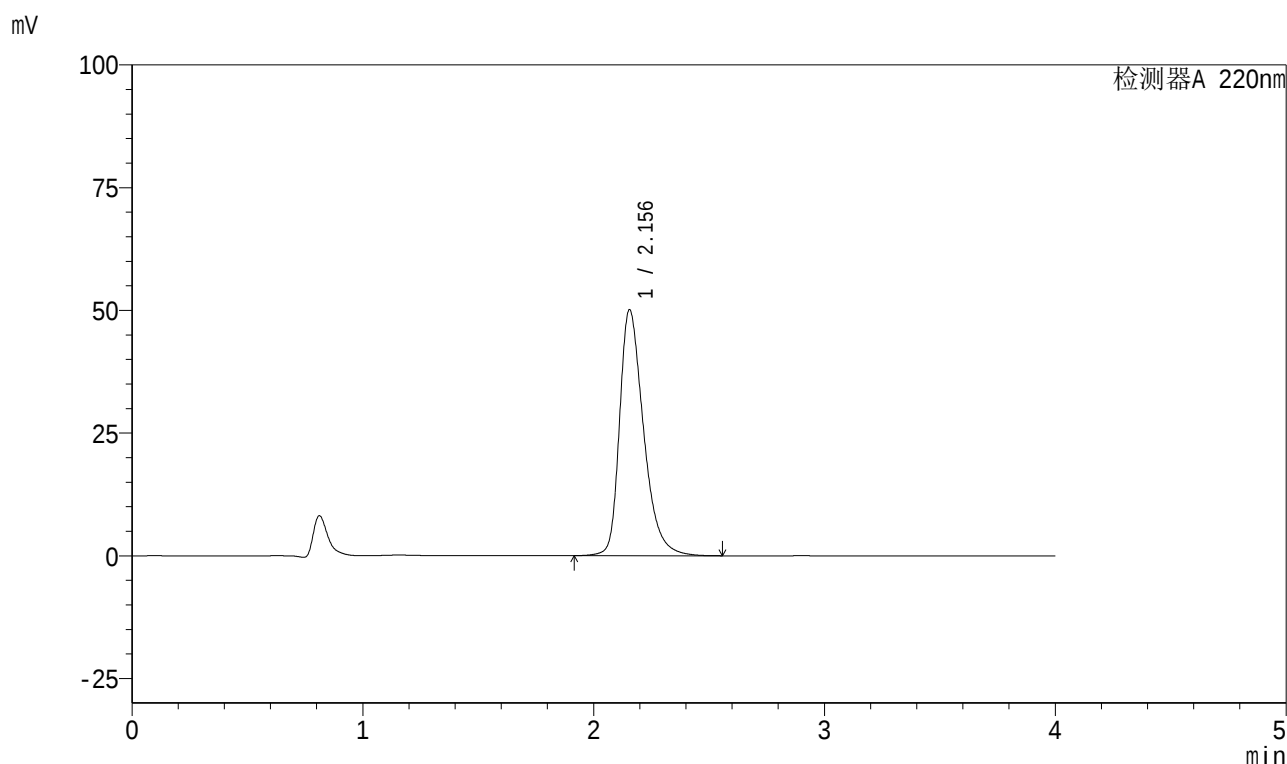

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	362883	100.000	50141	2170	1.368	--
总计		362883	100.000	50141			

图85 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-30min-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-201-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:52:12
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

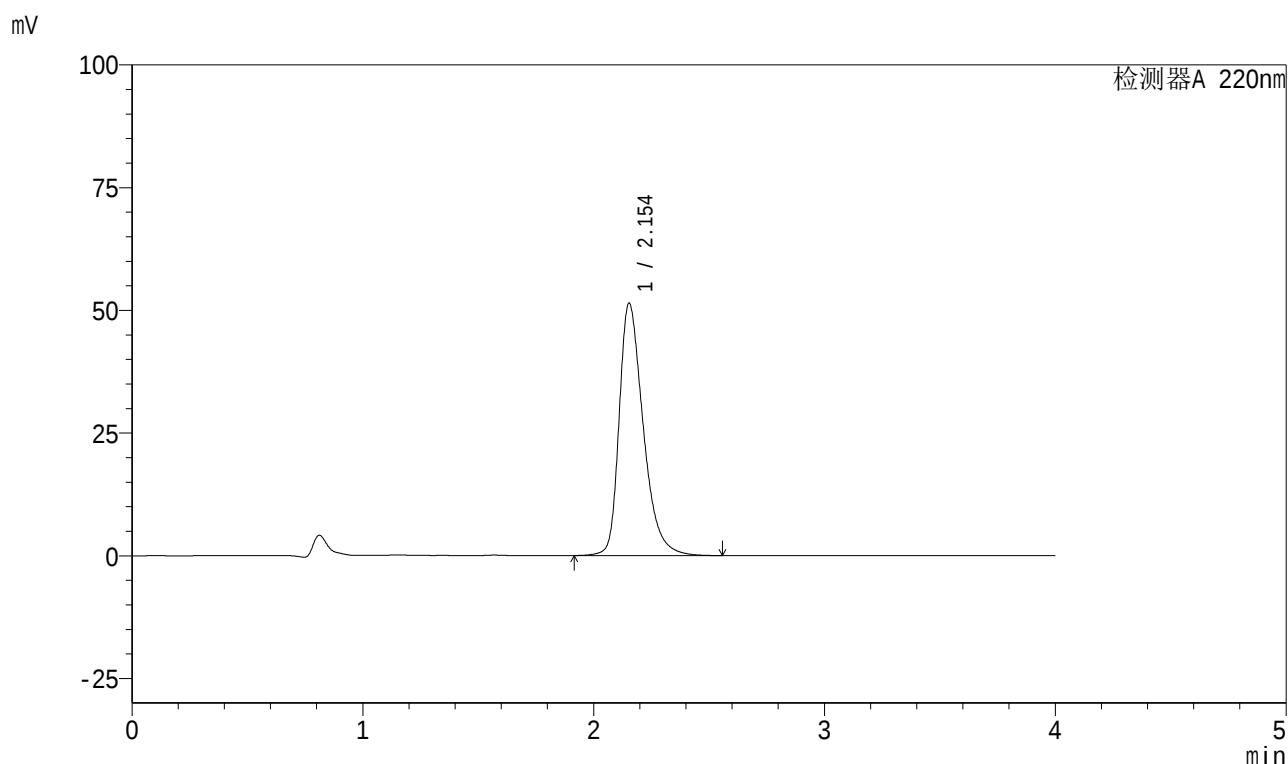

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	372878	100.000	51420	2158	1.373	--
总计		372878	100.000	51420			

图86 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-30min-片6
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-202-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 22:56:36
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

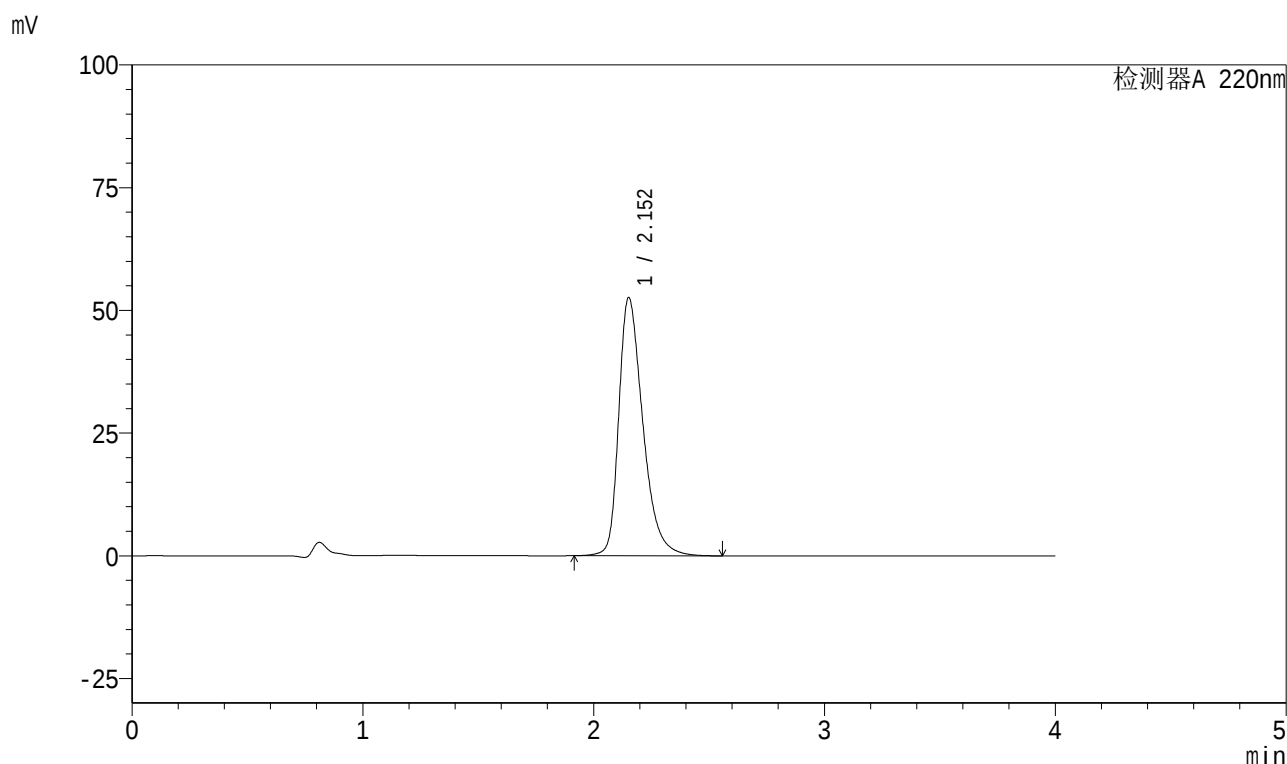

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	382307	100.000	52533	2145	1.379	--
总计		382307	100.000	52533			

图87 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-203-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-45min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb	
样品瓶号: 2-15	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 23:01:00	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:17	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)	

<色谱图>

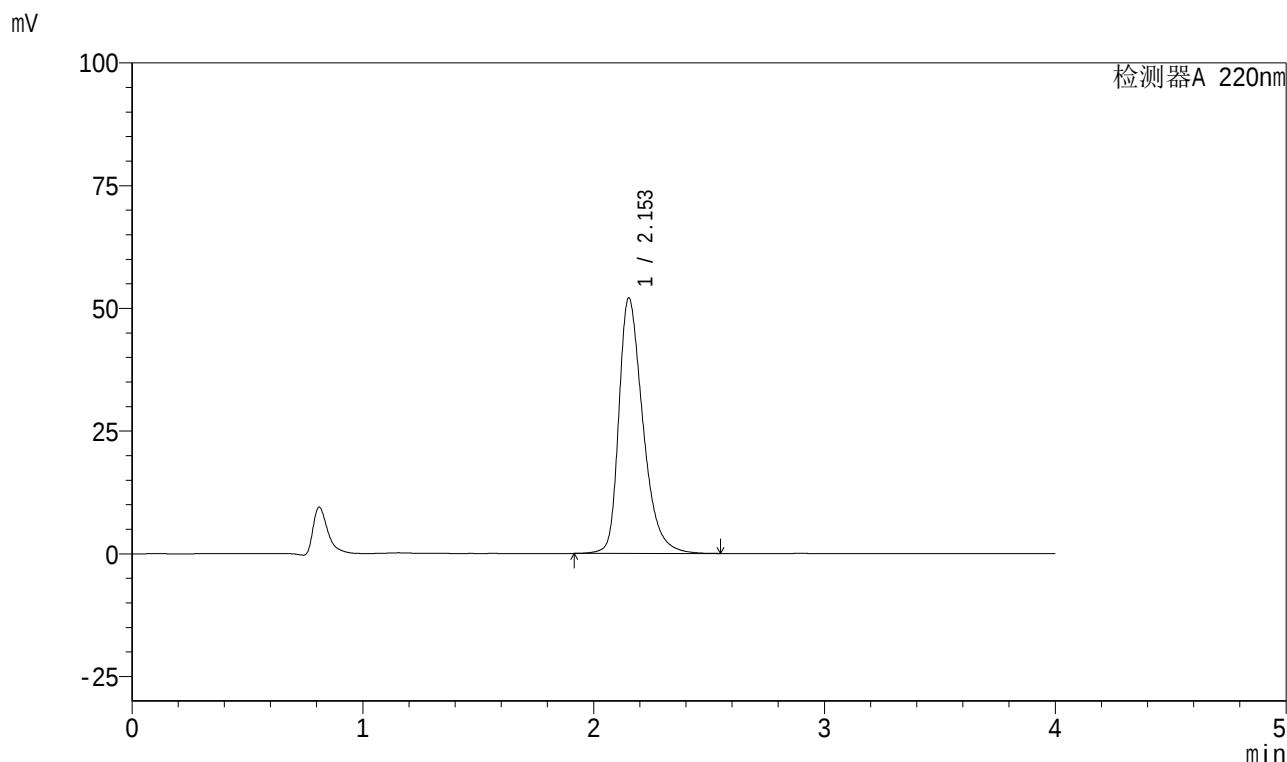

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	377604	100.000	52002	2154	1.376	--
总计		377604	100.000	52002			

图88 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-45min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-204-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:05:24
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

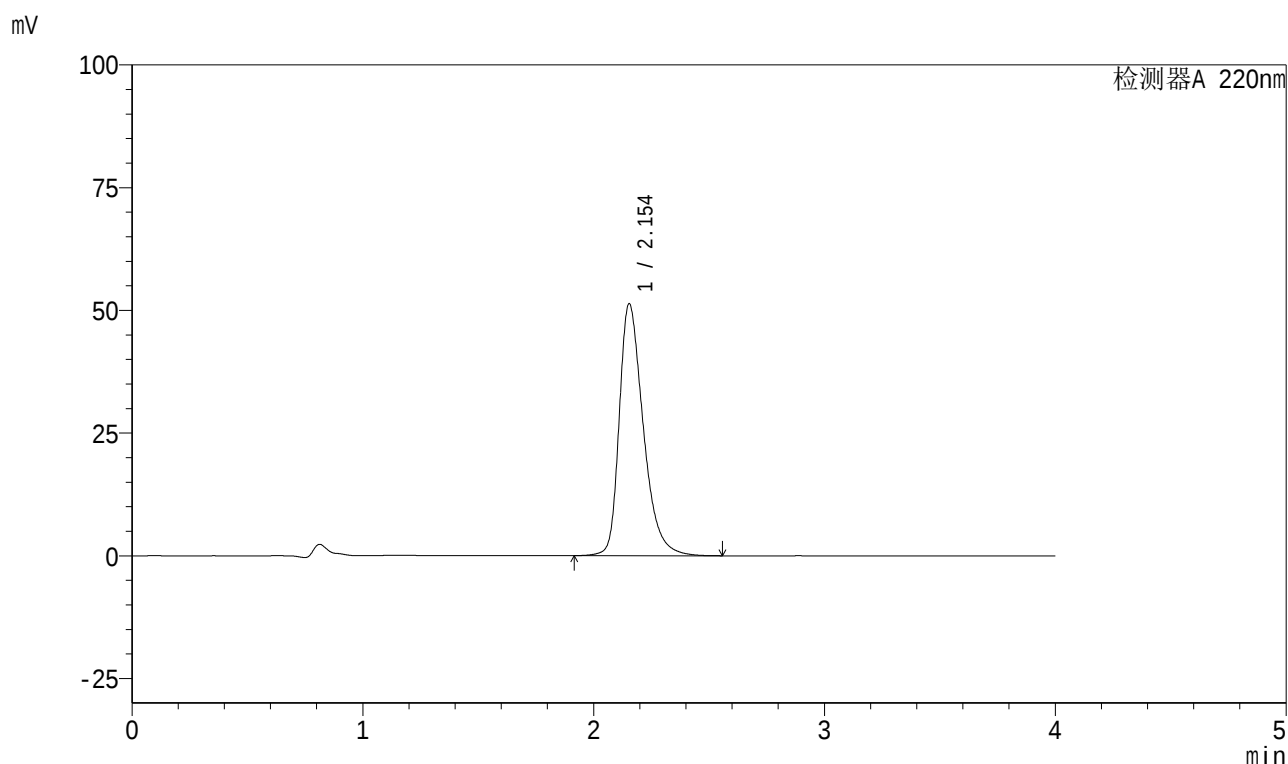

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	372224	100.000	51352	2160	1.373	--
总计		372224	100.000	51352			

图89 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-205-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:09:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

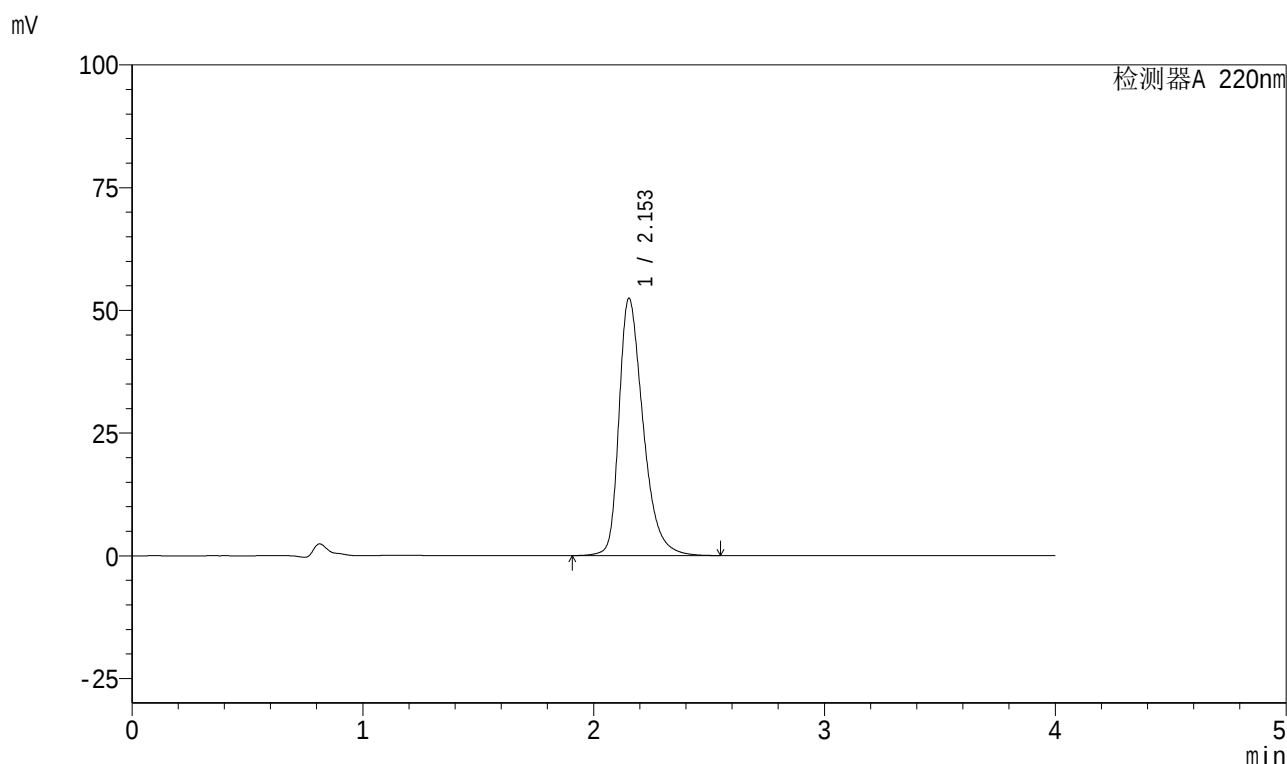

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	380671	100.000	52403	2151	1.377	--
总计		380671	100.000	52403			

图90 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-45min-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-206-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:14:10
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

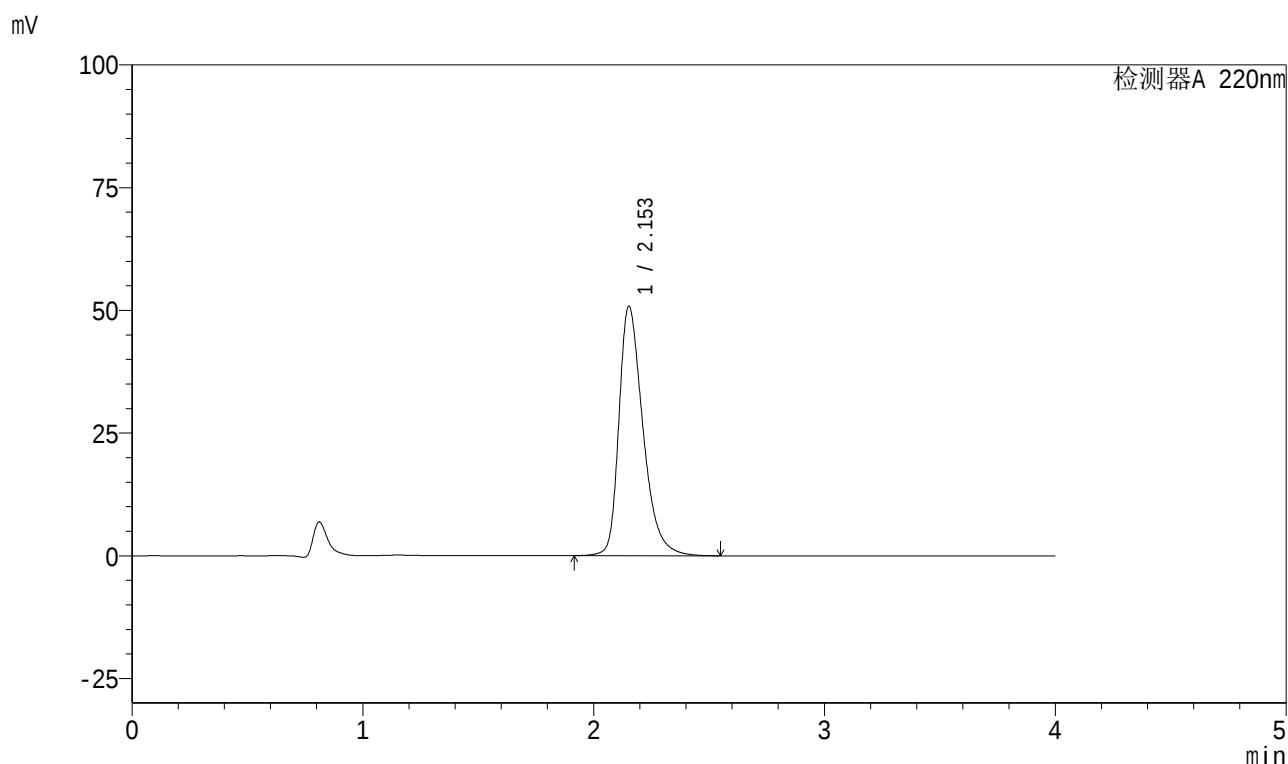

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	368081	100.000	50795	2164	1.372	--
总计		368081	100.000	50795			

图91 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-207-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:18:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

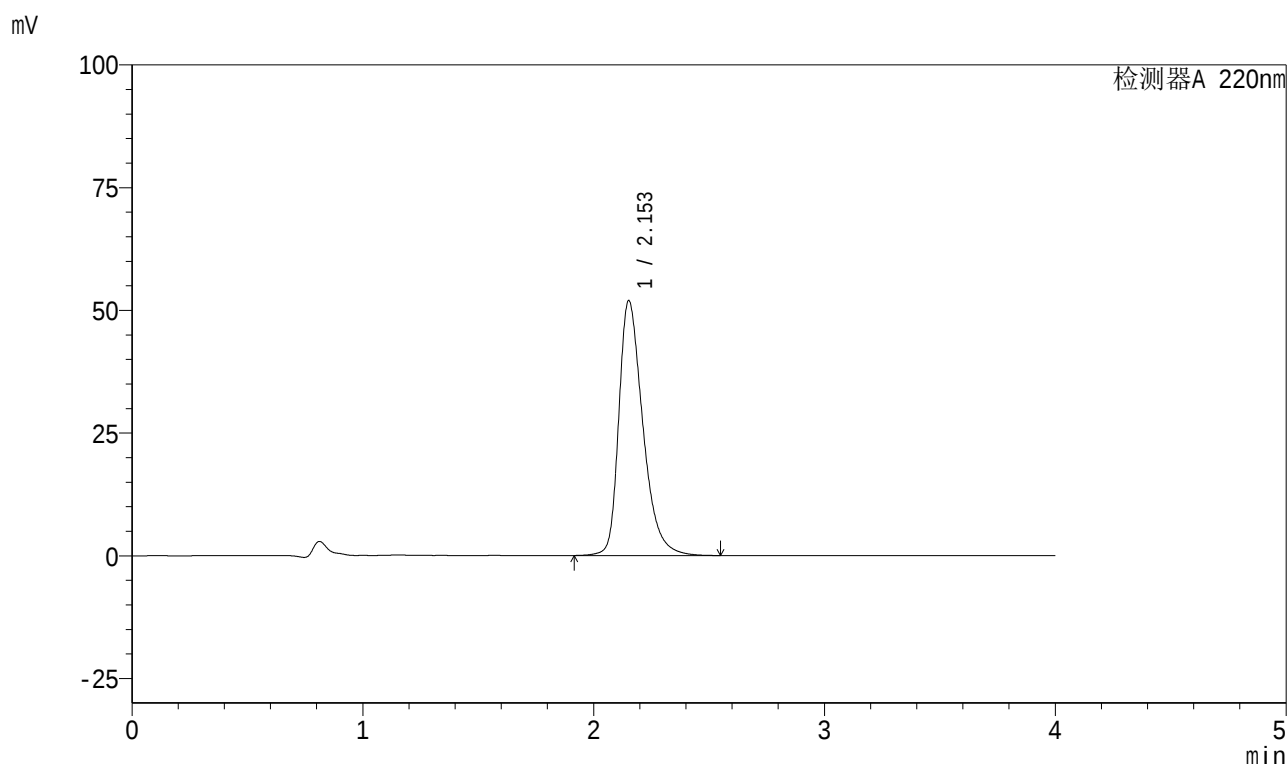

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	376597	100.000	51854	2154	1.376	--
总计		376597	100.000	51854			

图92 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-45min-片6
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-208-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:22:58
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

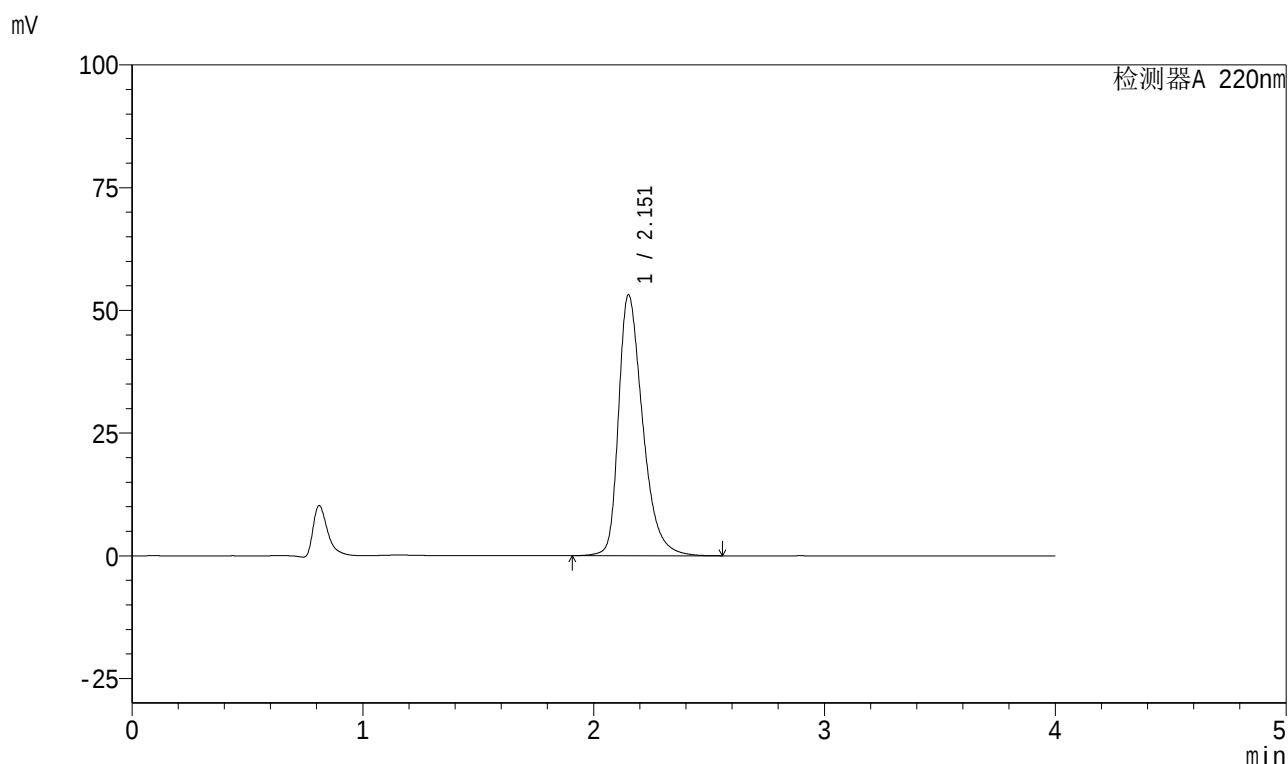

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	386293	100.000	53004	2143	1.382	--
总计		386293	100.000	53004			

图93 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-209-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:27:21 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:32 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

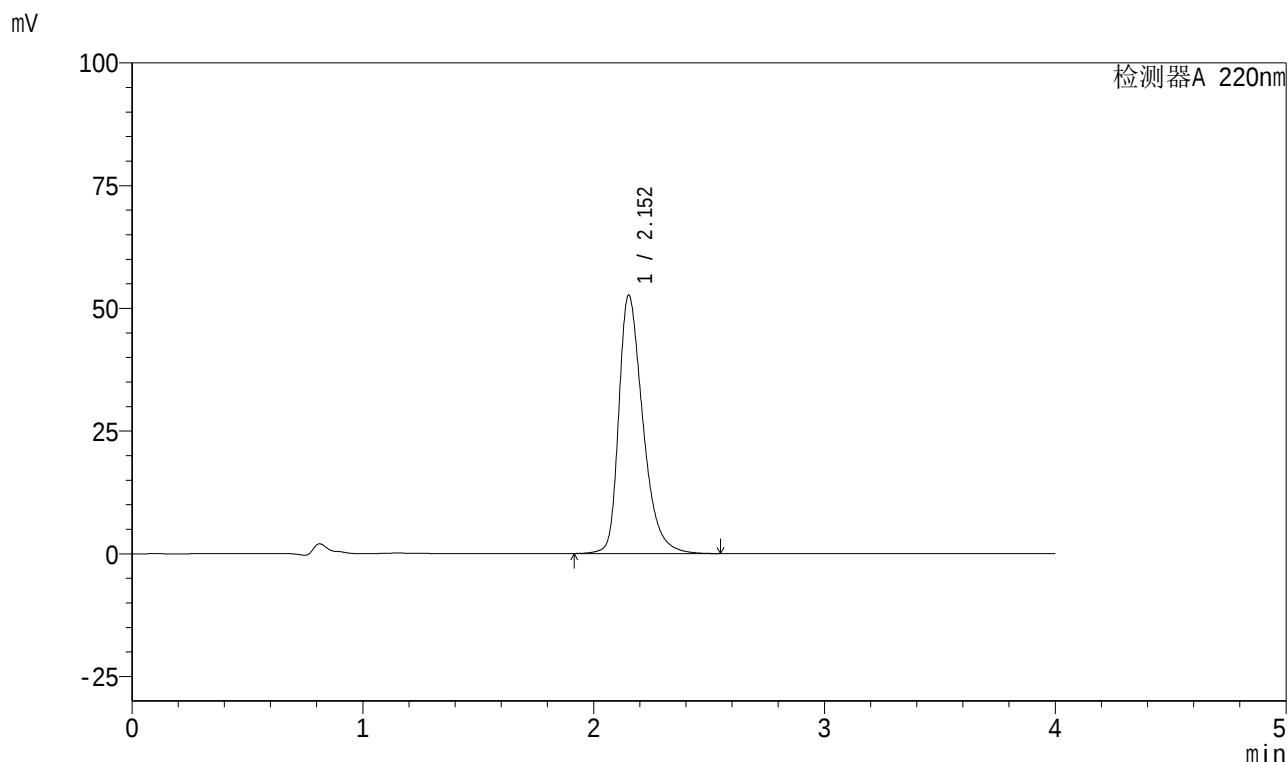

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	382242	100.000	52568	2148	1.379	--
总计		382242	100.000	52568			

图94 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-210-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-jx-P3.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb	
样品瓶号: 2-25	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/25 23:31:45	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:35	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)	

<色谱图>

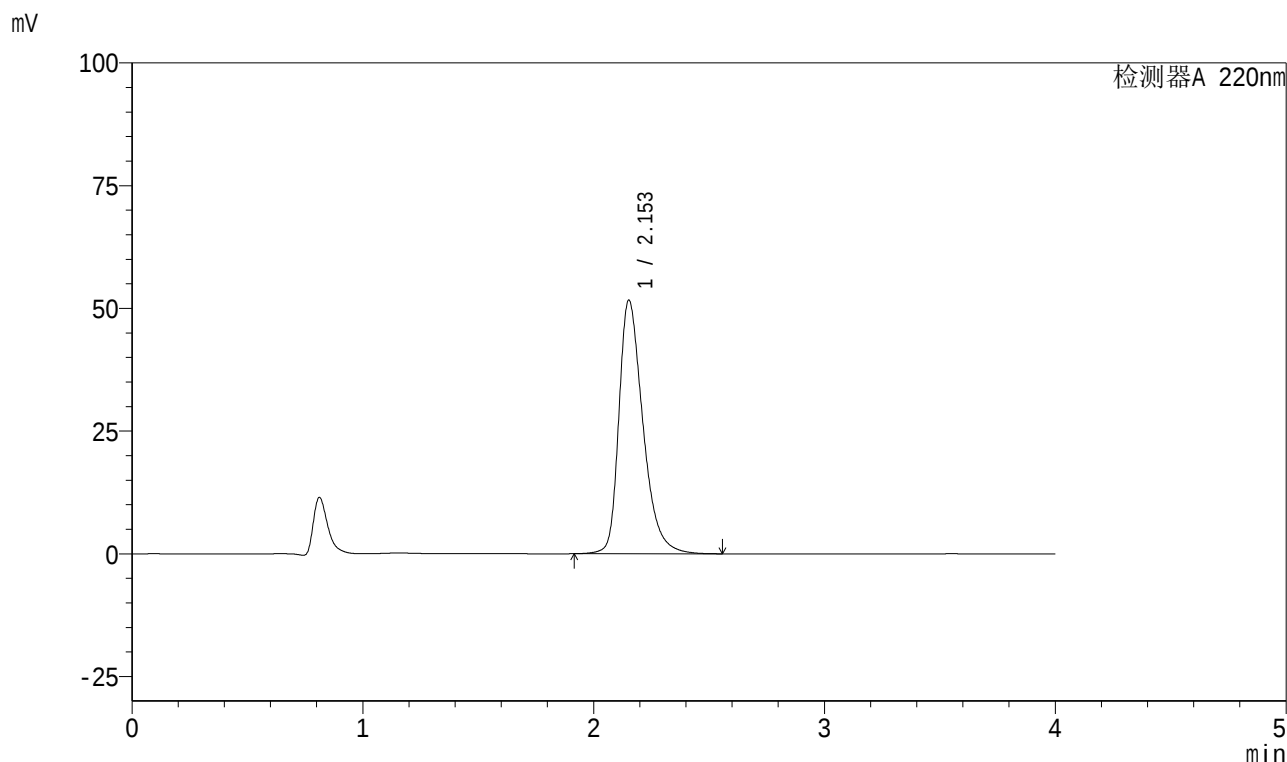

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	374629	100.000	51634	2159	1.374	--
总计		374629	100.000	51634			

图95 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-211-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:36:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

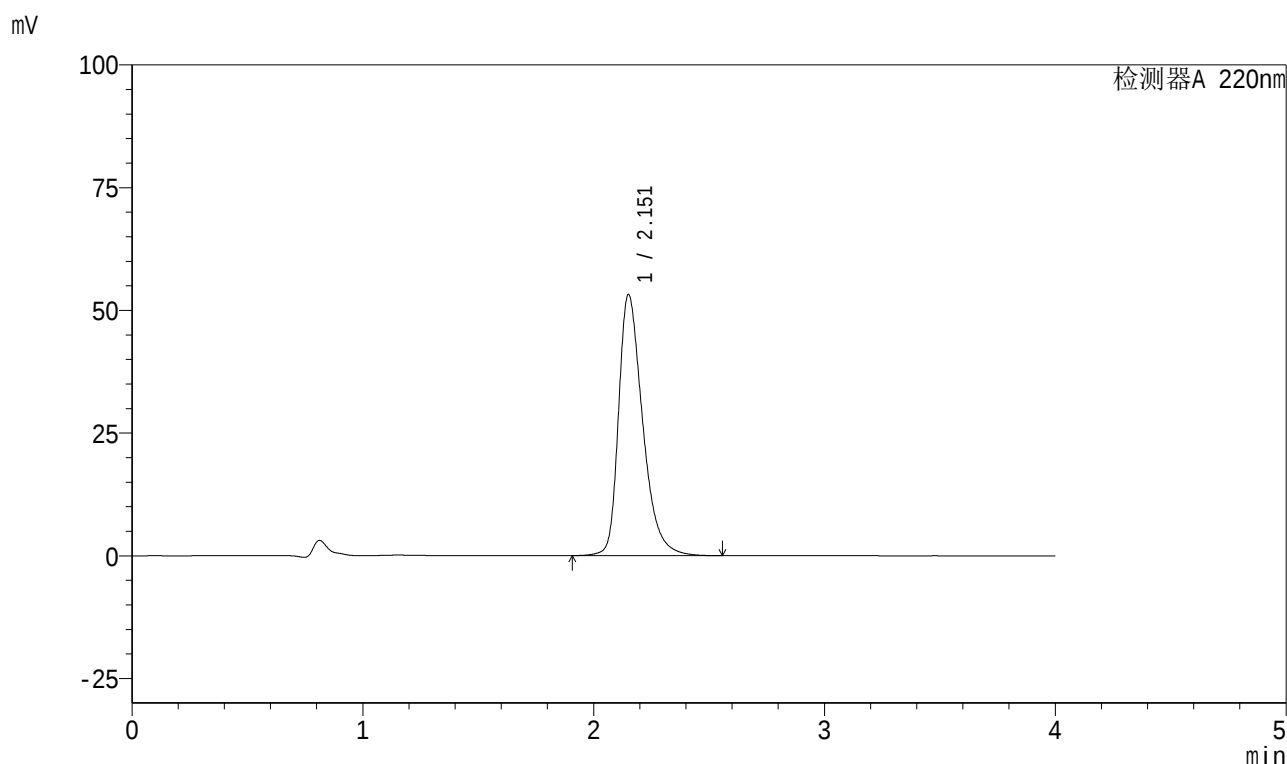

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	386725	100.000	53053	2143	1.382	--
总计		386725	100.000	53053			

图96 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-212-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:40:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

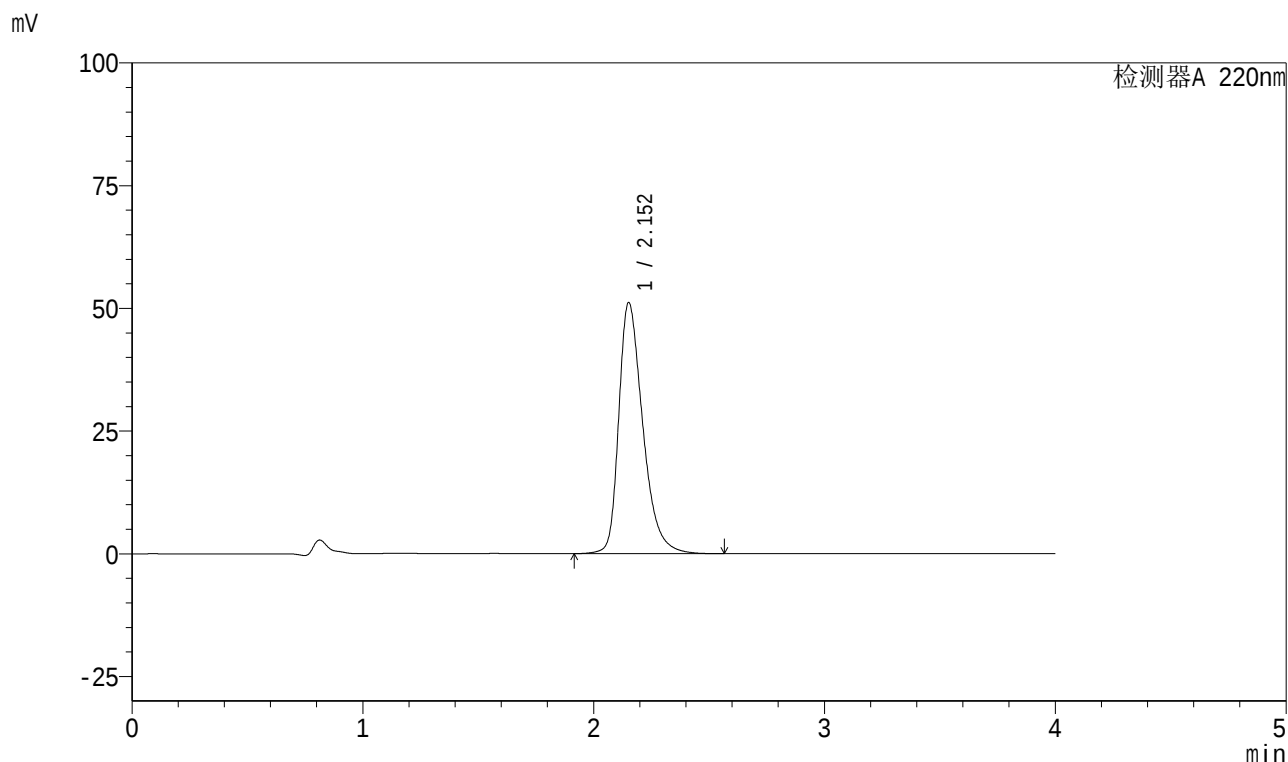

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	370531	100.000	51083	2162	1.373	--
总计		370531	100.000	51083			

图97 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-213-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/25 23:44:57
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

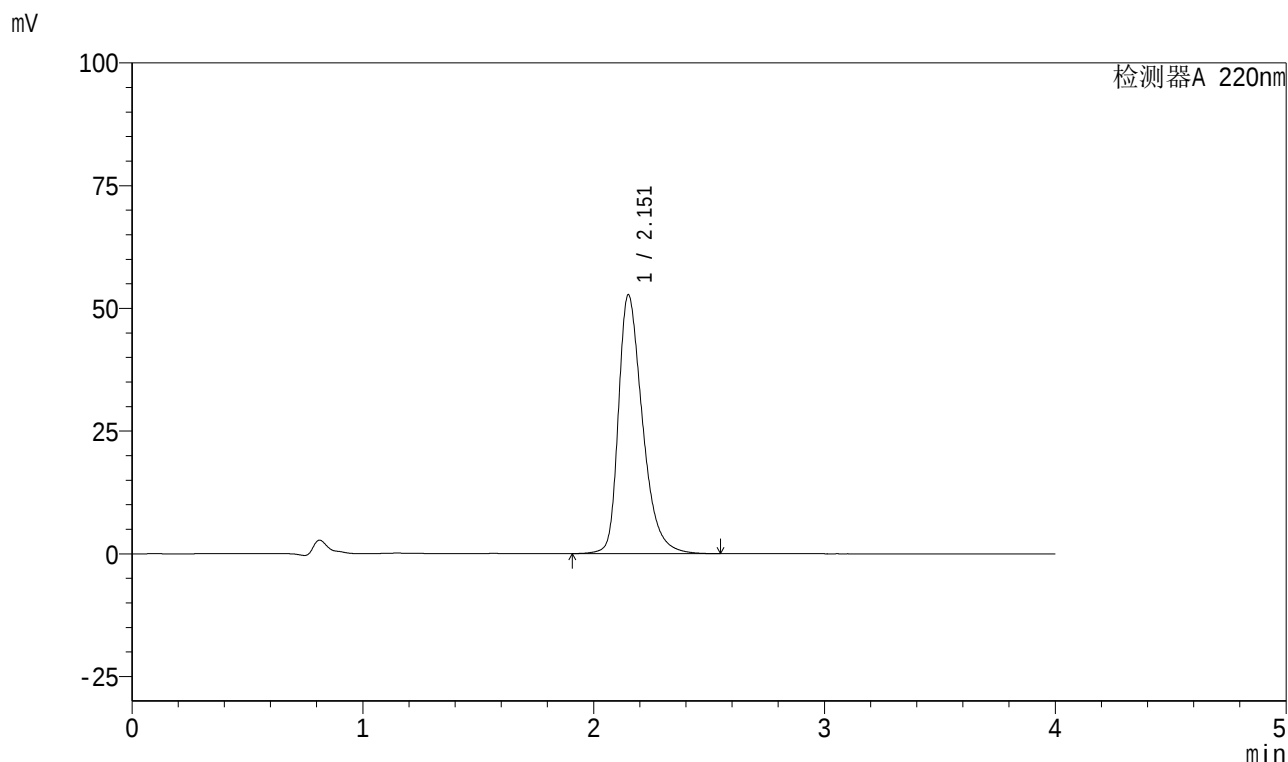

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	382726	100.000	52548	2148	1.381	--
总计		382726	100.000	52548			

图98 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-214-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:49:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

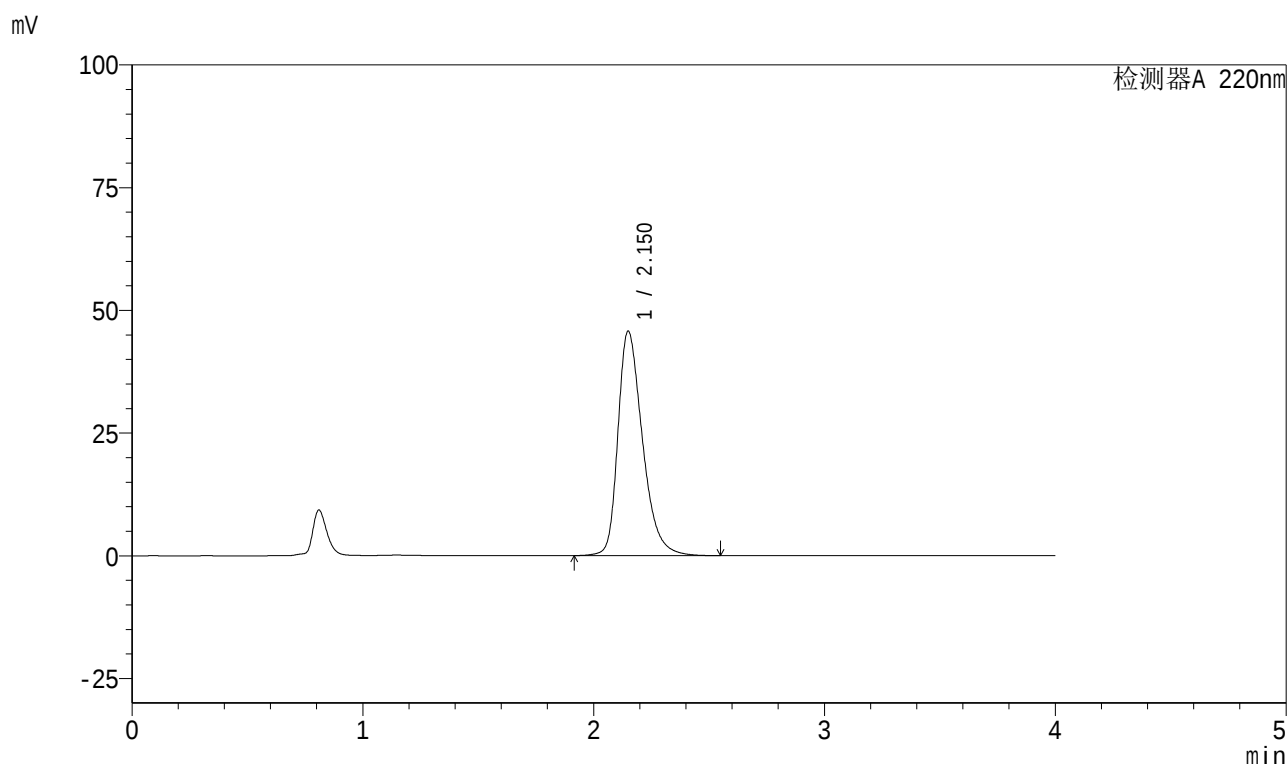

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	338402	100.000	45647	2054	1.351	--
总计		338402	100.000	45647			

图99 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-215-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-shuijz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:53:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

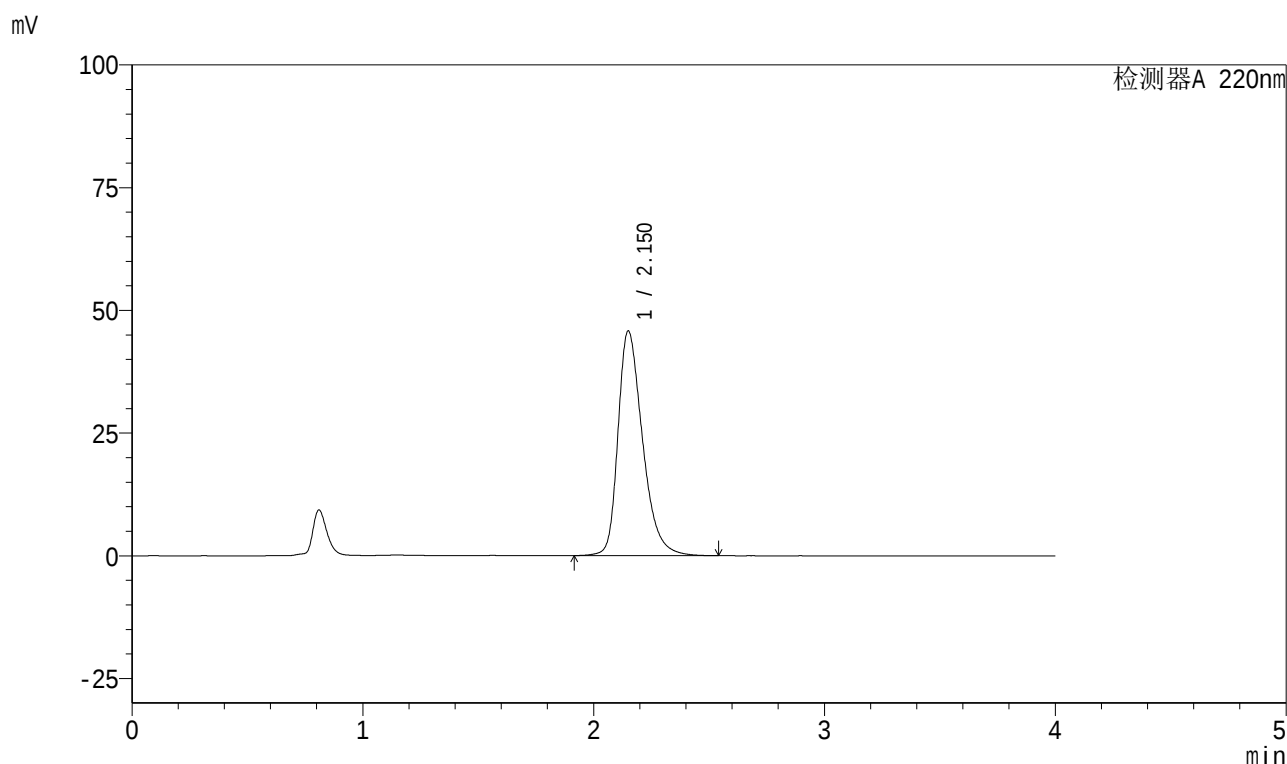

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	338596	100.000	45665	2054	1.351	--
总计		338596	100.000	45665			

图100 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-水介质
对照品溶液-2-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-216-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/25 23:58:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

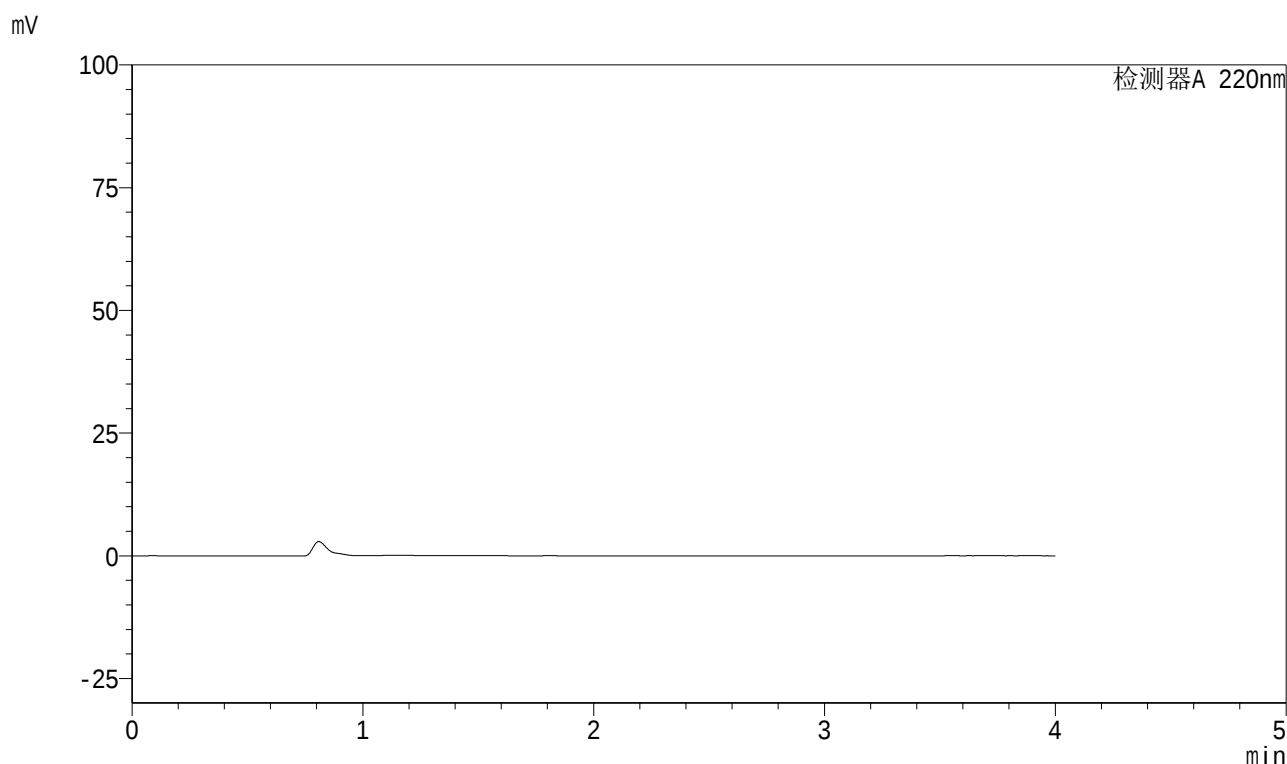

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-217-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:02:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

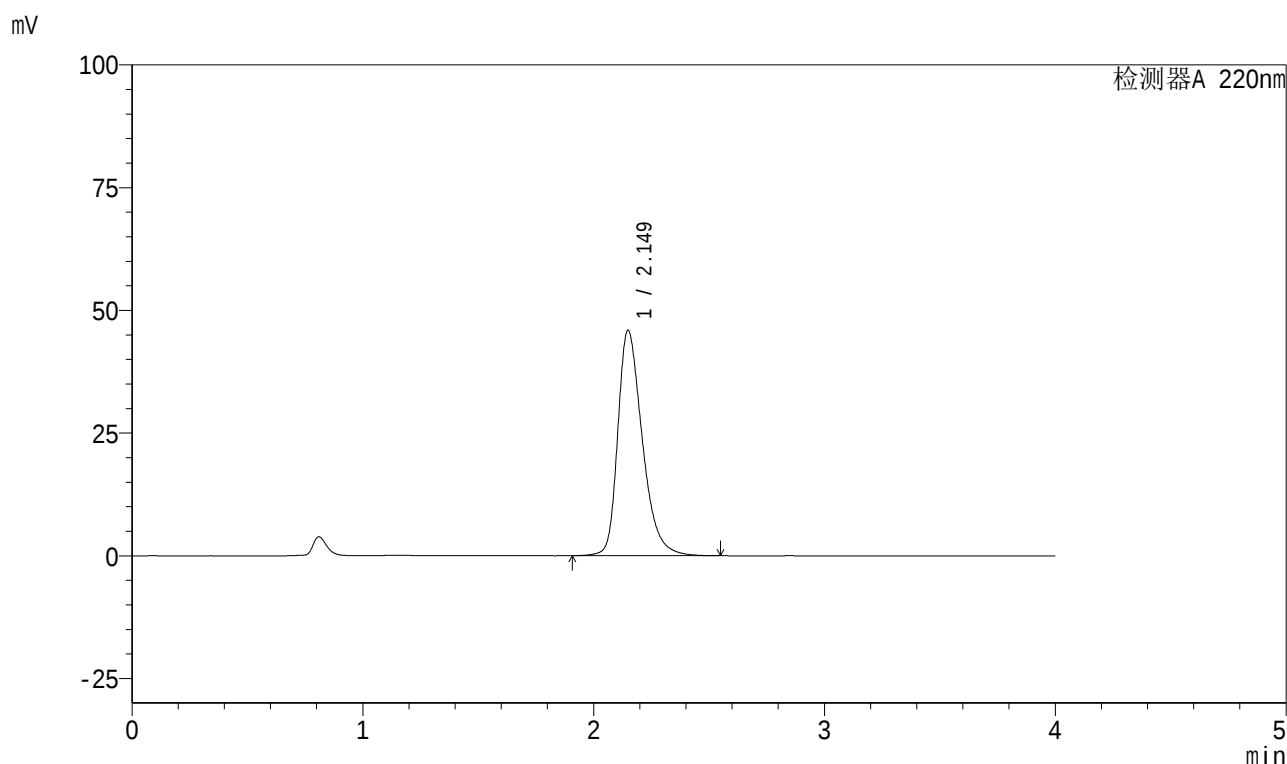

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	339624	100.000	45857	2055	1.351	--
总计		339624	100.000	45857			

图102 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-218-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:06:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

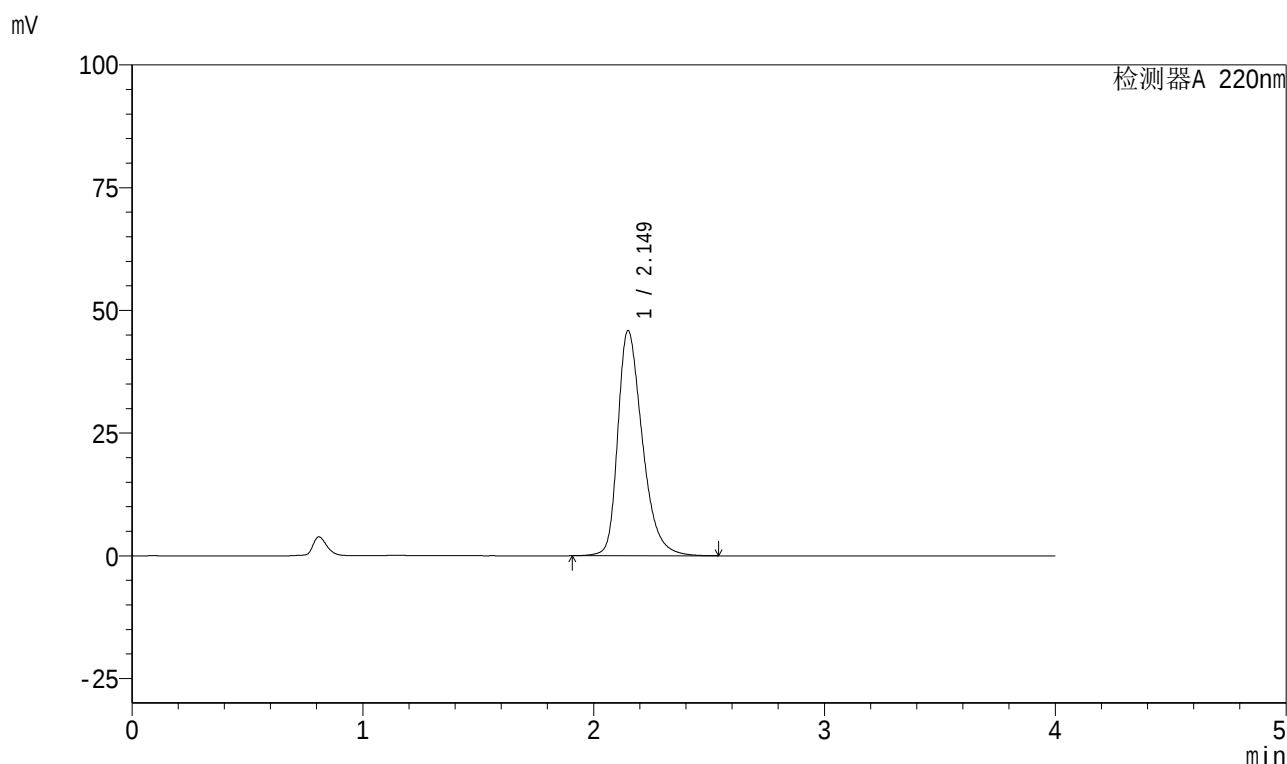

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	339671	100.000	45838	2052	1.352	--
总计		339671	100.000	45838			

图103 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-219-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:11:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:56:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

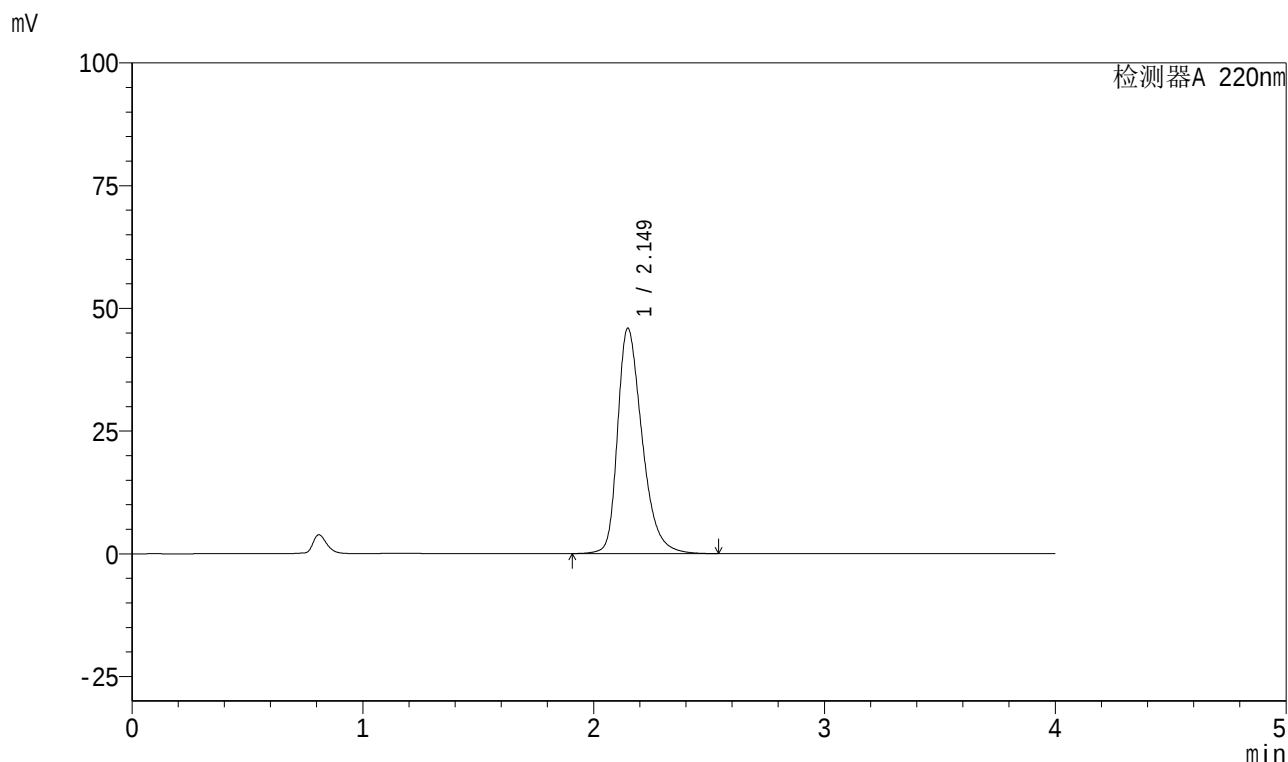

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	339570	100.000	45911	2054	1.350	--
总计		339570	100.000	45911			

图104 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-220-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:15:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

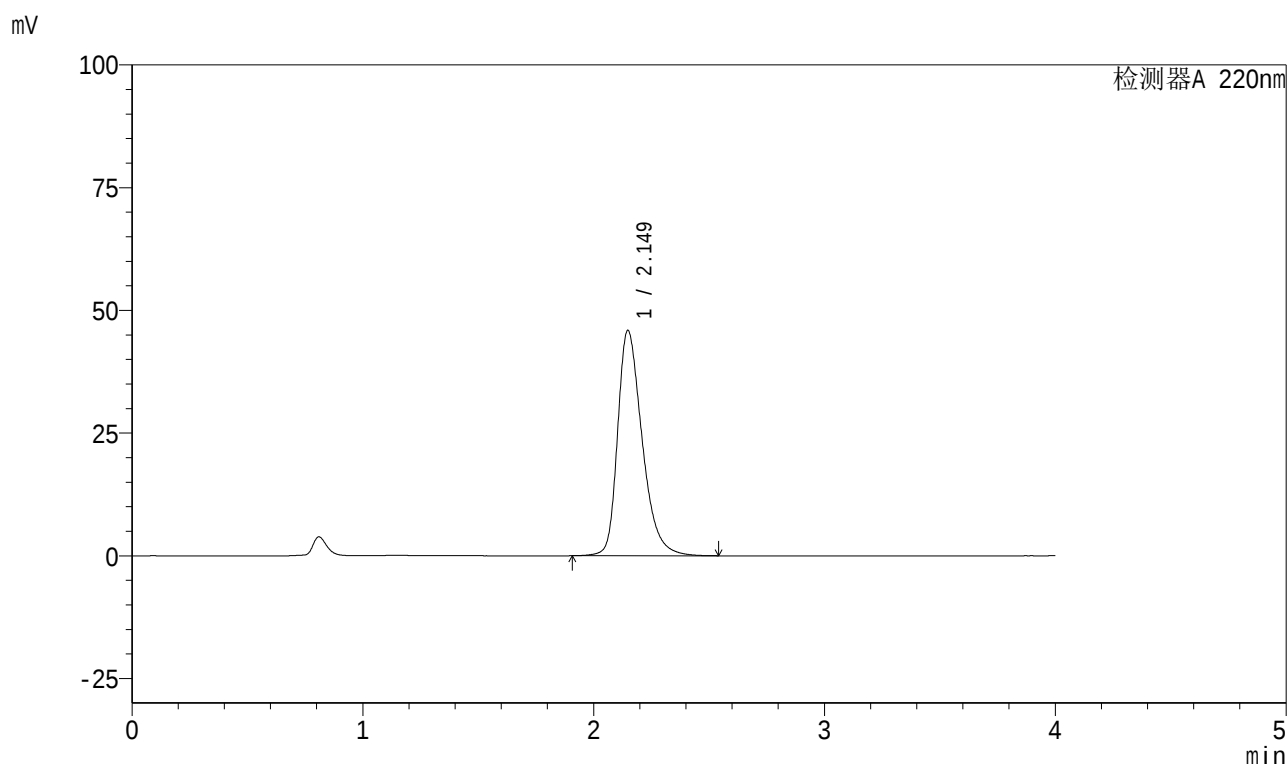

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	339624	100.000	45900	2052	1.350	--
总计		339624	100.000	45900			

图105 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-221-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:19:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

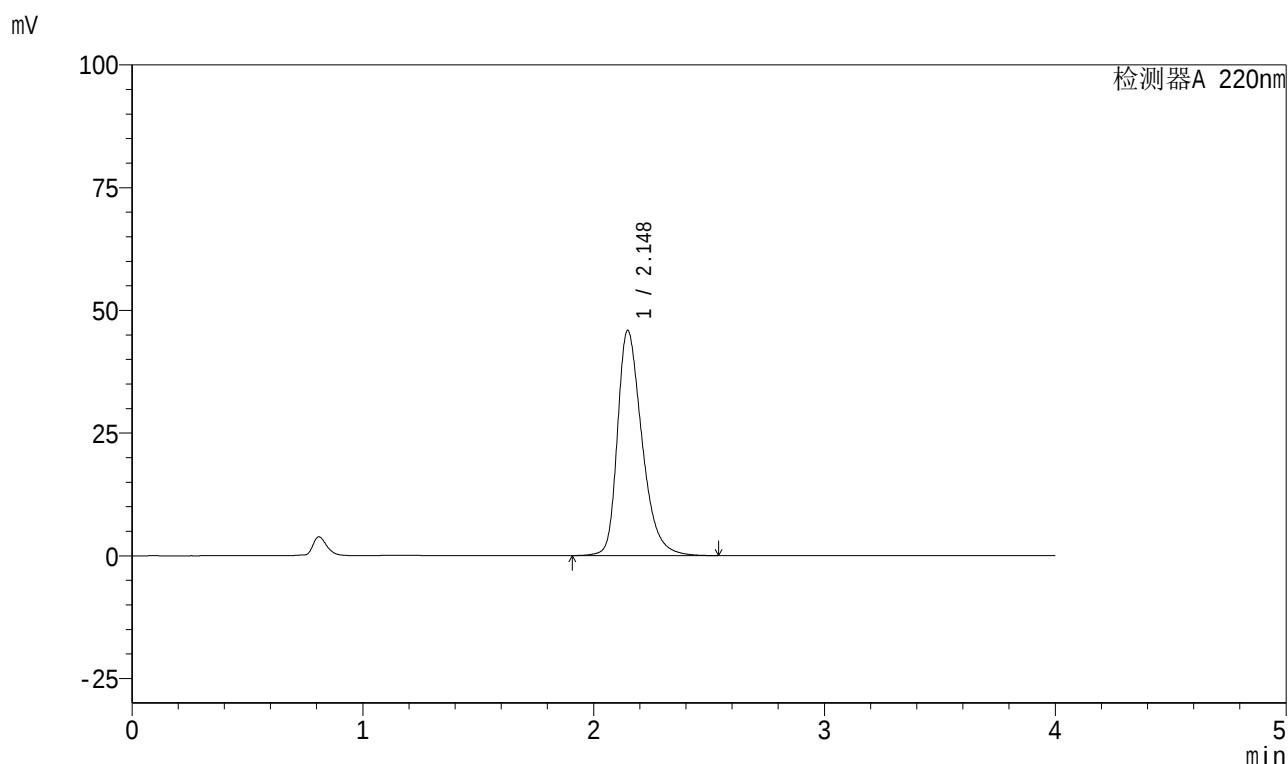

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	339533	100.000	45895	2051	1.351	--
总计		339533	100.000	45895			

图106 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-222-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 00:24:20
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

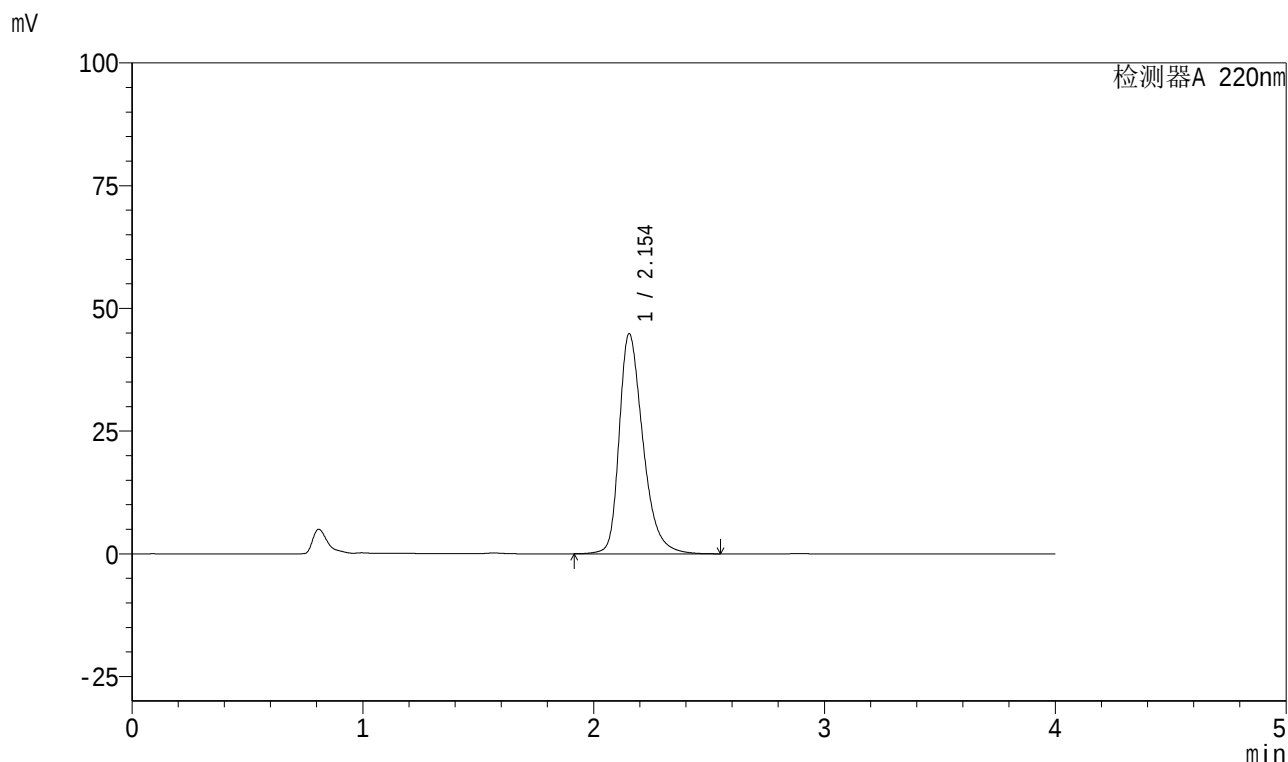

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	321148	100.000	44856	2222	1.346	--
总计		321148	100.000	44856			

图107 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-223-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:28:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

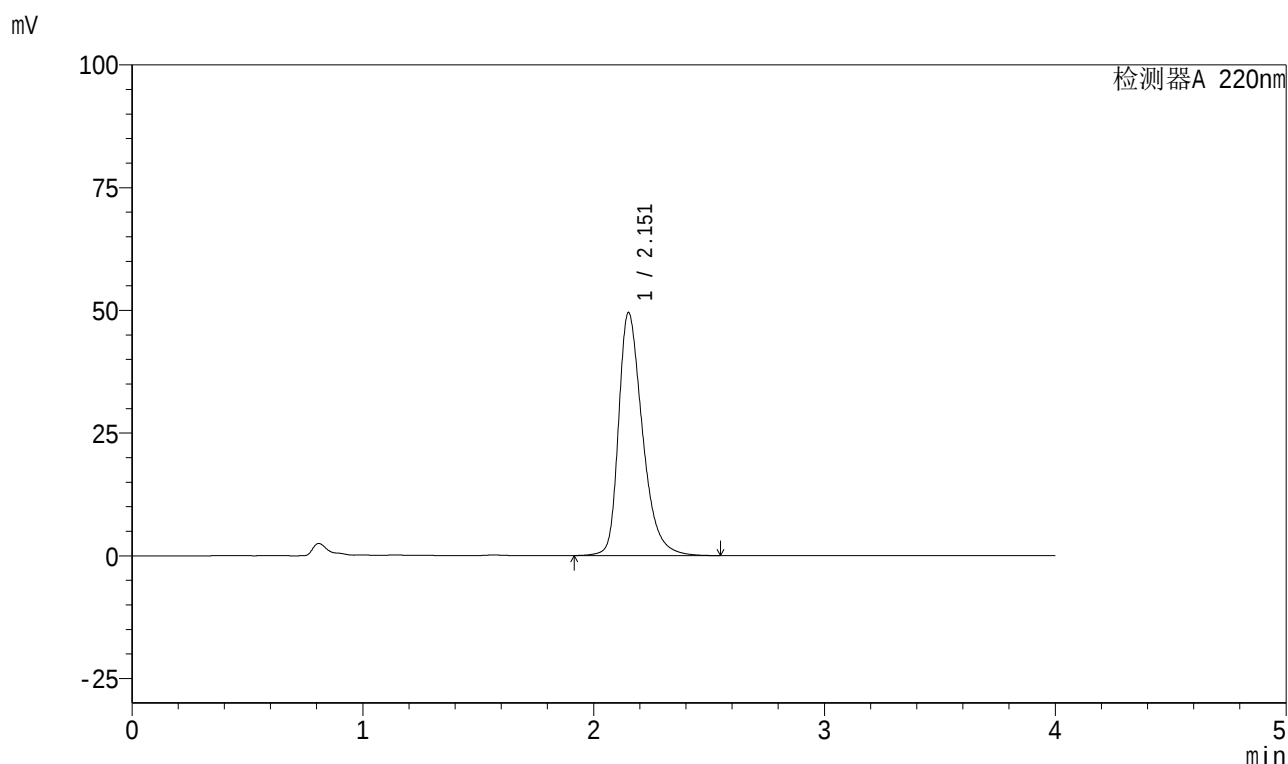

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	356666	100.000	49365	2187	1.367	--
总计		356666	100.000	49365			



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-224-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 00:33:04
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

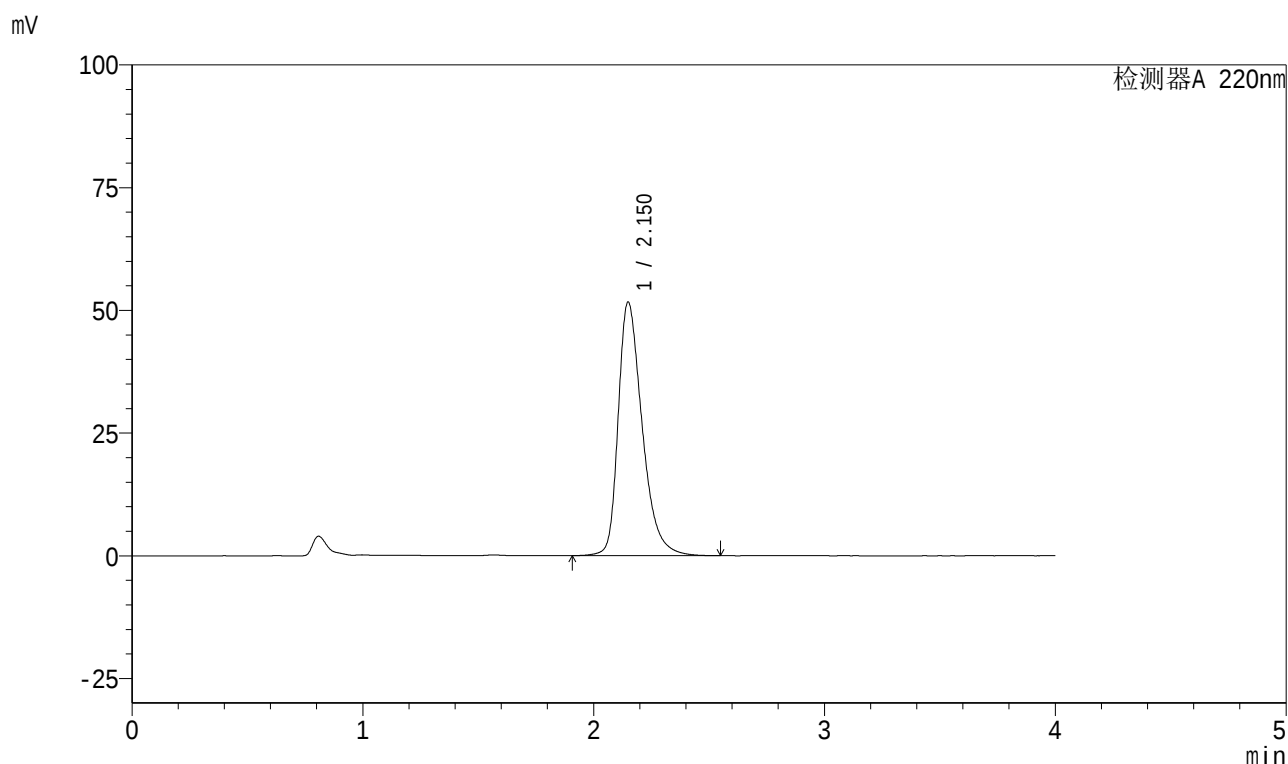

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	373555	100.000	51581	2167	1.375	--
总计		373555	100.000	51581			

图109 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-225-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:37:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

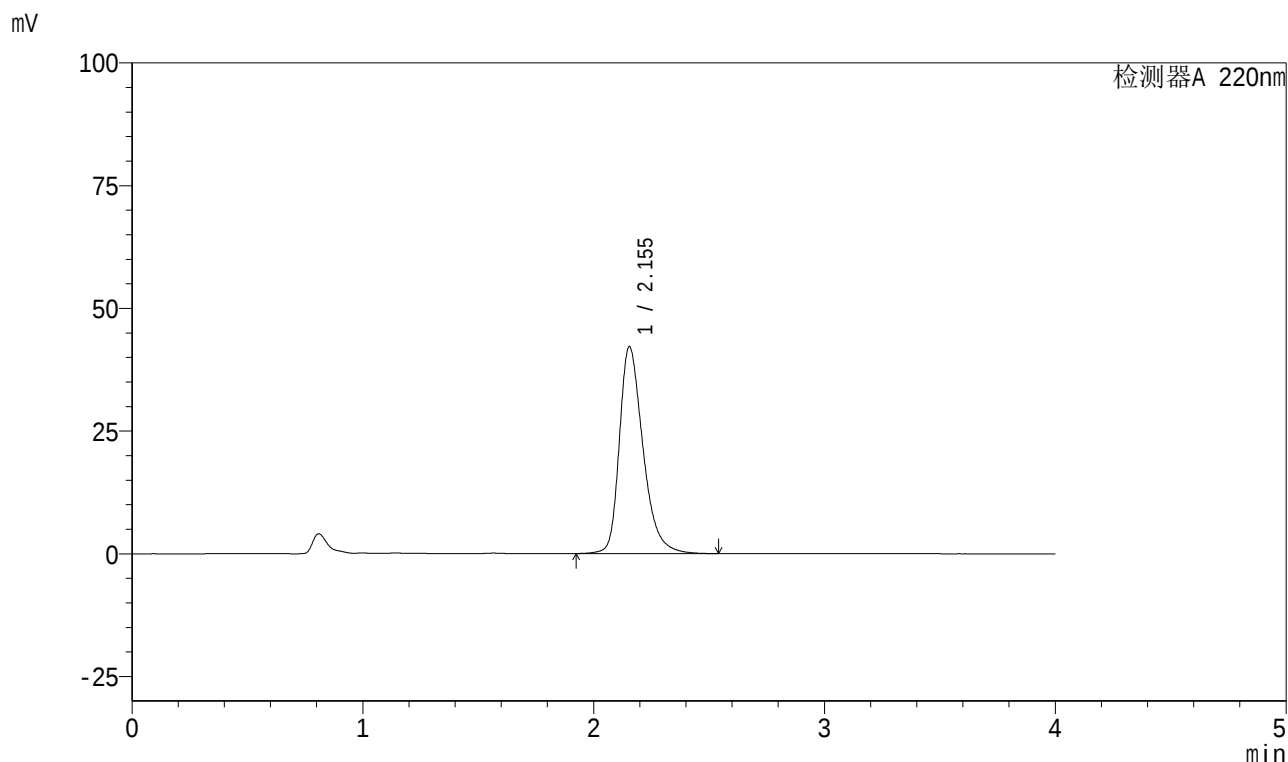

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	300401	100.000	42174	2248	1.335	--
总计		300401	100.000	42174			

图110 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-226-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 00:41:47
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

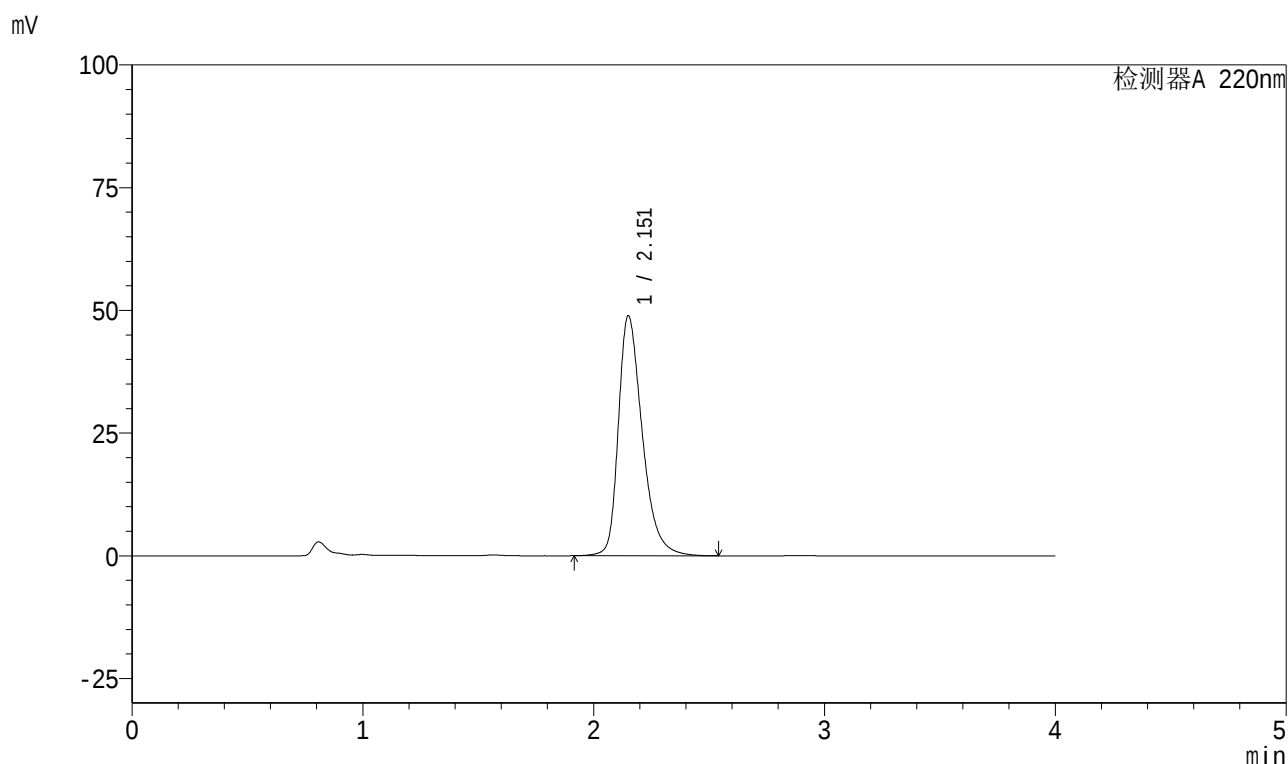

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	351763	100.000	48723	2188	1.365	--
总计		351763	100.000	48723			

图111 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-227-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb	
样品瓶号: 3-46	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 00:46:10	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:17	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)	

<色谱图>

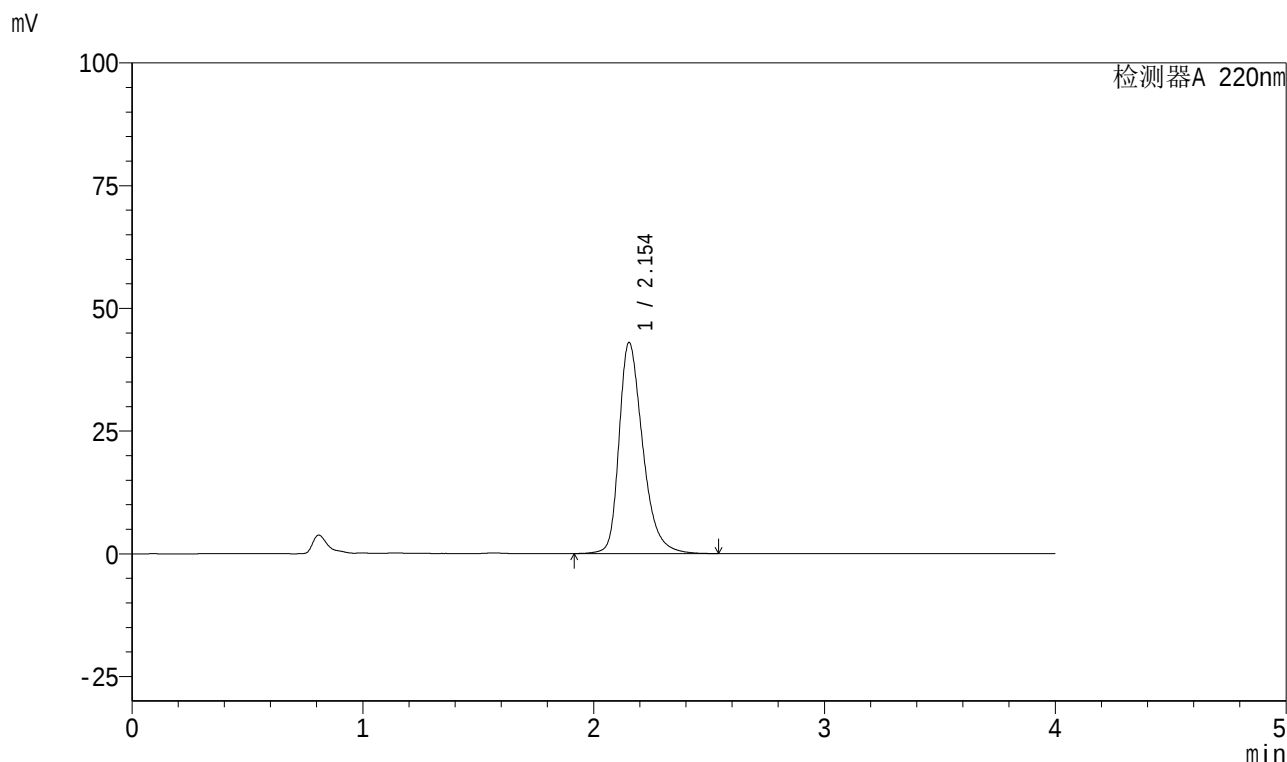

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	306924	100.000	43014	2237	1.337	--
总计		306924	100.000	43014			

图112 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-228-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 00:50:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

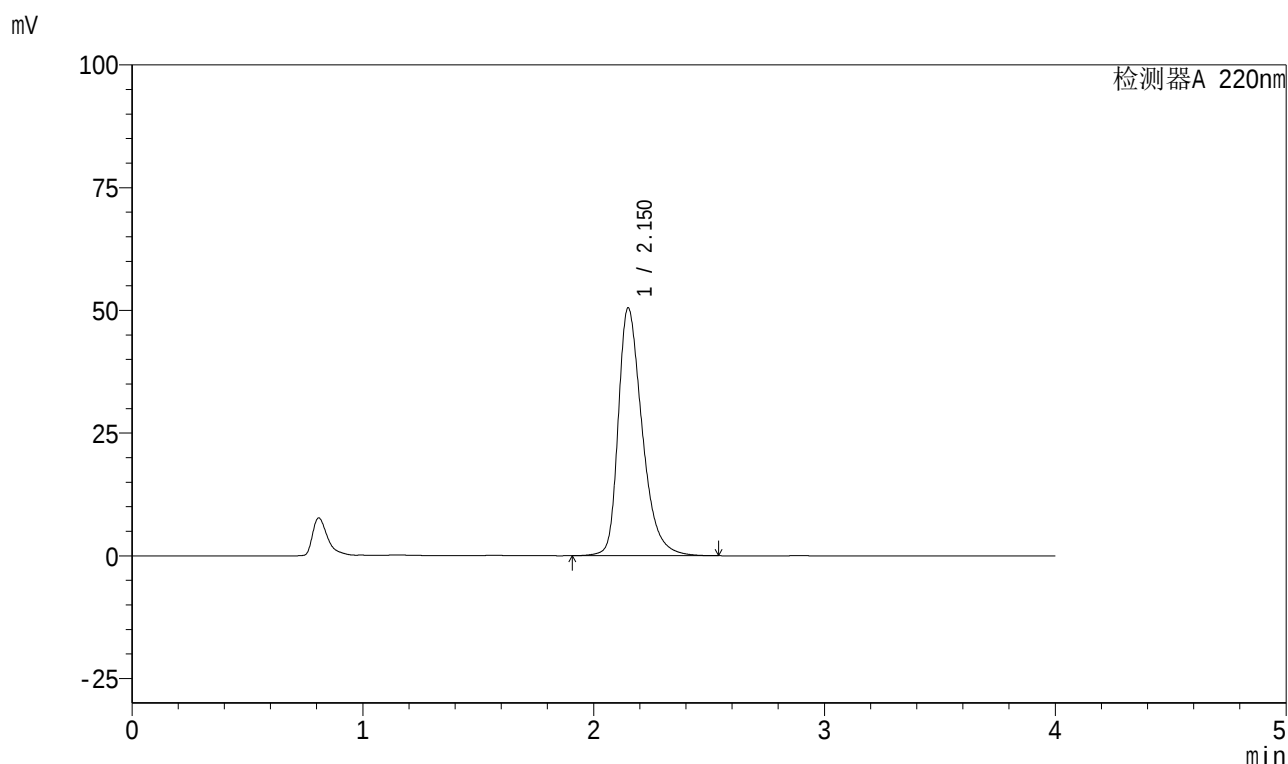

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	364225	100.000	50388	2177	1.371	--
总计		364225	100.000	50388			

图113 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-229-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 00:54:53
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

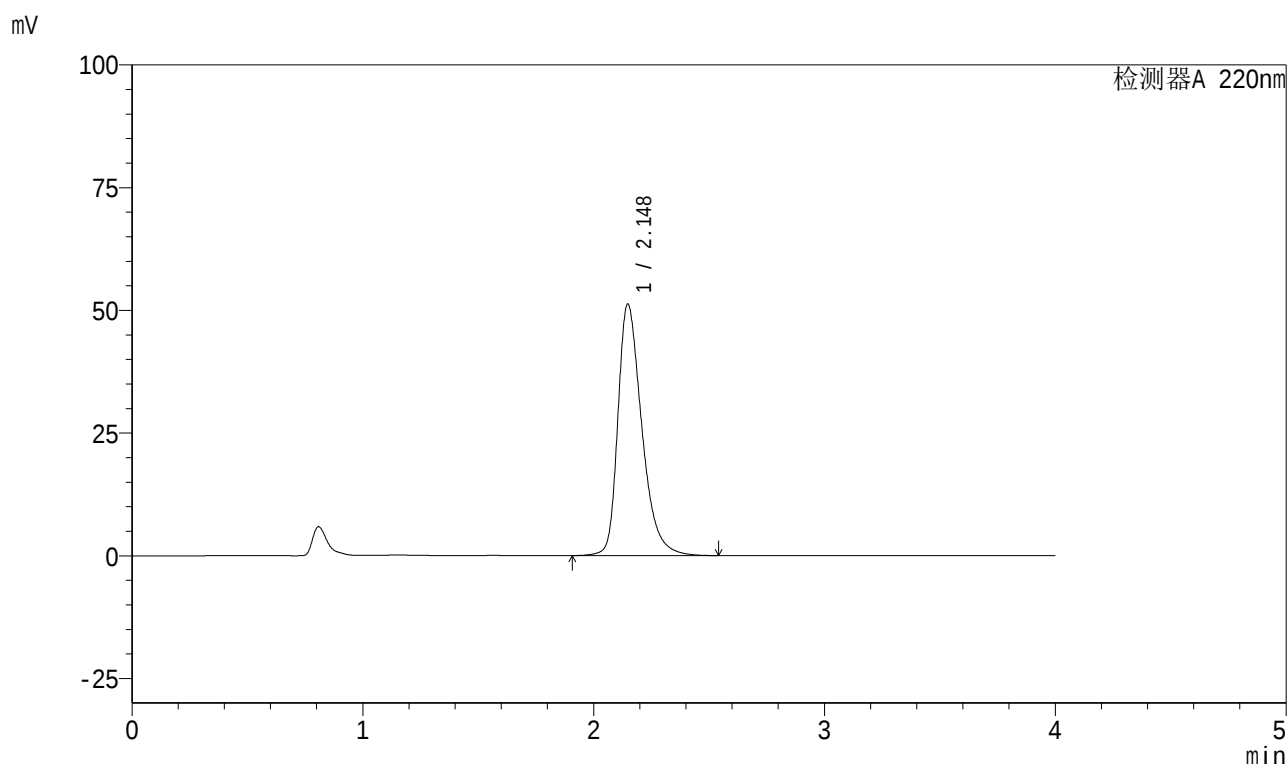

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	369998	100.000	51236	2169	1.373	--
总计		369998	100.000	51236			

图114 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-230-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 00:59:15
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

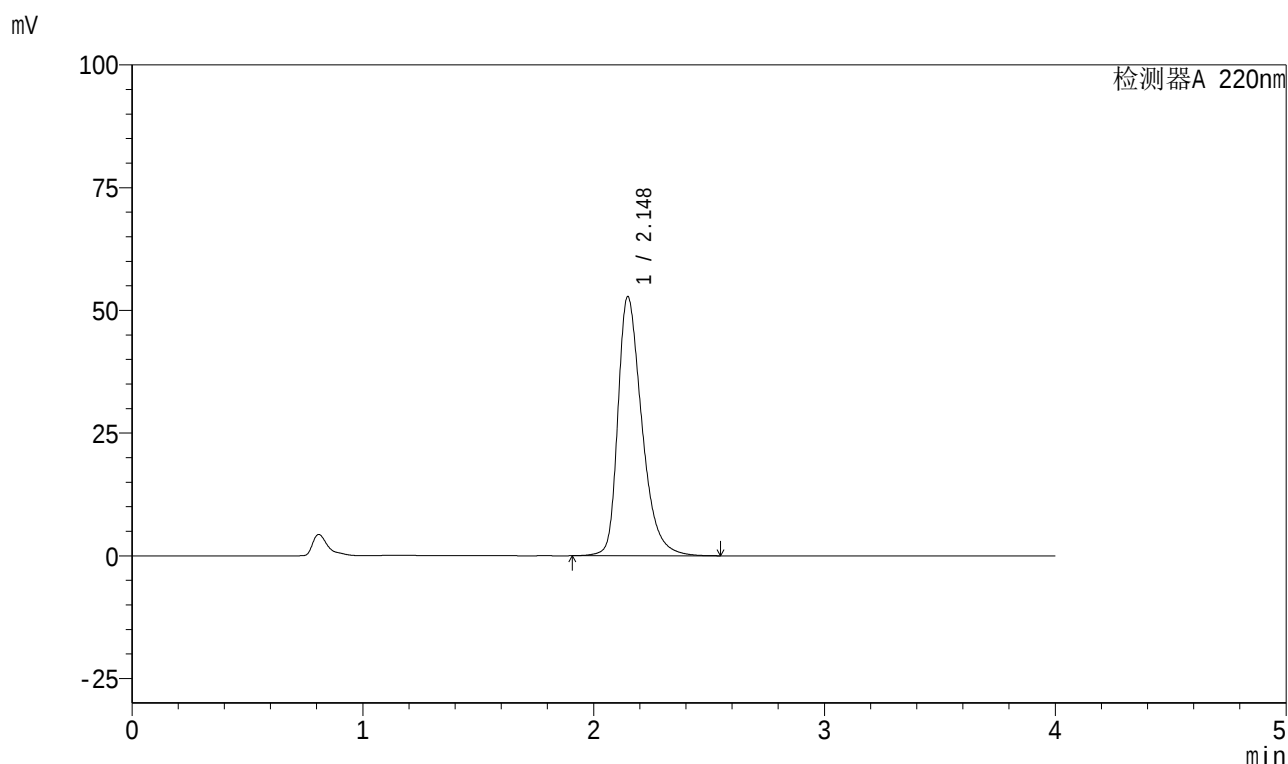

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	382008	100.000	52786	2158	1.379	--
总计		382008	100.000	52786			

图115 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-231-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:03:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

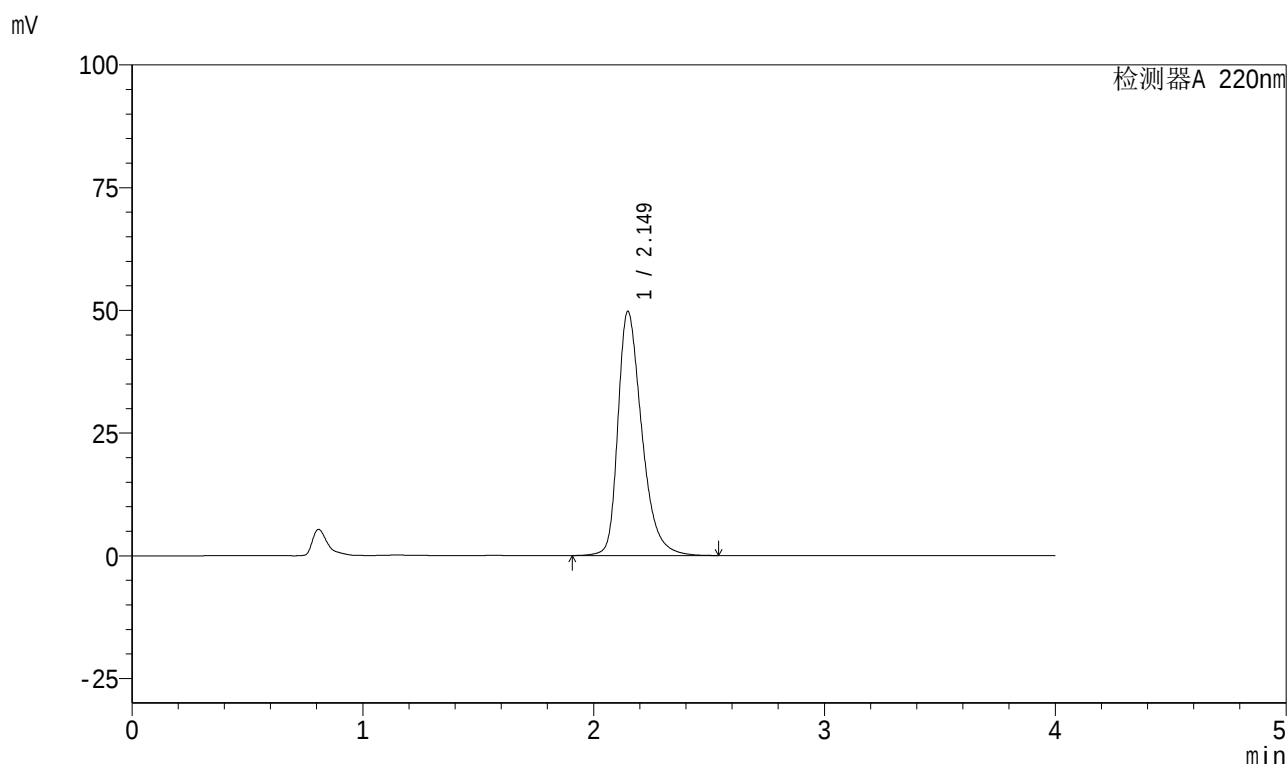

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	357954	100.000	49715	2184	1.366	--
总计		357954	100.000	49715			

图116 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-232-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:07:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

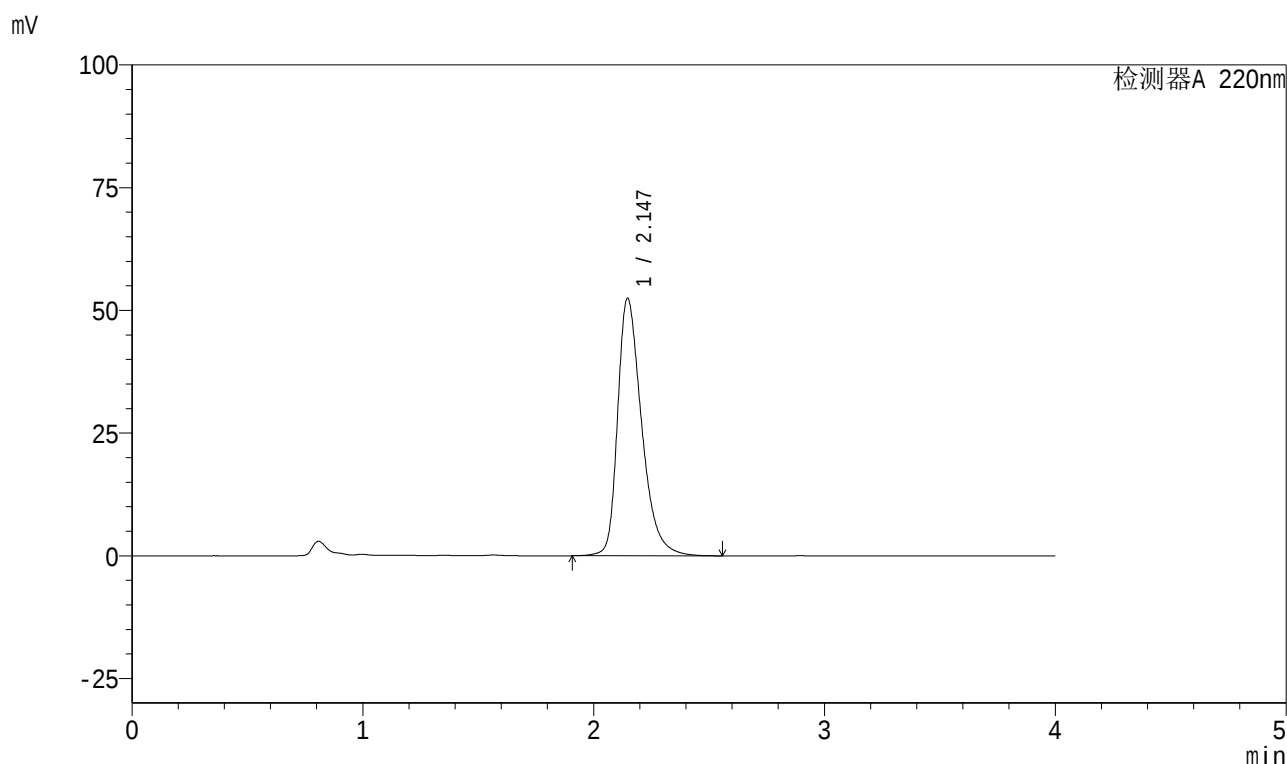

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	379673	100.000	52492	2156	1.378	--
总计		379673	100.000	52492			

图117 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-233-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:12:19
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

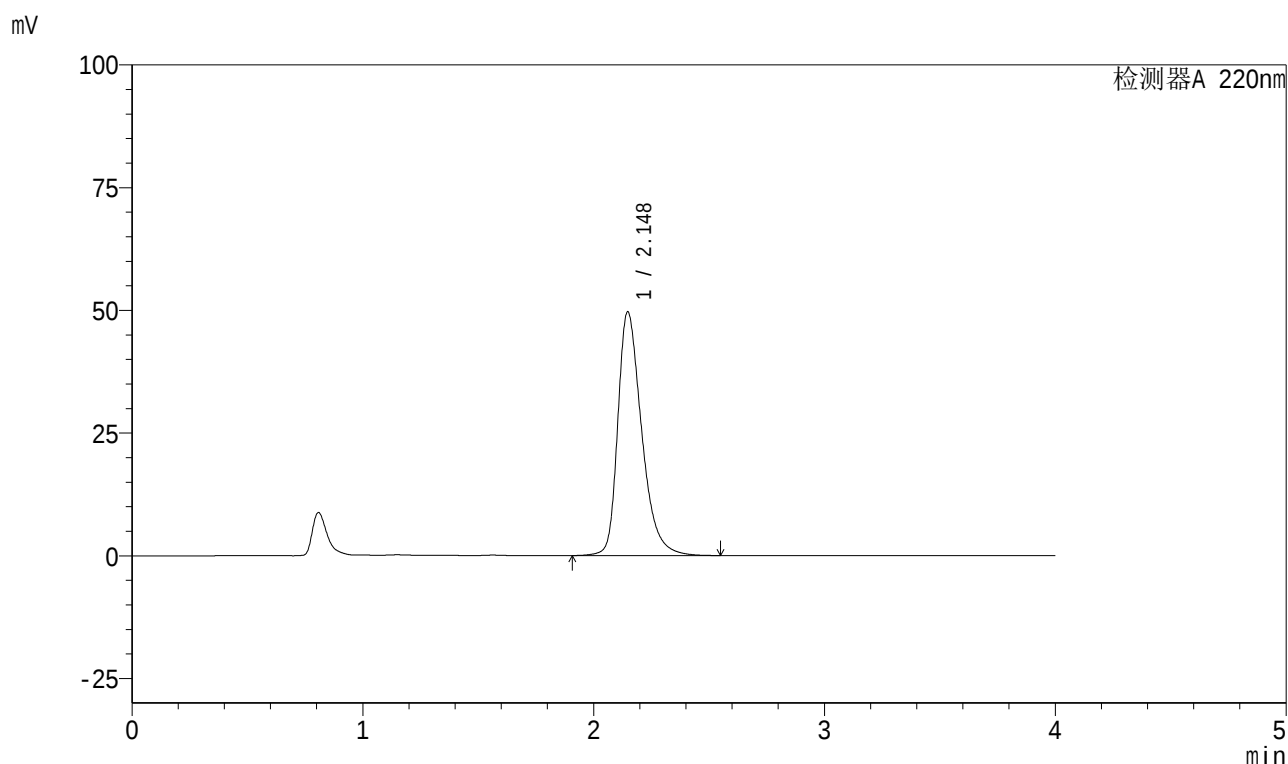

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	357491	100.000	49649	2182	1.367	--
总计		357491	100.000	49649			

图118 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-234-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:16:40
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

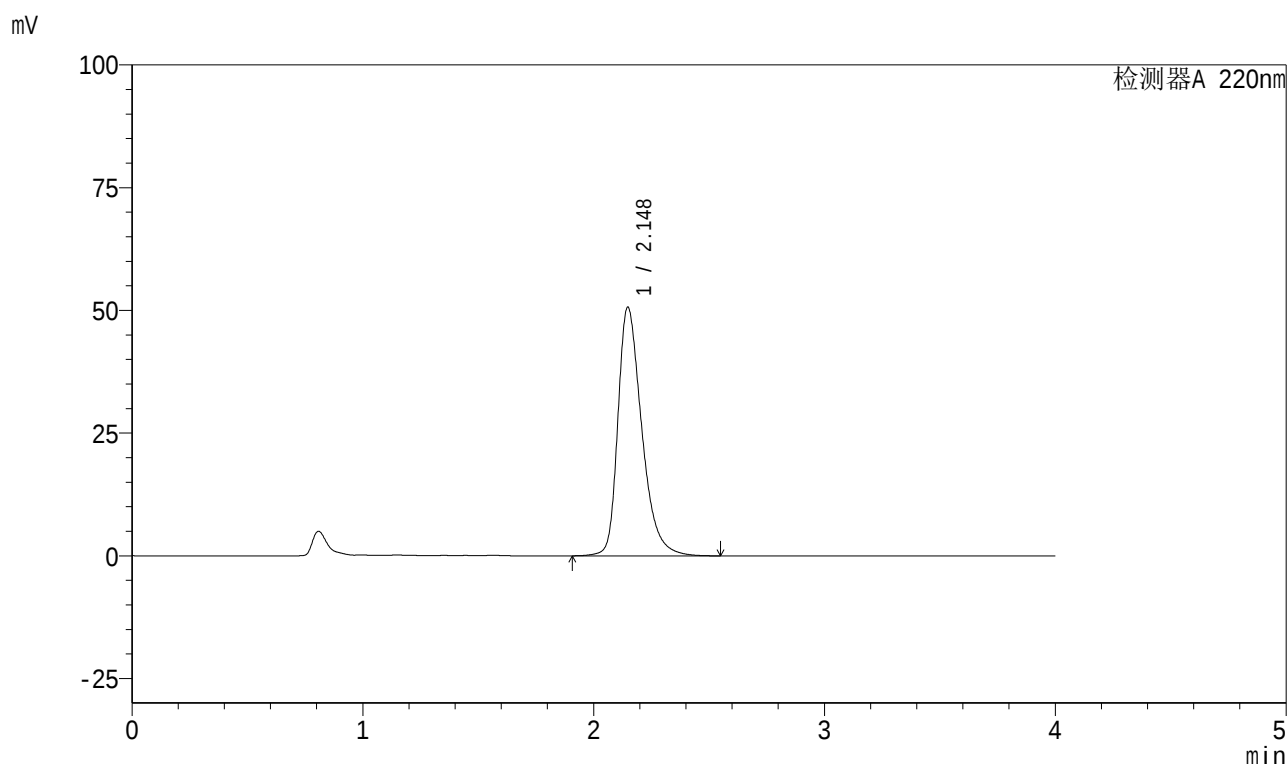

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	365310	100.000	50653	2176	1.371	--
总计		365310	100.000	50653			

图119 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-235-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:21:02
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min

波长:220nm


版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV

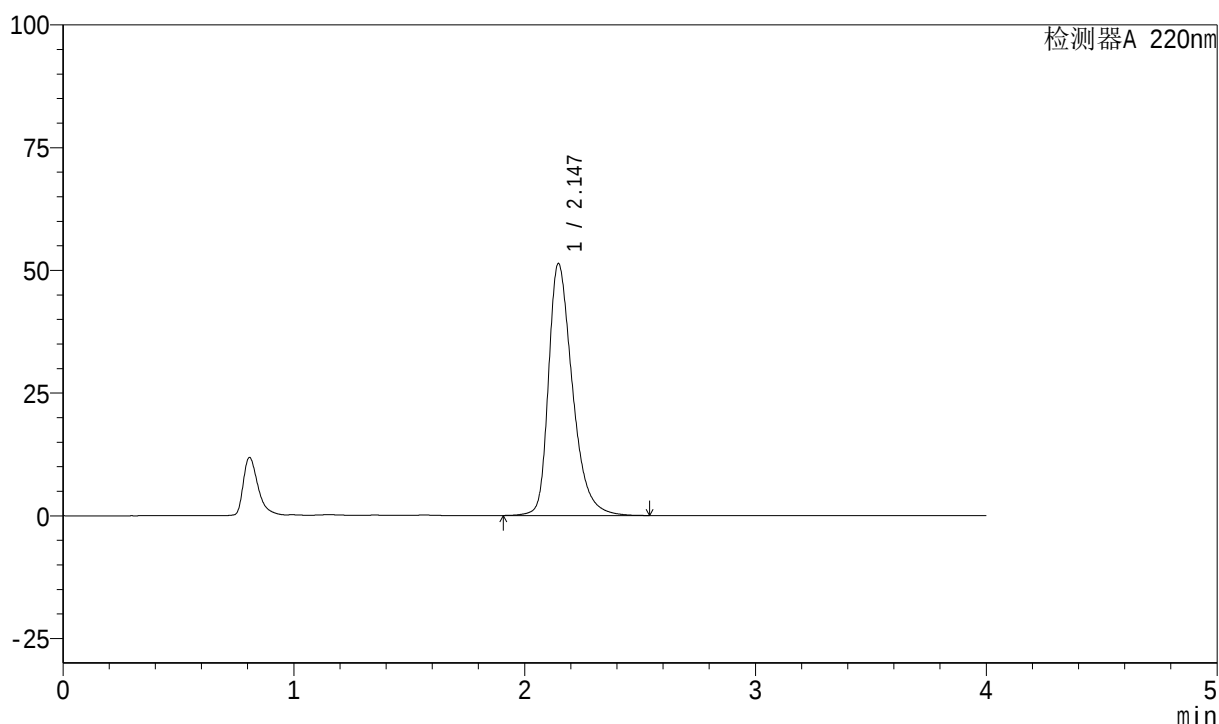

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	370222	100.000	51345	2171	1.372	--
总计		370222	100.000	51345			




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-236-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-21 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 01:25:24 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

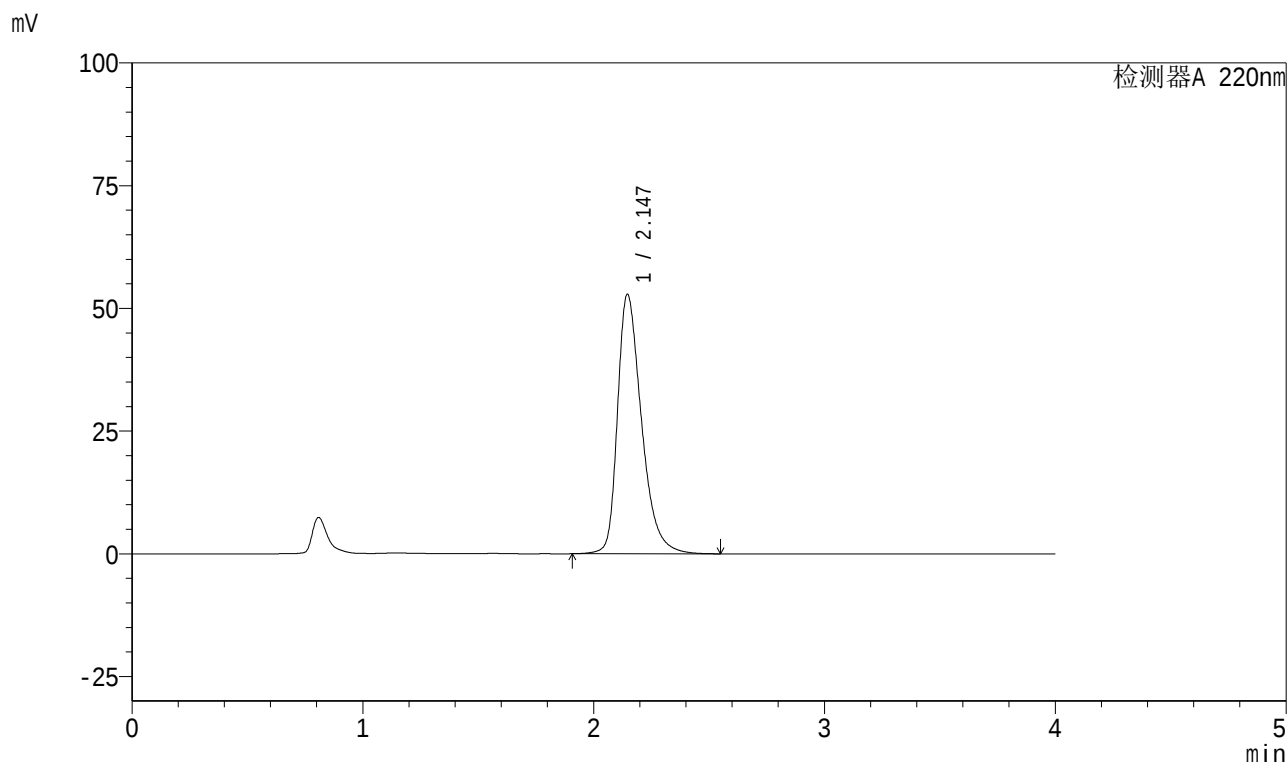

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	382463	100.000	52887	2156	1.379	--
总计		382463	100.000	52887			

图121 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-237-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-30 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 01:29:46 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

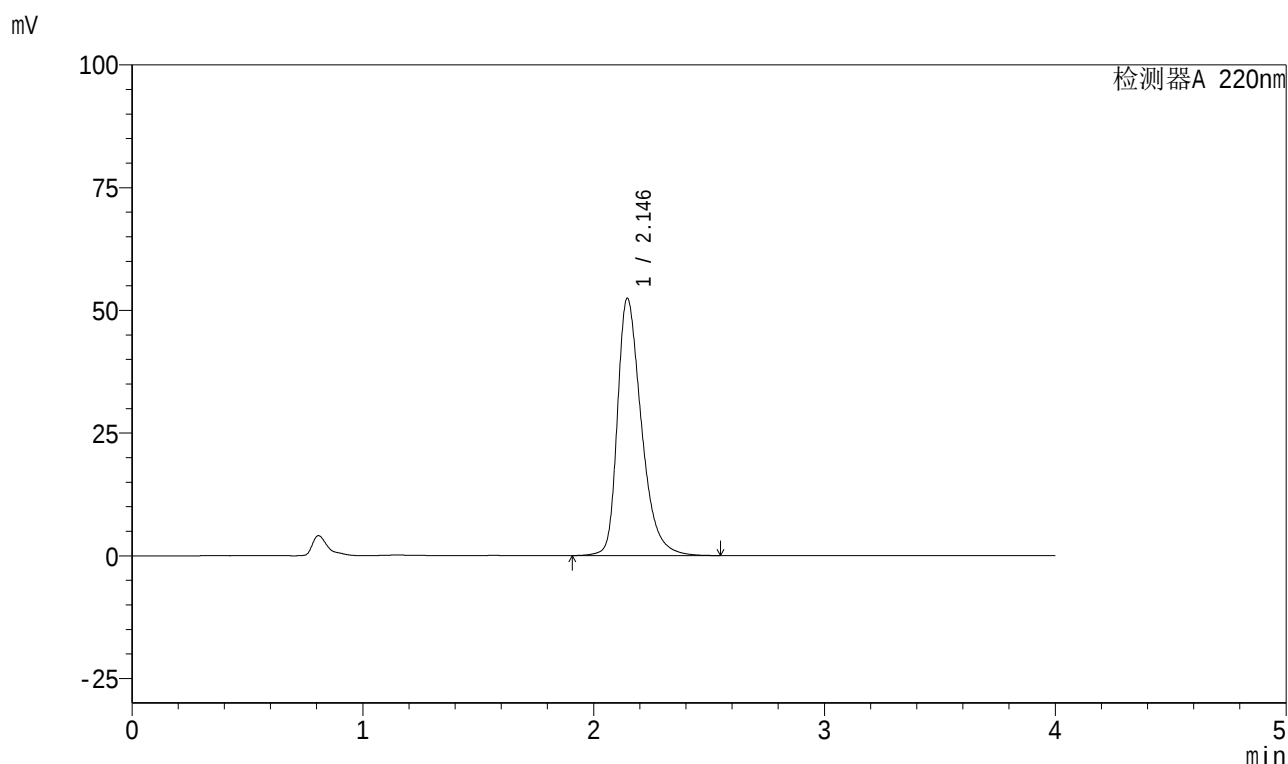

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	378954	100.000	52435	2159	1.377	--
总计		378954	100.000	52435			

图122 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-238-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:34:07
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min
波长:220nm
版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

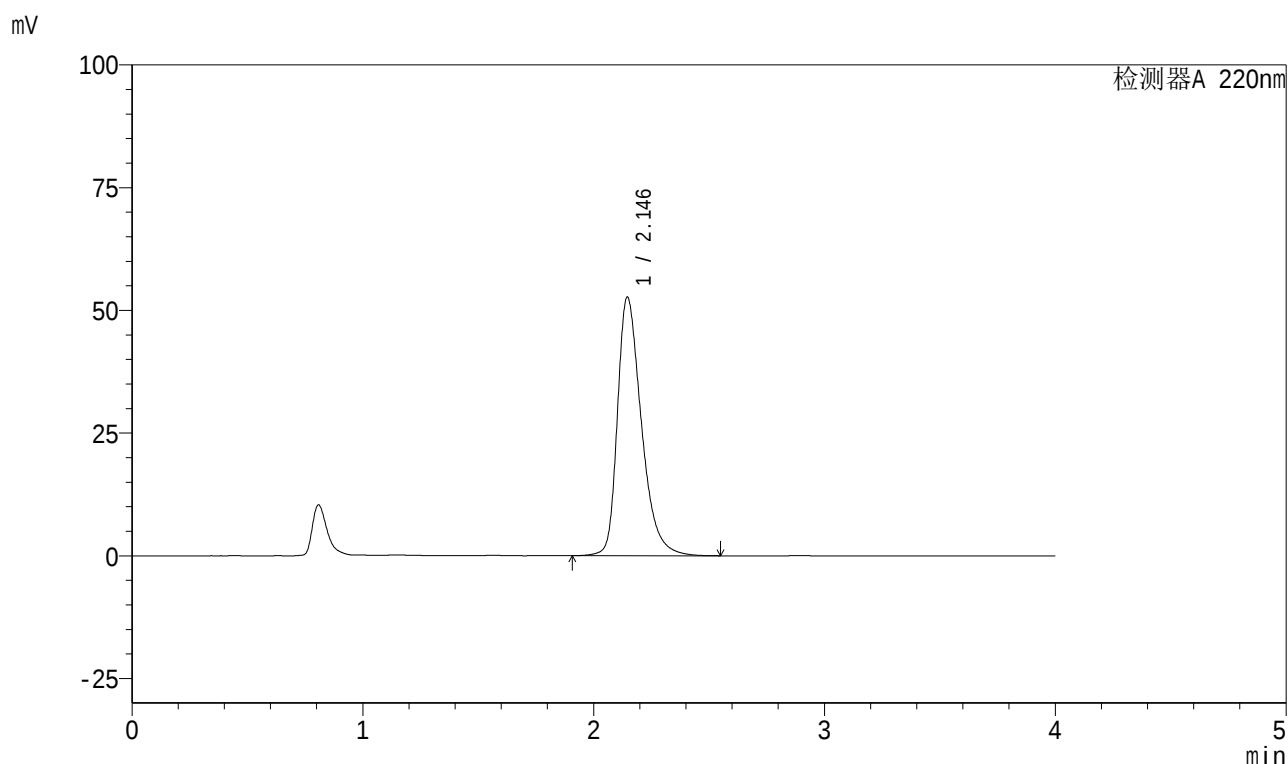

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	381280	100.000	52720	2156	1.380	--
总计		381280	100.000	52720			

图123 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-239-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:38:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

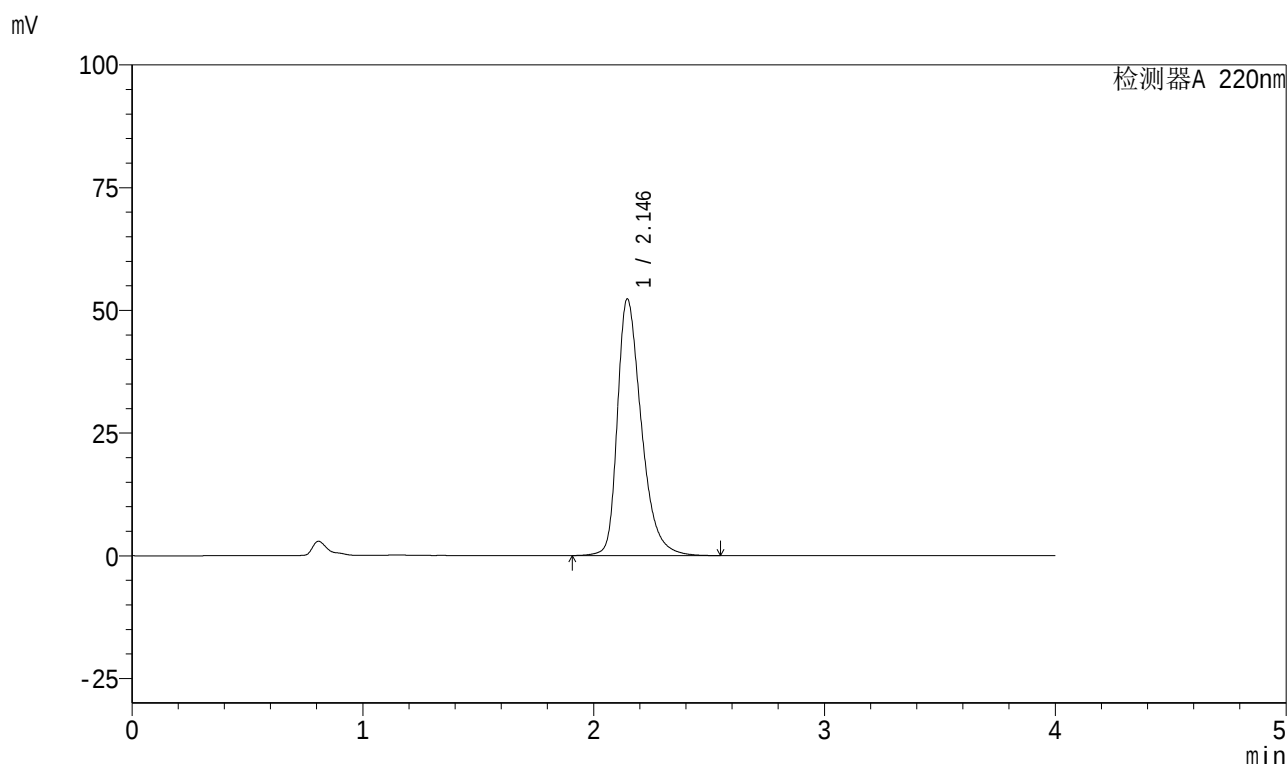

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	377628	100.000	52305	2165	1.378	--
总计		377628	100.000	52305			

图124 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-240-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:42:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

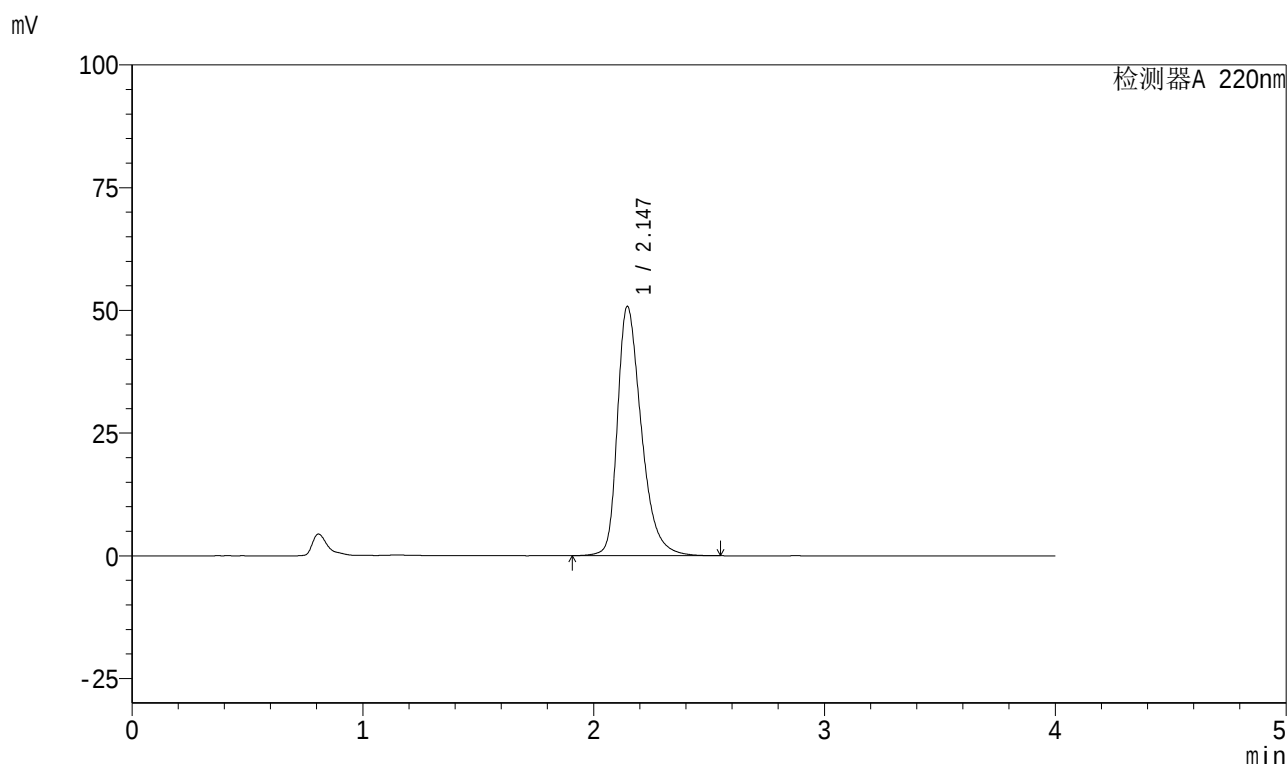

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	366166	100.000	50817	2175	1.371	--
总计		366166	100.000	50817			

图125 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-241-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:47:12
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

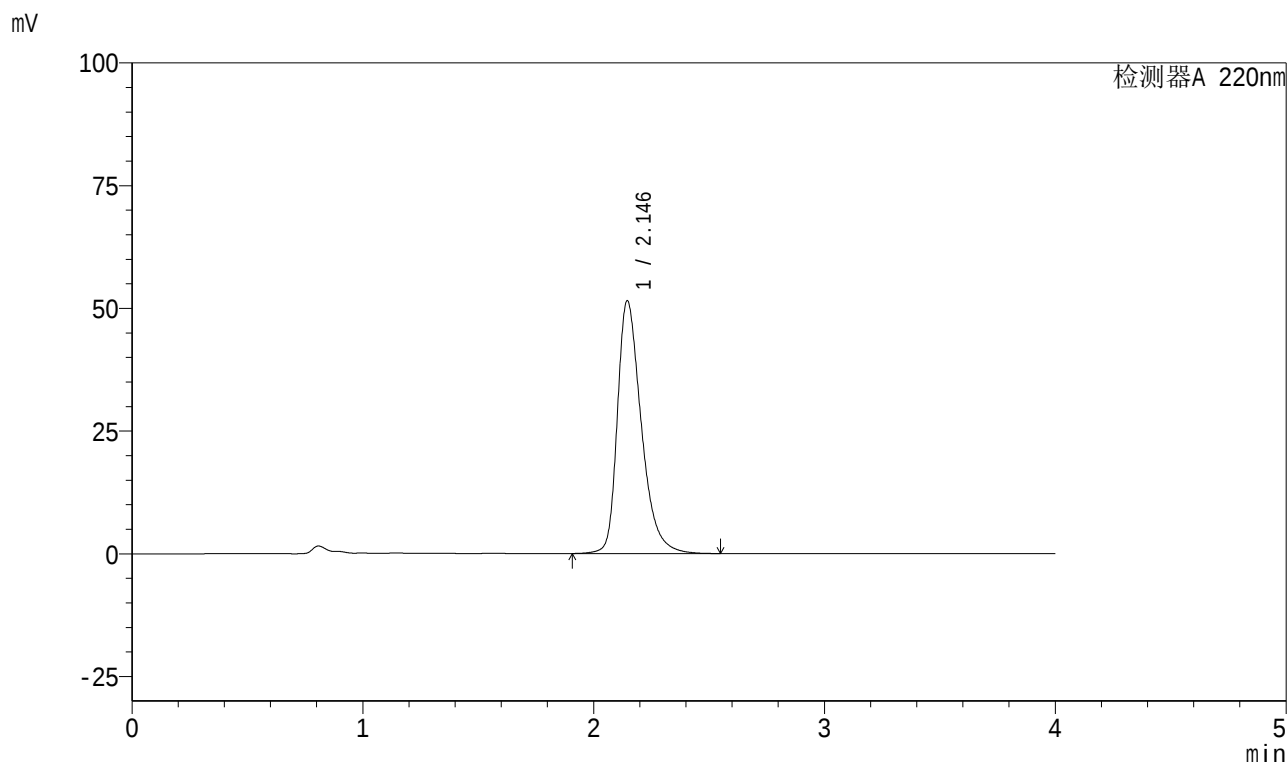

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	371449	100.000	51504	2171	1.374	--
总计		371449	100.000	51504			

图126 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-242-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 01:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

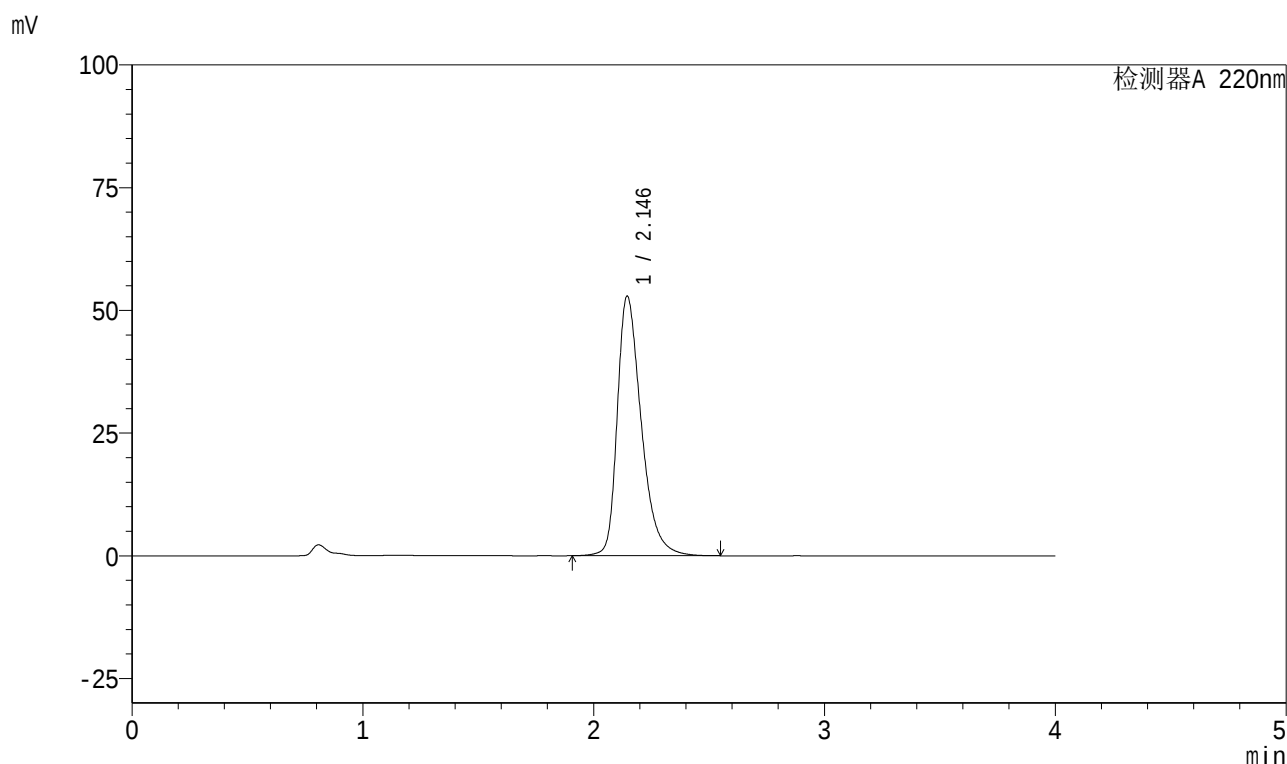

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	382616	100.000	52909	2155	1.380	--
总计		382616	100.000	52909			

图127 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-243-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 01:55:55
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:57:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

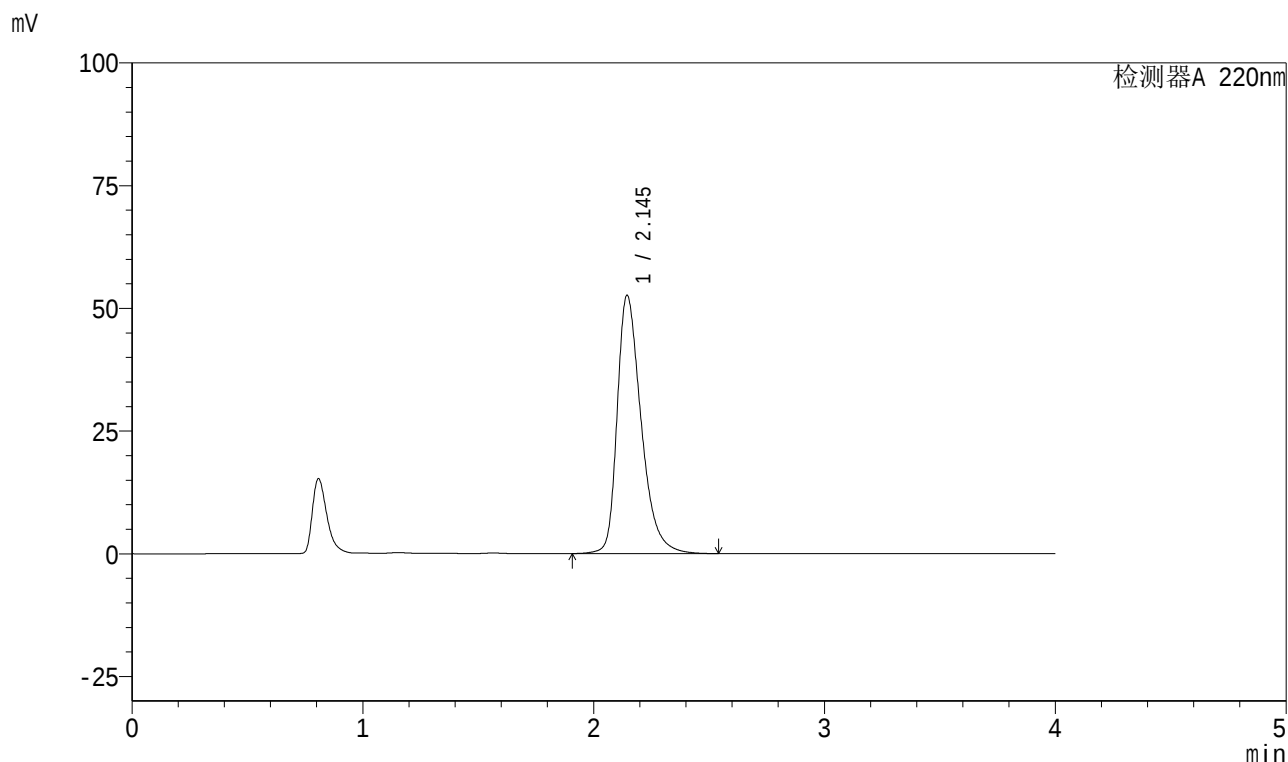

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	380221	100.000	52606	2159	1.379	--
总计		380221	100.000	52606			

图128 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-244-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:00:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

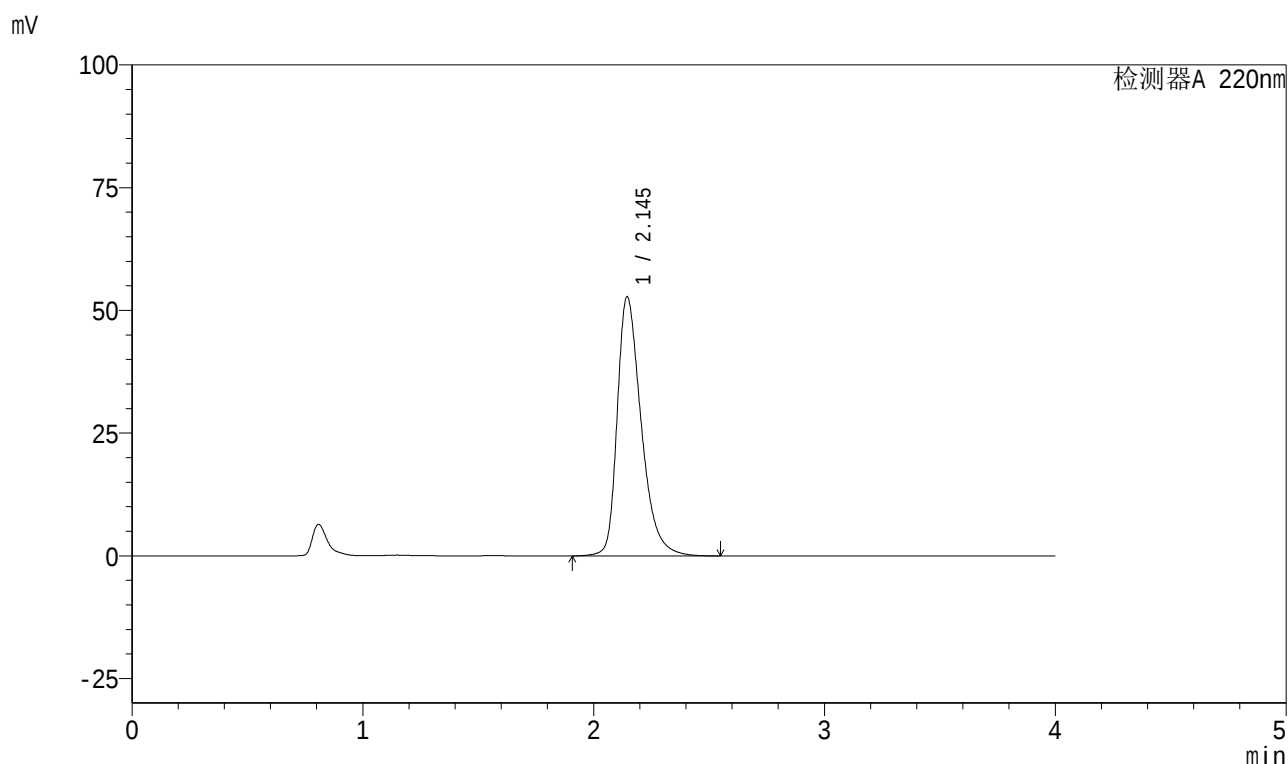

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	381815	100.000	52805	2155	1.380	--
总计		381815	100.000	52805			

图129 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-245-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:04:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

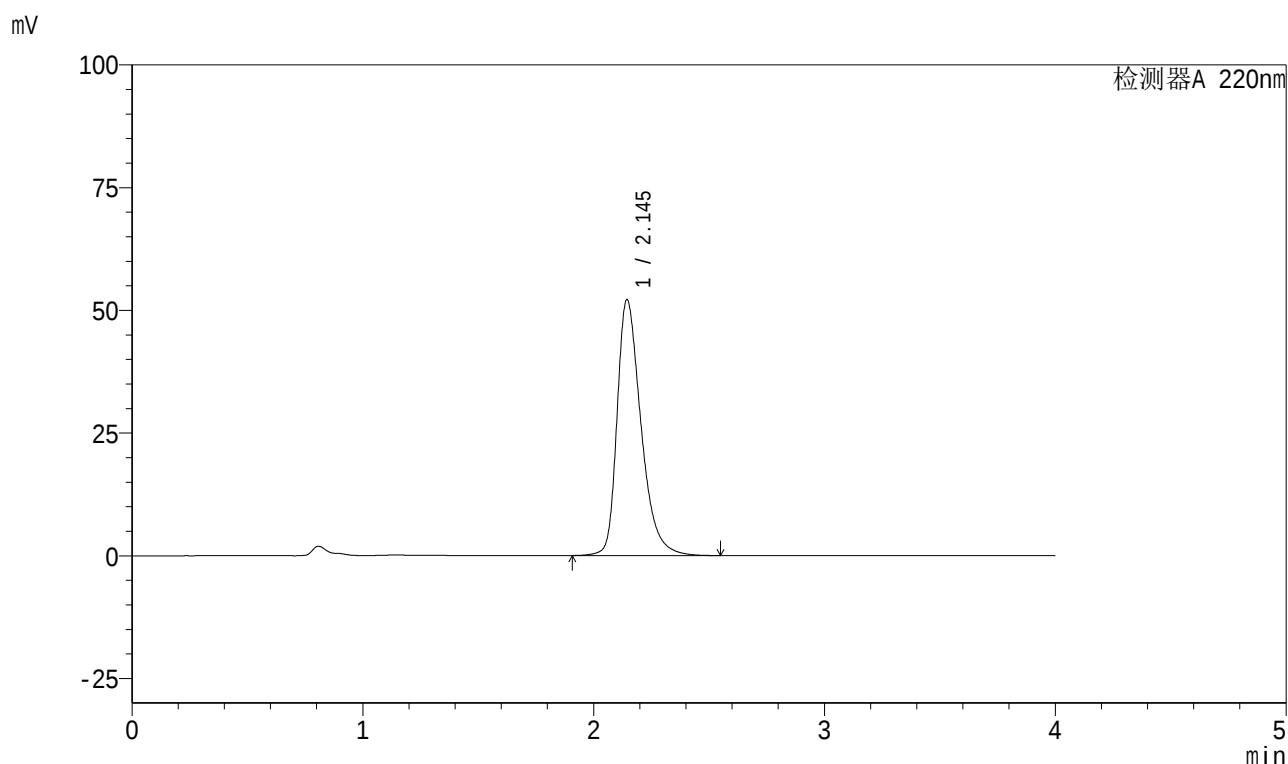

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	376212	100.000	52103	2165	1.378	--
总计		376212	100.000	52103			

图130 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-246-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:08:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

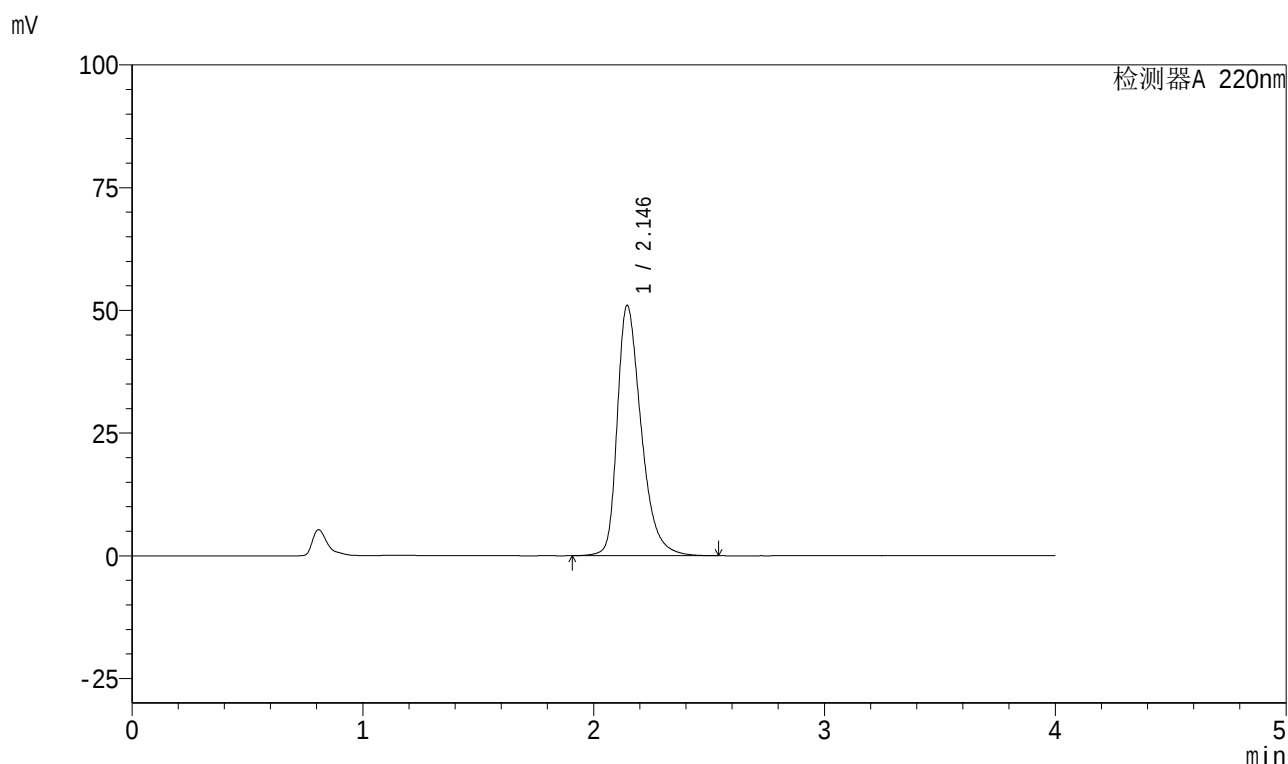

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	367584	100.000	50999	2170	1.372	--
总计		367584	100.000	50999			

图131 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-247-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:13:21 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:09 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

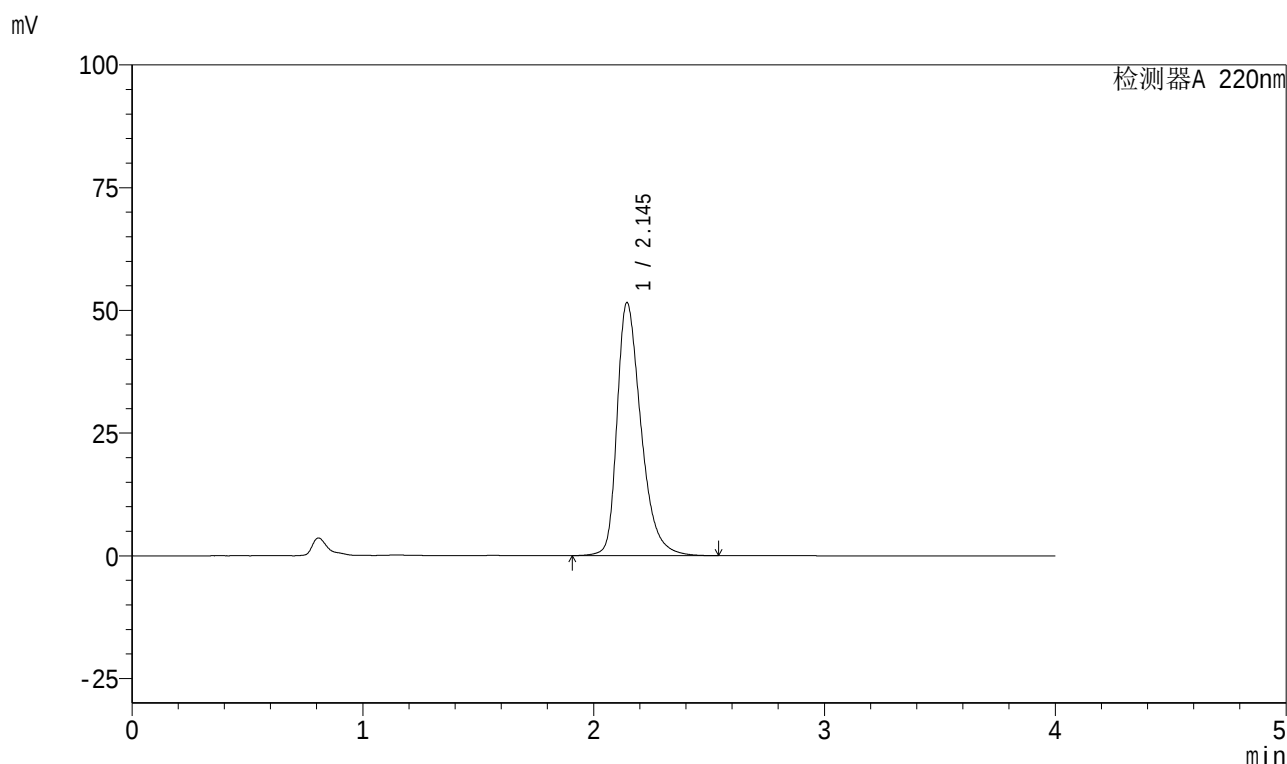

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	372047	100.000	51532	2166	1.375	--
总计		372047	100.000	51532			

图132 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-248-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:17:43
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

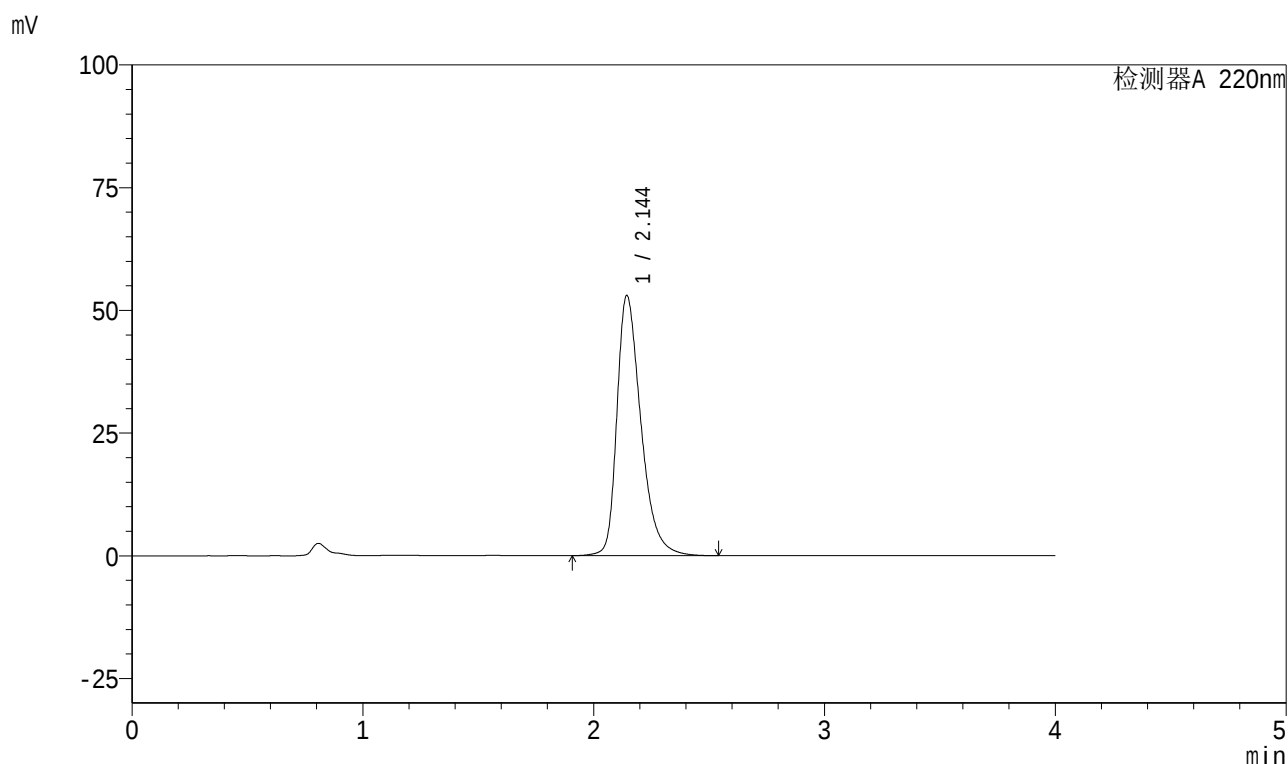

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	383057	100.000	52931	2155	1.381	--
总计		383057	100.000	52931			

图133 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-249-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:22:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

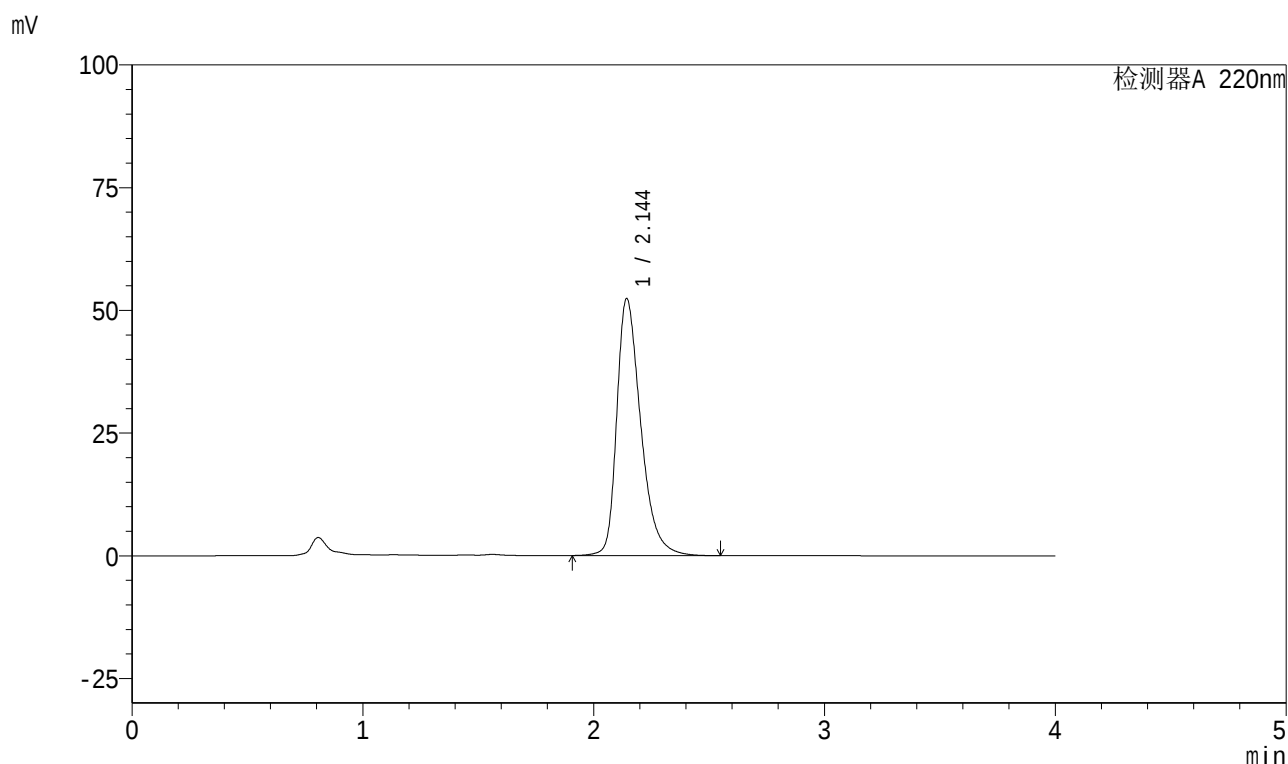

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	378309	100.000	52258	2156	1.379	--
总计		378309	100.000	52258			

图134 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-250-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:26:26 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:17 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

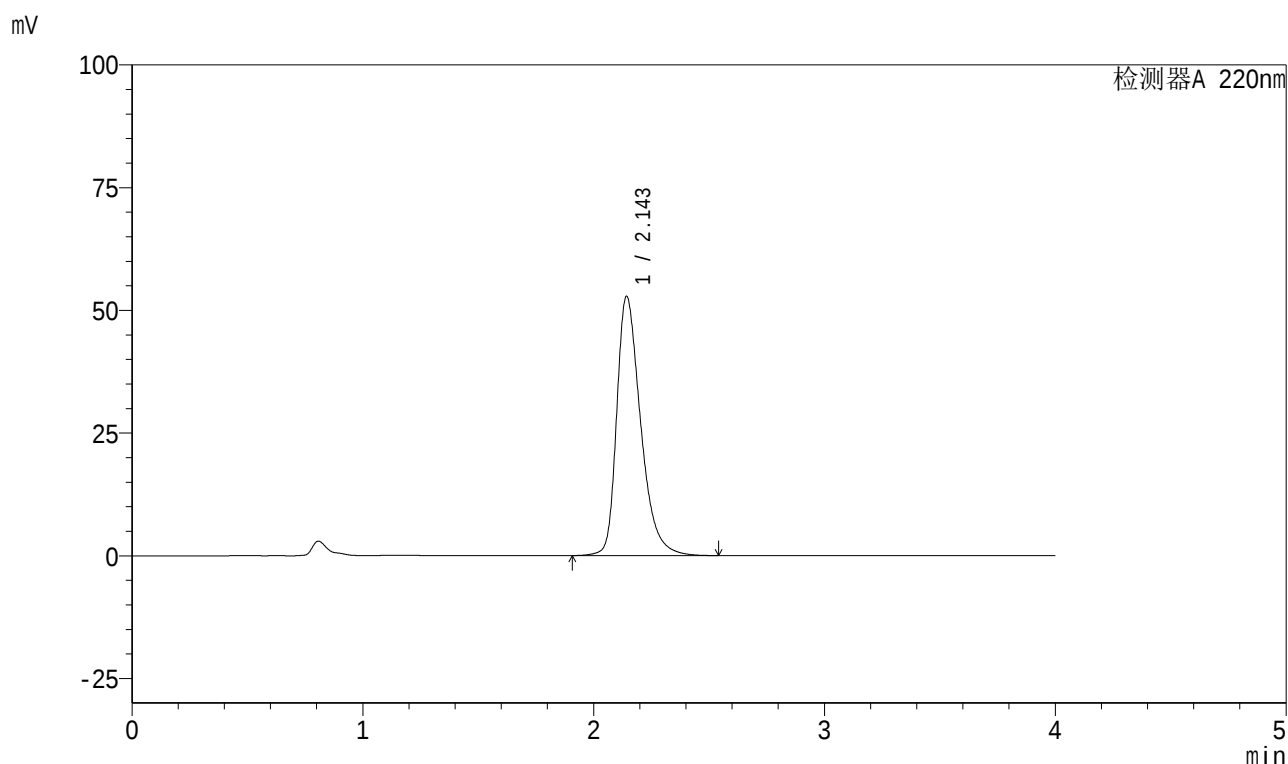

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	381670	100.000	52669	2155	1.382	--
总计		381670	100.000	52669			

图135 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-251-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:30:48 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:20 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

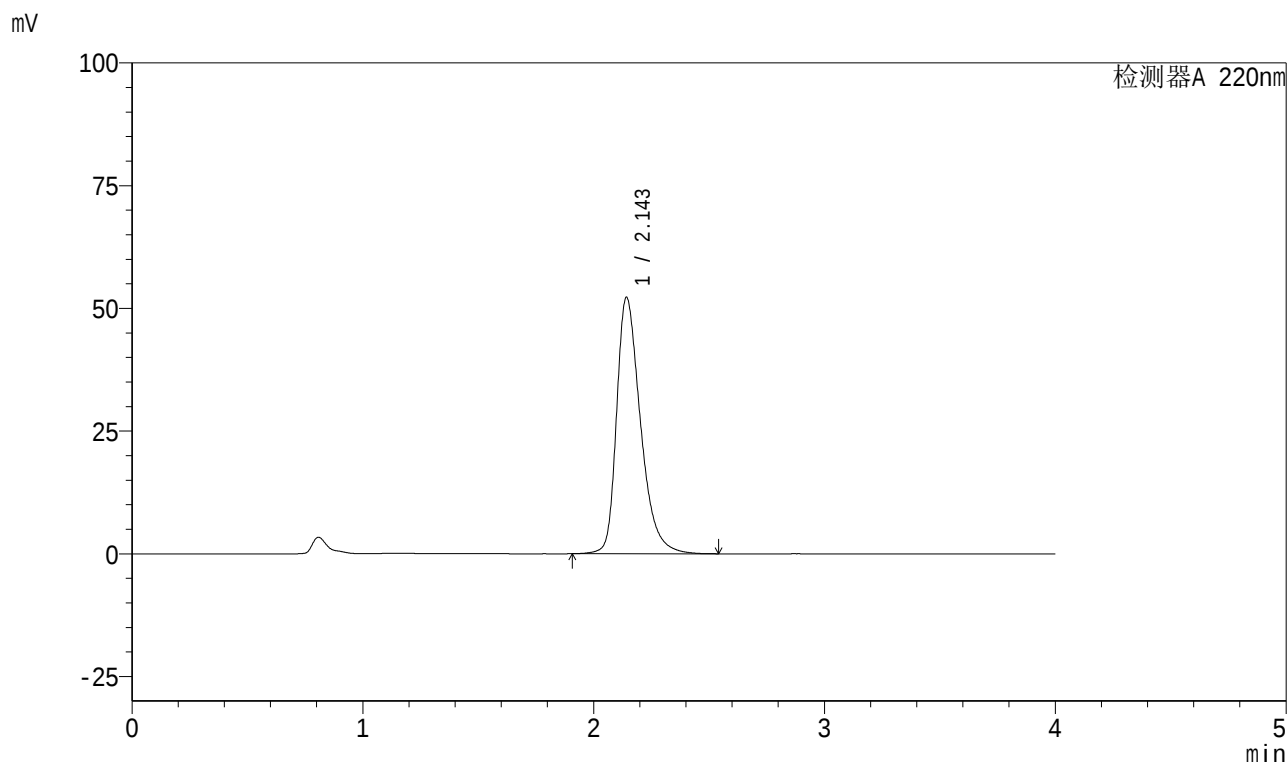

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	376646	100.000	52039	2164	1.380	--
总计		376646	100.000	52039			

图136 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-252-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:35:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

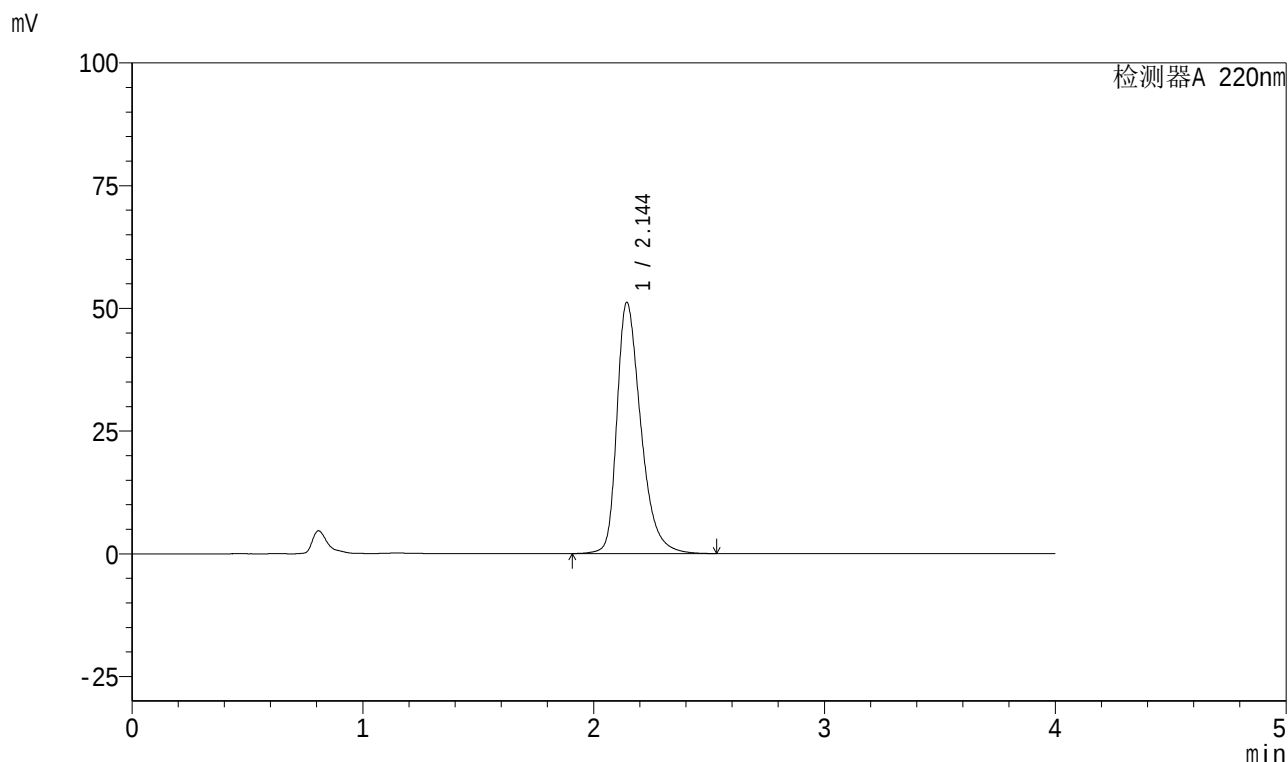

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	368657	100.000	51114	2171	1.373	--
总计		368657	100.000	51114			

图137 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-253-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:39:31
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

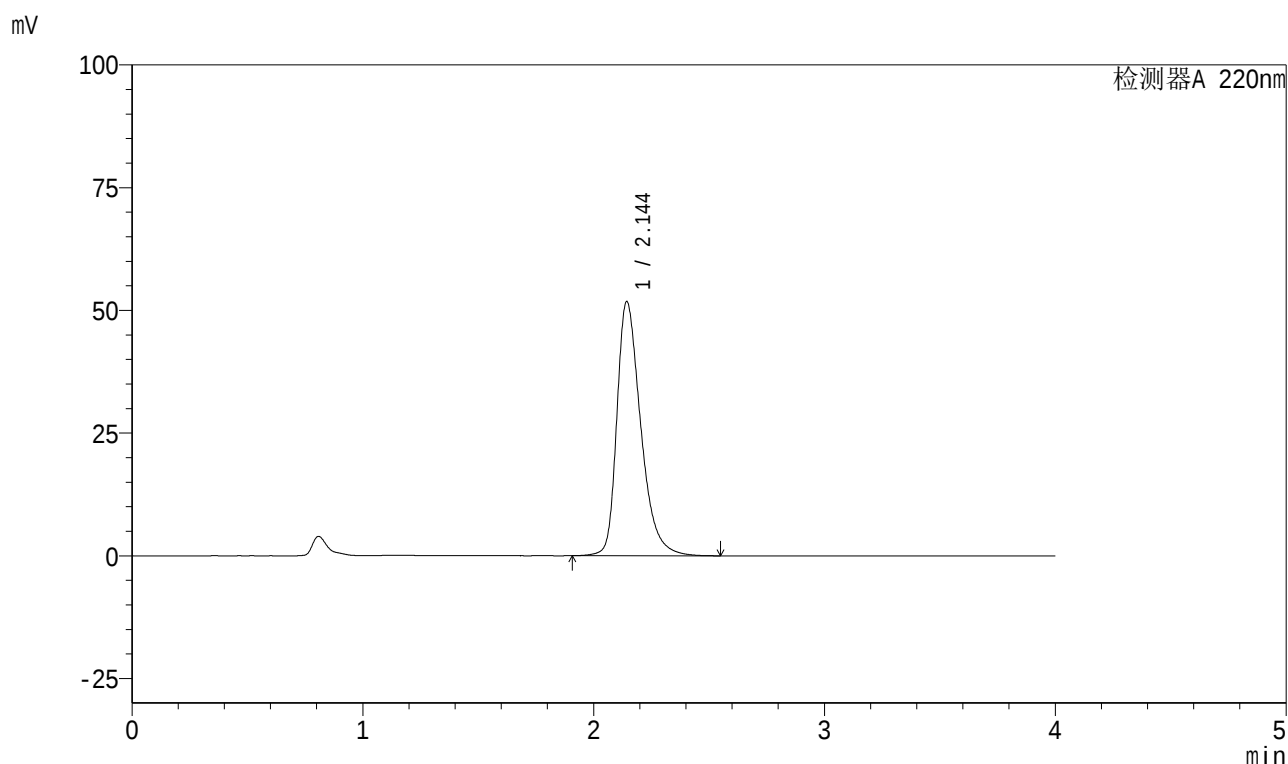

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	373277	100.000	51700	2168	1.376	--
总计		373277	100.000	51700			

图138 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-254-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:43:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

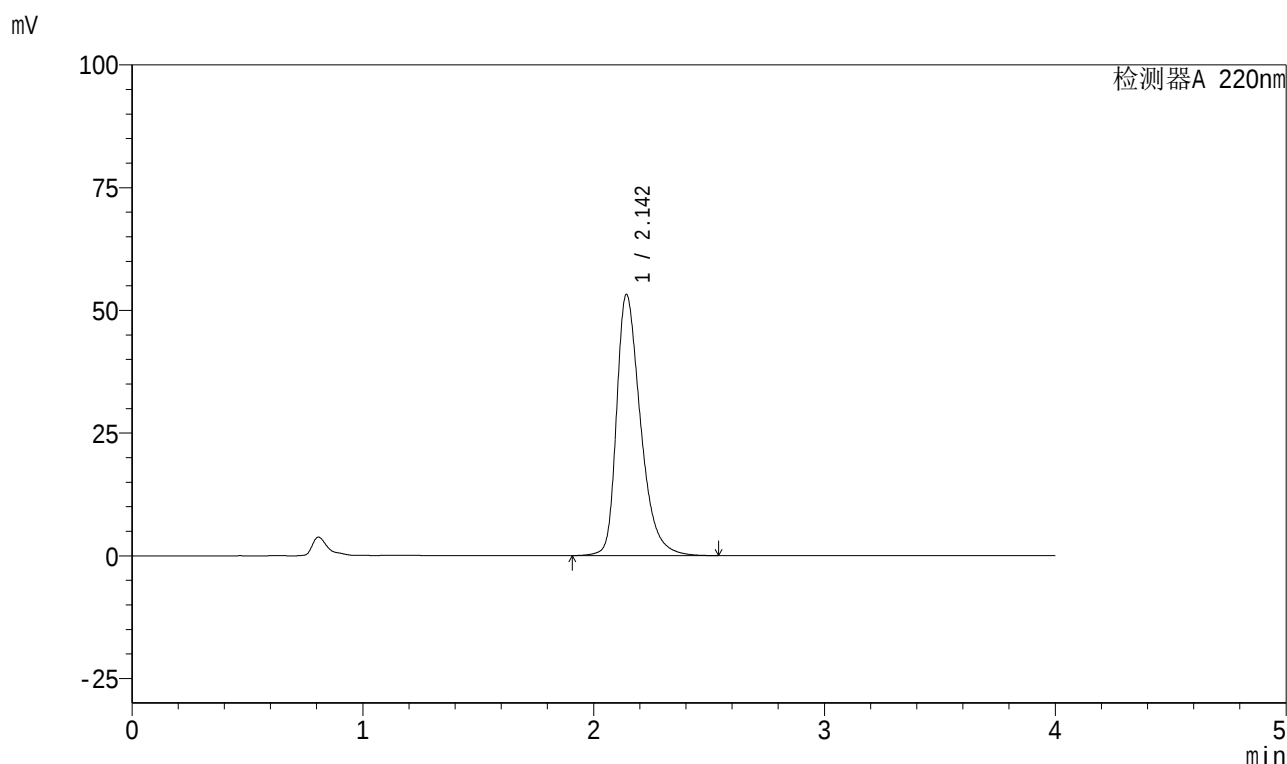

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	384576	100.000	53028	2154	1.384	--
总计		384576	100.000	53028			

图139 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-255-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:48:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

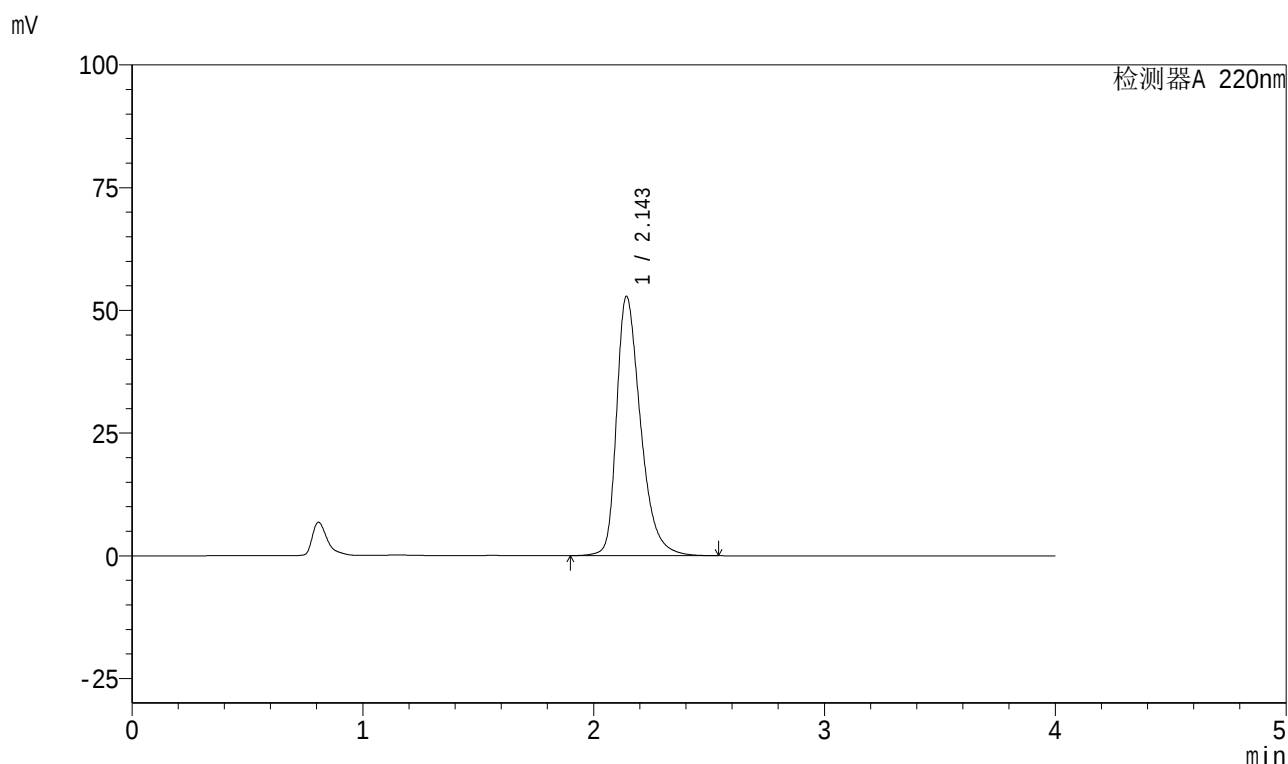

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	381746	100.000	52657	2156	1.382	--
总计		381746	100.000	52657			

图140 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-256-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 02:52:35
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

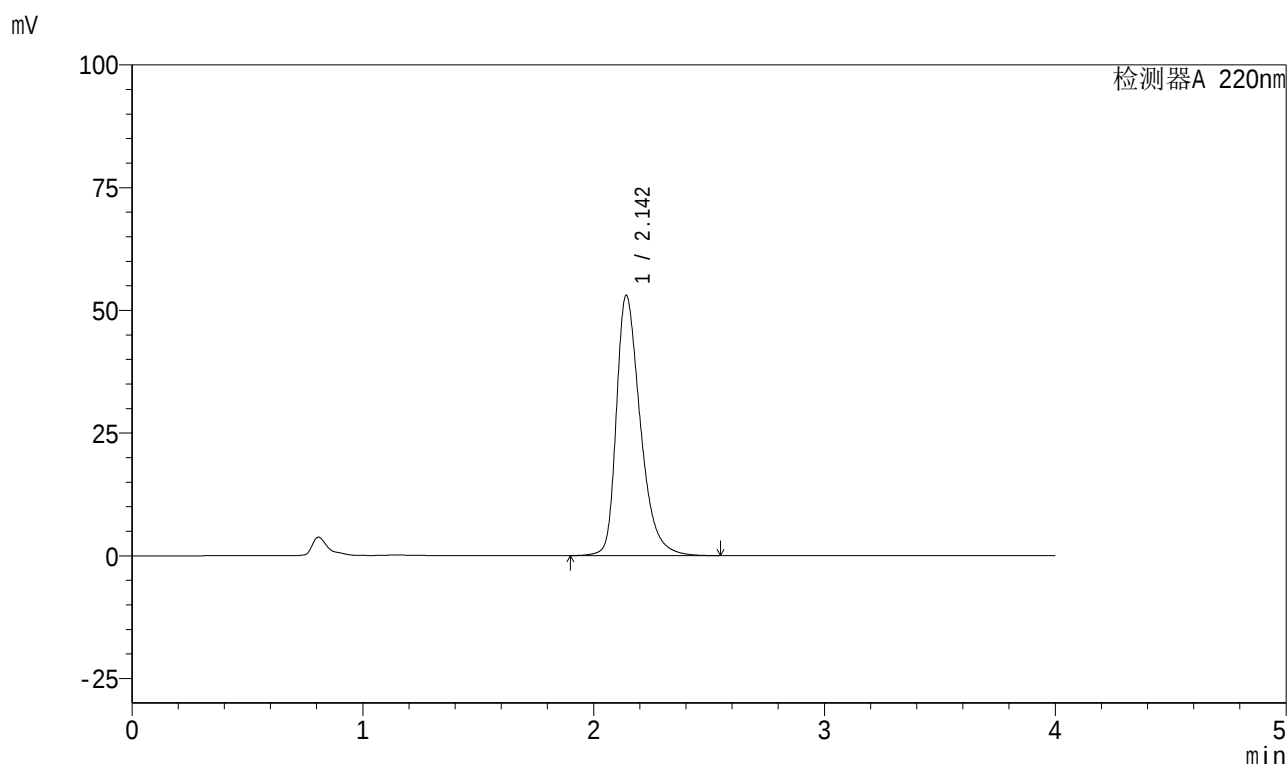

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	383042	100.000	52908	2153	1.382	--
总计		383042	100.000	52908			

图141 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-257-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 02:56:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

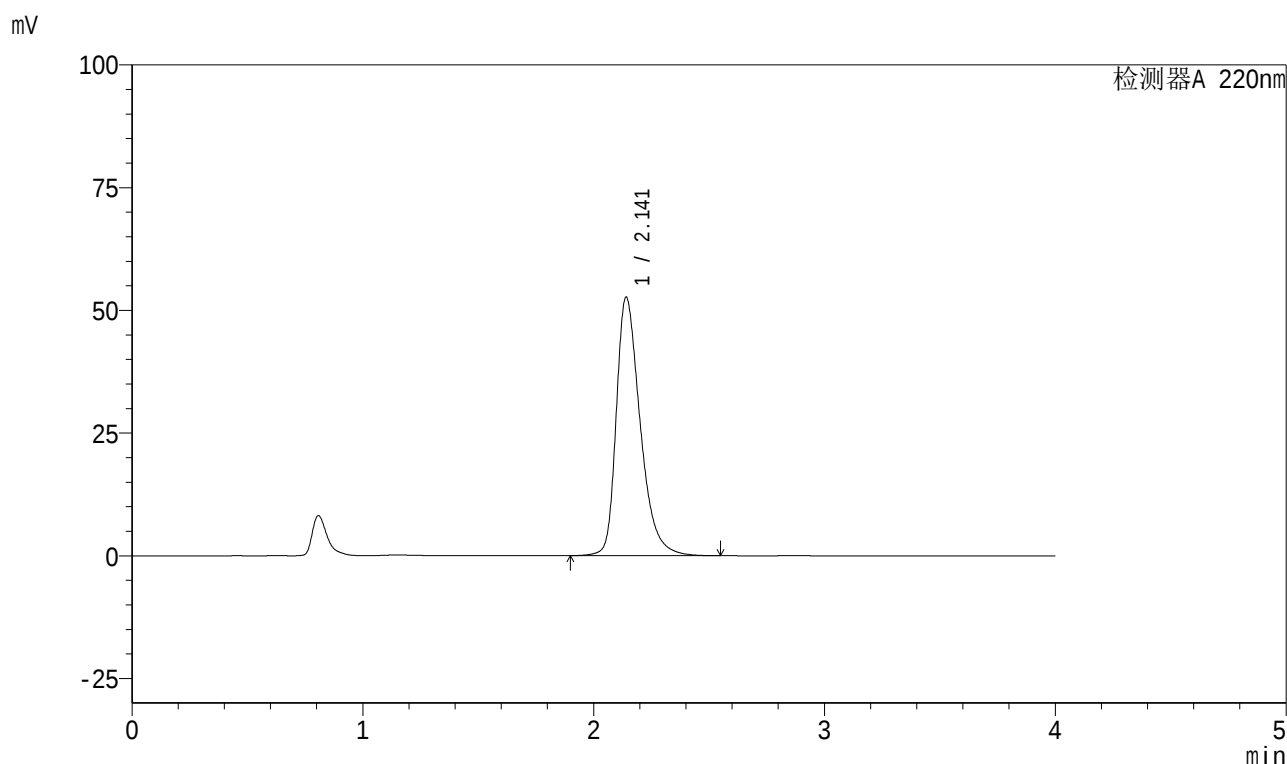

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	380199	100.000	52590	2157	1.381	--
总计		380199	100.000	52590			

图142 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-258-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μl
分析时间: 2026/05/26 03:01:17
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

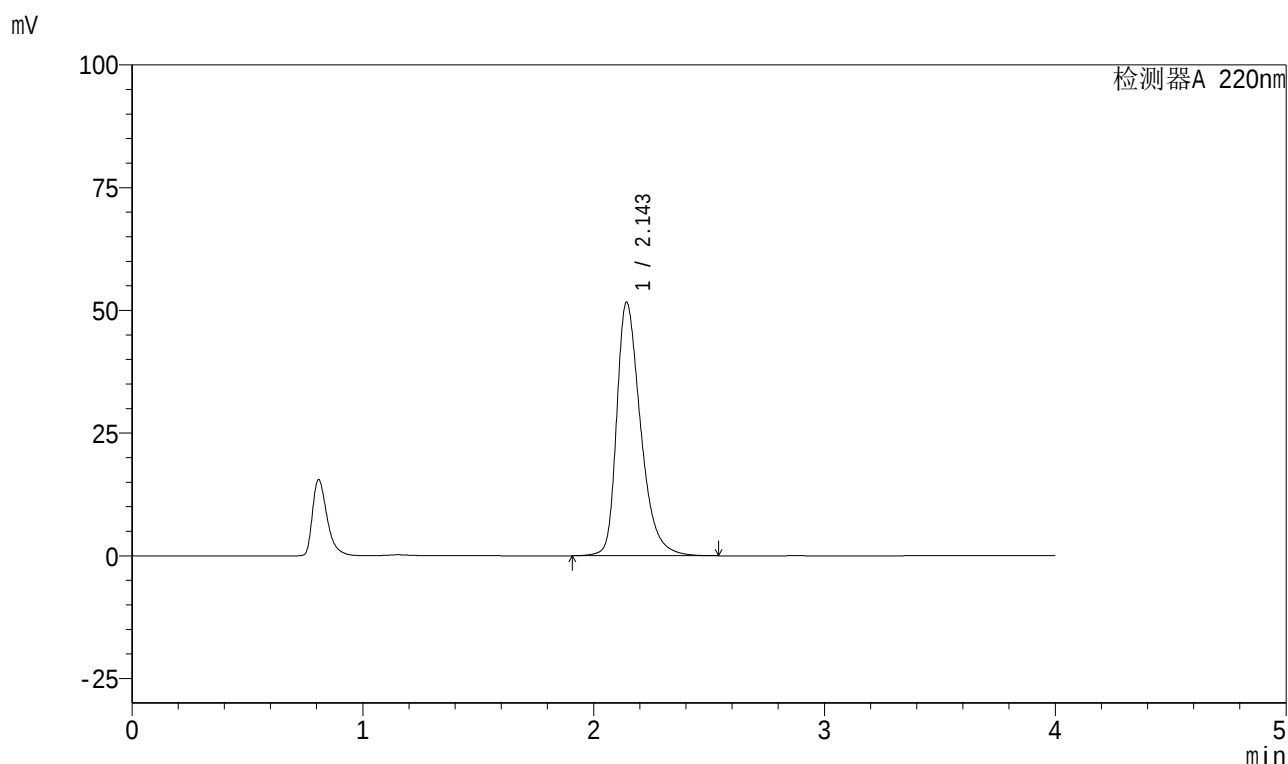

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	372354	100.000	51508	2167	1.377	--
总计		372354	100.000	51508			

图143 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-259-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:05:39
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

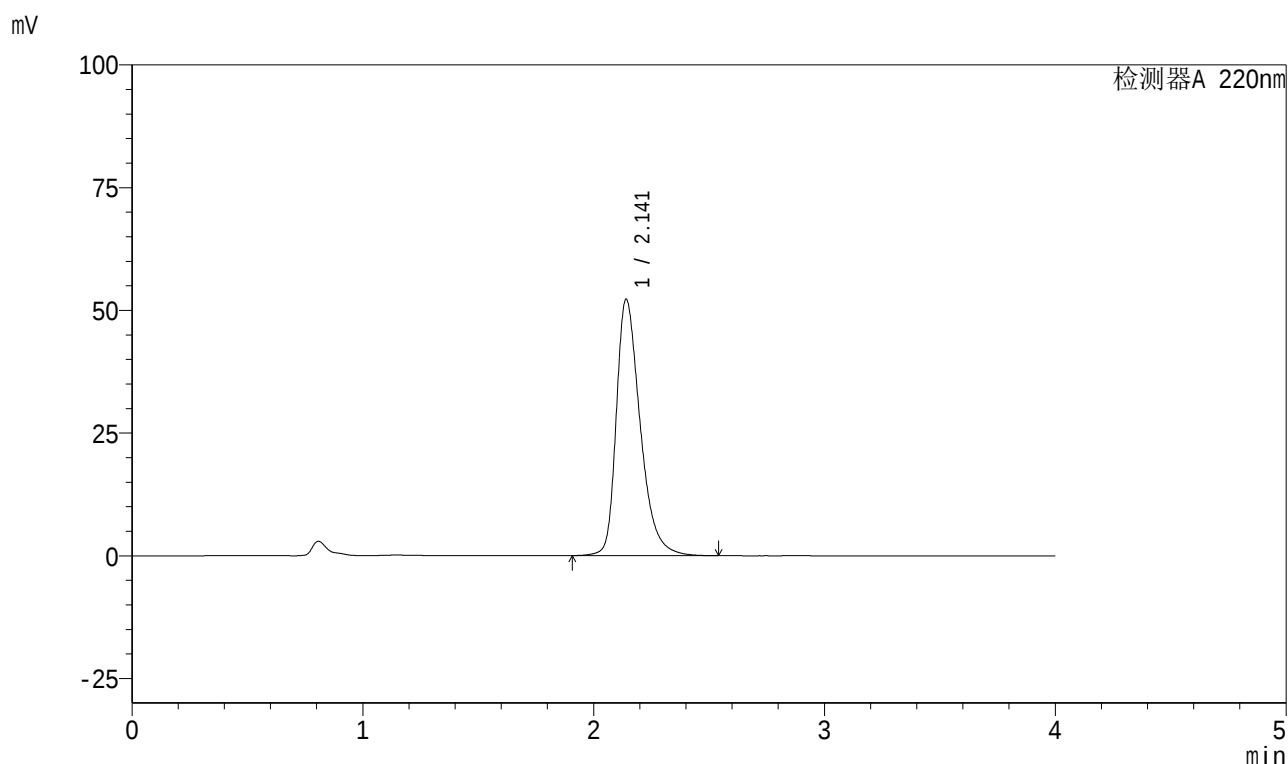

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	376803	100.000	52164	2159	1.379	--
总计		376803	100.000	52164			

图144 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-260-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:10:01
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

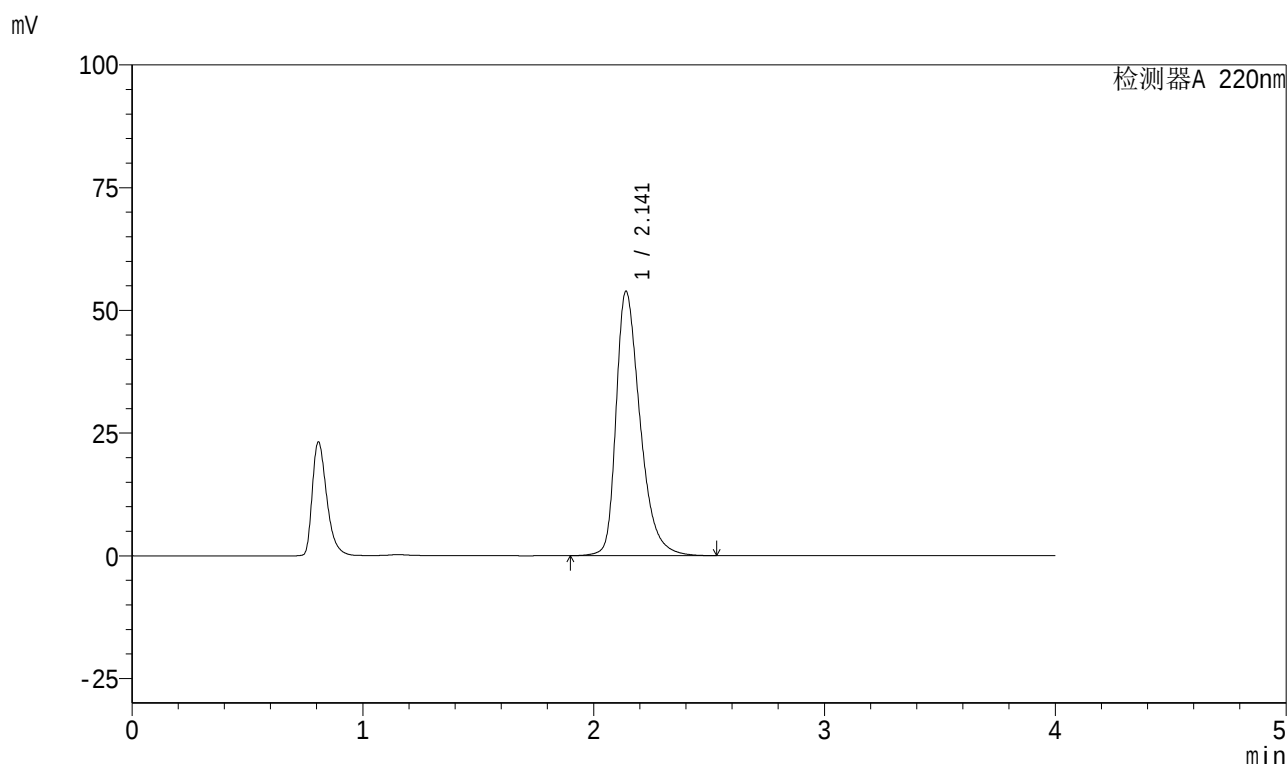

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	389544	100.000	53845	2146	1.384	--
总计		389544	100.000	53845			

图145 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-261-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:14:22
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

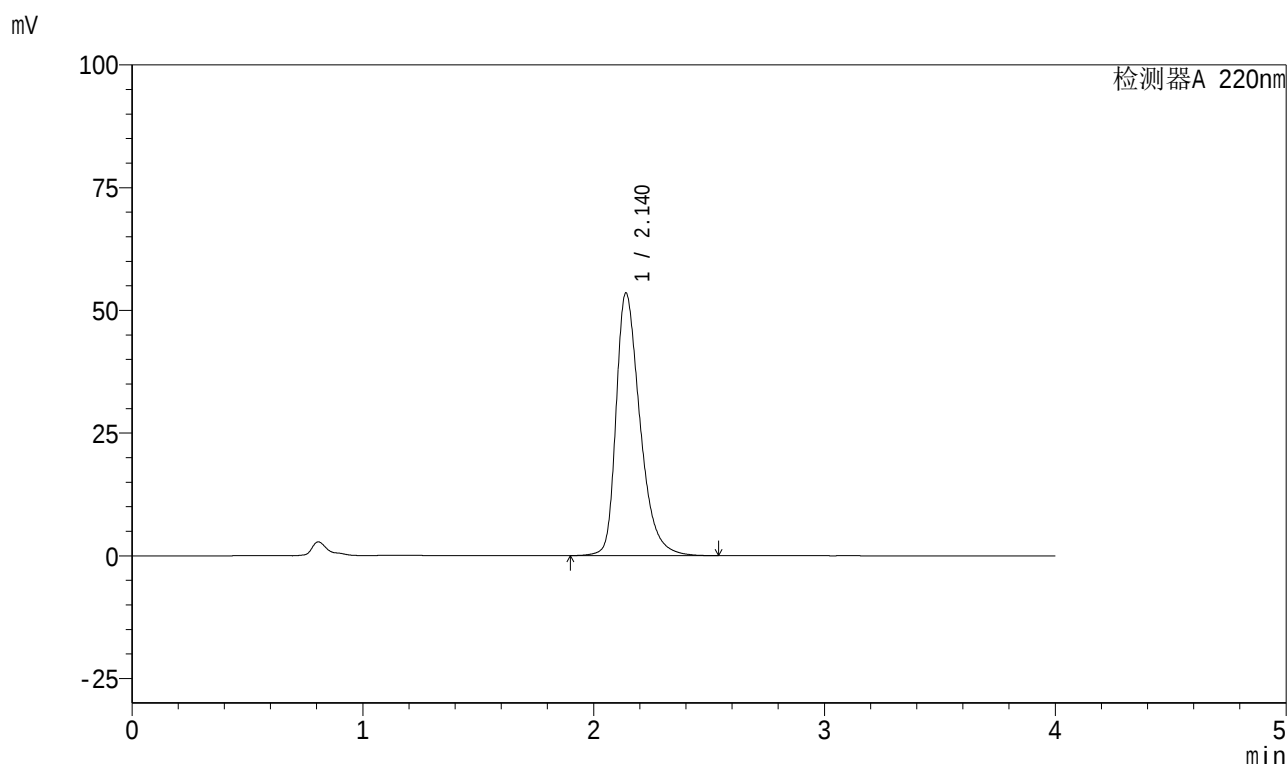

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	386464	100.000	53500	2151	1.383	--
总计		386464	100.000	53500			

图146 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-262-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:18:43
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

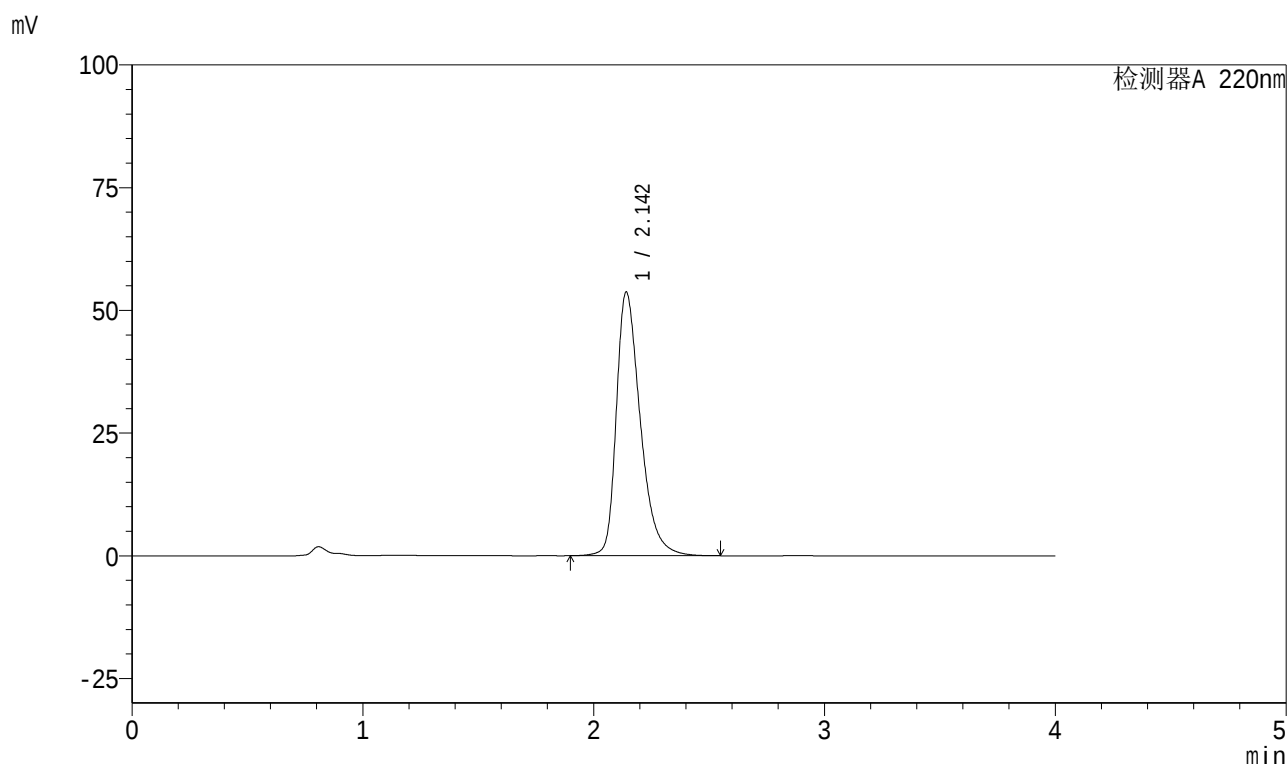

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	388269	100.000	53609	2151	1.386	--
总计		388269	100.000	53609			

图147 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-263-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 03:23:04
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

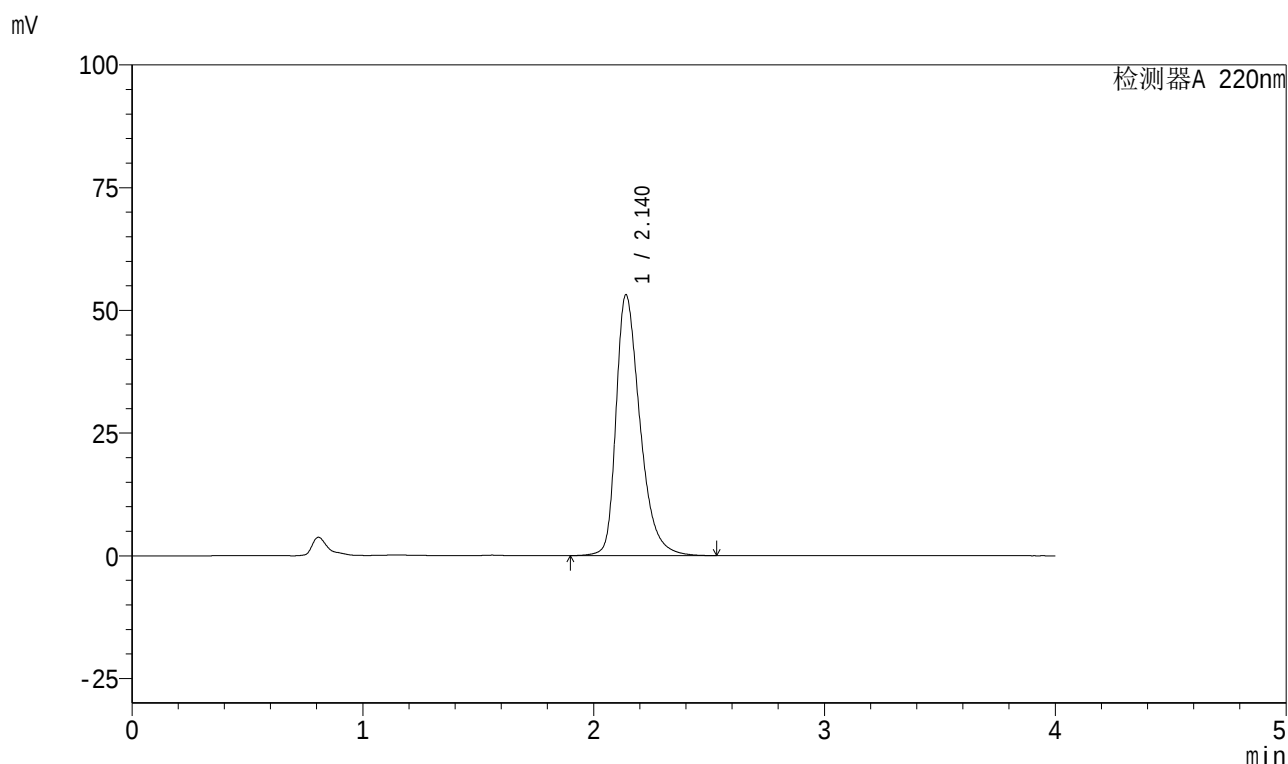

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	383430	100.000	53119	2155	1.382	--
总计		383430	100.000	53119			

图148 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-264-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:27:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

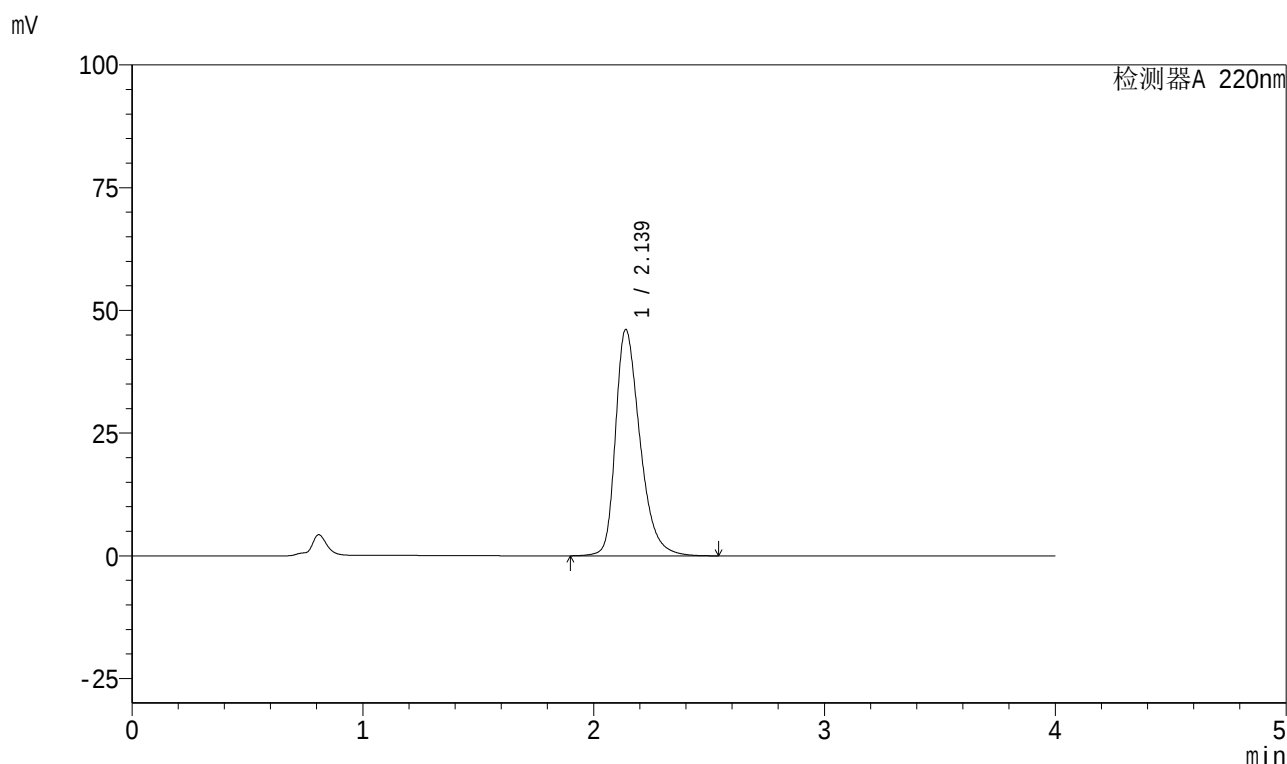

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	339946	100.000	46124	2051	1.351	--
总计		339946	100.000	46124			

图149 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-265-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:31:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

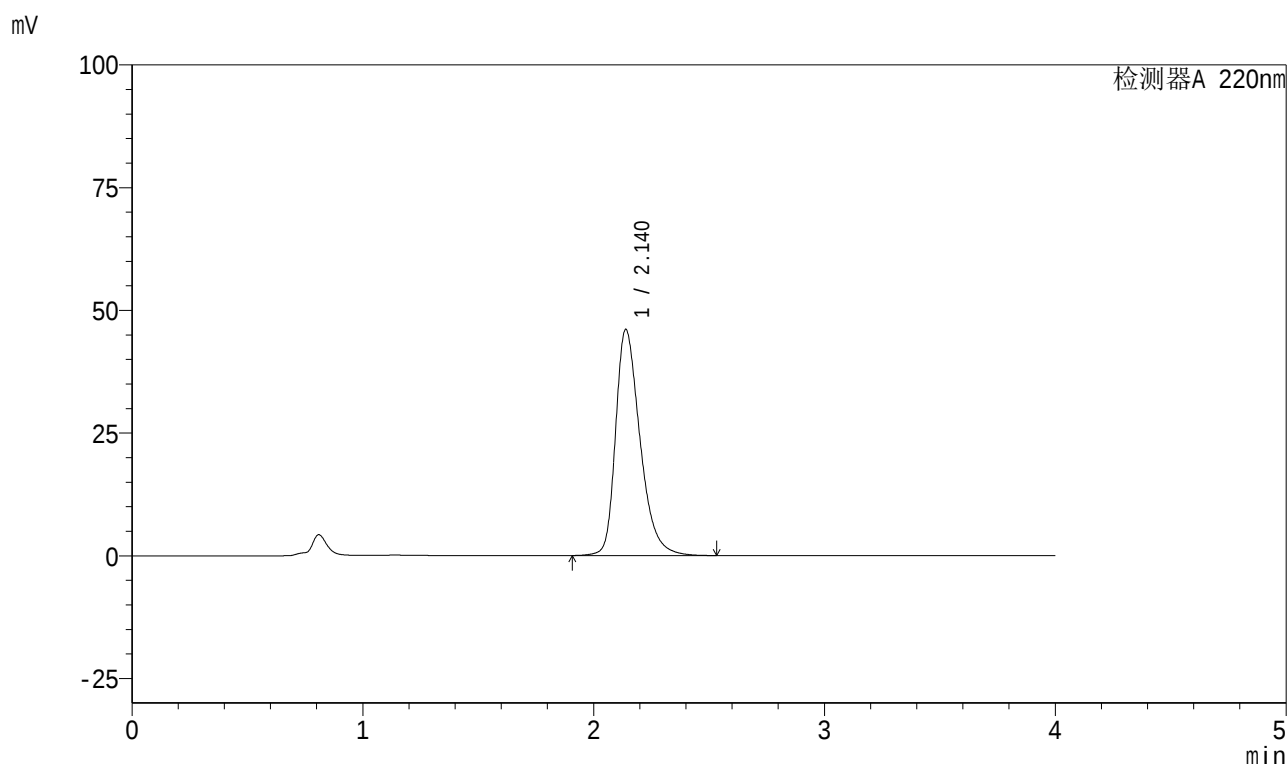

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	339593	100.000	46078	2051	1.352	--
总计		339593	100.000	46078			

图150 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-266-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:36:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:58:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

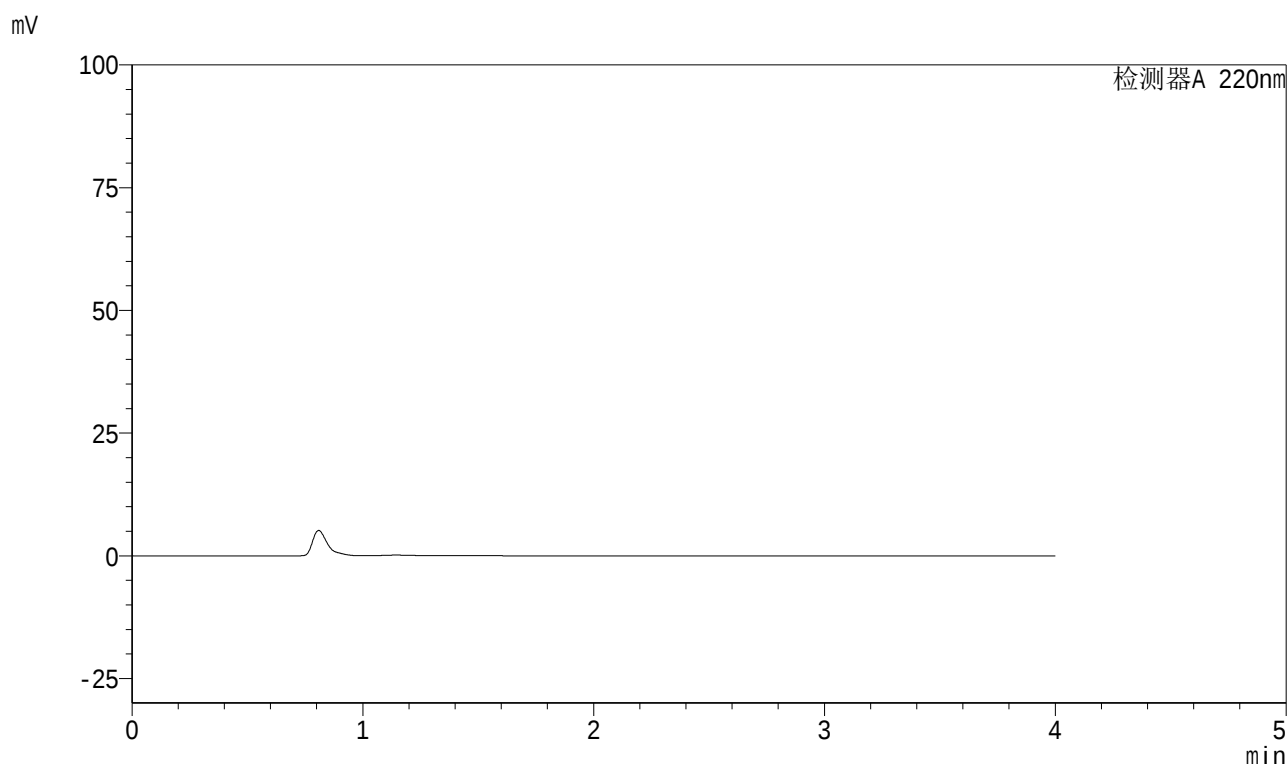

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
溶剂




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-267-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:40:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

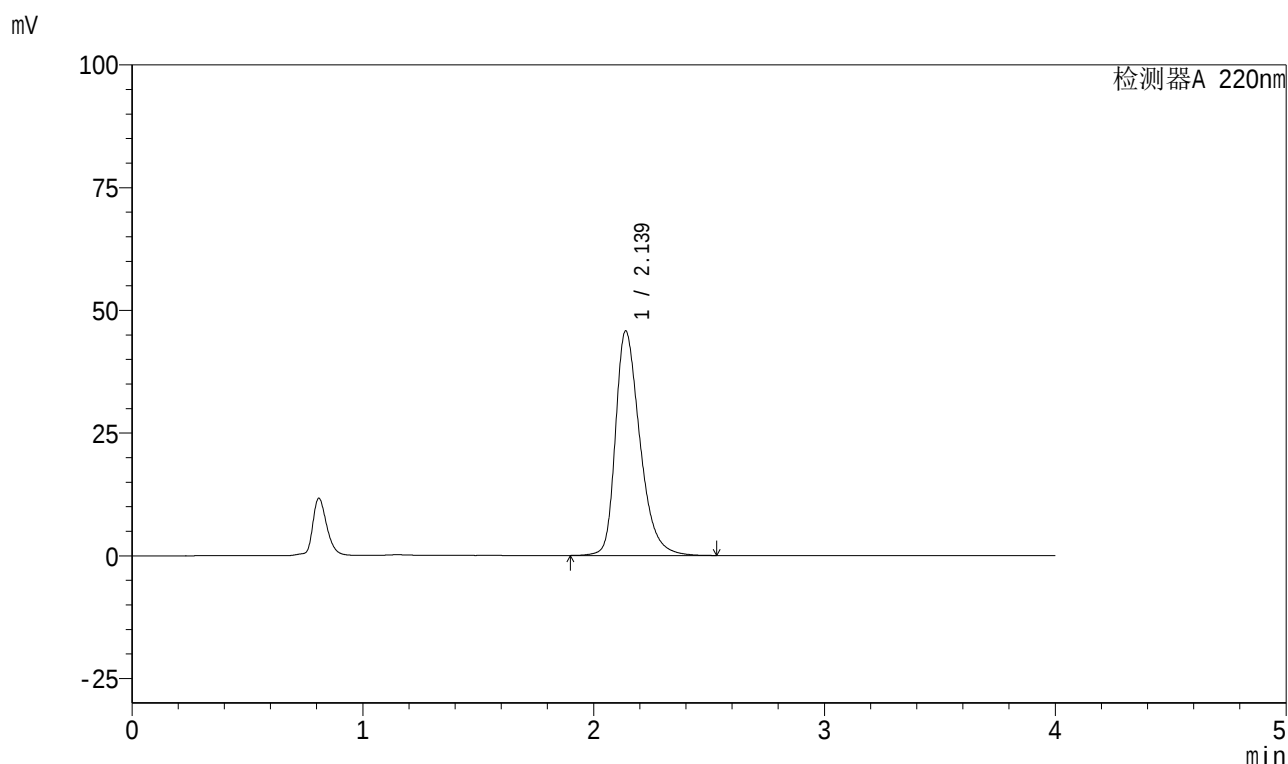

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	337183	100.000	45751	2051	1.350	--
总计		337183	100.000	45751			

图152 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-268-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:44:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

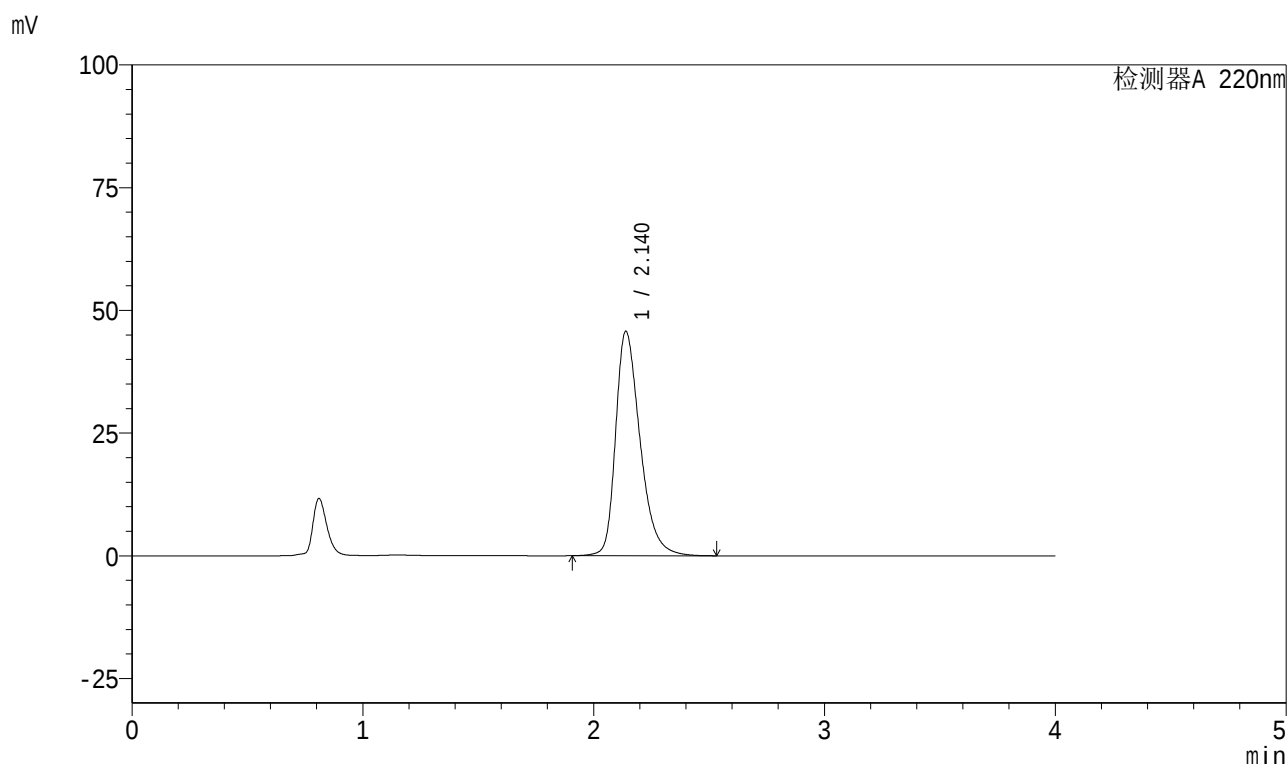

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	336986	100.000	45726	2052	1.351	--
总计		336986	100.000	45726			

图153 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-269-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:49:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

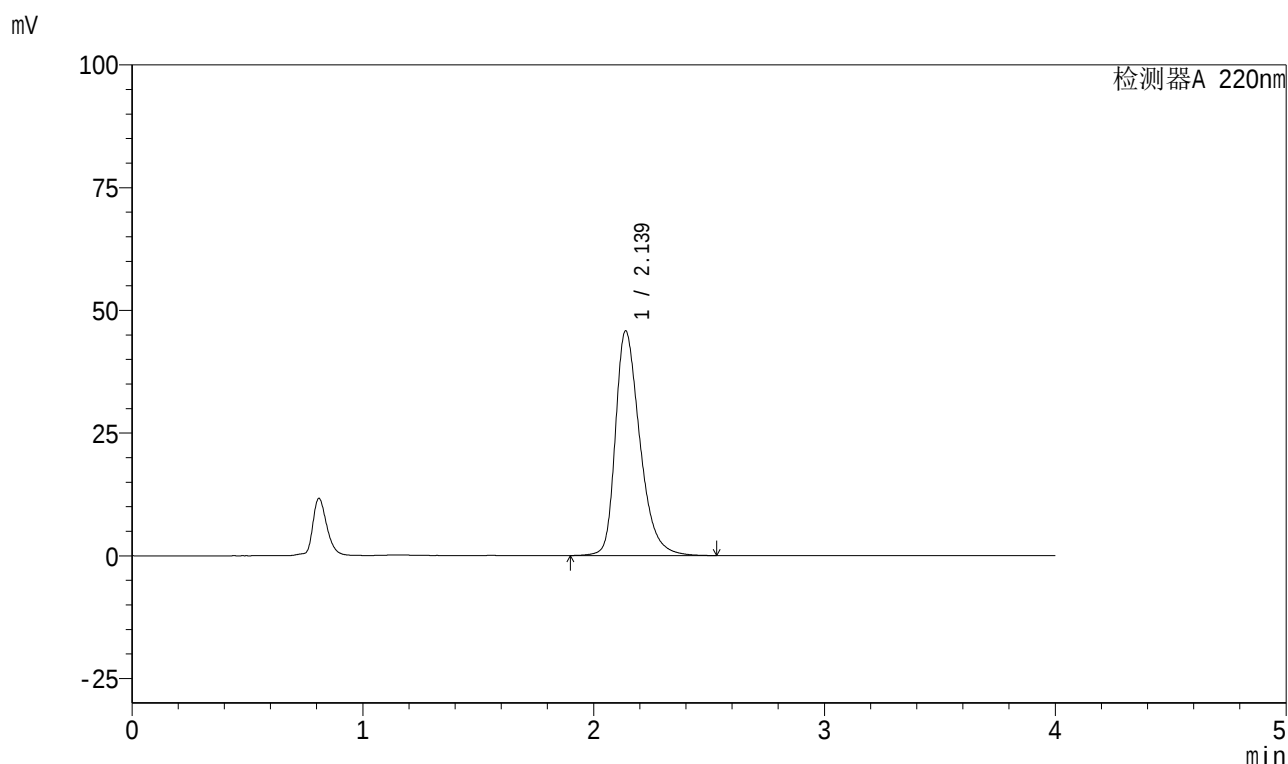

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	337438	100.000	45772	2049	1.351	--
总计		337438	100.000	45772			

图154 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-270-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:53:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

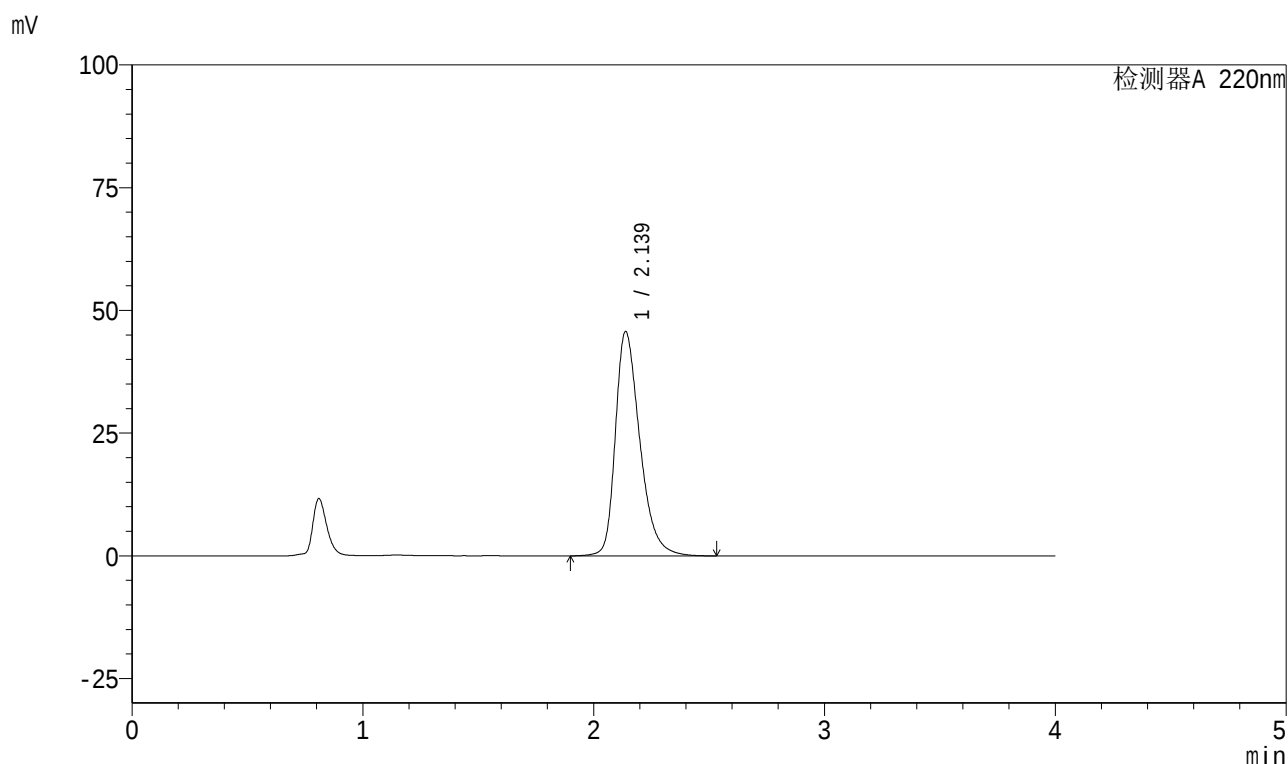

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	336919	100.000	45729	2051	1.351	--
总计		336919	100.000	45729			

图155 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-271-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 03:58:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

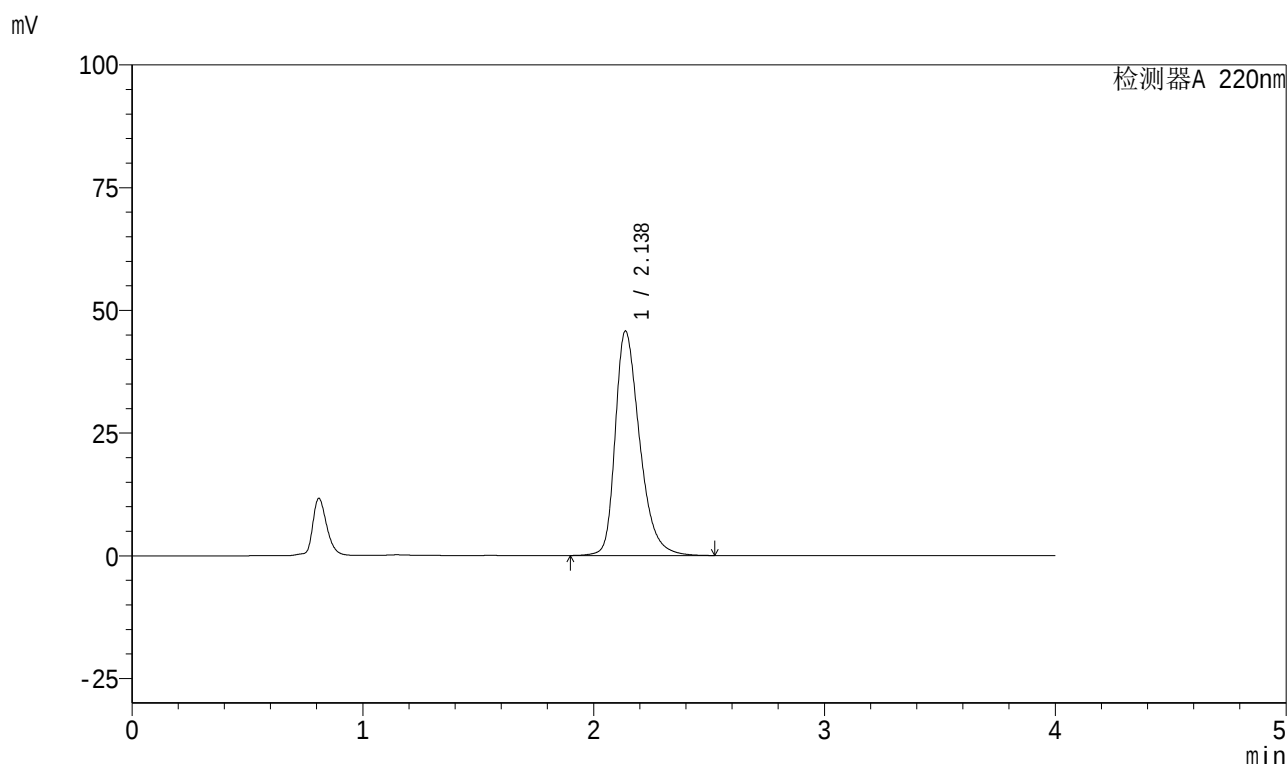

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	336766	100.000	45747	2053	1.350	--
总计		336766	100.000	45747			

图156 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-272-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 04:02:34
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

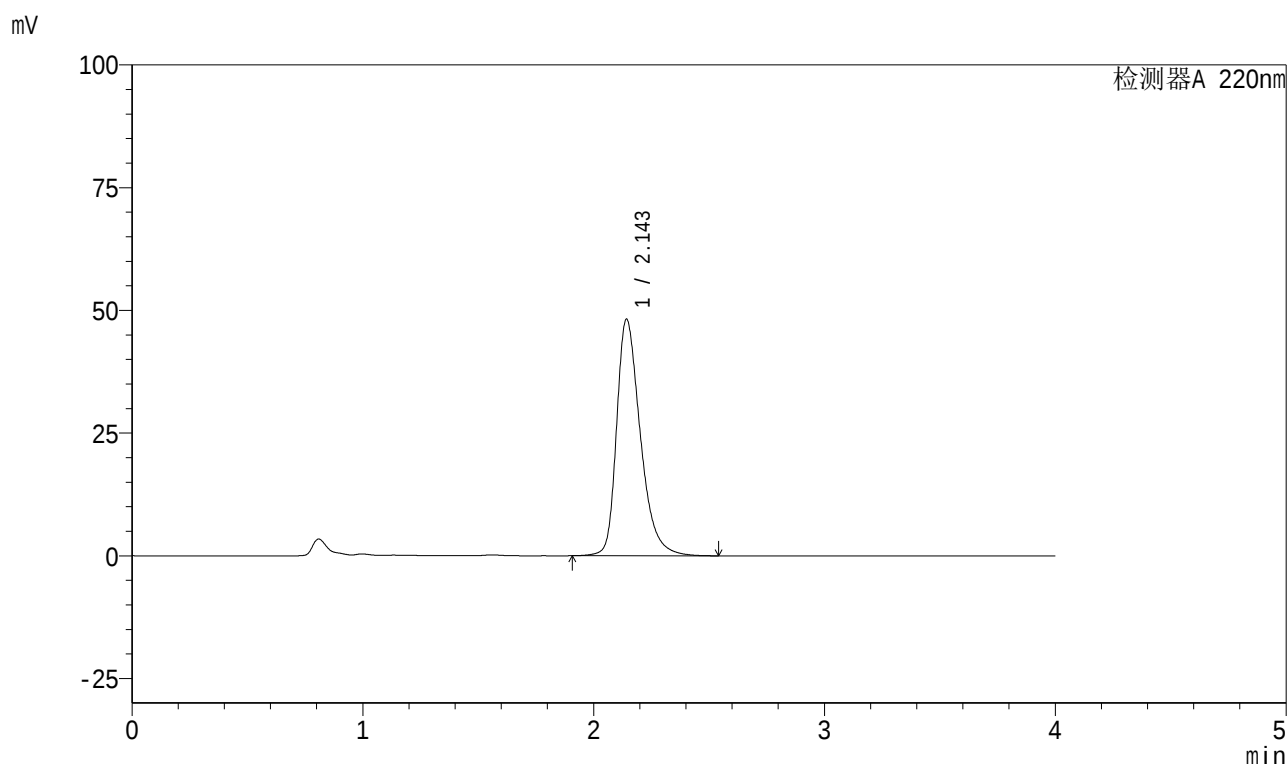

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	345426	100.000	48025	2194	1.364	--
总计		345426	100.000	48025			

图157 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-273-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 04:06:57
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

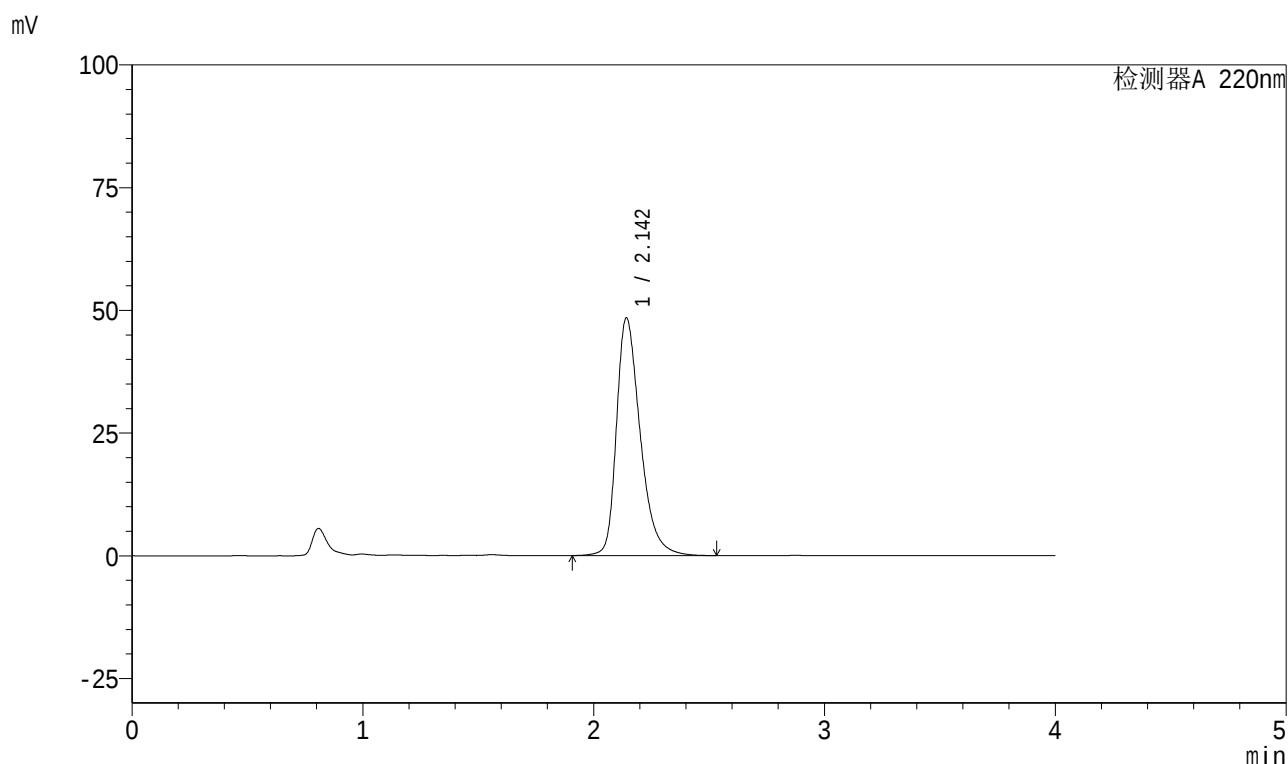

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	347094	100.000	48274	2192	1.364	--
总计		347094	100.000	48274			

图158 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-274-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-19 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 04:11:20 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

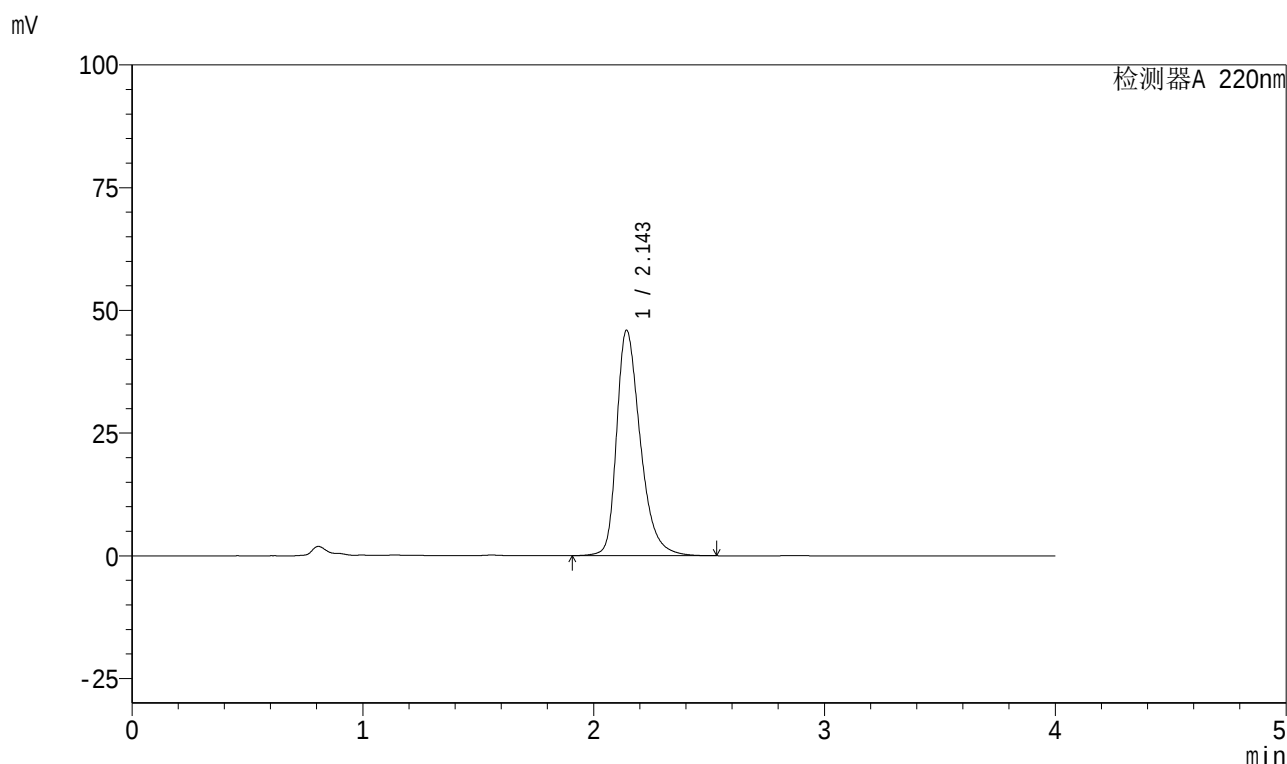

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	328109	100.000	45798	2212	1.353	--
总计		328109	100.000	45798			

图159 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C	波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-275-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm	
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb	
样品瓶号: 4-28	版本号:6.115
进样体积: 10 μl	实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 04:15:42	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:20	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)	

<色谱图>

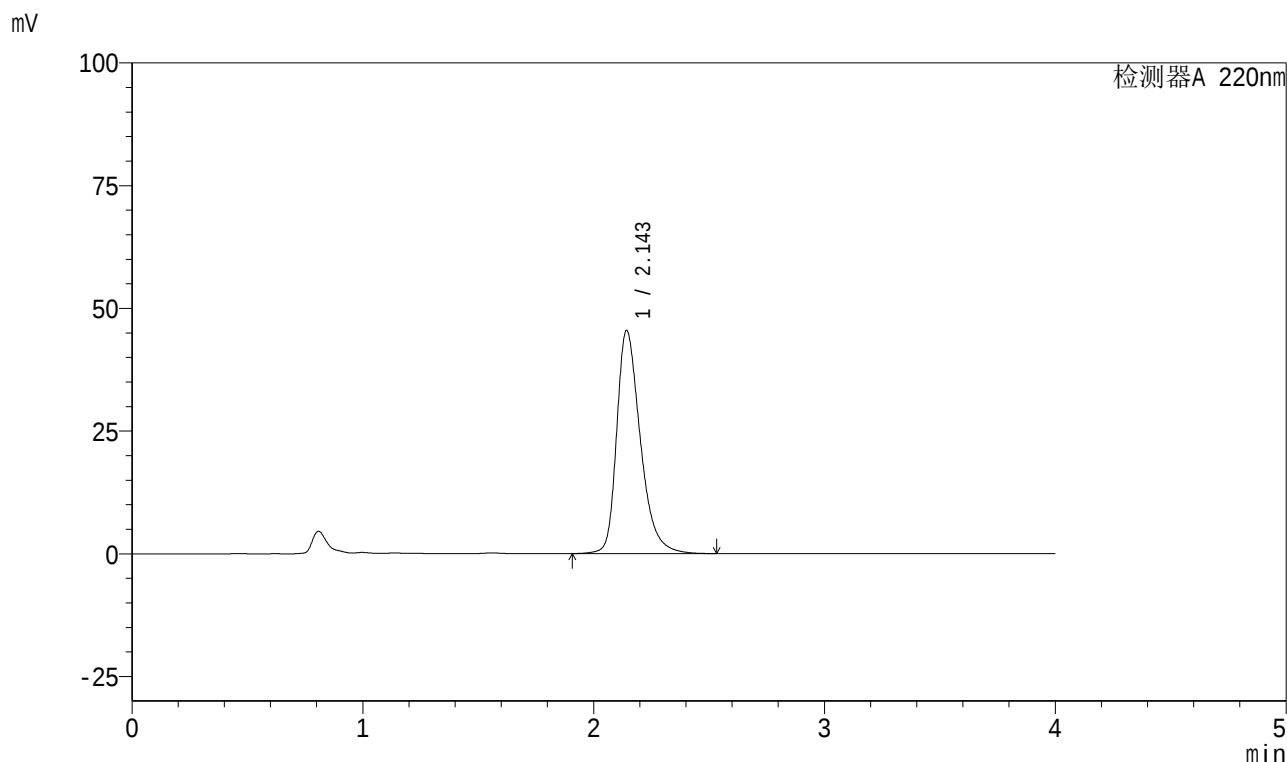

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	324477	100.000	45335	2215	1.351	--
总计		324477	100.000	45335			

图160 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-276-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:20:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

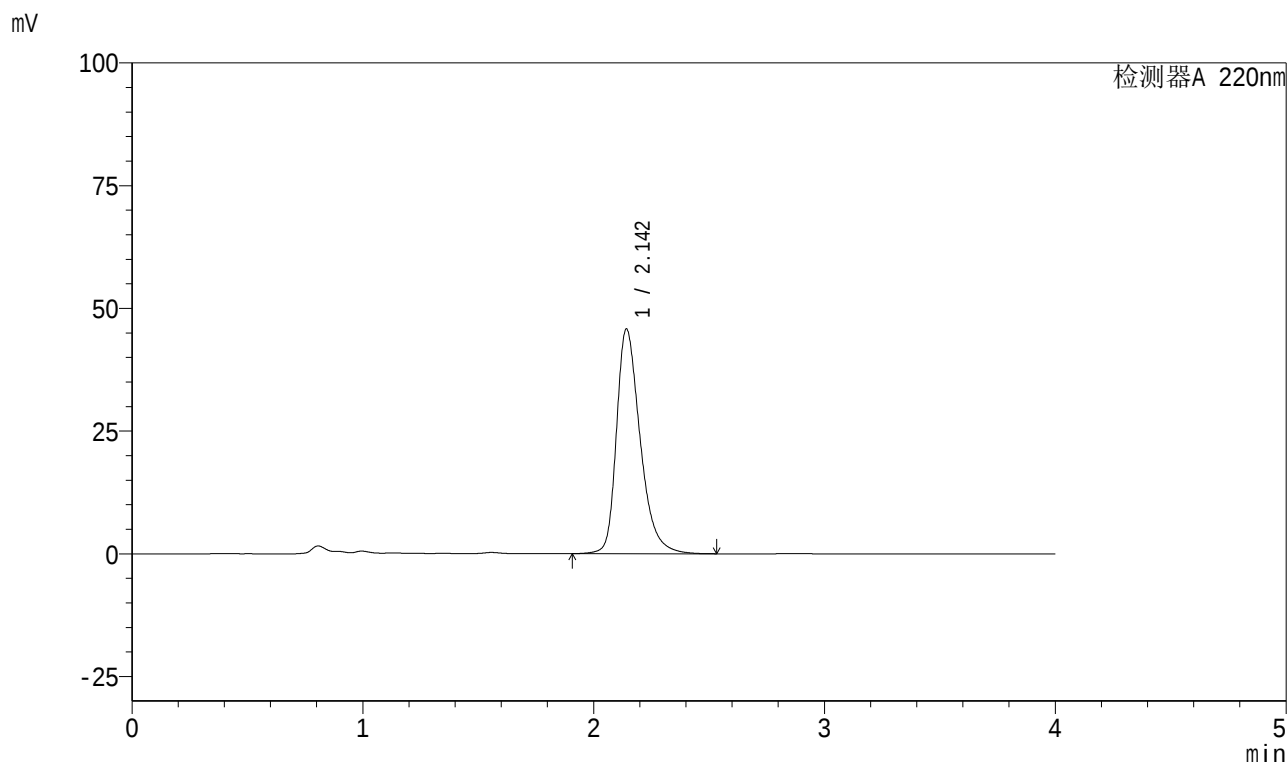

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	326805	100.000	45622	2214	1.353	--
总计		326805	100.000	45622			

图161 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-277-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:24:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

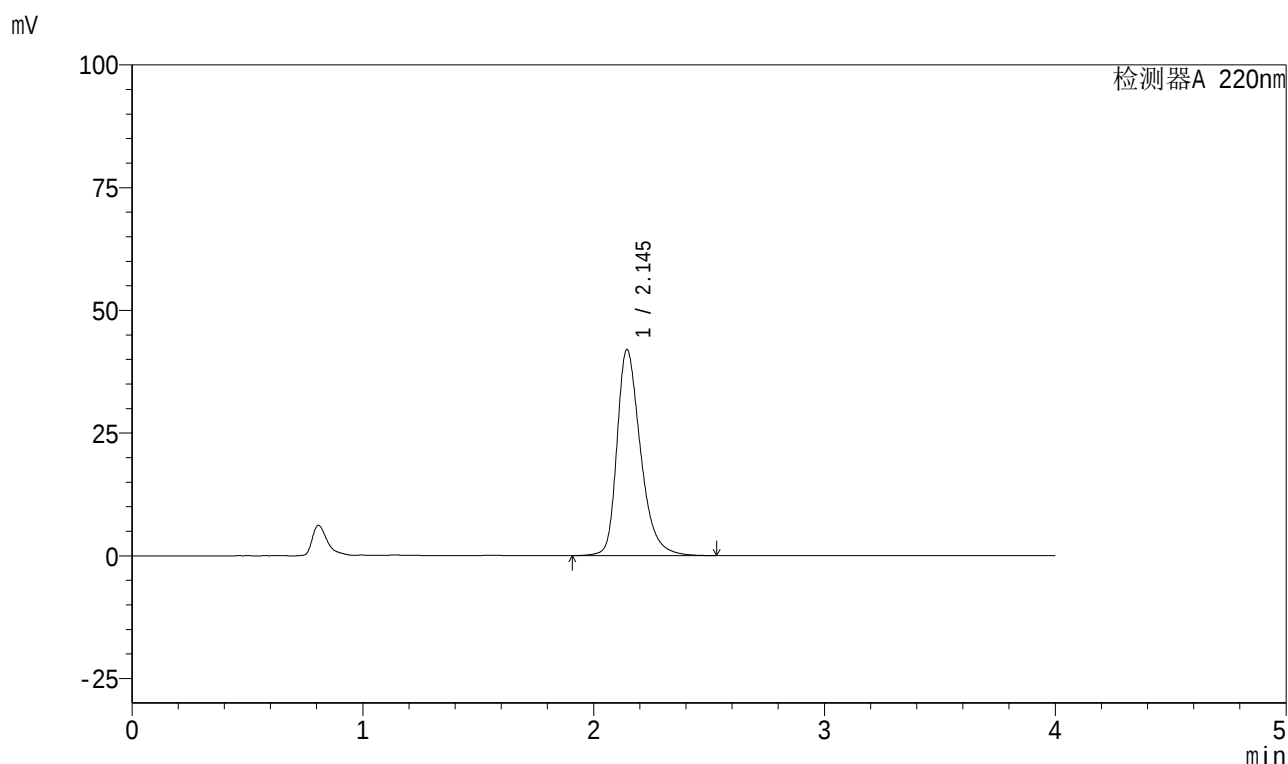

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	298278	100.000	41954	2242	1.337	--
总计		298278	100.000	41954			

图162 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-278-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 04:28:50
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

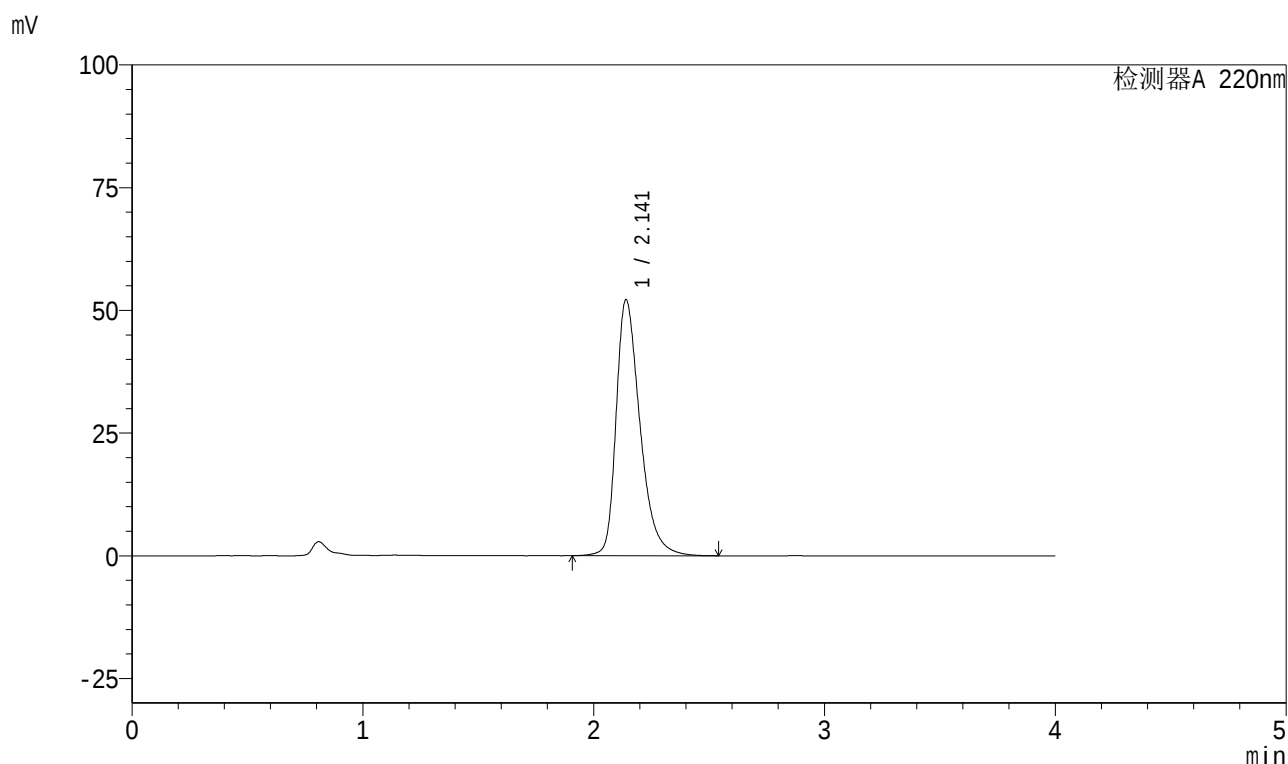

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	375726	100.000	52124	2164	1.379	--
总计		375726	100.000	52124			

图163 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-279-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 04:33:13
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

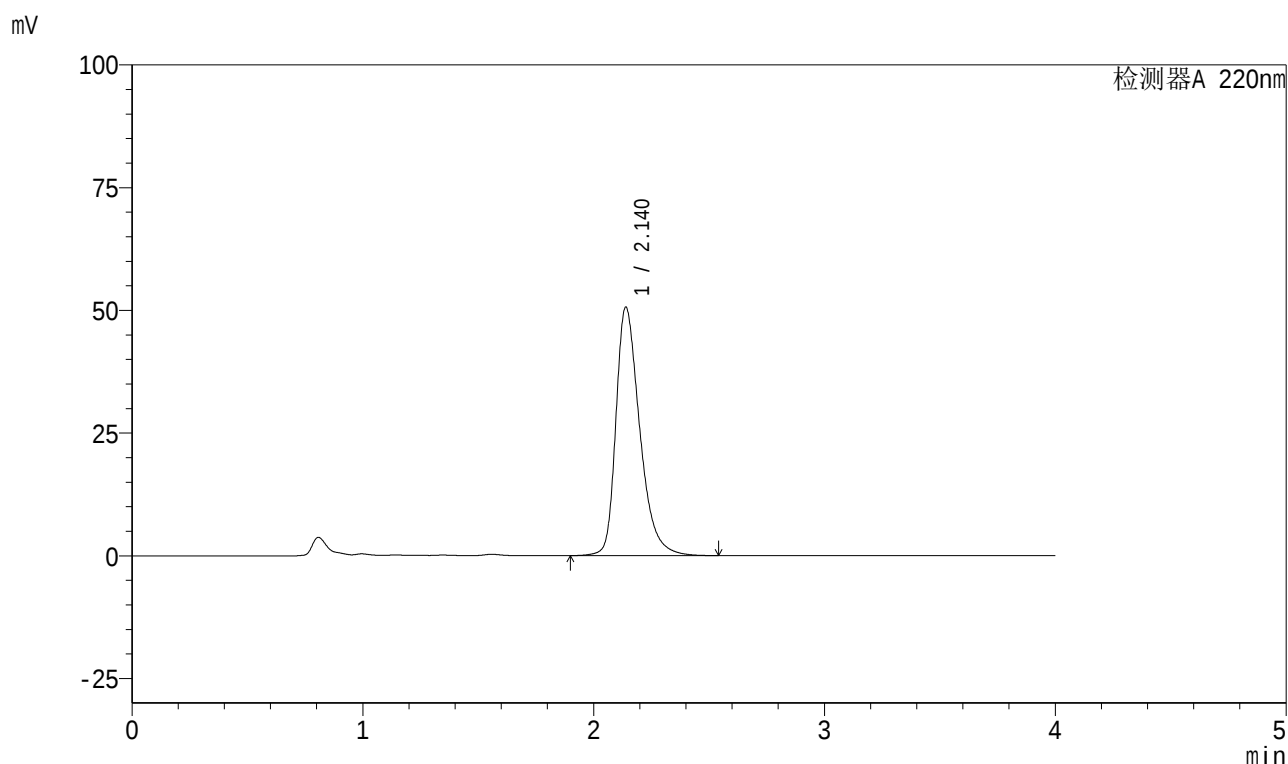

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	363930	100.000	50632	2175	1.372	--
总计		363930	100.000	50632			

图164 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-280-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-20 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: jiangjinwei
分析时间: 2026/05/26 04:37:36 处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

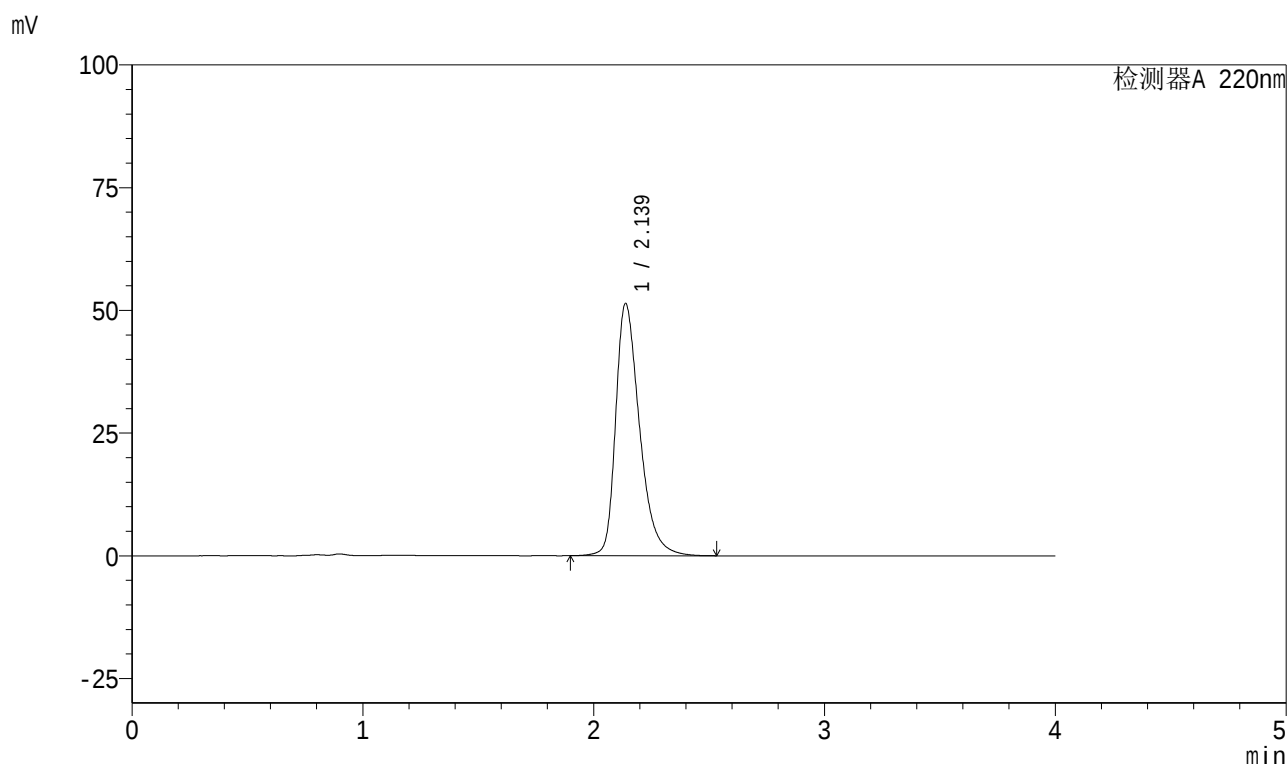

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	369983	100.000	51417	2163	1.374	--
总计		369983	100.000	51417			

图165 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-281-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:41:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

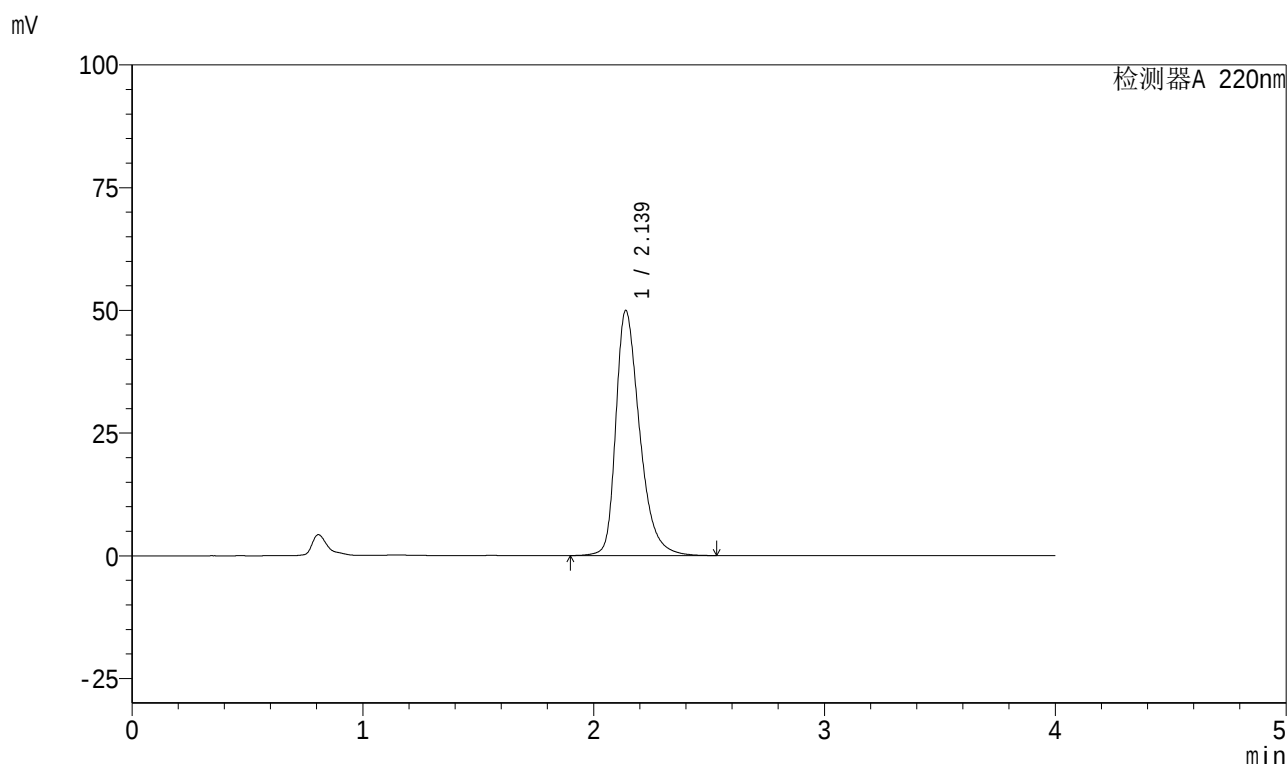

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	358195	100.000	49930	2182	1.369	--
总计		358195	100.000	49930			

图166 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-282-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 04:46:21
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

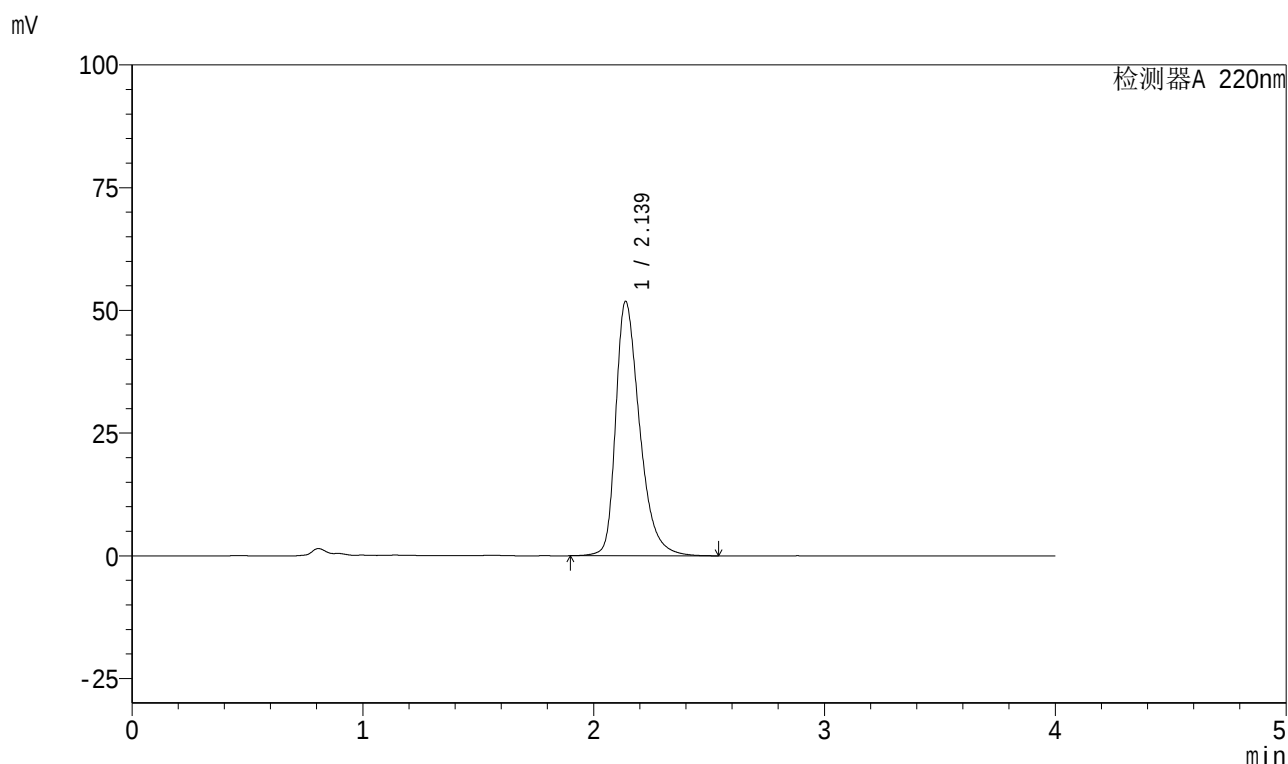

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	373388	100.000	51849	2162	1.376	--
总计		373388	100.000	51849			

图167 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-283-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2026/05/26 04:50:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

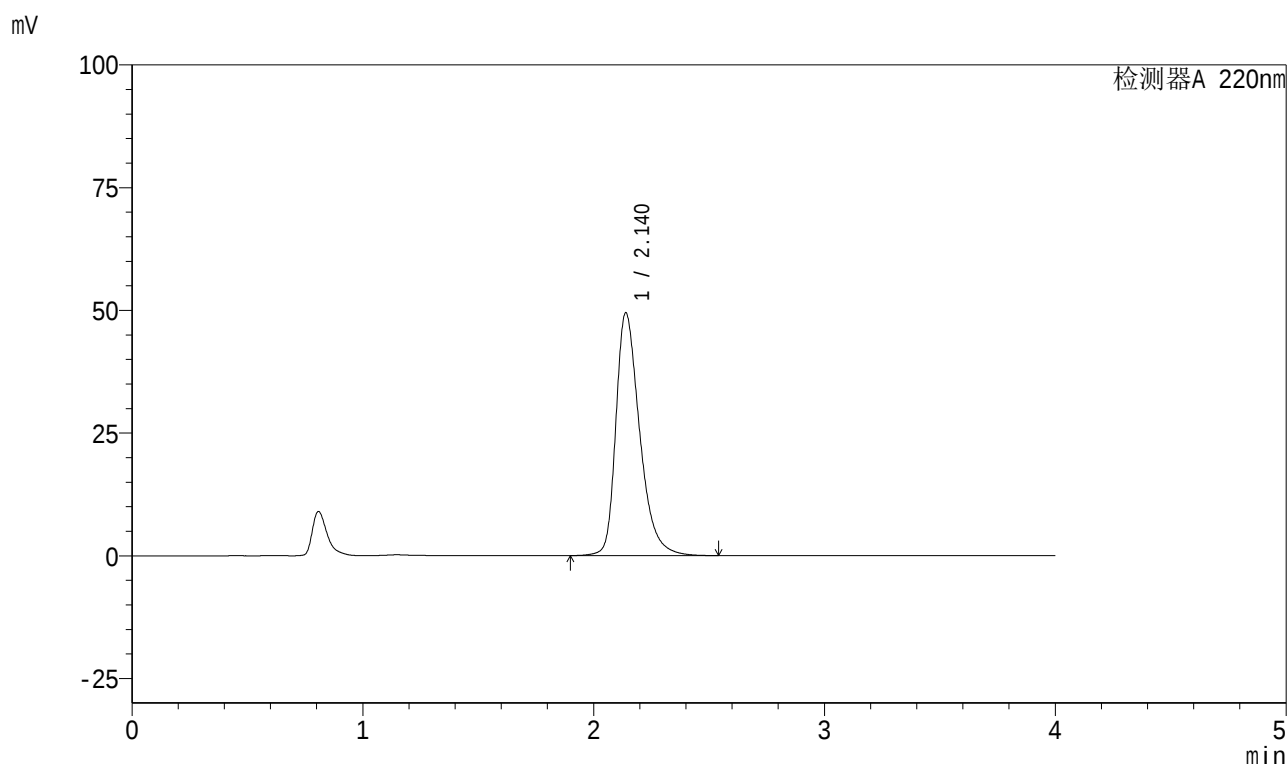

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.140	354864	100.000	49463	2182	1.367	--
总计		354864	100.000	49463			

图168 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-284-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:55:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

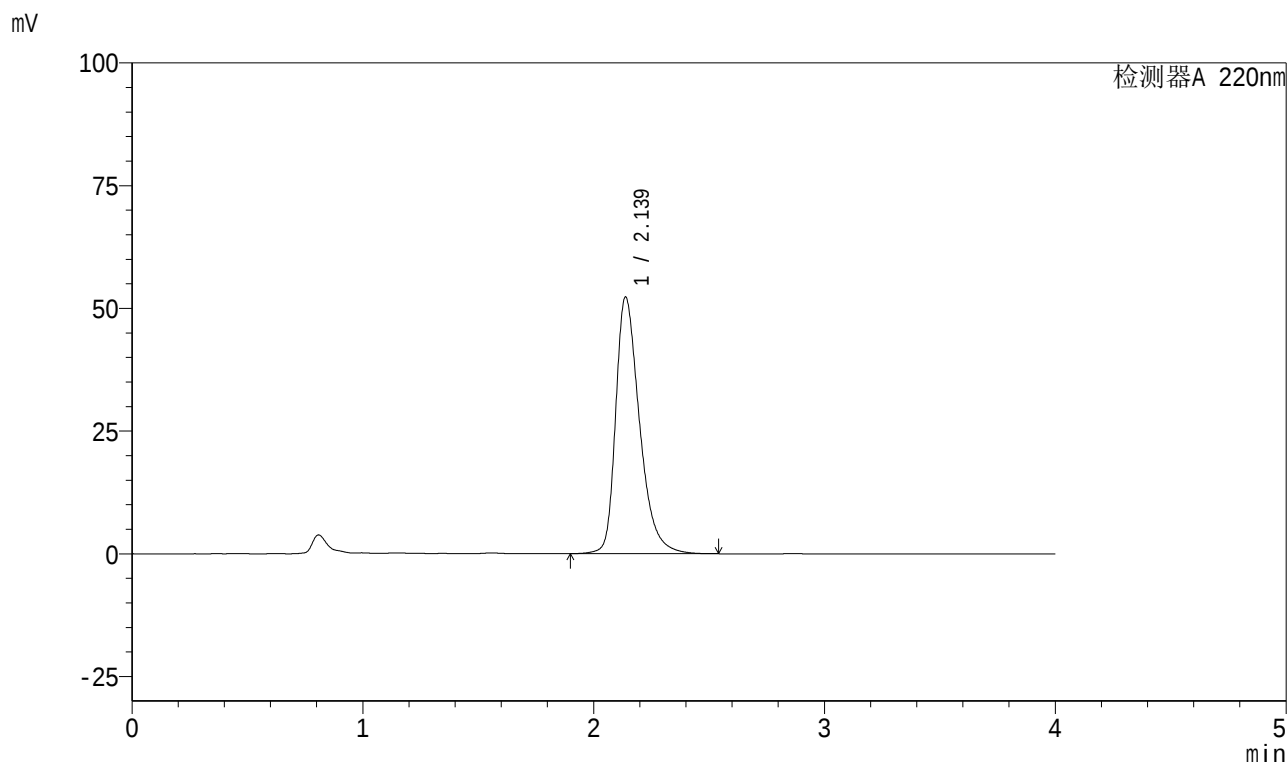

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	376620	100.000	52324	2160	1.378	--
总计		376620	100.000	52324			

图169 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-285-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 04:59:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

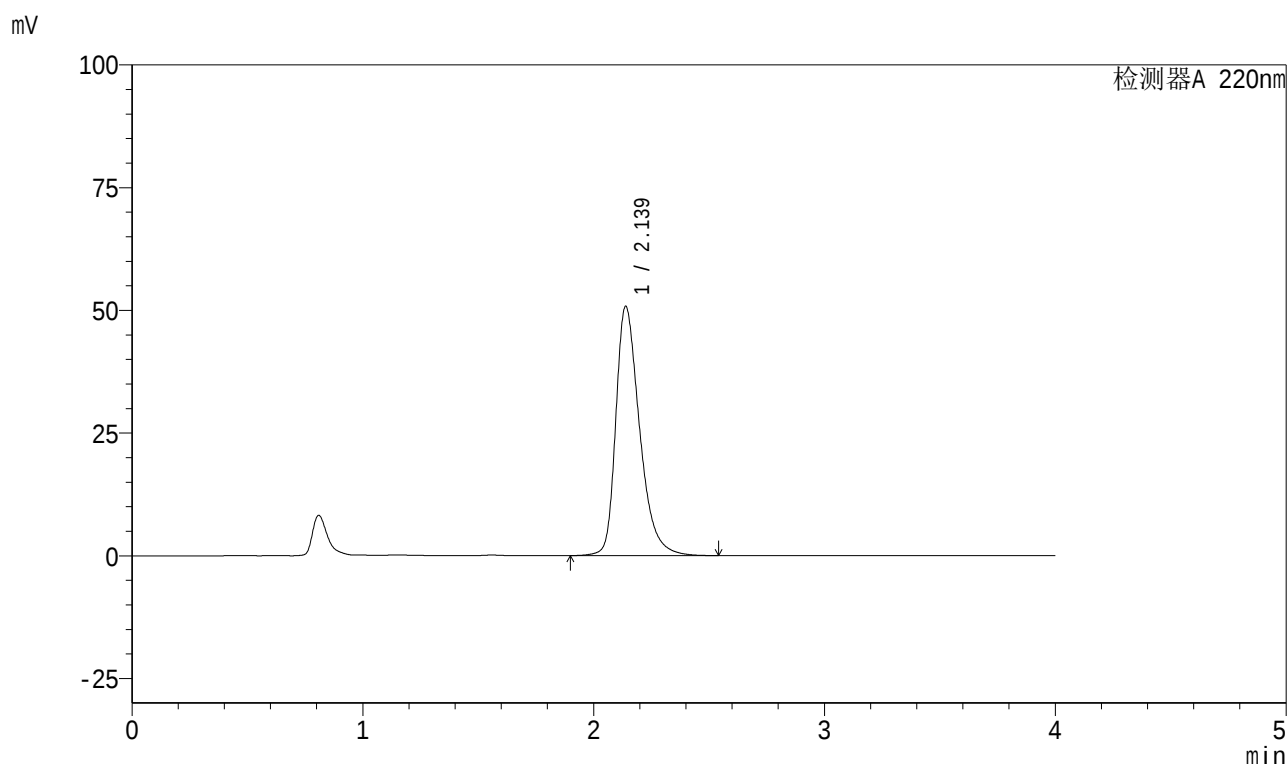

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	364501	100.000	50798	2180	1.372	--
总计		364501	100.000	50798			

图170 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-286-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:03:53
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

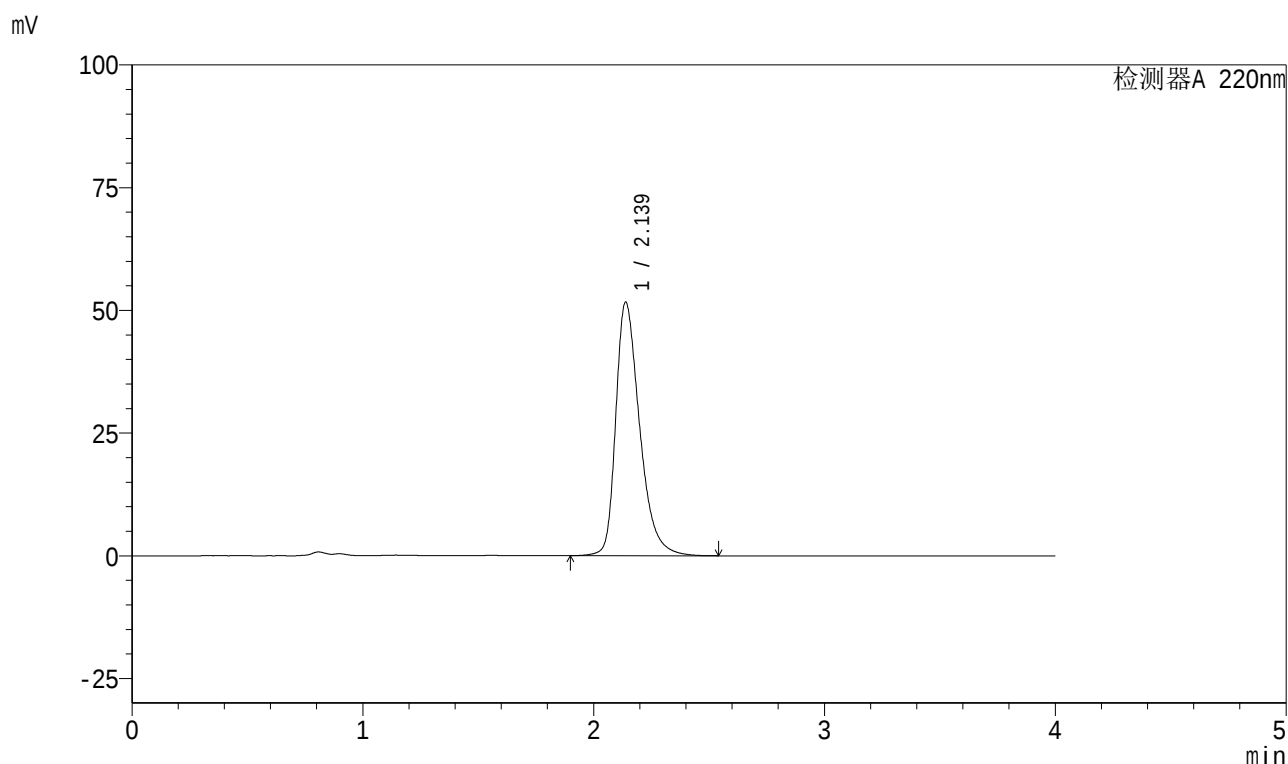

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	371897	100.000	51675	2166	1.376	--
总计		371897	100.000	51675			

图171 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-287-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:08:15
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

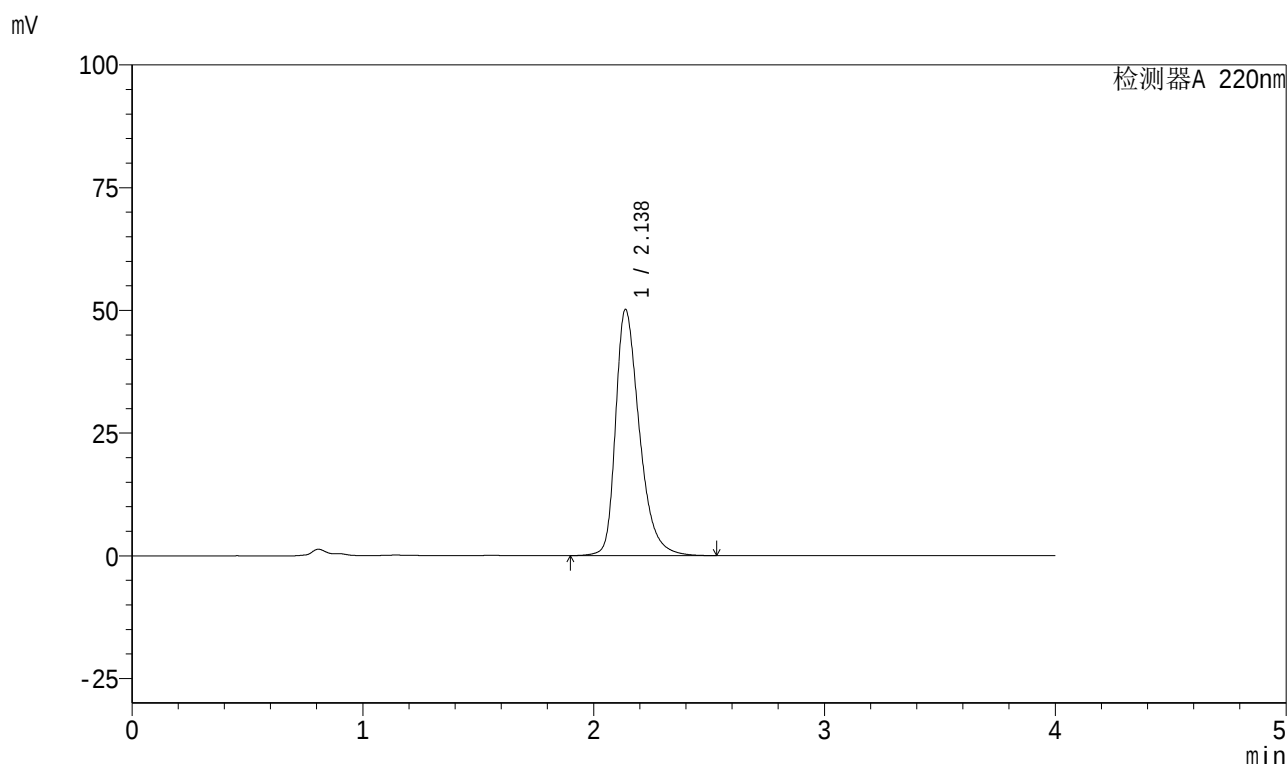

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	359904	100.000	50174	2179	1.369	--
总计		359904	100.000	50174			

图172 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-288-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 05:12:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

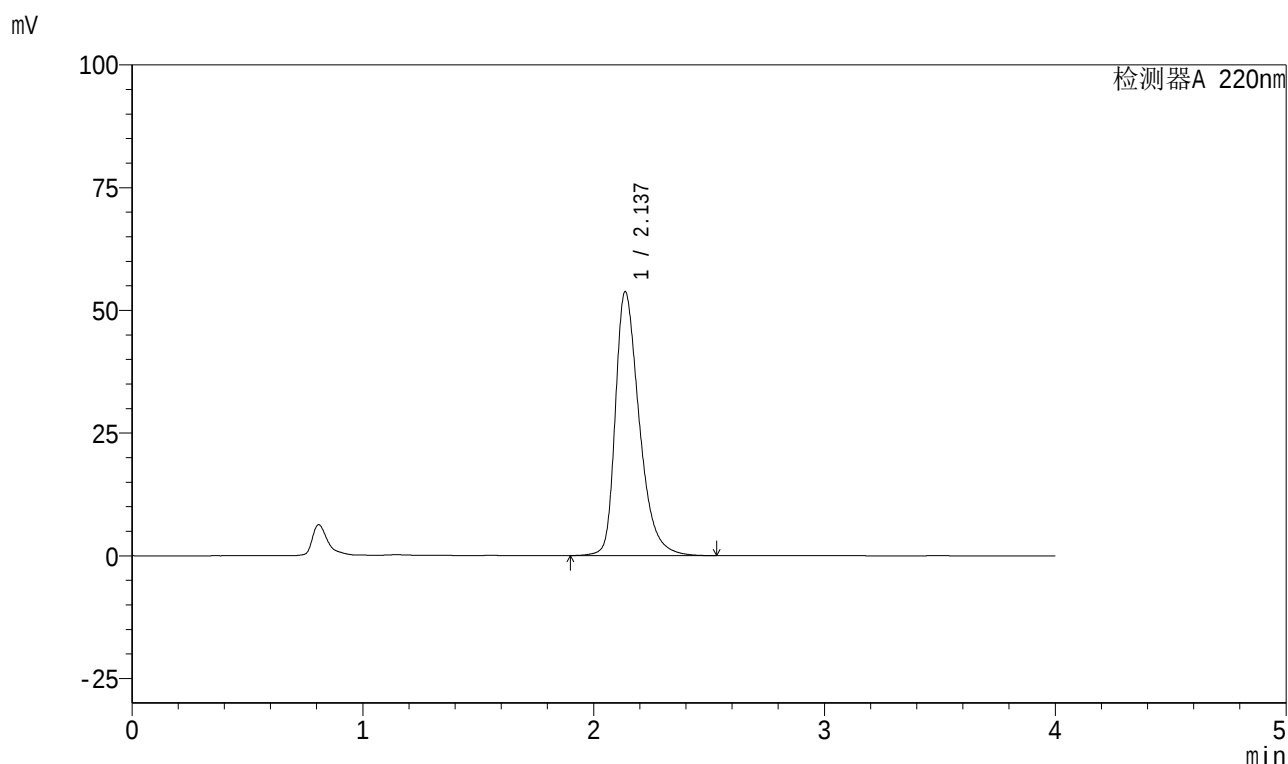

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	388161	100.000	53764	2147	1.384	--
总计		388161	100.000	53764			

图173 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-289-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 05:17:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

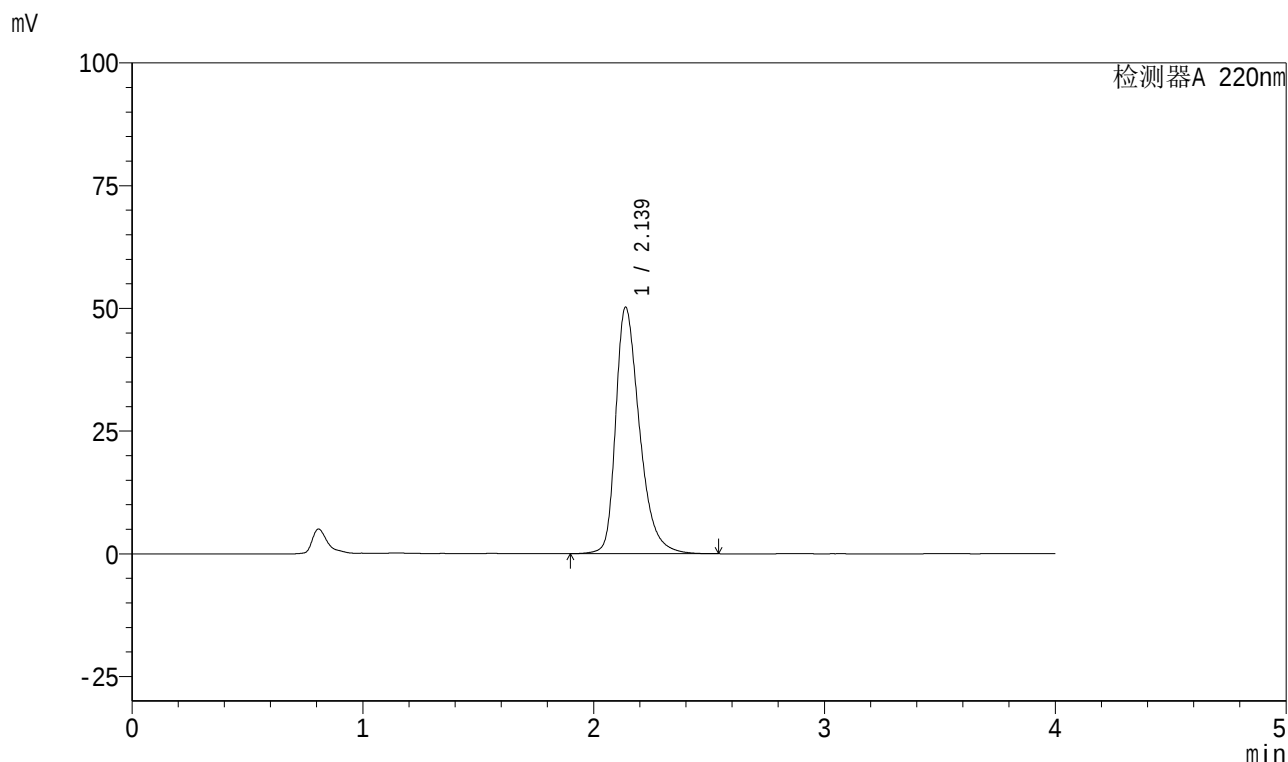

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	360820	100.000	50247	2174	1.370	--
总计		360820	100.000	50247			

图174 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-290-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 05:21:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 10:59:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

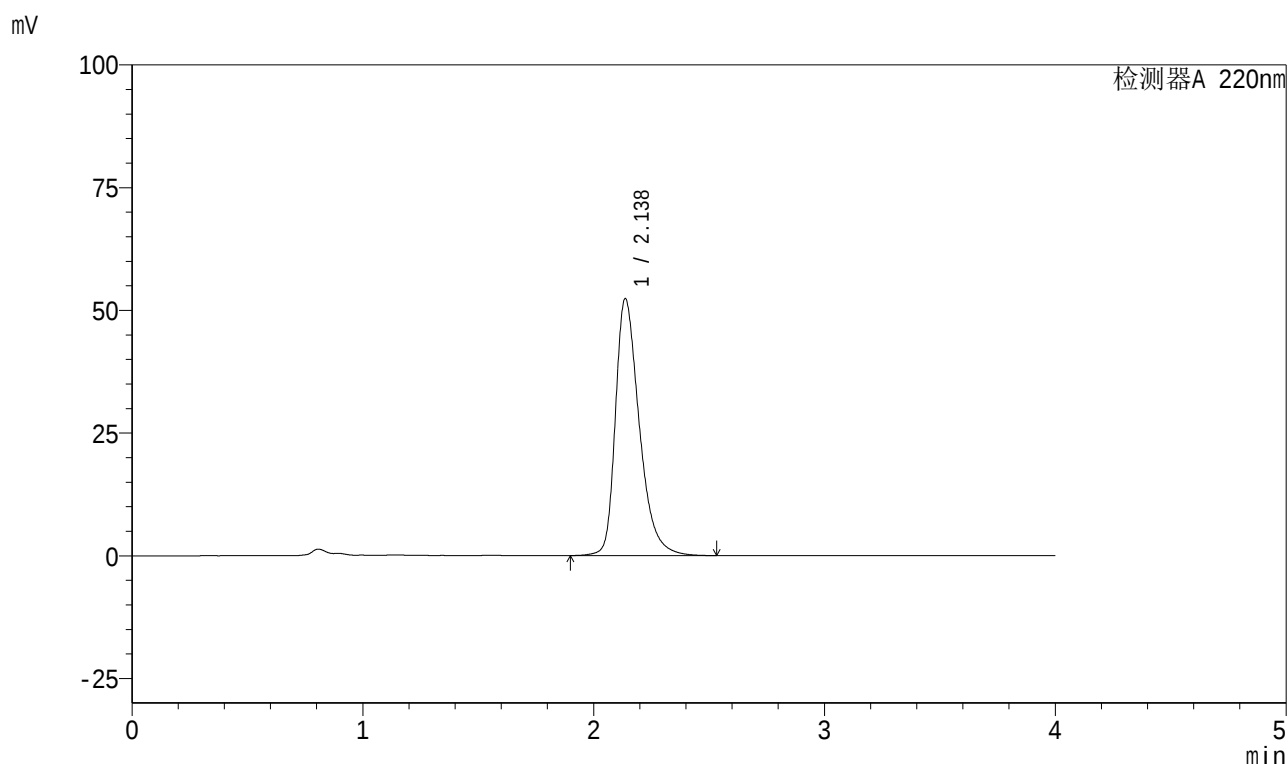

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	376858	100.000	52361	2162	1.378	--
总计		376858	100.000	52361			

图175 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-291-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 05:25:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

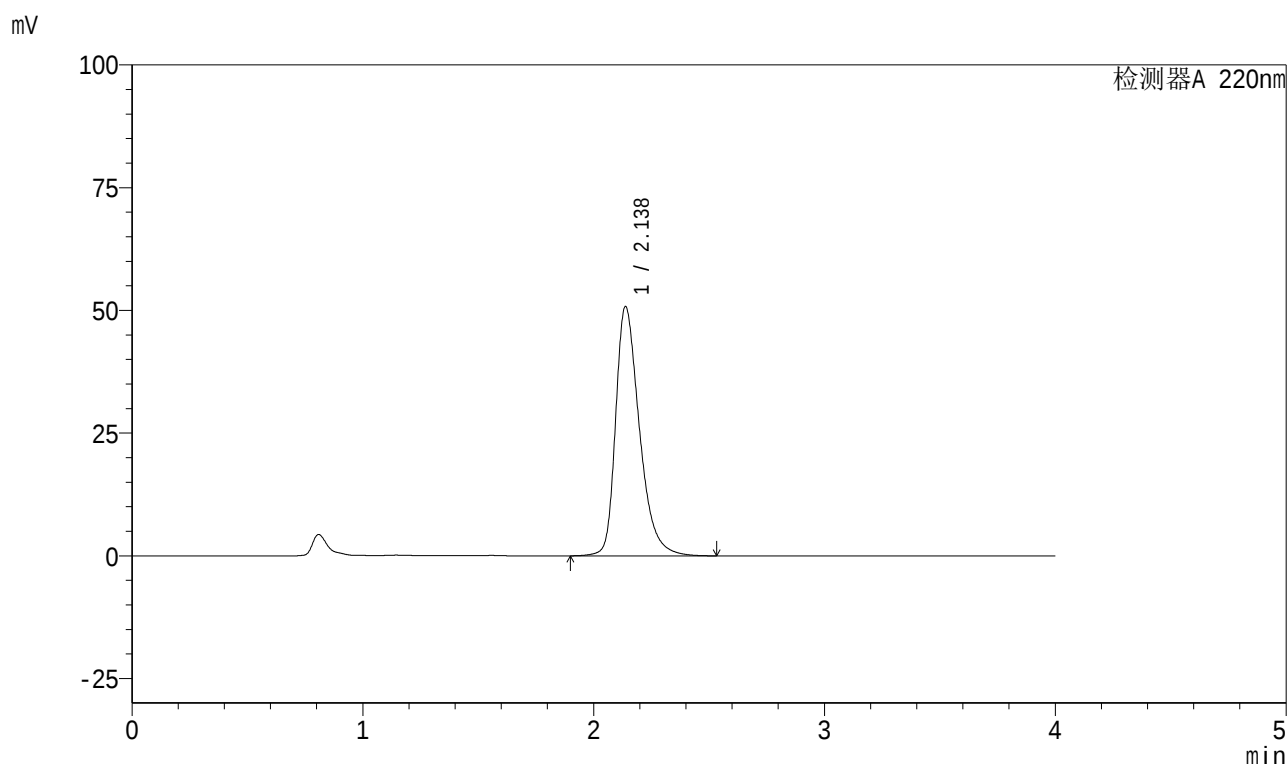

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	365080	100.000	50824	2173	1.372	--
总计		365080	100.000	50824			

图176 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-292-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:30:11
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

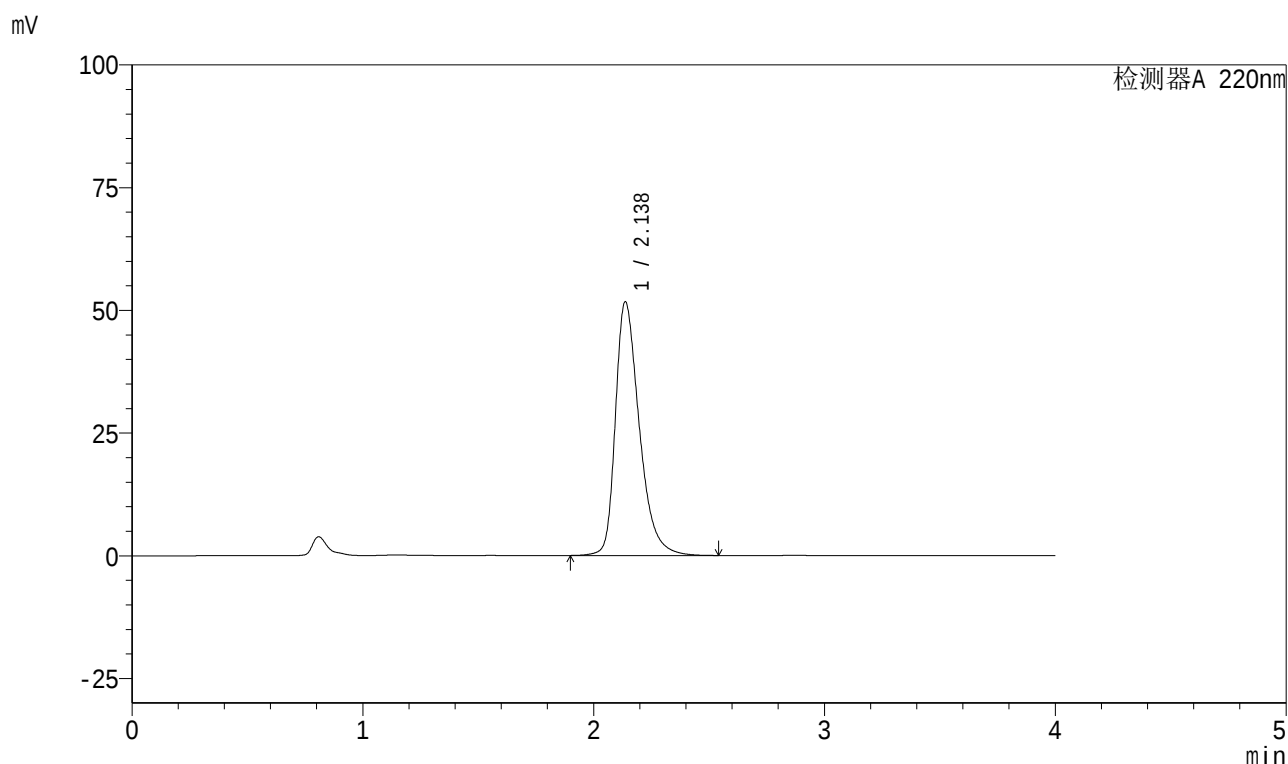

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	371978	100.000	51707	2165	1.376	--
总计		371978	100.000	51707			

图177 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-293-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:34:35
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

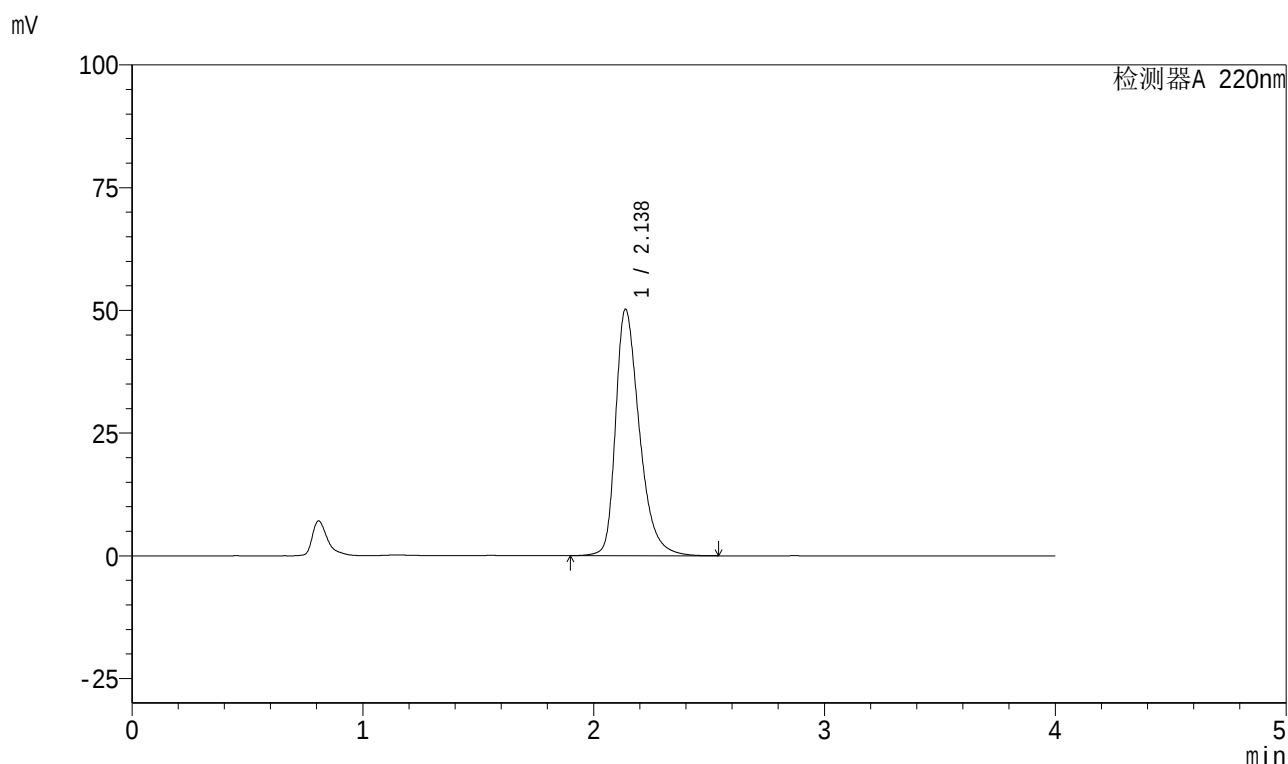

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	360615	100.000	50249	2177	1.370	--
总计		360615	100.000	50249			

图178 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-294-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:38:57 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:08 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

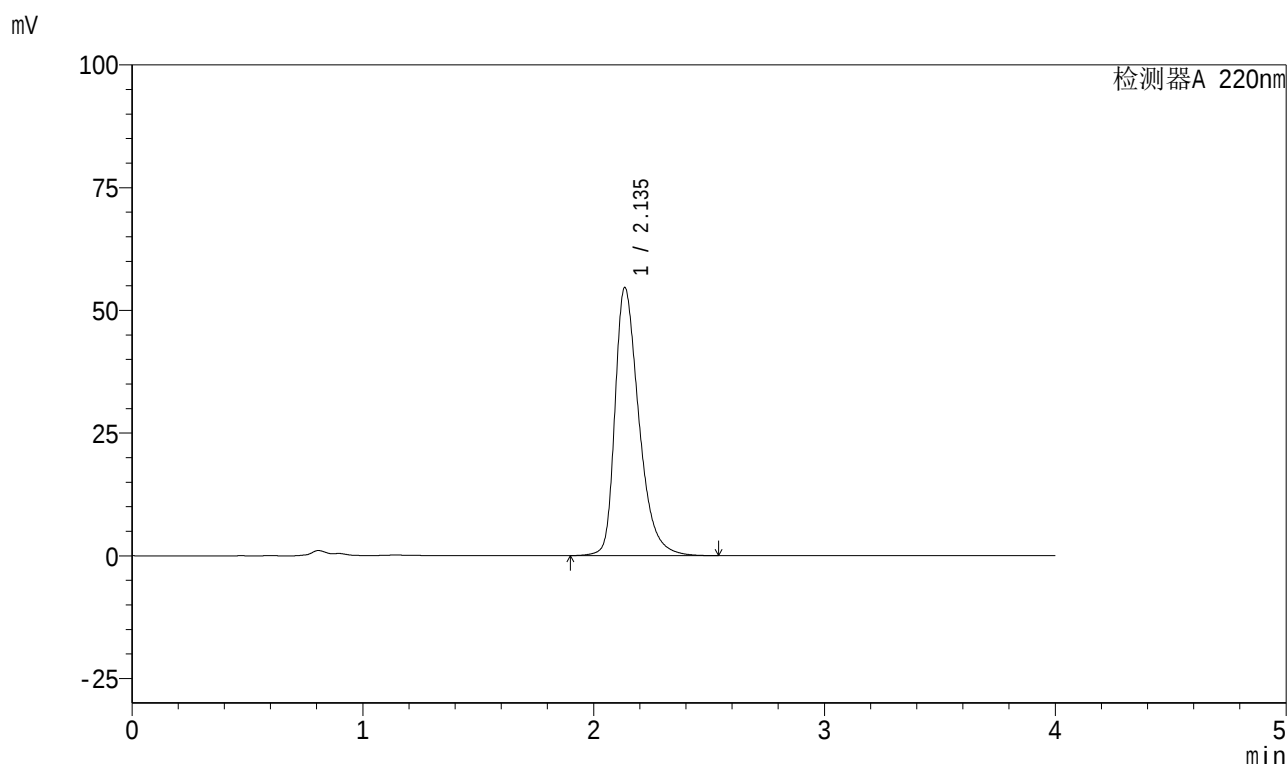

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	394638	100.000	54526	2138	1.389	--
总计		394638	100.000	54526			

图179 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-295-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 05:43:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

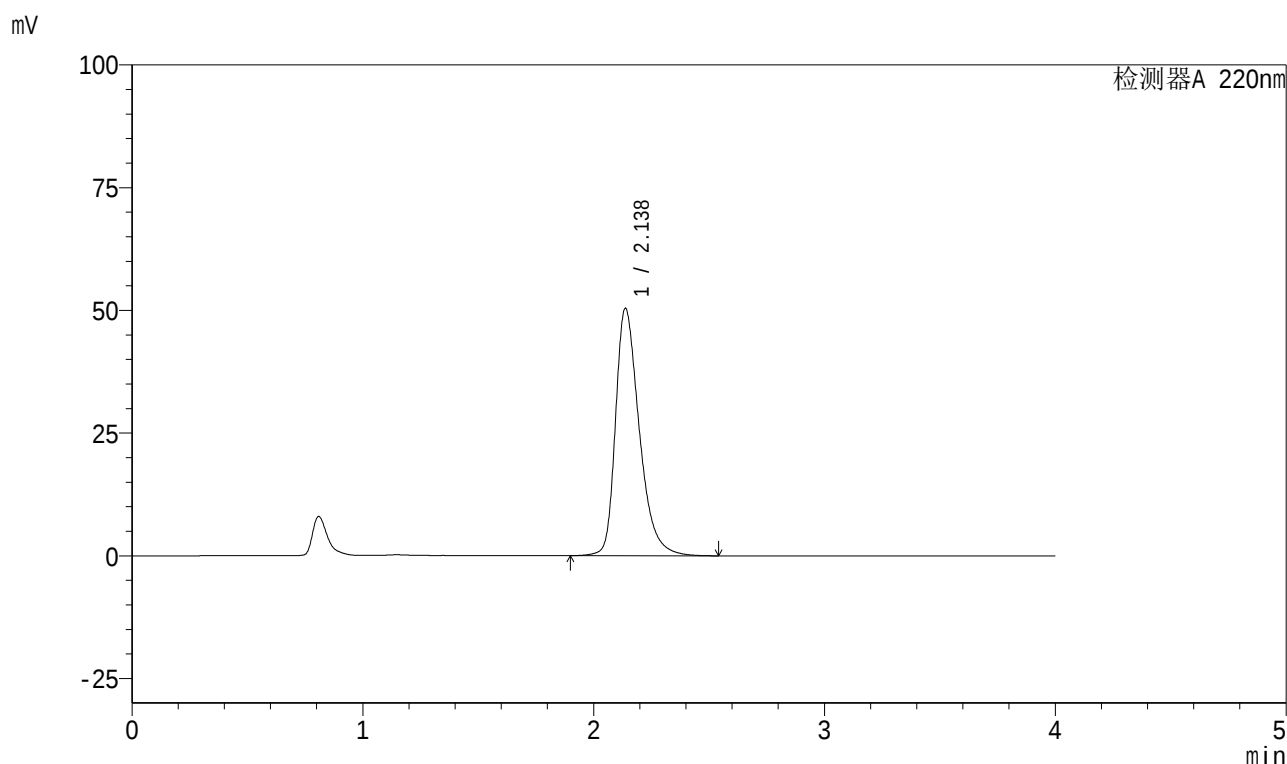

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	361597	100.000	50413	2179	1.371	--
总计		361597	100.000	50413			

图180 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-296-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:47:43 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:13 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

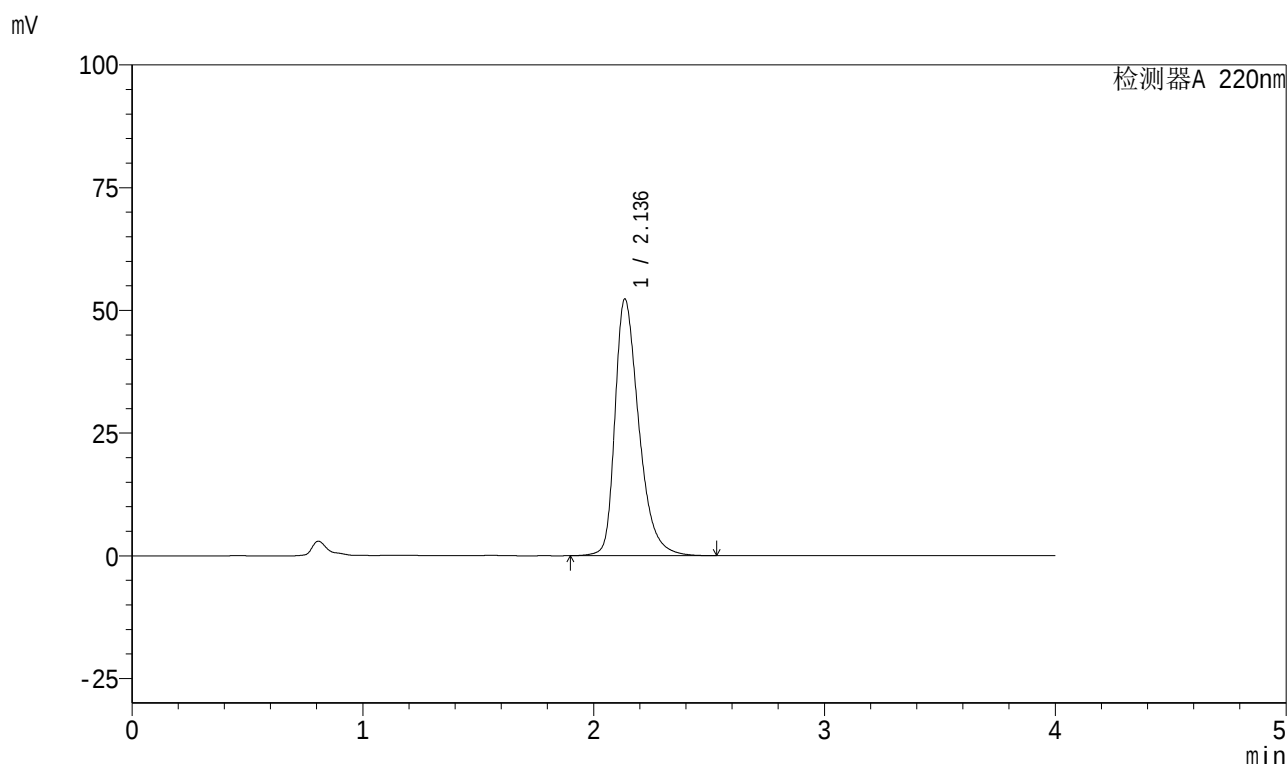

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	376582	100.000	52217	2155	1.379	--
总计		376582	100.000	52217			

图181 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-297-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 05:52:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

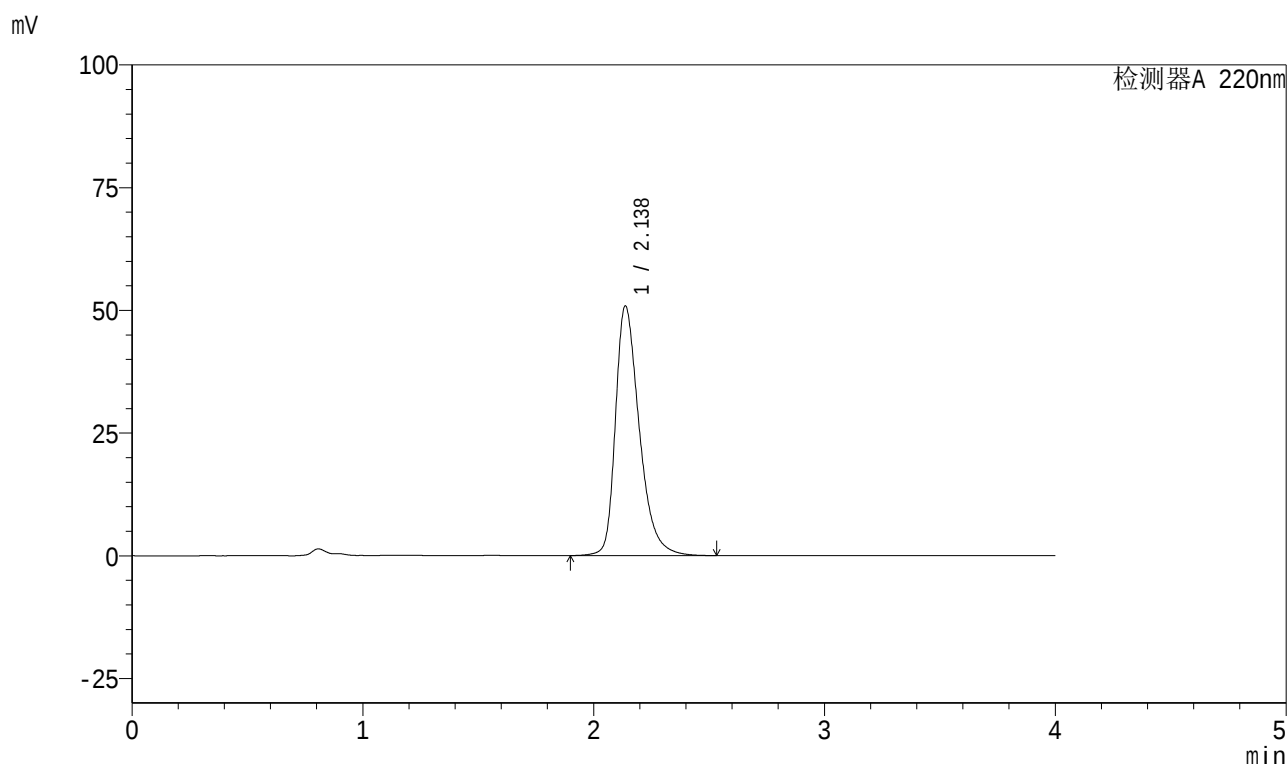

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.138	365336	100.000	50881	2174	1.372	--
总计		365336	100.000	50881			

图182 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-298-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 05:56:29
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

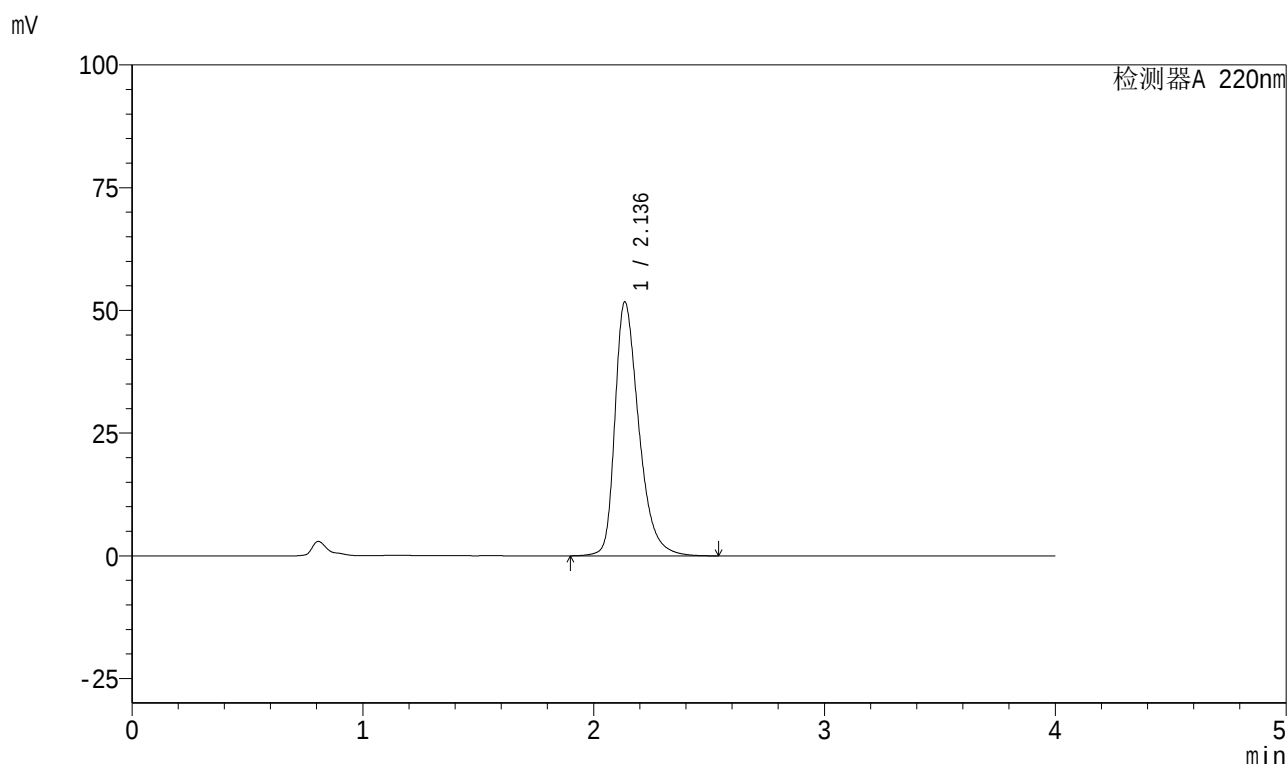

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	372169	100.000	51646	2161	1.377	--
总计		372169	100.000	51646			

图183 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-299-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10 μl
 分析时间: 2026/05/26 06:00:52
 处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:21
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

版本号:6.115
 实验者: jiangjinwei
 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

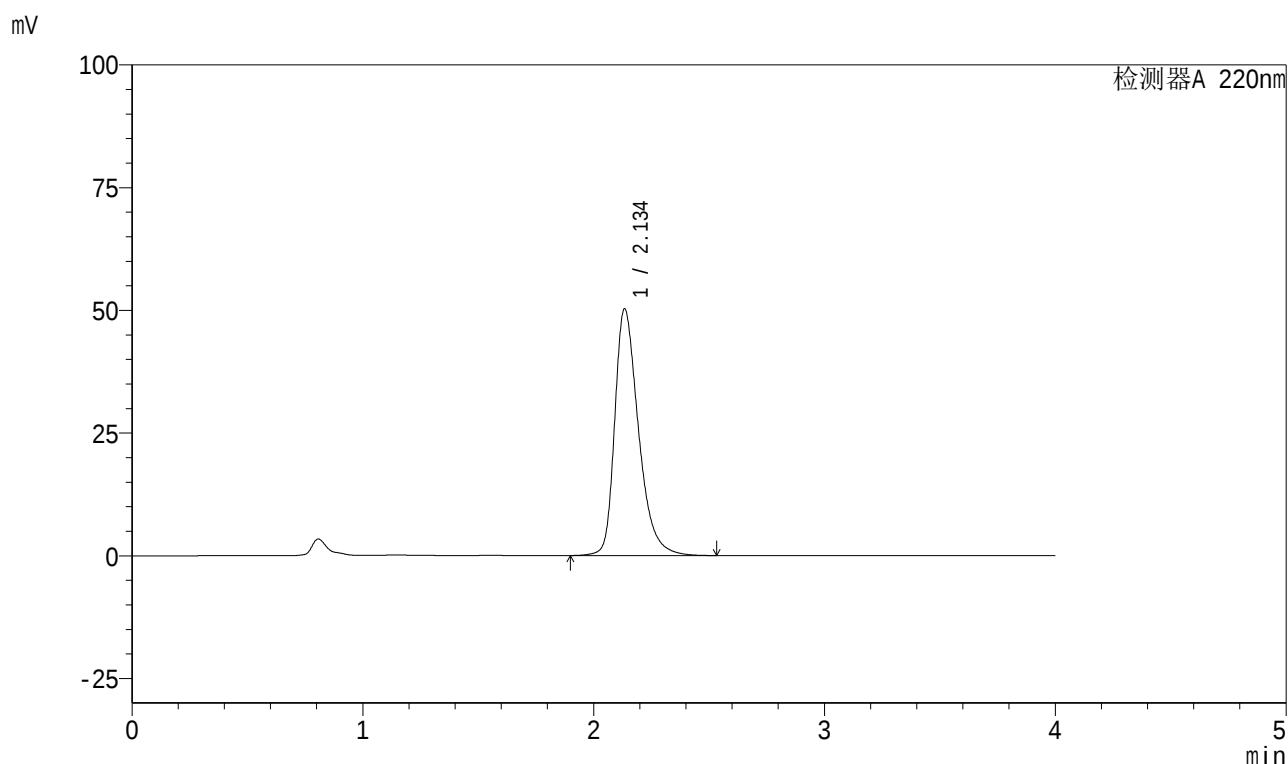

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	360543	100.000	50085	2172	1.372	--
总计		360543	100.000	50085			

图184 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-300-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 06:05:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

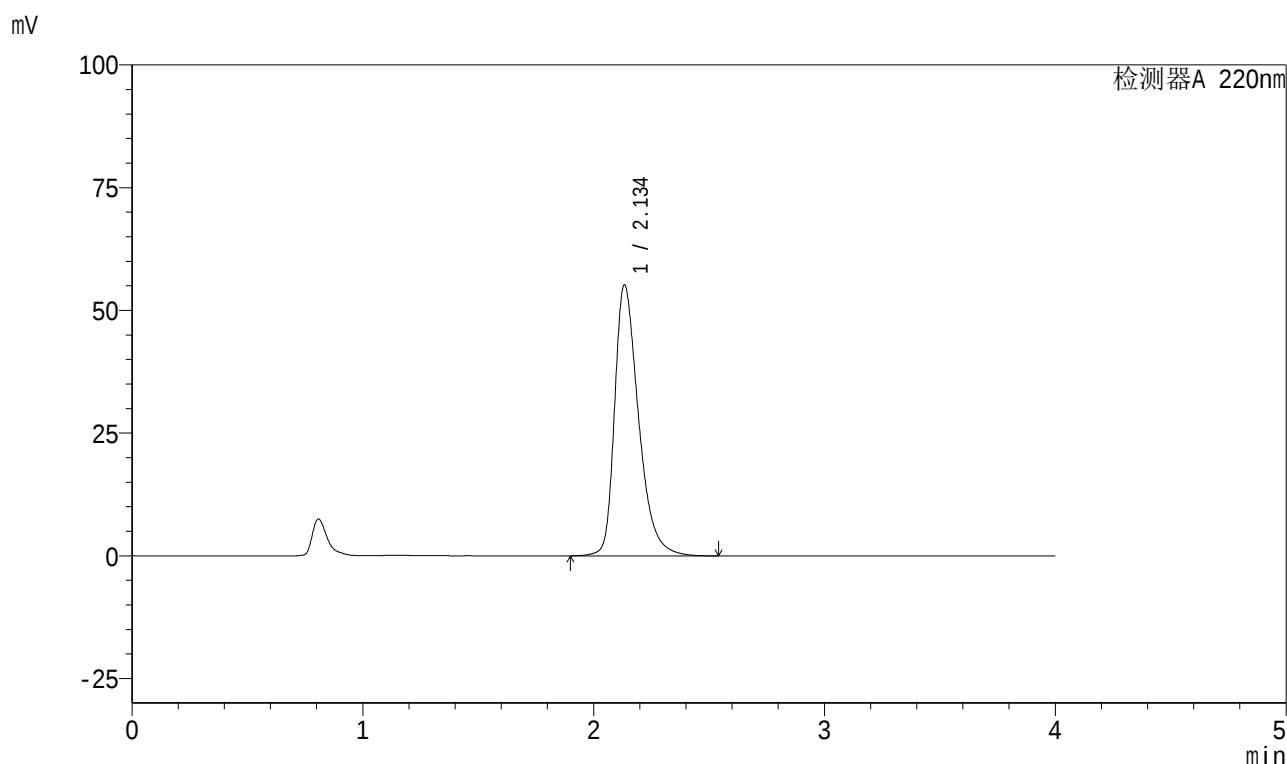

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	399195	100.000	55054	2133	1.392	--
总计		399195	100.000	55054			

图185 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-301-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 06:09:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

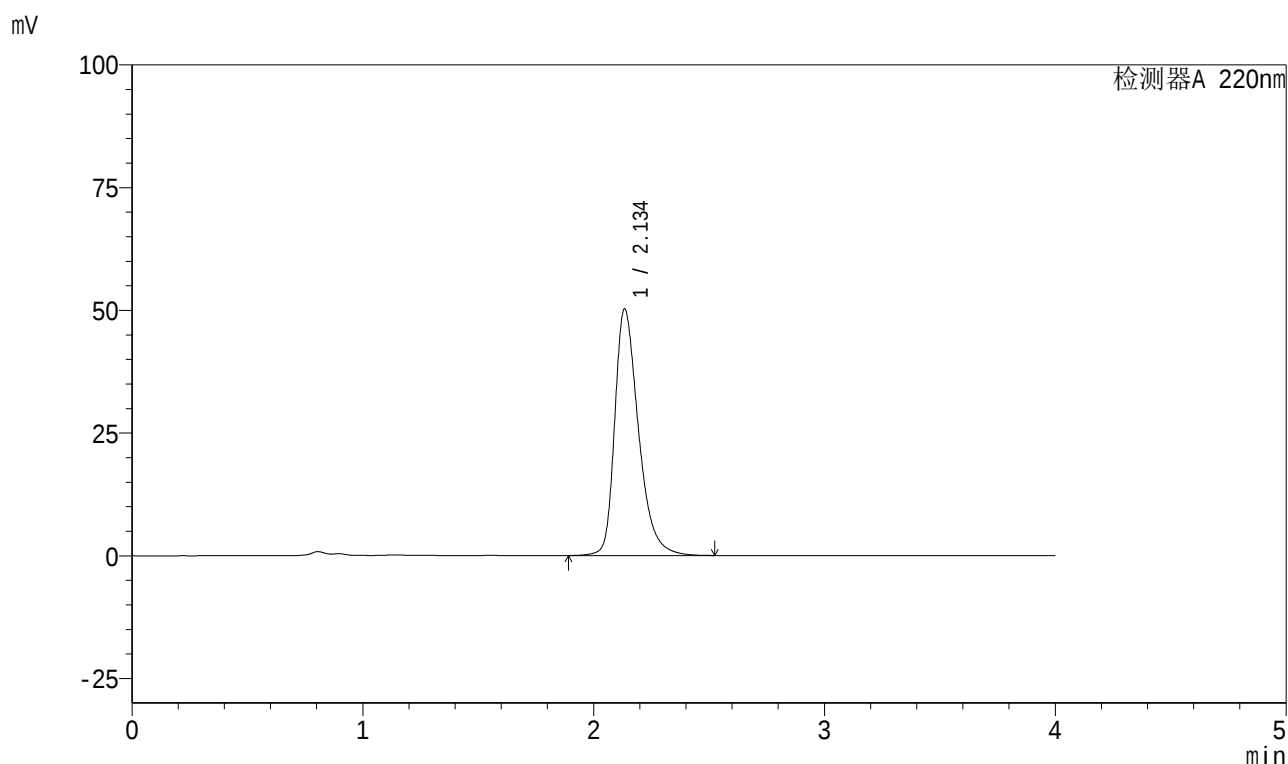

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	360088	100.000	50060	2176	1.372	--
总计		360088	100.000	50060			

图186 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-302-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:14:01 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:28 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

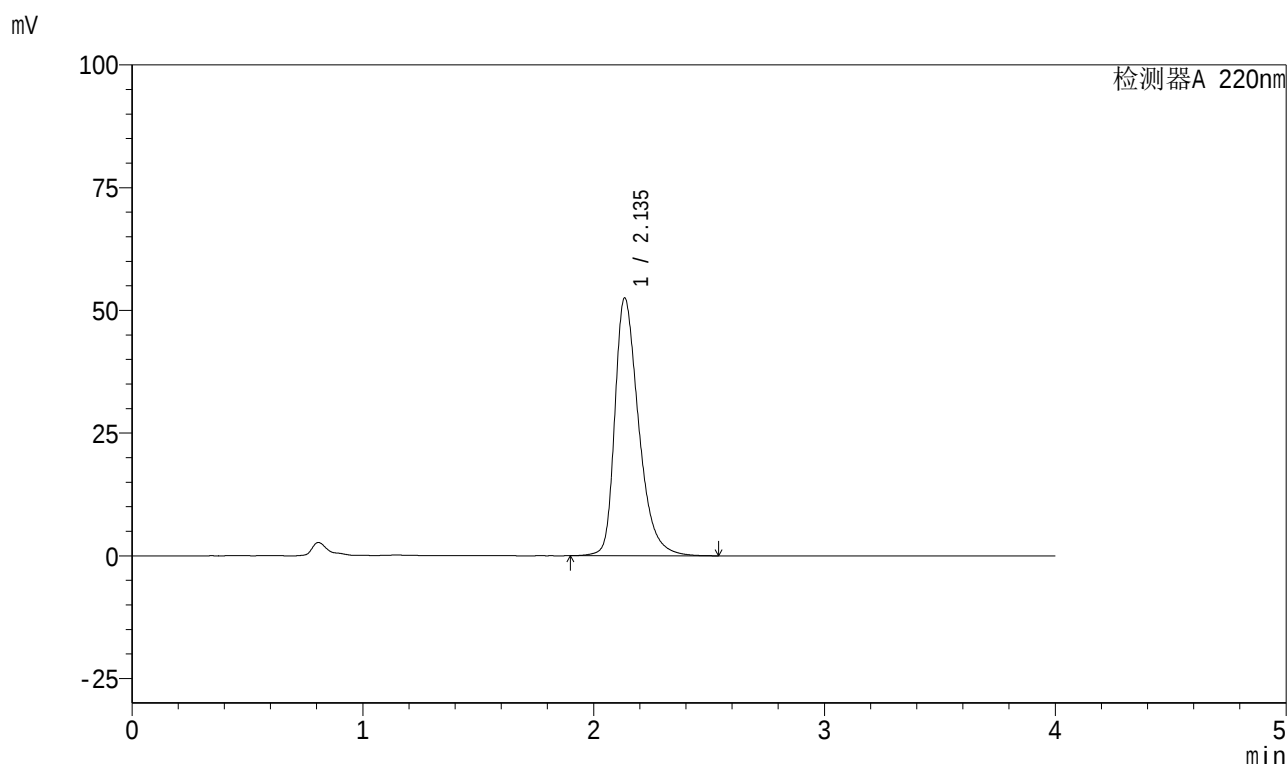

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	378064	100.000	52375	2157	1.381	--
总计		378064	100.000	52375			

图187 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-303-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:18:25 版本号:6.115
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:31 实验者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270) 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

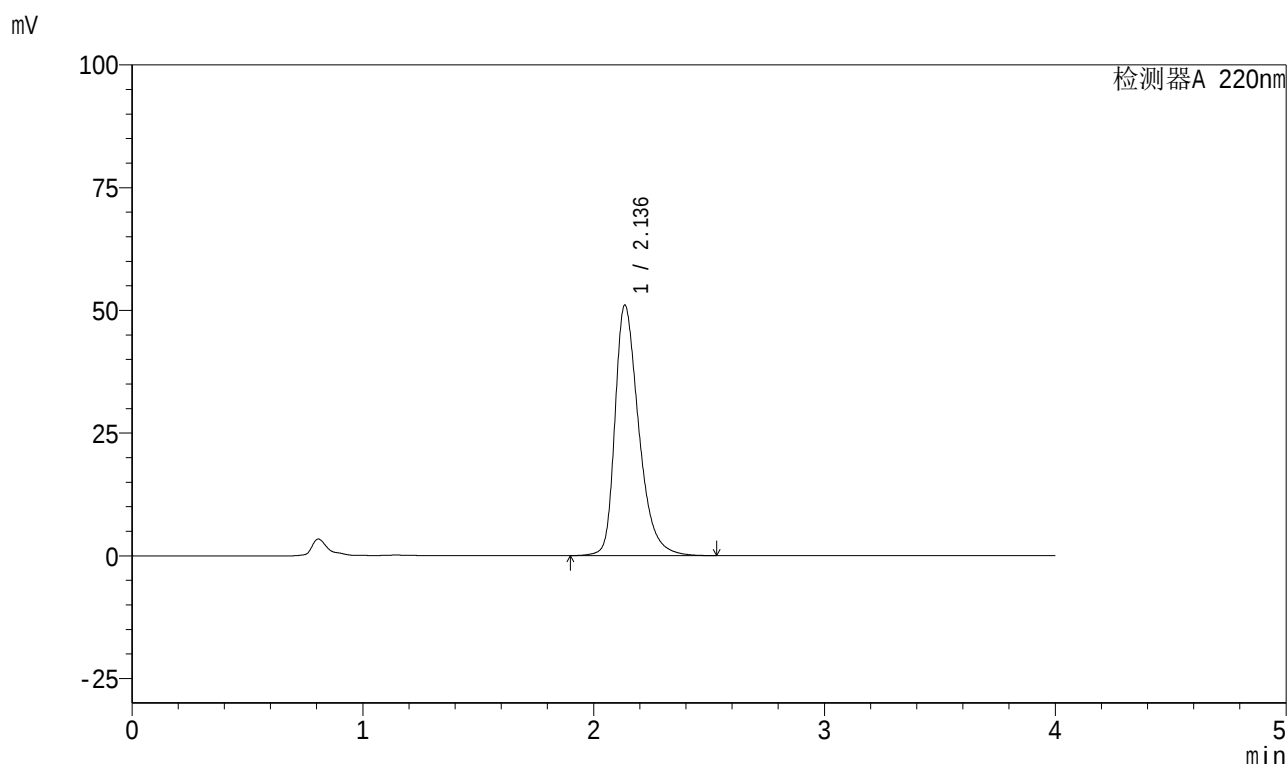

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	366538	100.000	50955	2168	1.374	--
总计		366538	100.000	50955			

图188 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-304-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:22:48
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

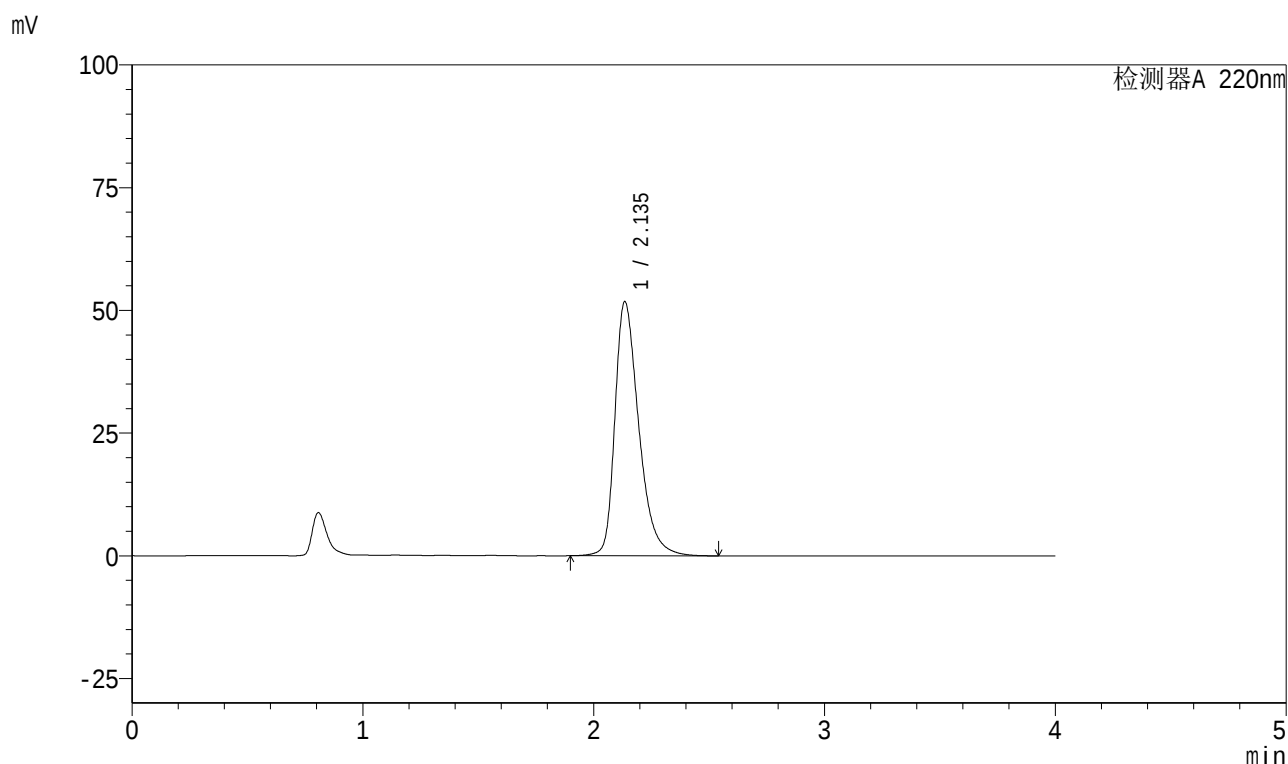

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	372733	100.000	51689	2157	1.377	--
总计		372733	100.000	51689			

图189 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-305-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 06:27:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

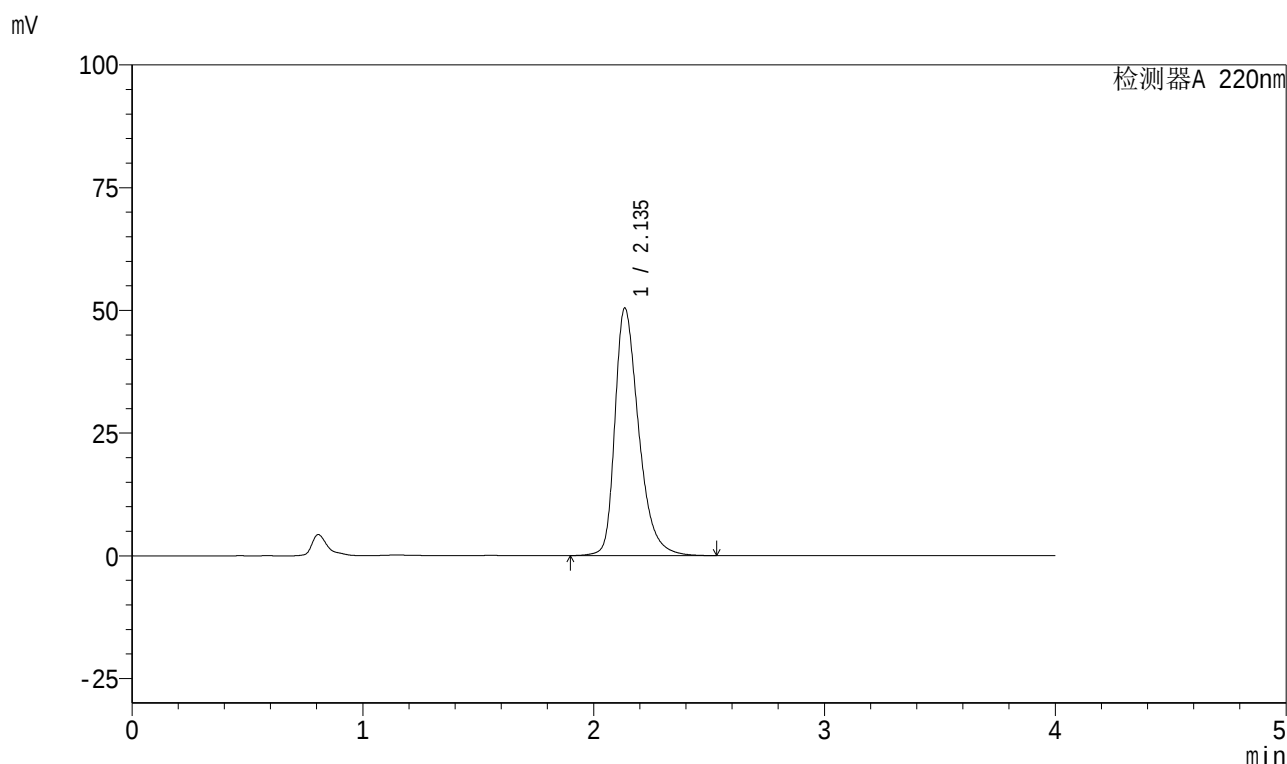

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	361669	100.000	50328	2174	1.371	--
总计		361669	100.000	50328			

图190 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-306-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 06:31:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

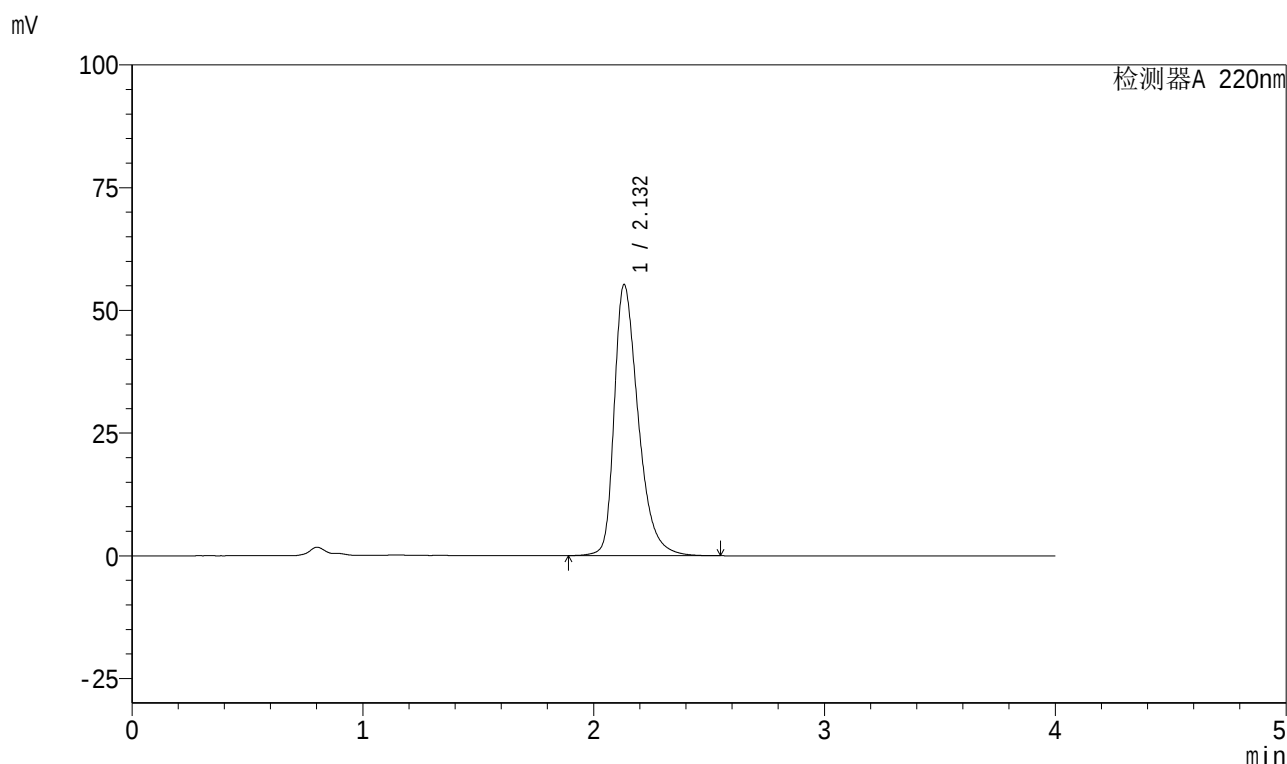

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	399298	100.000	55181	2132	1.392	--
总计		399298	100.000	55181			

图191 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-307-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 06:35:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

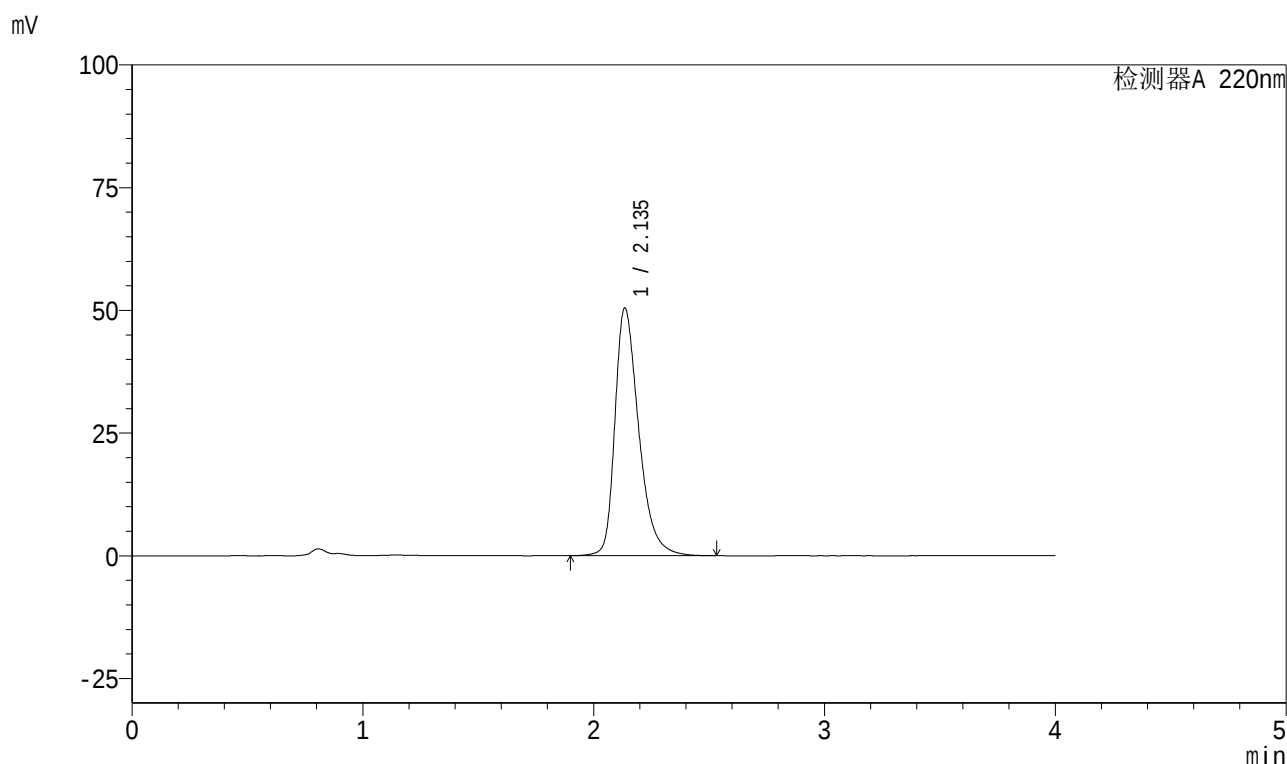

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	362388	100.000	50374	2167	1.372	--
总计		362388	100.000	50374			

图192 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-308-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 06:40:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

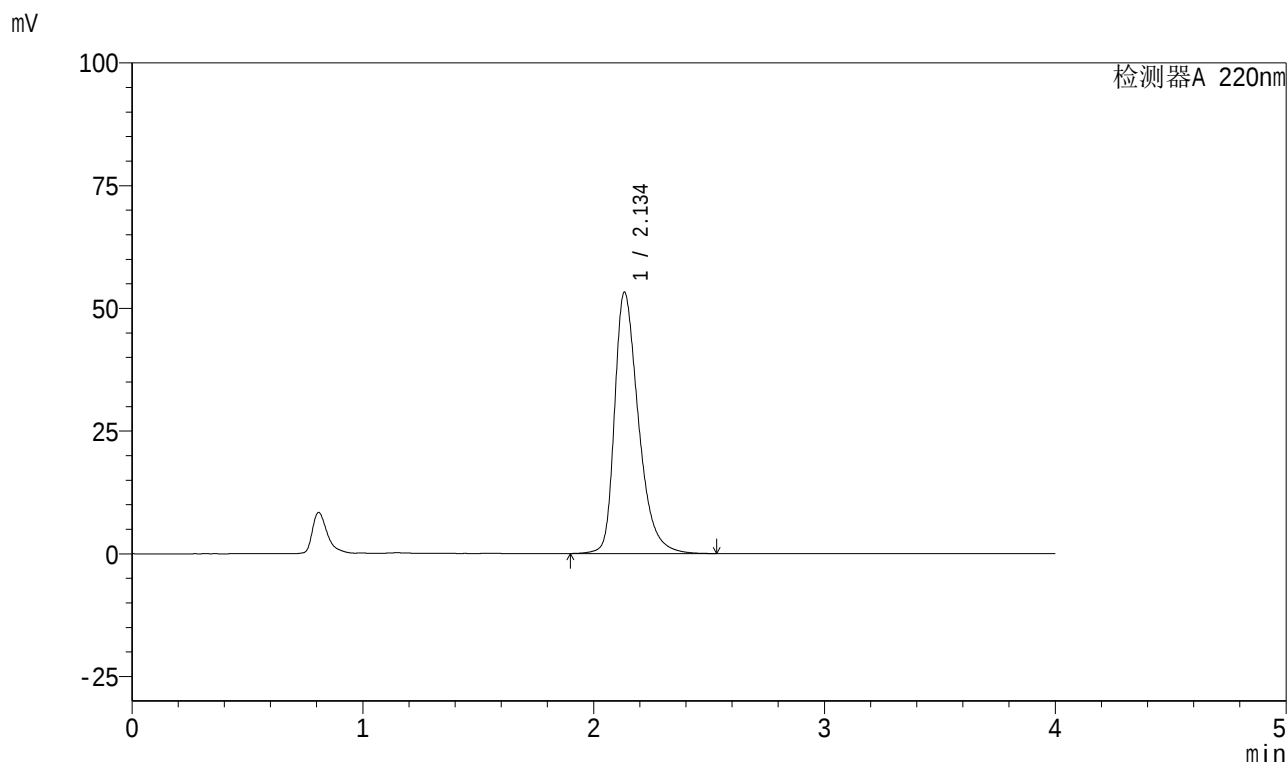

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	383679	100.000	53078	2147	1.385	--
总计		383679	100.000	53078			

图193 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-309-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:44:44
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

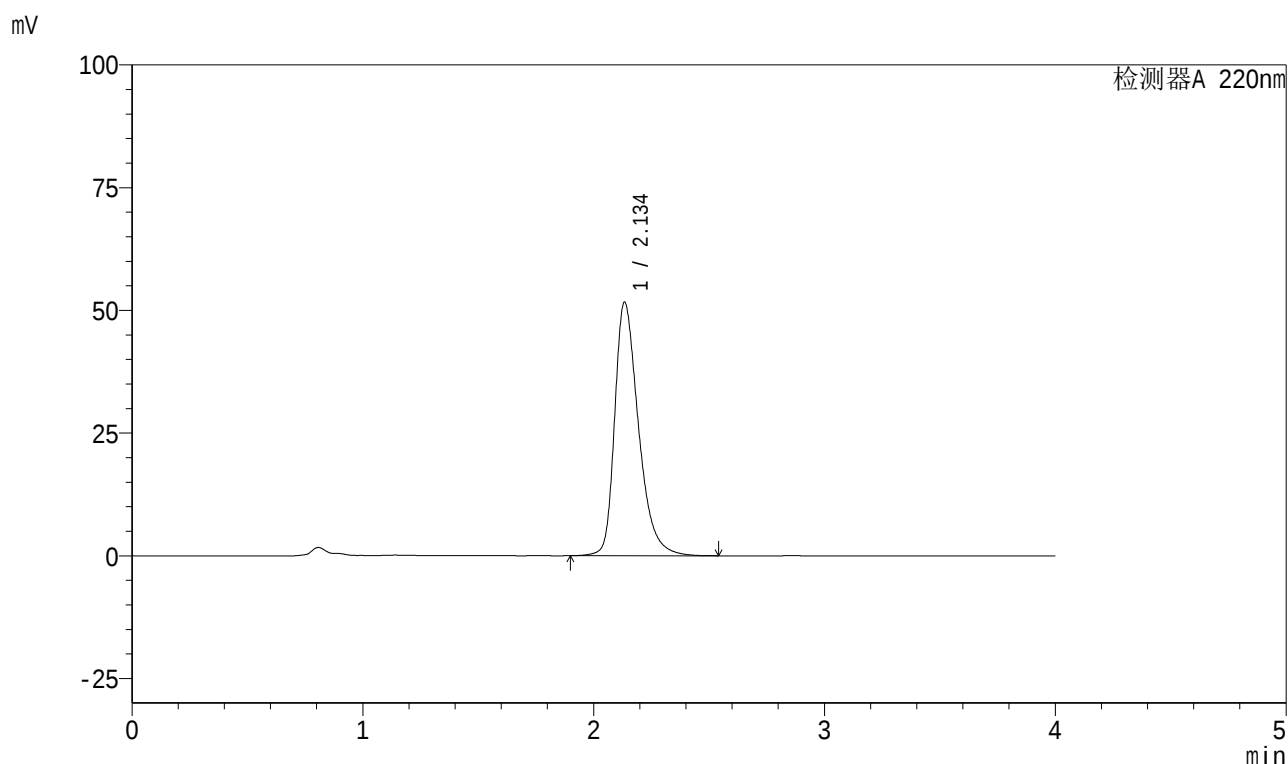

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	371318	100.000	51460	2163	1.378	--
总计		371318	100.000	51460			

图194 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-310-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:49:06
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

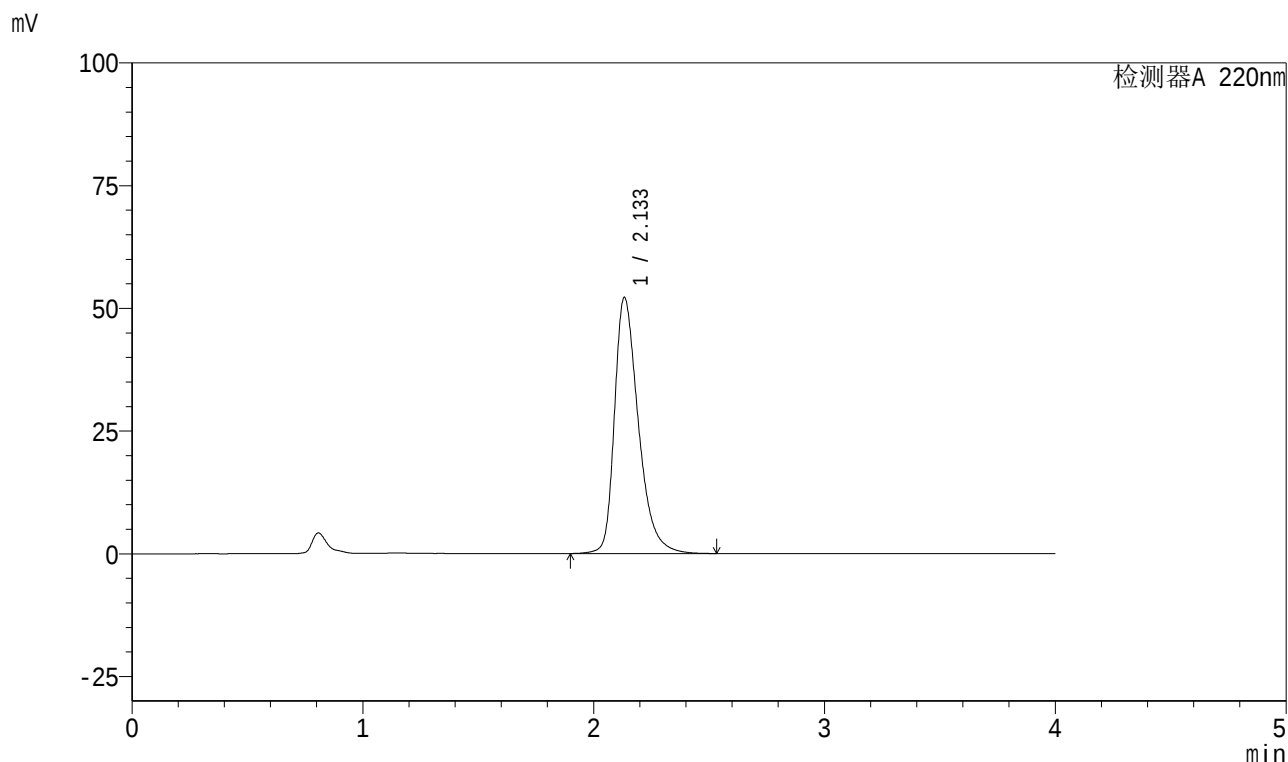

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	375382	100.000	52048	2155	1.380	--
总计		375382	100.000	52048			

图195 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-311-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:53:30
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min

波长:220nm


版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV

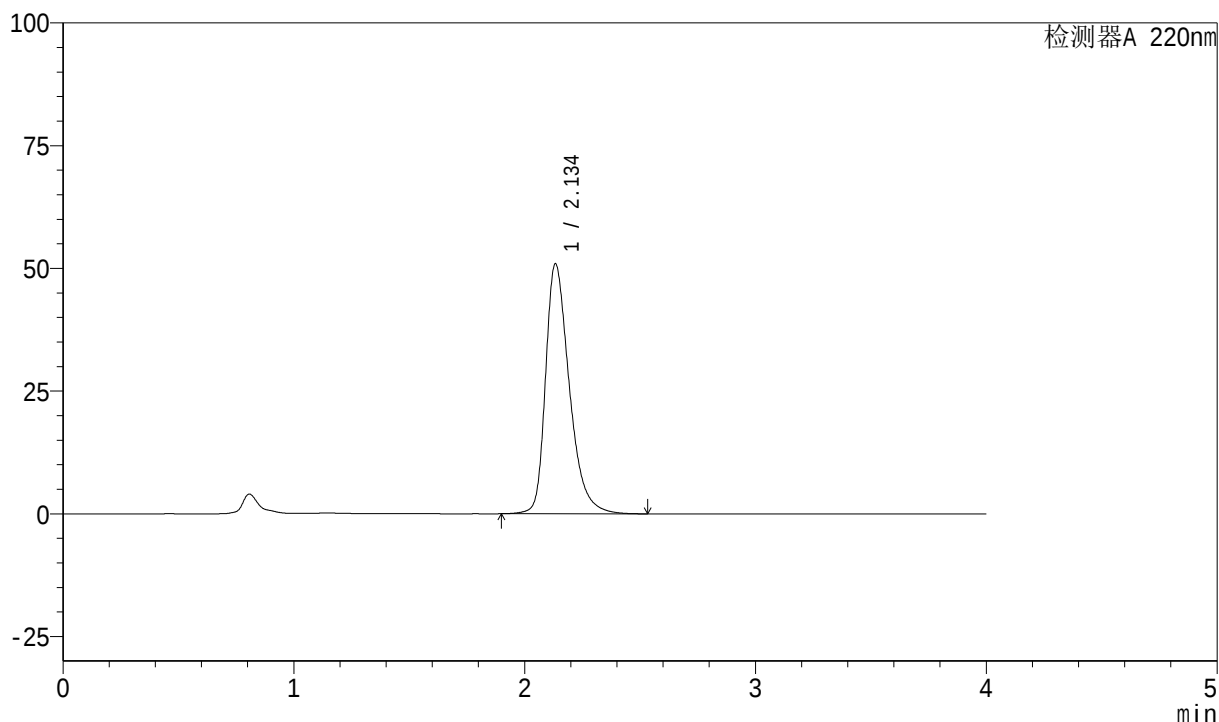

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	365558	100.000	50788	2166	1.375	--
总计		365558	100.000	50788			

图196 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-312-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 06:57:52
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

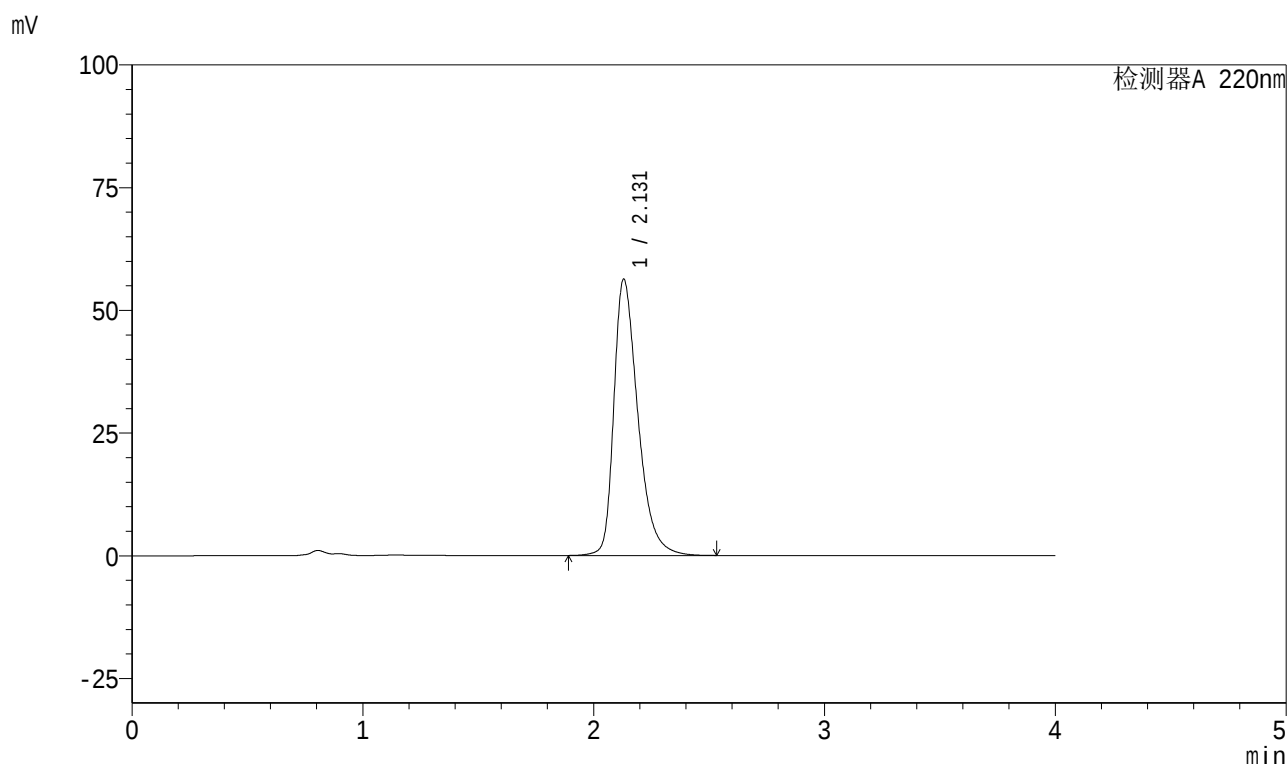

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	407358	100.000	56316	2122	1.395	--
总计		407358	100.000	56316			

图197 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-313-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l
分析时间: 2026/05/26 07:02:16
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

流速:1.0ml/min


波长:220nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

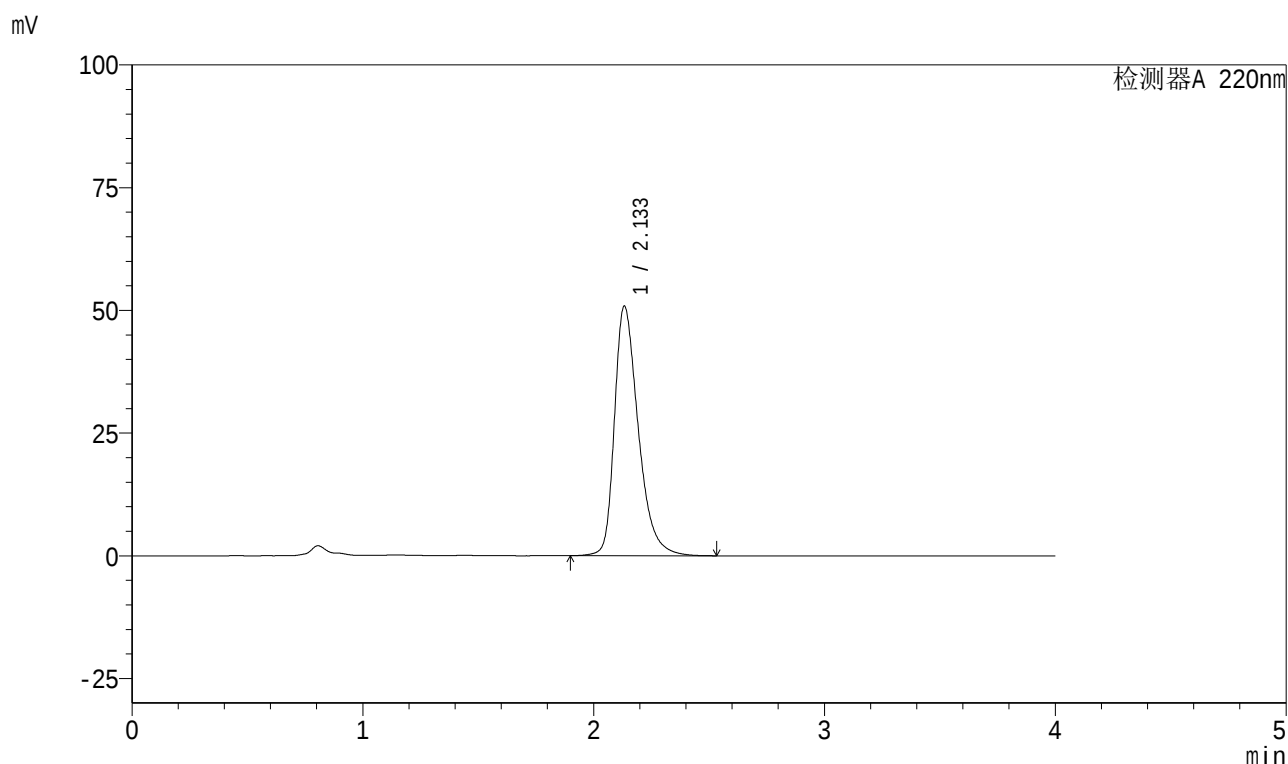

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	365023	100.000	50752	2168	1.375	--
总计		365023	100.000	50752			

图198 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-314-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 07:06:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:00:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

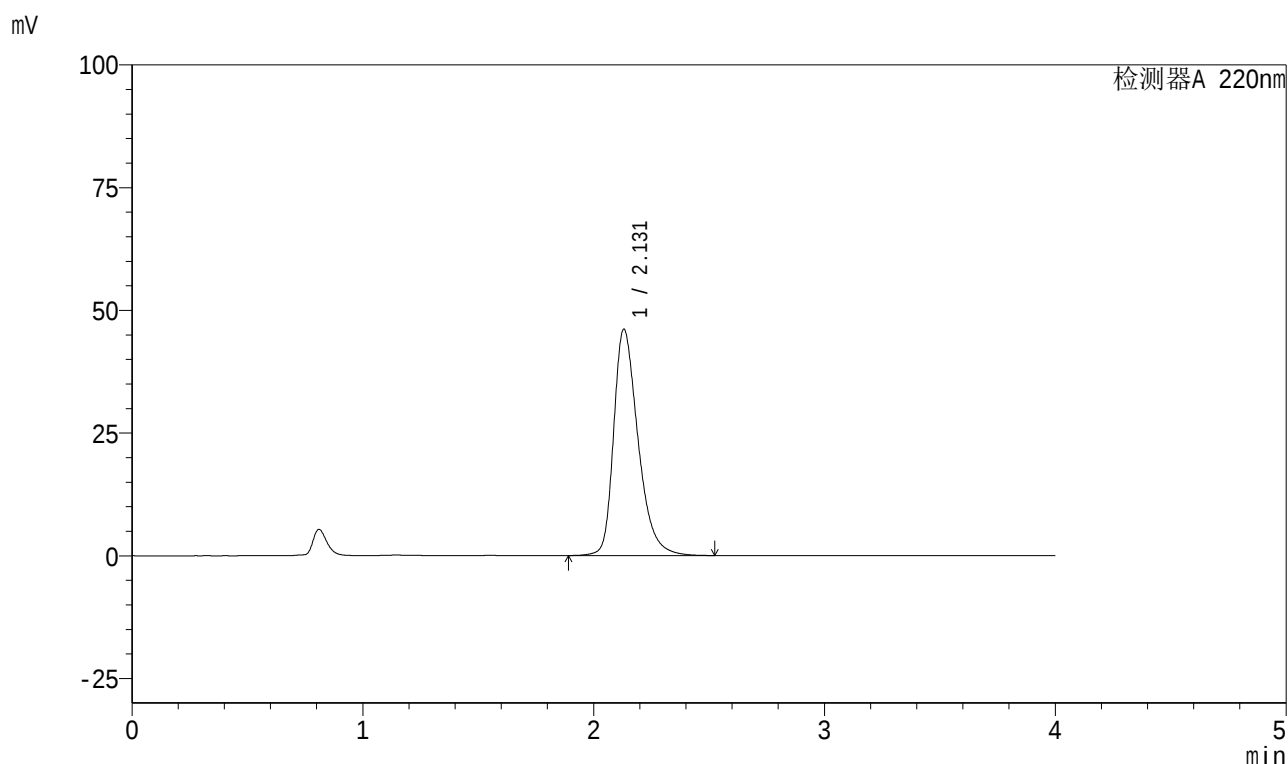

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	339312	100.000	46129	2045	1.353	--
总计		339312	100.000	46129			

图199 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




999磷酸西格列汀片

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长:220nm
数据文件名: RC\$999 - 27-67/21-315-2 - zzp-2025041211p-rcqx-100mg-pH6.8jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20260525-FX270.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2026/05/26 07:11:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2026/05/26 11:01:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX270)

<色谱图>

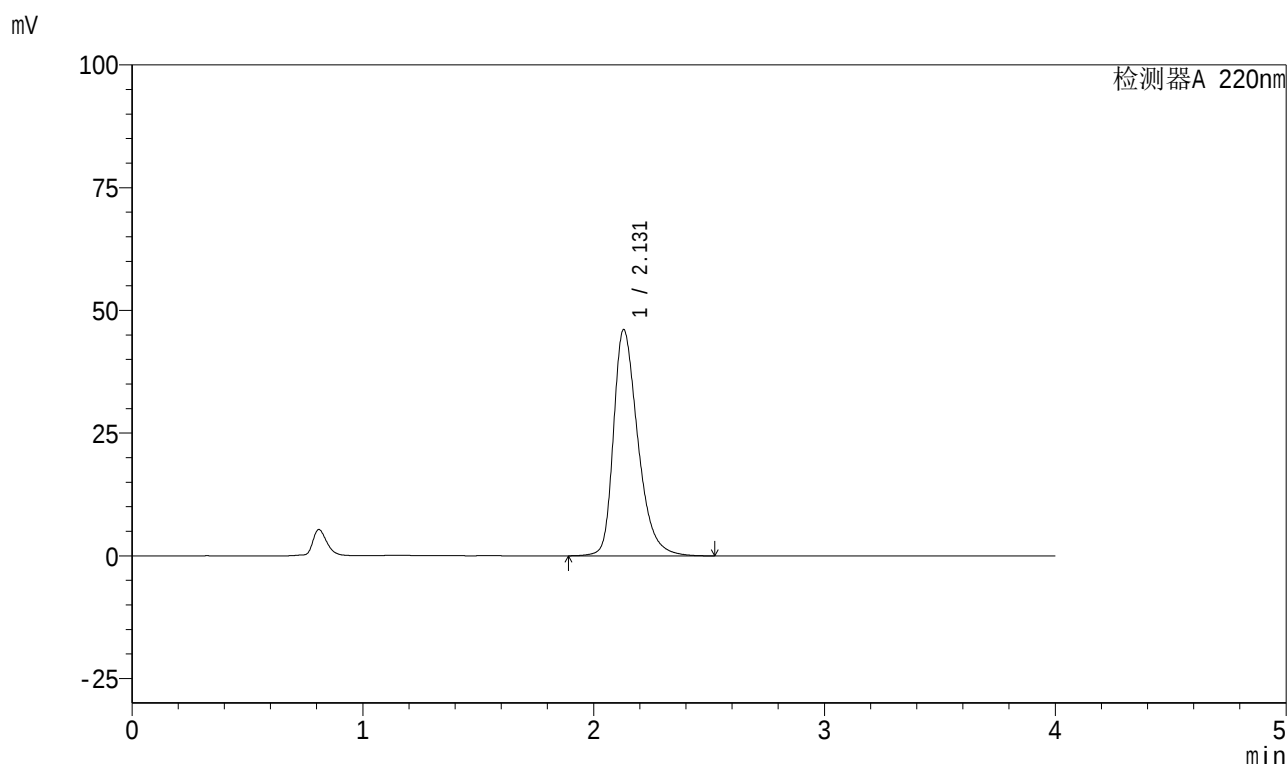

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	339415	100.000	46114	2041	1.354	--
总计		339415	100.000	46114			

图200 磷酸西格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025041211批(100mg规格)-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2